


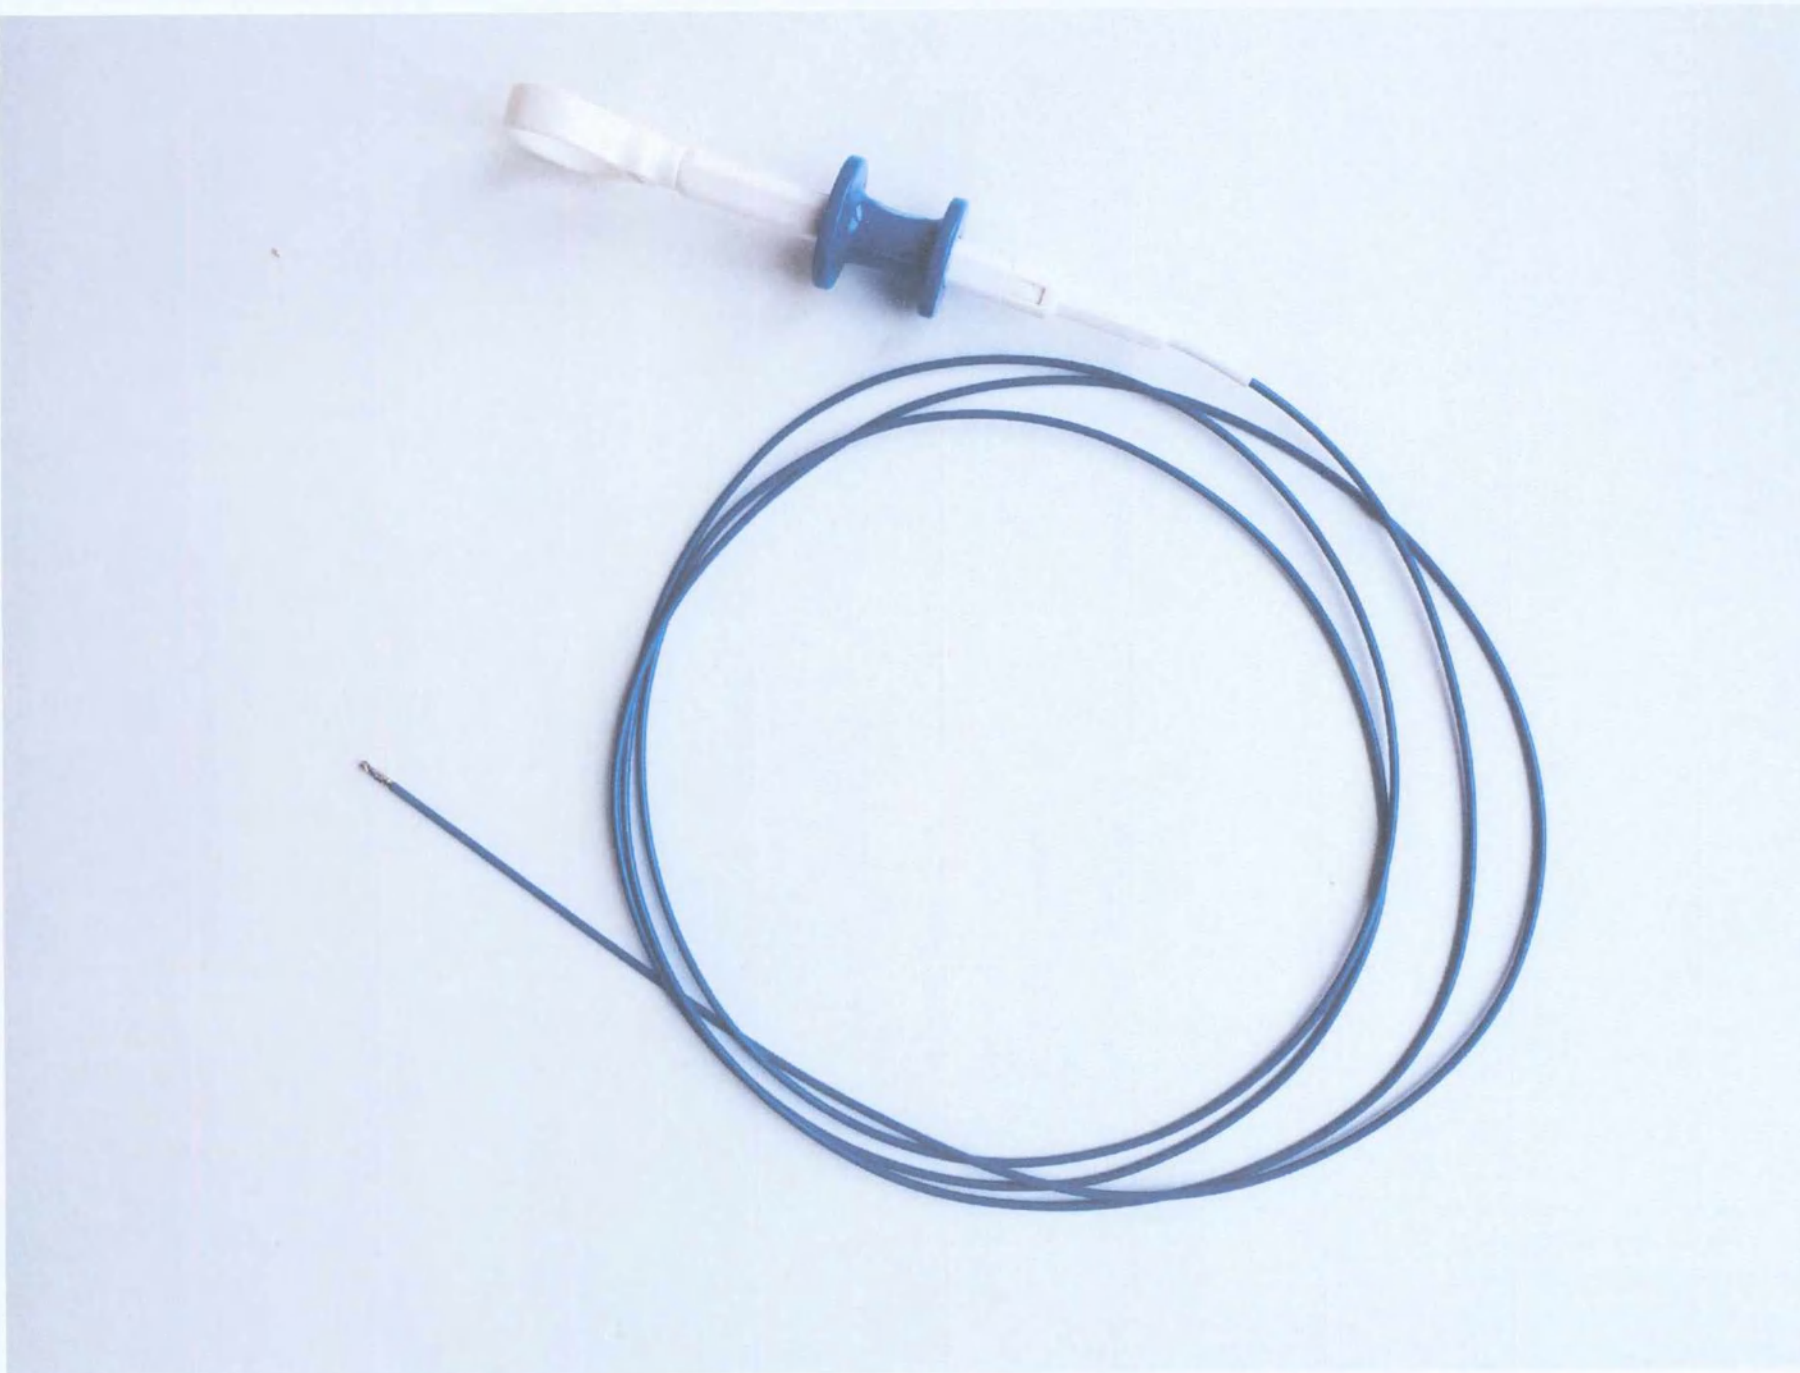

Щипцы биопсийные с овальными чашками

Щипцы биопсийные однократного применения, тип "качающиеся чашечки", с овальными чашечками, без иглы, диаметр 2,3 мм, для рабочего канала 2,8 мм, длина 180 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.13113

ЗАВ.№ 20150407/032

 2015.02 - 2017.02



EndoStars

производитель:

ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101

8 (800) 555-56-57

тел./факс: +7 (812) 600-25-26

e-mail: info@endo-stars.ru

www.endo-stars.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Щипцы биопсийные однократного применения, тип "качающиеся чашечки", с овальными чашечками, без иглы, диаметр 2,3 мм, для рабочего канала 2,8 мм, длина 120 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.13111

ЗАВ.№ 20150407/030

 2015.02 - 2017.02



EndoStars

производитель:

ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101

8 (800) 555-56-57

тел./факс: +7 (812) 600-25-26

e-mail: info@endo-stars.ru

www.endo-stars.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Маркировка (Щипцы биопсийные с овальными чашками)

Шпильки биологические одноразового применения, с овальными чашечками, с ниткой, диаметр 2,1 мм, для рабочего канала 2,4 мм, длина 180 см

Шпигли биосливные однократного применения,
с овальными чашечками, без иглы, диаметр 2,3 мм,
для рабочего канала 2,8 мм, длина 160 см
по ТУ 9431-003-89134710-2014

Шпильки биометрические одноокрастного применения, с овальными чашечками, без гильз. Диаметр 2,3 мм, для рабочего канала 2,8 мм, длина 180 см

APT 9437.12113
3AB.Nº 20150407/022

APT 9437.12116
3AB.Nº 20150407/025

APT 9437.12117
3AB № 20150407/026

 2015.02 - 2017.02



EndoStax

2015-02 - 2017-02

DOCTOR/PHYSICIAN

CCC, CMG, CCRP
Norman University 27th
Fellowship
Fellow, ISCT/ISCT
Fellow, ISCT/ISCT

8 800.555.56.57
www.endo-stax.com
info@endo-stax.com
www.endo-stax.com

EndoStats

Office: 904.944.9910
DOC: 1-800-CHOC
Katherine Mendenhall, PhD
Cancer: 704.944.9910
Phone: 904.910

8:00-5:00 PM
www.choc.org
tel: 904.910.2526
e-mail: info@choc.org
www.choc.org

2015.02 - 2017.02

11

2

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений ламинации. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Неприменяется инструмент при наличии повреждений
ушиков. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Шпильки биосильные однократного применения,
с овальными чашечками, без иглы, диаметр 2,3 мм,
для рабочего канала 2,8 мм, длина 120 см

Шпильки биосилициновые однозарядного применения, с овальными чашечками, без гильз, диаметр 2,3 мм, для рабочего канала 2,8 мм, длина 300 см

Штифт биосигнальный однократного применения, с овальными цапками, без илты, диаметр 2,3 мм, для рабочего канала 7,8 мм, длина 260 см

APT 9437.12115
3AB.Nº 20150407/024

APT 9437.12120
3AB.Nº 20150407/029

APT 9437.12119
3AB.Nº 20150407/028

EndoStats

Information from:
DCCO Health Capital
Bismarck Boulevard 17A
Malloryville, 21072-0015, NE
email: info@endo-stats.com

1 800-333-5847

2015.02 - 2017.02

1

2

EndoStats
 2015-02-2017-02
 11
 2

[illegible]

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии перчаточной рукавицы. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению.

Не рекомендуется использовать при наличии повреждений
указов. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению!

He possesses the necessary information to answer your queries regarding the various types of information needed to obtain a passport, and is prepared to provide you with the necessary information.

Щипцы биомеханические однократного применения, с овальными чашечками. Без иглы. Диаметр 2,3 мм, для рабочего канала 2,8 мм, длина 230 см

идентифицировать одноокрастного протоменина, тип "качалочка" (чаще всего с овальными чашечками, без илти, диаметр 2,3 мм, для рабочего канала 2,8 мм, длина 160 см

Штандлы ополаскиватели одноразового применения, тип "качающийся чашечкой", с овальными чашечками, без илгип, диаметр 2,3 мм, для рабочего канала 2,8 мм, длина 230 см

APT	9437.12118
3AB.Nº	20150407/027

APT 9437.13112
3AB.Nº 20150407/031

APT 9437.13114
3AB No 20150407/033

EndoStats

2015-02 - 2017-02

DOO: Chelbi Chiriac
Doina Maria 17A
Chelbi Chiriac
Bucuresti 071071

0000 115-56-67
info@endo-stats.ro
endo@endo-stats.ro
www.endo-stats.ro

 2015-02-2017-02  

EndoStats
by EndoStat

0000 Chapel Circle
 Bethesda, Maryland 20814
 Contact: 703/993-1511
 Fax: 703/993-1511

818.61.5544-44-57
 mail@endo-stats.com
 or email info@endo-stats.com
 www.endo-stats.com




 Mailing label with date 2015-02-20 17:02, address 1000 N. 11th St, Phoenix, AZ 85001, and phone 602-442-1111.

He pishcheyetsoy i spichalnoy ispiyemoy pishcheye moyzhe
ynachit. Tipichnoy pishcheye moyzhe byt' osnovechnoy
s pishcheyem po pishcheyem.

He presentava-se como jovem, de "pauzete" (ou talvez não),
gracioso. Tinha acentuação e uma maneira de falar
e psicológica no momento.

The present authors are aware that the present paper contains several inaccuracies and omissions. They are sorry for this and hope that the present authors will be able to publish a corrected version of the paper in the near future.

Щипцы биопсийные однократного применения, с овальными чашечками, с иглой, диаметр 2,5 мм, для рабочего канала 2,8 мм, длина 120 см
по ТУ 9431-003-89134/710-2014

Штипы оловянистые одноократного применения, с овальными чашечками, с игой, диаметр 2,5 мм, для рабочего канала 2,8 мм, длина 160 см

Щипцы биологические однокоранного применения,
с овальными чашечками, без иглы, диаметр 2,5 мм,
для рабочего канала 2,8 мм, длина 160 см

APT 9437.13217
3AB.Nº 20150407/044

APT 9437.13218
3AB.№ 20150407/045

APT	9437.13116
3AB.Nº	20150407/041

EndoStax

ООО «Эндостакс»
Бизнес-Квартал 27А
Саларийный проезд, 18/1101
Москва, 1251101

Тел: 8 (800) 555-56-57
Факс: +7 (812) 000-25-26
e-mail: info@endo-stax.ru
www.endo-stax.ru

М 2015-02 - 2017-02

2

EndoTrace

©2006 Endo Corporation
Boston, MA 02128
www.endo.com
1-800-345-5637
#BX01155-56-57
www.endo.com
e-mail: info@endo.com
www.endo.com

Endogates

representatives:
OOO «Endo Gate»
Koshaka Akira-mae 27A
Chuo-ku, Chiyoda-ku
Tokyo, 100-0001
Japan
Tel: +81-3-555-54-57
Fax: +81-3-555-92-26
E-mail: info@endo-gates.jp
www.endo-gates.jp

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению.

Не рекомендуются использовать инструмент при наличии повреждений
указов. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению!

с руководством по применению

Щипцы биопсийные однократного применения,
с овальными чашечками, без иглы, диаметр 2,5 мм,
для рабочего канала 2,8 мм, длина 180 см

Щипцы биосигнальные одноразового применения, с овальными чашечками, без иглы, диаметр 2,5 мм, для рабочего канала 2,8 мм, длина 120 см
по ТУ 9431-003-89134710-2014

Щипцы биоскопические однократного применения, с овальными чашечками, без иглы, диаметр 2,5 мм, для рабочего канала 2,8 мм, длина 230 см

APT	9437.13117
3A8.Nº	20150407/042

APT 9437.13115

APT 9437.13118
3AB.Nº 20150407/043

 2015-02 - 2017-02


10000 115-06-57
 10000 115-06-57
 10000 115-06-57
 10000 115-06-57
 10000 115-06-57

 2015.02 - 2017.02



EndoGates

aprendizagem
OOO + 3600 73000
Rimosa Alameda 214
Cidade - Curitiba/PR
Fones: 327.1071

8 (800) 333-54-57
fax: (41) 212-600-21-26
e-mail: info@endo-gates.it
www.endo-gates.it

2015.02 - 2017.02

1

2

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений улавливателя. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению.

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной или отсутствующей изоляции. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

те презентации используются инструменты при наличии соответствующей усадки. Тесты используются независимо от количества элементов с функциями по применению.

Штипы оцинкованные двужыральные применения, с овальными чешуйками, без иголки, диаметр 1,8 мм, для рабочего канала 2,0 мм, длина 180 см

Щипцы биологические одноразового применения, с овальными чашечками, с петлей, диаметр 1,8 мм, для рабочего канала 2,0 мм, длина 120 см

Шлипы биотинирующие однократного применения, с овальными чашечками, без иглы, диаметр 1,8 мм, для рабочего канала 2,0 мм, длина 160 см

APT 9437.11123
3AB № 20150407/066

APT **9437.11219**
3AB № **20150407/069**

APT 9437.11122
JAB No 20150407/065

 2015-02 - 2017-02
 

EndoStats
Endometriosis Statistics

www.endostats.org
 2005 - 2010
 2011 - 2014
 2015 - 2017
 2018 - 2020


800.333.5545
 415.333.5545
 415.333.5545
 415.333.5545



EndoStar

10001 Judd Creek
Bromfield, Oregon 97108
Crest Medical Center
Tel: 503/255-5643
Fax: 503/255-5236
E-mail: info@endo.com

© 2015 Endo Inc.



 2015 02 - 2017 02

Не предусматривается использование инструментов при наложении повязочного устройства. Перевод вертикального метода наложения повязки осуществляется с помощью лент по направлению:

He промывался водой, а потом при нахождении нарядовых уличных. После происшествия немедленно обратились к врачам, которые поставили диагноз: «мозговая кома».

в промышленности и коммунальном секторе отходы не подлежат повторному использованию. Поэтому необходимо широко использовать биотехнологии

Шпильцы биотиссивные однократного применения, с овальными чашечками, с иглой, диаметр 2,5 мм, с рабочим каналом 2,8 мм, длина 230 см

no TY 9431-003-89134710-2014

Щипцы биопсийные однократного применения, с овальными чашечками, с иглой, диаметр 2,5 мм, для рабочего канала 2,8 мм, длина 180 см

no TY 9431-003-89134710-2014

Шпильцы биоспецифичные однократного применения, с овальными чашечками, без иглы, диаметр 1,8 мм, для рабочего канала 2,0 мм, длина 280 см

no TY 9431-003-891 34710-2014

APT	9437.13220
3AB.Nº	20150407/047

MM 2015.02 - 2017.02

EndoStarz

TYPE: INCUBATOR
DOO • Phas C/Oasis
Ermawati Mawarnita 27A
Caret / Rhyndor
Poccan 87101

8 1800 555-56-67
Tel/Fax: +7 3112 600-25-26
e-mail info@endo-star.ru
www.endo-star.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии порезов, ушибов. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Шпильки биопсийные однократного применения, с овальными чашечками, с иглой, диаметр 2,3 мм, для рабочего канала 2,8 мм, длина 230 см

no TY 9431-003-89134710-2014

APT 9437.13214
3AB.Nº 20150407/037

2015.02 - 2017.02

EndoStarz

10000 Highway 100
Boulder, Colorado 80501
Phone: 303.440.1100
Fax: 303.440.1101
www.endostarz.com

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Шпильки биоспиральные однократного применения, с овальными чашечками, с жилой, диаметр 2,3 мм, для рабочего канала 2,8 мм, длина 160 см

NO TY 9431-003-89134710-2014

APT	9437.13212
3AB.No	20150407/035

2015.02 - 2017.02

Endoglyasts
 Reprogramming
 (OO) + Adult Cells
 Molecular Biology 21A
 Cancer Therapy
 Focus 15710
 8 800 335 56 57
 www.ooi.com
 1 800 335 56 57
 e-mail: info@ooi.com
 www.ooi.com

На протяжении многих лет мы сотрудничаем с вами и благодарим за оказанную помощь. Предлагаем рассмотреть возможность сотрудничества с производством по проекту:

APT 9437.13216
3AB.Nº 20150407/039

2015.02 - 2017.02

EndoStarz

Information:
OOO 414-600-5463
EndoStarz, Inc. 214
Crestview Plaza
Piquette, MI 48675

800 555-5463
www.endo-starz.com
e-mail: info@endo-starz.com
www.endo-starz.com

Не рекомендуется использовать при наличии повреждений у пациента. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Шпильки биоспиральные одноократного применения, с овальными чашечками, с шпилькой, диаметр 2,3 мм, для рабочего канала 2,8 мм, длина 120 см

no TY 9431-003-89134710-2014

APT 9437.13211
3AB.Nº 20150407/034

MM 2015.02 - 2017.02

EndoStats
STATISTICS
FOR
ENDOCRINOLOGY

SPONSORSHIP:
OOO + Single Checks
Business Inquiries: 734
Crest Drive/400
Plymouth, MI 48175

8 000 351-56-51
www.ooos.com
e-mail: info@ooos.com
www.ooos.com

He proved that the action of the operator T on the space $L^p(\mathbb{R}^n)$ is bounded if and only if $p \in [1, \infty)$. The operator T is called the Riesz potential of order α . The operator T is called the Riesz potential of order α if $\alpha \in (0, n)$ and $p \in [1, \infty)$. The operator T is called the Riesz potential of order α if $\alpha \in (0, n)$ and $p \in [1, \infty)$.

APT	9437.13213
3AB.Nº	20150407/036

MM 2015.02 - 2017.02

EndoStarz

Specialists in:
OOO - Abused Children
Domestic Violence - 27A
Child Abuse/Neglect
Foster Care, 1827(1)

800-315-54-57
toll-free: 1-877-803-25-50
e-mail: info@endo-starz.com
www.endo-starz.com

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений улавливателя. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Шпатель биопсийный однократного применения, с овальными чашечками, с иглой, диаметр 2,3 мм, для забора канала 2,8 мм, длина 280 см

MO TY 9431-003-89134710-2014

APT 9437.13215
3AB.Nº 20150407/038


2015.02 - 2017.02

EndoTraz

Information:
000 x 6400 7090
Bologna Marzotto 274
Cant' Ingegneria
Pavia 13710

8 800 515 56 57
info@endo.it / 02 2326951-2
e-mail info@endo.it - endo.it
www.endo-it.com

5. Судебная медицина

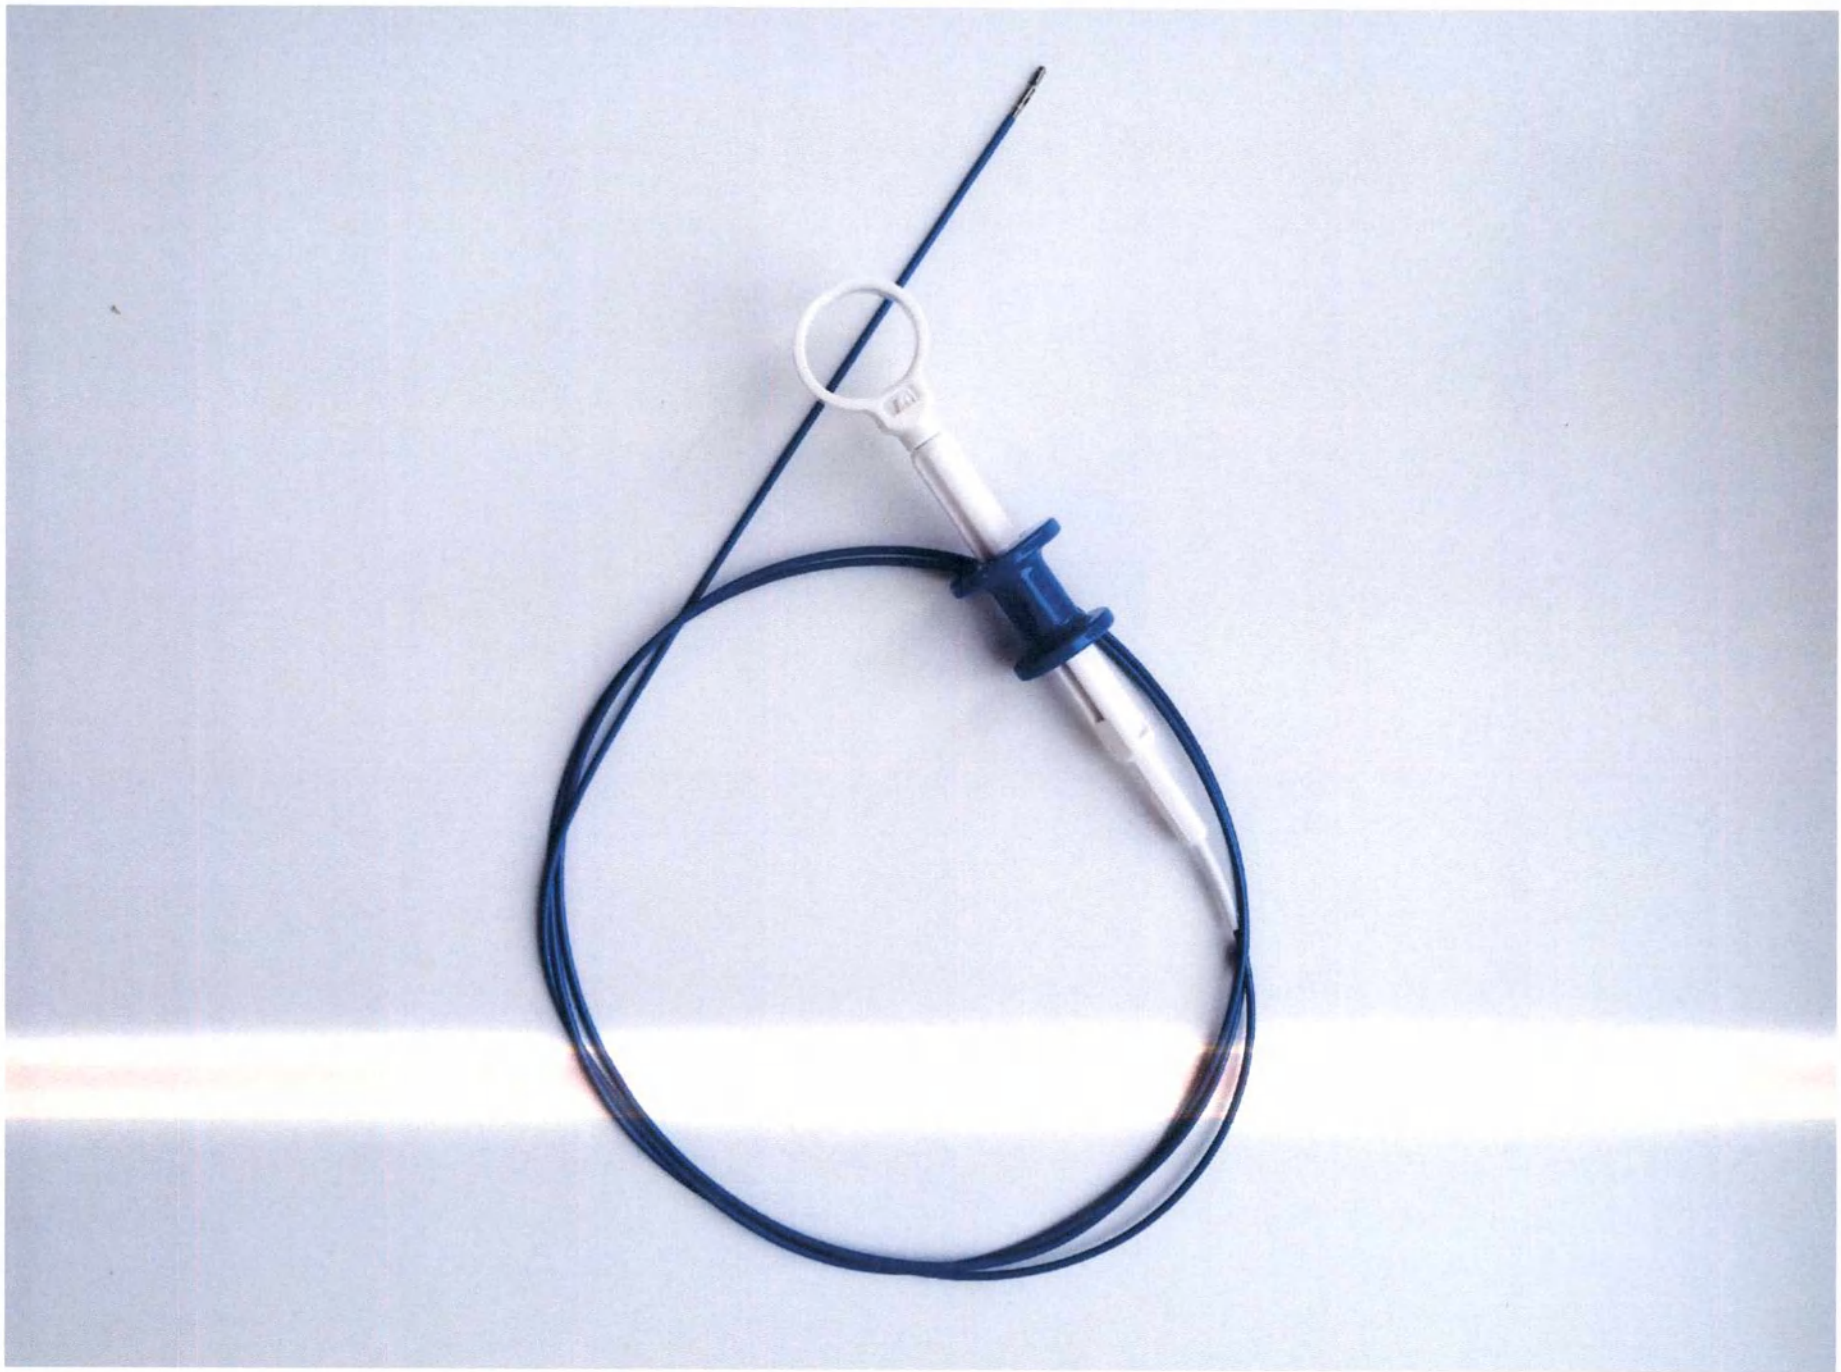

Щипцы биопсийные с круглыми чашками

Щипцы биопсийные однократного применения, с круглыми чашечками, без иглы, диаметр 2,3 мм, для рабочего канала 2,8 мм, длина 300 см
по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT **9437.11116**
3AB.Nº **20150407/006**

MM 2015.02 - 2017.02

EndoStats

©2004 EndoStats, Inc.
1000 115 Ave SE
Burlington, VT 05403
www.endo-stats.com

©2004 EndoStats, Inc.
1000 115 Ave SE
Burlington, VT 05403
www.endo-stats.com

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений улавливателя. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению.

Штипелью описанные однократного применения, с круглыми чашечками, без иглы, диаметр 3,4 мм, для рабочего канала 3,7 мм, длина 230 см

APT 9437.11120
3AB,Nº 20150407/014

2015.02 - 2017.02

Endo
crats

CONFERENCING
DOO Shale Crags
Bismark Avenue 27A
Cairns, Queensland
Phone: (07) 401

8 3005 555-56-57
Web: www.endocrats.com.au
E-mail: info@endocrats.com.au
www.endocrats.com.au

He premissa questa: i ricercatori si sono trovati proprio davanti al problema che si poneva. Perché i ricercatori non hanno mai fatto un lavoro di questo tipo. Perché non hanno mai fatto un lavoro di questo tipo.

Штипы ополнительные одноорнатного применения, с круглыми чашечками, без иглы, диаметр 3,4 мм, для рабочего канала 3,7 мм, длина 180 см

APT 9437.11119
3AB.Nº 20150407/013

MM 2015-02 - 2017-02

Endoglycates

©2003 Endoglycates, Inc.
1000 S. Maple Canyon
Boulder, Colorado 80501
Carter, Christopher
Phone: 303.441.1111

4 (800) 333-5646
fax: (303) 441-1111
e-mail: info@endoglycates.com
www.endoglycates.com

He personajul este înalt și slab, are părul negru, ochii albaștri, înălțimea este de 1,75 m, greutatea de 65 kg, are 30 de ani, este căsătorit și are doi copii. Este un bărbat inteligent, cu o cultură bogată, care se ocupă de activități de cercetare științifică în domeniul fizicii.

Шпильки биометрические однократного применения, с круглыми шайечками, с иглой, диаметр 2,3 мм, для рабочего канала 2,8 мм, длина 120 см

APT 9437.11211
3AB.Nº 20150407/007

2015.02 - 2017.02

EndoStats

Report Requirements:
COO • Ship Counts
Business Warehouse 2.1A
Client: ncs@nyf.fr
Password: 1927101

800.555.56-57
no@nyf.fr • B 212.800.57.00
e-mail: info@nyf.fr • info@nyf.fr
www.endo-stats.fr

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений усталости. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Шпильца биопсийная однократного применения, с круглыми чашечками, без иглы, диаметр 3,4 мм, для рабочего канала 3,7 мм, длина 120 см

APT 9437.1117
3AB.Nº 20150407/011

 2015.02 - 2017.02

EndoGraft

Spinal Implants
DOO & Hight Chicago
Lombard & Hennepin 278
Oakbrook Terrace, IL
Phone: 630-595-4647
Fax: 630-595-4648
e-mail: info@endo-graft.com
www.endo-graft.com

Не представляется возможным исключить из группы для анализа пациентов, перенесших перитонит, методологию исследования с применением сыворотки по сравнению

Штатсбиблиотекные однократно примененные, с круглыми насечками, с интригой, диаметр 2,3 мм, для рабочего канала 2,8 мм, длина 180 см

APT 9437.11213
3AB.Nº 20150407/009

MM 2015 02 - 2017 02

[illegible]

He promotes the growth of the economy and the development of the country. He is a very good person and a very good leader. He is a very good person and a very good leader. He is a very good person and a very good leader.

Шпильки бесшлицевые однократного применения, с крутящими чашечками, с иглой, диаметр 2,3 мм, для рабочего канала 2,8 мм, длина 160 см
по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.11212
3AB.№ 20150407/008

2015.02 - 2017.02

EndoStarz

7000 E. Highway 101
PO Box 2700
Bozeman, Montana 59718
Care@EndoStarz.com
800.655.5647
Fax: 406.595.2548
www.endostarz.com

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Шпильки биосовместимые однократного применения,
с круглыми чашечками, без иглы, диаметр 3,4 мм,
для рабочего канала 3,7 мм, длина 160 см
по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT **9437.11118**
3AB.Nº **20150407/012**

2015.02 - 2017.02

[illegible]

Не рекомендуется вводить интубацию при наличии подострой или острой фазы инфекционного заболевания. Перед интубацией необходимо провести туалет ротоглотки.

Штанды биосистемные одноокрадные применения,
с круглыми зажимами, с иголок, диаметр 2,3 мм,
дли рабочей канавки 2,8 мм, длина 230 см
по ТУ 9431-003-89134710-2014


APT 9437.1121
3AB.Nº 20150407/010

2015-02-2017-02

[illegible]

the present-day agricultural activities are typical of the historical landscape practices. The agricultural landscape is well defined and characteristic.

Маркировка (Щипцы биопсийные с круглыми чашками)

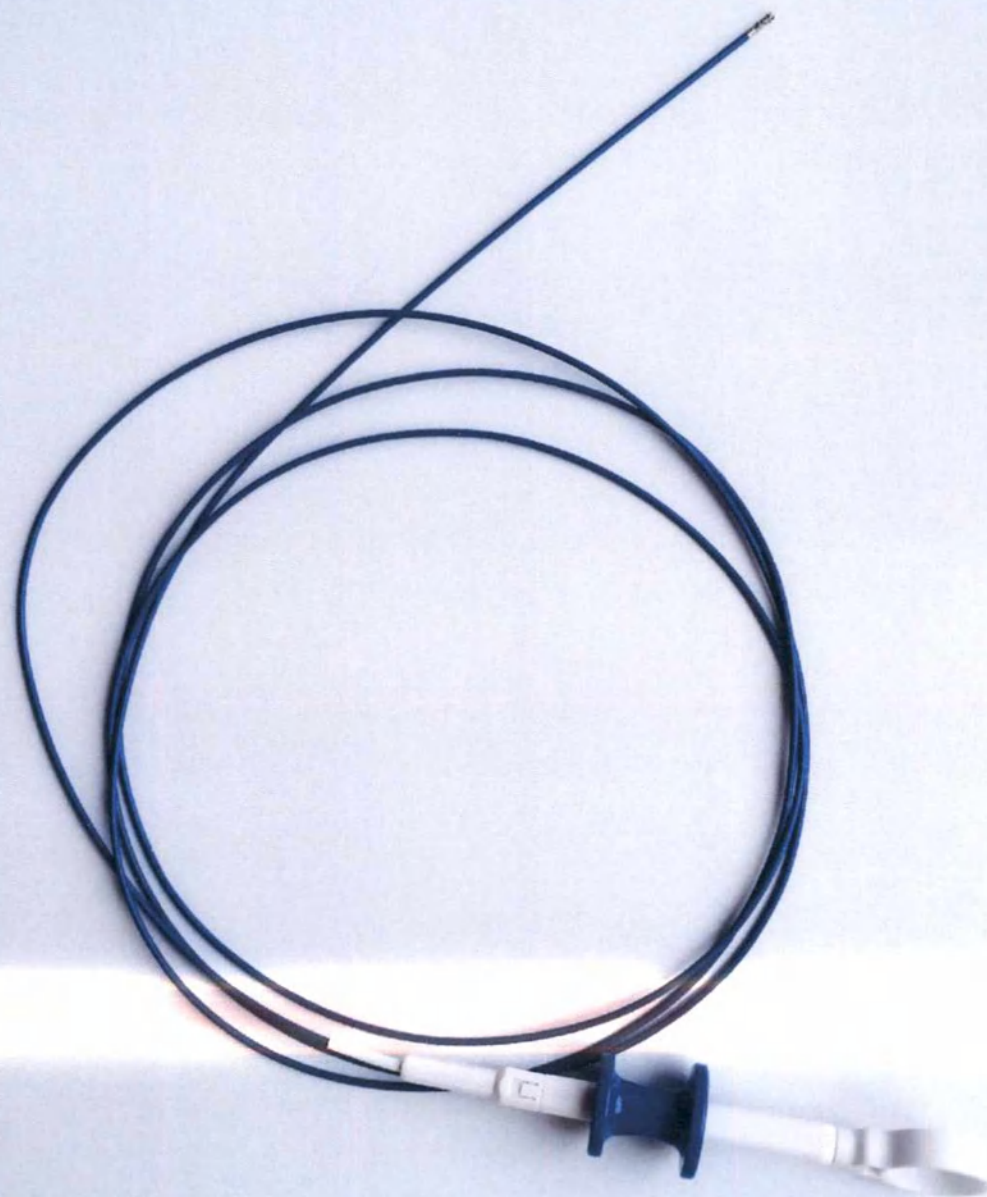

Щипцы биопсийные с овальными чашками типа «крысиный зуб», «аллигатор»

Шипцы биопсийные однократного применения, тип "аллигатор", с овальными чашечками, без иглы, диаметр 1,8 мм, для рабочего канала 2,0 мм, длина 180 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

АРТ 9437.14113
ЗАВ.№ 20150407/054

М 2015.02 - 2017.02



EndoZac
ООО "Эндоскоп"
Брянская область, г. Брянск, ул. Мухоморова, д. 27А
Смарт-Праймер
Ростов, 357101
8 (800) 555-54-57
моб. +7 (812) 800-25-26
e-mail: info@endo-zac.ru
www.endo-zac.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению

Шипцы биопсийные однократного применения, тип "крысиный зуб", с овальными чашечками, без иглы, диаметр 2,3 мм, для рабочего канала 2,8 мм, длина 230 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

АРТ 9437.13122
ЗАВ.№ 20150407/051

М 2015.02 - 2017.02



EndoZac
ООО "Эндоскоп"
Брянская область, г. Брянск, ул. Мухоморова, д. 27А
Смарт-Праймер
Ростов, 357101
8 (800) 555-54-57
моб. +7 (812) 800-25-26
e-mail: info@endo-zac.ru
www.endo-zac.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению

Шипцы биопсийные однократного применения, тип "аллигатор", с овальными чашечками, без иглы, диаметр 2,3 мм, для рабочего канала 2,8 мм, длина 120 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

АРТ 9437.14115
ЗАВ.№ 20150407/056

М 2015.02 - 2017.02



EndoZac
ООО "Эндоскоп"
Брянская область, г. Брянск, ул. Мухоморова, д. 27А
Смарт-Праймер
Ростов, 357101
8 (800) 555-54-57
моб. +7 (812) 800-25-26
e-mail: info@endo-zac.ru
www.endo-zac.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению

Шипцы биопсийные однократного применения, тип "крысиный зуб", с овальными чашечками, без иглы, диаметр 2,3 мм, для рабочего канала 2,8 мм, длина 180 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

АРТ 9437.13121
ЗАВ.№ 20150407/050

М 2015.02 - 2017.02



EndoZac
ООО "Эндоскоп"
Брянская область, г. Брянск, ул. Мухоморова, д. 27А
Смарт-Праймер
Ростов, 357101
8 (800) 555-54-57
моб. +7 (812) 800-25-26
e-mail: info@endo-zac.ru
www.endo-zac.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению

Шипцы биопсийные однократного применения, тип "аллигатор", с овальными чашечками, без иглы, диаметр 2,3 мм, для рабочего канала 2,8 мм, длина 160 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

АРТ 9437.14116
ЗАВ.№ 20150407/057

М 2015.02 - 2017.02



EndoZac
ООО "Эндоскоп"
Брянская область, г. Брянск, ул. Мухоморова, д. 27А
Смарт-Праймер
Ростов, 357101
8 (800) 555-54-57
моб. +7 (812) 800-25-26
e-mail: info@endo-zac.ru
www.endo-zac.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению

Шипцы биопсийные однократного применения, тип "аллигатор", с овальными чашечками, с иглой, диаметр 2,3 мм, для рабочего канала 2,8 мм, длина 180 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

АРТ 9437.14213
ЗАВ.№ 20150407/062

М 2015.02 - 2017.02



EndoZac
ООО "Эндоскоп"
Брянская область, г. Брянск, ул. Мухоморова, д. 27А
Смарт-Праймер
Ростов, 357101
8 (800) 555-54-57
моб. +7 (812) 800-25-26
e-mail: info@endo-zac.ru
www.endo-zac.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению

Шипцы биопсийные однократного применения, тип "крысиный зуб", с овальными чашечками, без иглы, диаметр 2,3 мм, для рабочего канала 2,8 мм, длина 120 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

АРТ 9437.13119
ЗАВ.№ 20150407/048

М 2015.02 - 2017.02




EndoZac
ООО "Эндоскоп"
Брянская область, г. Брянск, ул. Мухоморова, д. 27А
Смарт-Праймер
Ростов, 357101
8 (800) 555-54-57
моб. +7 (812) 800-25-26
e-mail: info@endo-zac.ru
www.endo-zac.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению


Шипцы биопсийные однократного применения, тип "аллигатор", с овальными чашечками, без иглы, диаметр 1,8 мм, для рабочего канала 2,0 мм, длина 160 см по ТУ 9431-003-89134710-2014		Шипцы биопсийные однократного применения, тип "аллигатор", с овальными чашечками, без иглы, диаметр 1,8 мм, для рабочего канала 2,0 мм, длина 120 см по ТУ 9431-003-89134710-2014		Шипцы биопсийные однократного применения, тип "аллигатор", с овальными чашечками, без иглы, диаметр 1,8 мм, для рабочего канала 2,0 мм, длина 230 см по ТУ 9431-003-89134710-2014	
APT 9437.14112 ЗАВ.№ 20150407/053	2015.02 - 2017.02 EndoGata производитель: ООО "Альдо-Сторк" Большая Вишняков 21А, Москва, 197101 телефон: +7 (812) 000-51-57 факс: +7 (812) 000-51-58 e-mail: info@endo-gata.ru www.endo-gata.ru	APT 9437.14111 ЗАВ.№ 20150407/052	2015.02 - 2017.02 EndoGata производитель: ООО "Альдо-Сторк" Большая Вишняков 21А, Санкт-Петербург, Россия, 197101 телефон: +7 (812) 000-51-57 факс: +7 (812) 000-51-58 e-mail: info@endo-gata.ru www.endo-gata.ru	APT 9437.14214 ЗАВ.№ 20150407/065	2015.02 - 2017.02 EndoGata производитель: ООО "Альдо-Сторк" Большая Вишняков 21А, Санкт-Петербург, Россия, 197101 телефон: +7 (812) 000-51-57 факс: +7 (812) 000-51-58 e-mail: info@endo-gata.ru www.endo-gata.ru
Шипцы биопсийные однократного применения, тип "аллигатор", с овальными чашечками, без иглы, диаметр 2,3 мм, для рабочего канала 2,8 мм, длина 180 см по ТУ 9431-003-89134710-2014		Шипцы биопсийные однократного применения, тип "аллигатор", с овальными чашечками, без иглы, диаметр 2,3 мм, для рабочего канала 2,8 мм, длина 230 см по ТУ 9431-003-89134710-2014		Шипцы биопсийные однократного применения, тип "аллигатор", с овальными чашечками, с иглой, диаметр 2,3 мм, для рабочего канала 2,8 мм, длина 160 см по ТУ 9431-003-89134710-2014	
APT 9437.14117 ЗАВ.№ 20150407/058	2015.02 - 2017.02 EndoGata производитель: ООО "Альдо-Сторк" Большая Вишняков 21А, Санкт-Петербург, Россия, 197101 телефон: +7 (812) 000-51-57 факс: +7 (812) 000-51-58 e-mail: info@endo-gata.ru www.endo-gata.ru	APT 9437.14118 ЗАВ.№ 20150407/059	2015.02 - 2017.02 EndoGata производитель: ООО "Альдо-Сторк" Большая Вишняков 21А, Санкт-Петербург, Россия, 197101 телефон: +7 (812) 000-51-57 факс: +7 (812) 000-51-58 e-mail: info@endo-gata.ru www.endo-gata.ru	APT 9437.14212 ЗАВ.№ 20150407/061	2015.02 - 2017.02 EndoGata производитель: ООО "Альдо-Сторк" Большая Вишняков 21А, Санкт-Петербург, Россия, 197101 телефон: +7 (812) 000-51-57 факс: +7 (812) 000-51-58 e-mail: info@endo-gata.ru www.endo-gata.ru
Шипцы биопсийные однократного применения, тип "хвостик змеи", с овальными чашечками, без иглы, диаметр 2,3 мм, для рабочего канала 2,8 мм, длина 160 см по ТУ 9431-003-89134710-2014		Шипцы биопсийные однократного применения, тип "аллигатор", с овальными чашечками, с иглой, диаметр 2,3 мм, для рабочего канала 2,8 мм, длина 120 см по ТУ 9431-003-89134710-2014		Шипцы биопсийные однократного применения, тип "аллигатор", с овальными чашечками, с иглой, диаметр 2,3 мм, для рабочего канала 2,8 мм, длина 230 см по ТУ 9431-003-89134710-2014	
APT 9437.13120 ЗАВ.№ 20150407/049	2015.02 - 2017.02 EndoGata производитель: ООО "Альдо-Сторк" Большая Вишняков 21А, Санкт-Петербург, Россия, 197101 телефон: +7 (812) 000-51-57 факс: +7 (812) 000-51-58 e-mail: info@endo-gata.ru www.endo-gata.ru	APT 9437.14211 ЗАВ.№ 20150407/060	2015.02 - 2017.02 EndoGata производитель: ООО "Альдо-Сторк" Большая Вишняков 21А, Санкт-Петербург, Россия, 197101 телефон: +7 (812) 000-51-57 факс: +7 (812) 000-51-58 e-mail: info@endo-gata.ru www.endo-gata.ru	APT 9437.14214 ЗАВ.№ 20150407/063	2015.02 - 2017.02 EndoGata производитель: ООО "Альдо-Сторк" Большая Вишняков 21А, Санкт-Петербург, Россия, 197101 телефон: +7 (812) 000-51-57 факс: +7 (812) 000-51-58 e-mail: info@endo-gata.ru www.endo-gata.ru

Маркировка (Шипцы биопсийные с овальными чашками типа «крысиный зуб», «аллигатор»)

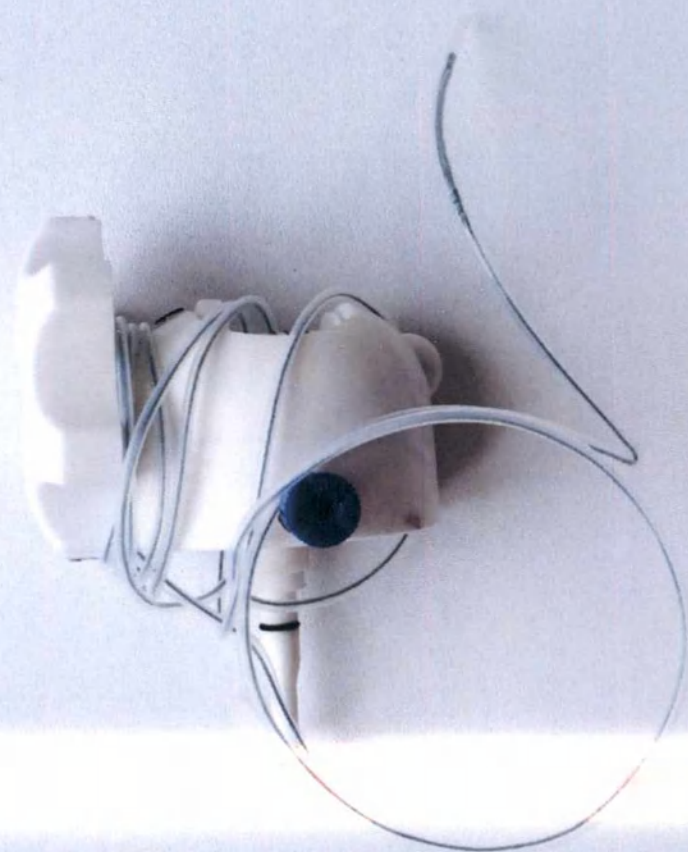

Лигатор для варикозно-расширенных вен пищевода

Лигатор однократного применения, 10 зарядный, с возможностью применения с эндоскопами с наружными диаметрами от 8,5 до 11,5 мм, полностью прозрачный дистальный колпачок, канал для иригации (в комплекте с защитным колпачком с люер Лок соединенным), длина катетера 160 см, диаметр катетера 2,2 мм, 10 установленных колп. АРТ 9437.91111 ЗАВ.№ 20150407/183	Лигатор однократного применения, 7 зарядный, с возможностью применения с эндоскопами с наружными диаметрами от 8,5 до 11,5 мм, полностью прозрачный дистальный колпачок, канал для иригации (в комплекте с защитным колпачком с люер Лок соединенным), длина катетера 160 см, диаметр катетера 2,2 мм, 7 установленных колп. АРТ 9437.91112 ЗАВ.№ 20150407/178	Лигатор однократного применения, 6 зарядный, с возможностью применения с эндоскопами с наружными диаметрами от 8,5 до 11,5 мм, полностью прозрачный дистальный колпачок, канал для иригации (в комплекте с защитным колпачком с люер Лок соединенным), длина катетера 160 см, диаметр катетера 2,2 мм, 6 установленных колп. АРТ 9437.91113 ЗАВ.№ 20150407/179
М 2015.02 - 2017.02 EndoGastr протектор: ООО «Эндоскоп» Большая Моршанская 27А, г. Москва, 119101 телефон: +7 (812) 800 25 28 e-mail: info@endo-gastr.ru www.endo-gastr.ru Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!	М 2015.02 - 2017.02 EndoGastr протектор: ООО «Эндоскоп» Большая Моршанская 27А, г. Москва, 119101 телефон: +7 (812) 800 25 28 e-mail: info@endo-gastr.ru www.endo-gastr.ru Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!	М 2015.02 - 2017.02 EndoGastr протектор: ООО «Эндоскоп» Большая Моршанская 27А, г. Санкт-Петербург, 197101 телефон: +7 (812) 800 25 28 e-mail: info@endo-gastr.ru www.endo-gastr.ru Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

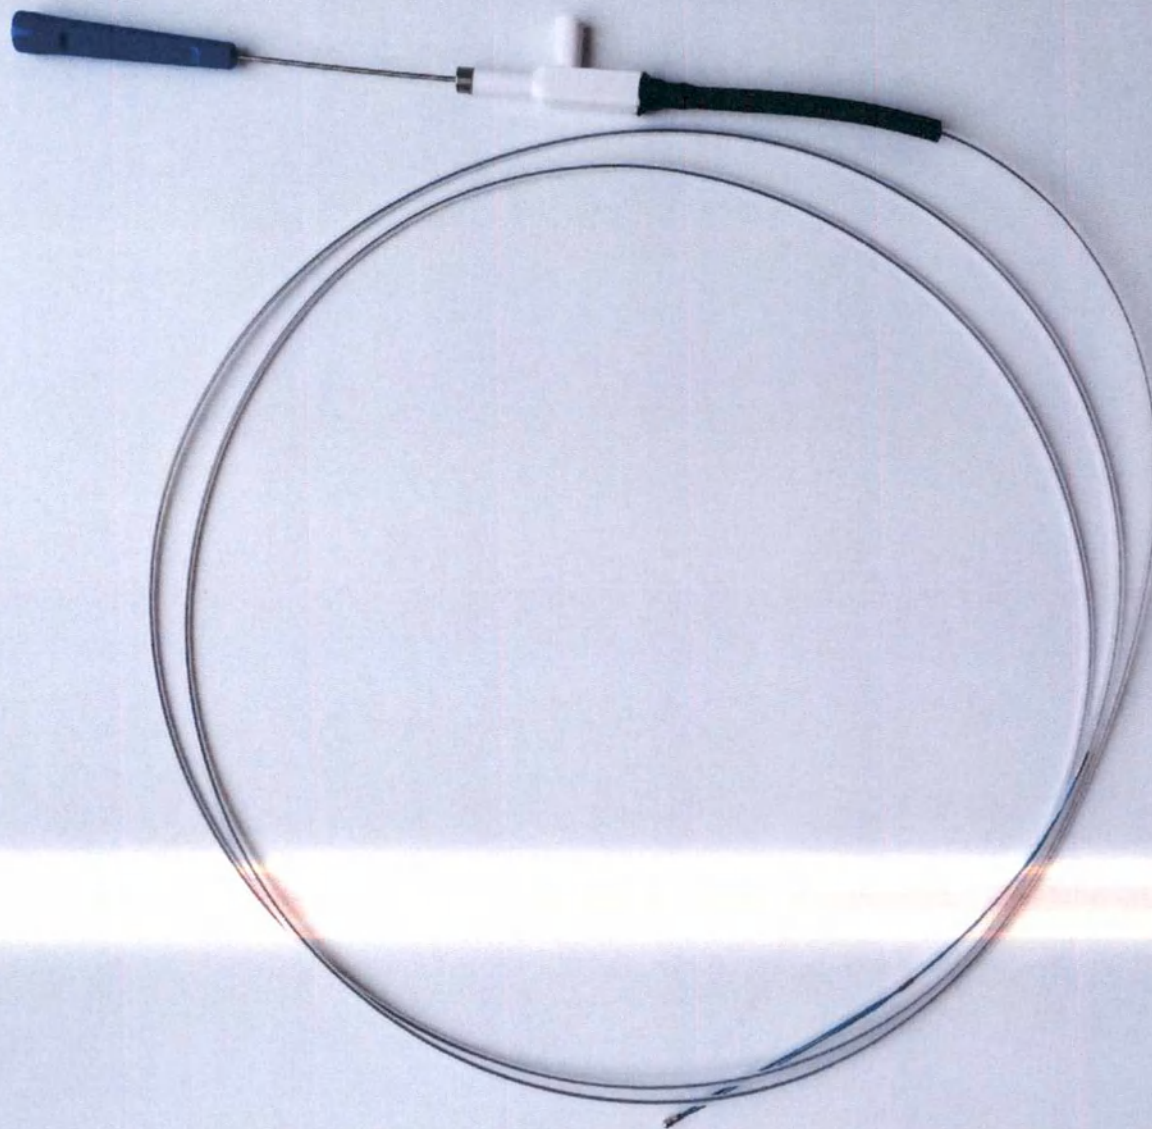

Корзина для удаления инородных тел 8 струнная

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 8-ми струнная, двойная струна,
ромбовидной формы, высота 60 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.31280

ЗАВ.№ 20150407/191

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
телефон: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 8-ми струнная, монофильная
струна, спиралевидной формы, высота 40 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.31236

ЗАВ.№ 20150407/235

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
телефон: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 8-ми струнная, монофильная
струна, спиралевидной формы, высота 70 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.31239

ЗАВ.№ 20150407/232

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
телефон: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 4/8-ми струнная,
монофильная струна, ромбовидной формы,
высота 60 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.31282

ЗАВ.№ 20150407/187

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
телефон: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 8-ми струнная, двойная струна,
ромбовидной формы, высота 40 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.31278

ЗАВ.№ 20150407/195

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
телефон: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 8-ми струнная, двойная струна,
спиралевидной формы, высота 50 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.31275

ЗАВ.№ 20150407/198

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
телефон: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 8-ми струнная, двойная струна,
ромбовидной формы, высота 50 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.31279

ЗАВ.№ 20150407/192

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
телефон: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 8-ми струнная, двойная струна,
ромбовидной формы, высота 70 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.31281


ЗАВ.№ 20150407/190

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
телефон: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

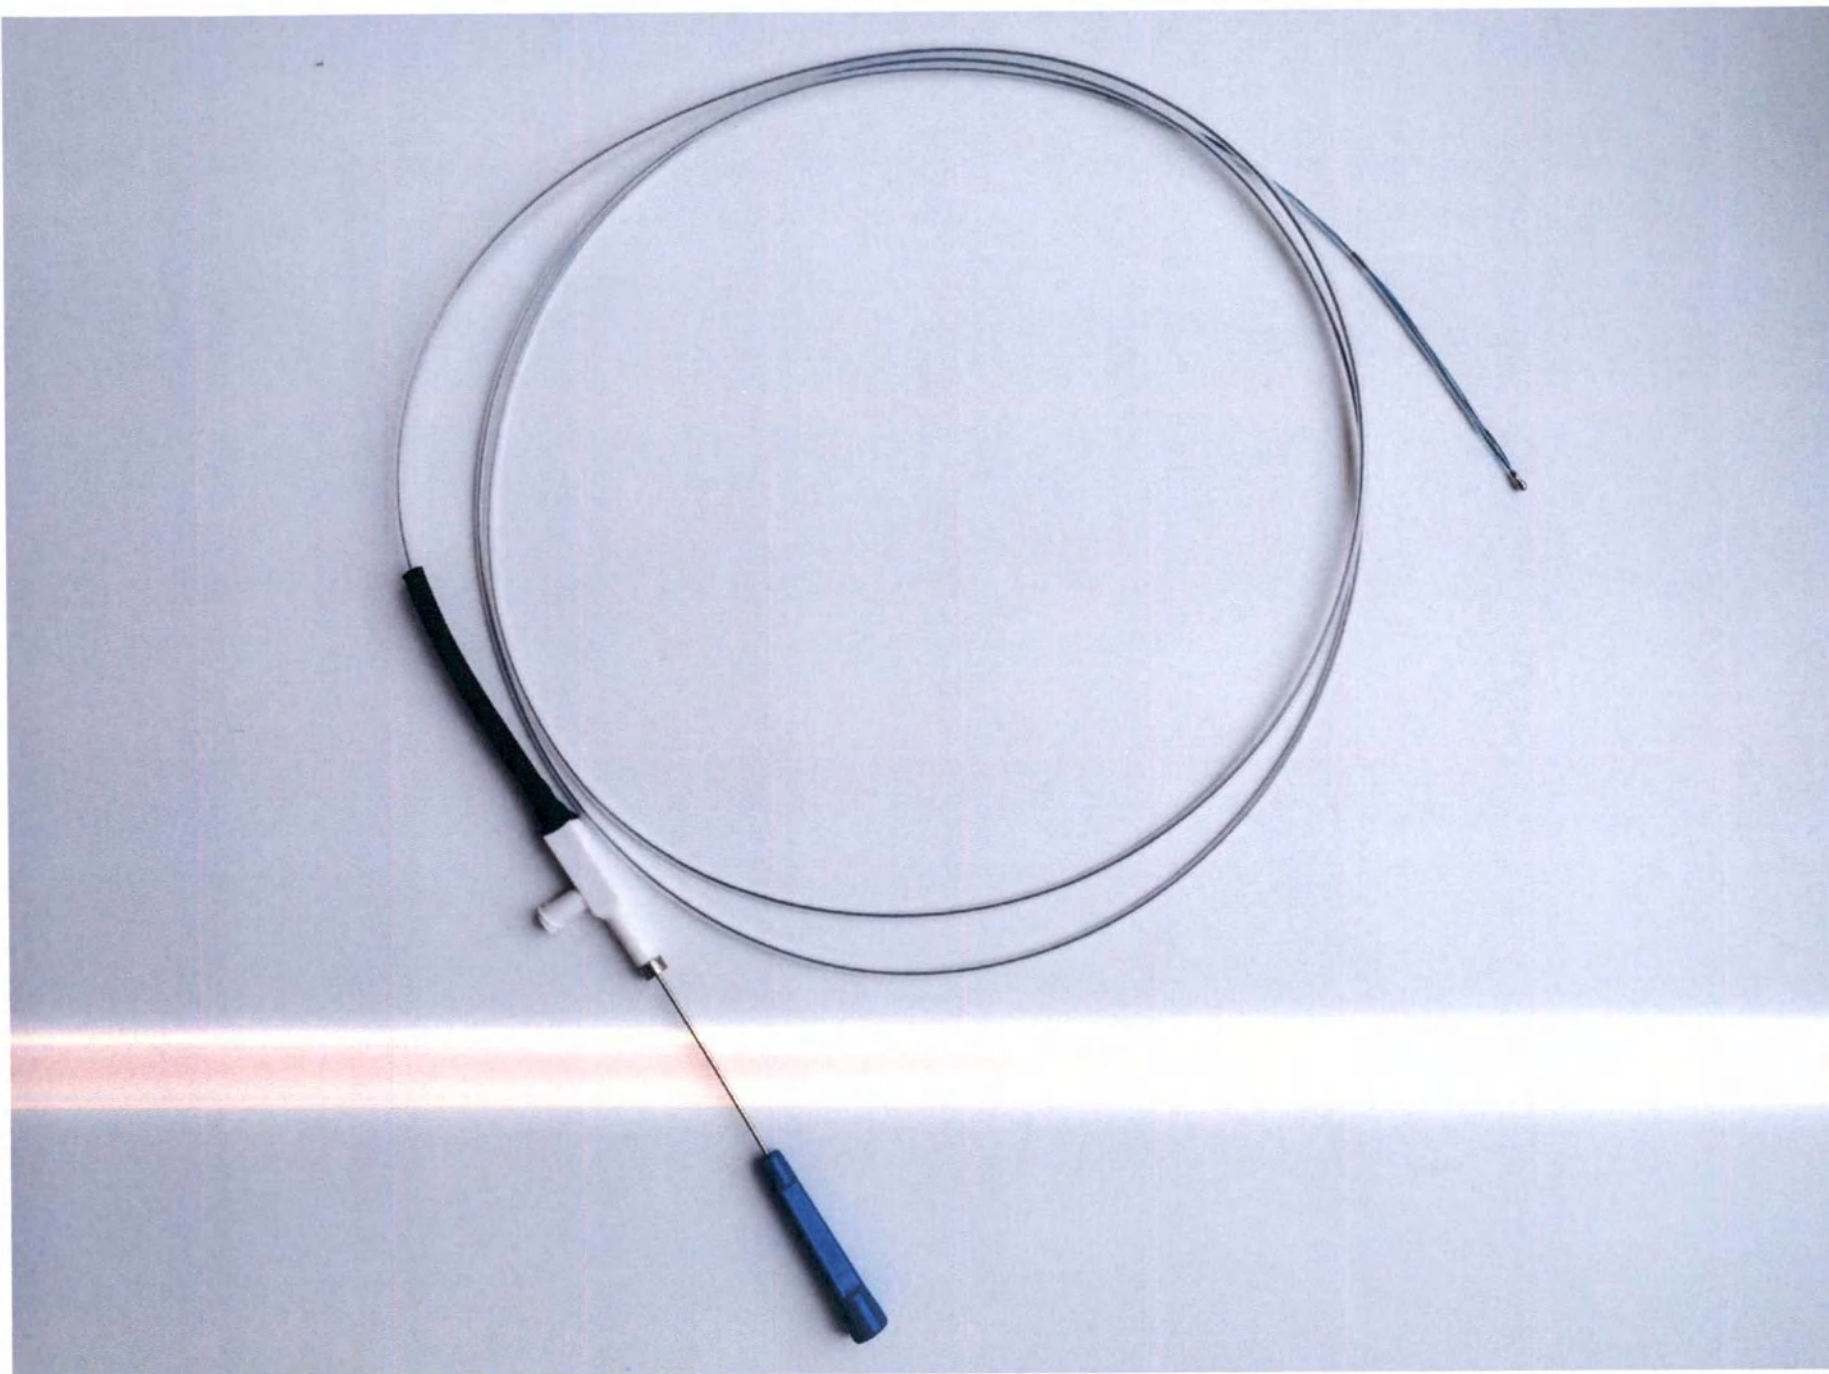

Корзина для удаления инородных тел 6 струнная

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, (для удаления полипов),
в тефлоновом тубусе, 6-ти струнная, двойная струна,
ромбовидной формы, высота 70 мм, Ø 2,3 мм, с портом
для проводника
по ТУ 9431-003-89134710-2014

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, (для удаления полипов),
в тефлоновом тубусе, 6-ти струнная, двойная струна,
ромбовидной формы, высота 60 мм, Ø 2,3 мм с портом
для проводника
по ТУ 9431-003-89134710-2014

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, (для удаления полипов),
в тефлоновом тубусе, 6-ти струнная, двойная струна,
ромбовидной формы, высота 60 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.31289

ЗАВ.№ 20150407/182

2015.02 - 2017.02

EndoStars

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101

8 (800) 555-56-57
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-stars.ru
www.endo-stars.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

APT 9437.31288

ЗАВ.№ 20150407/181

2015.02 - 2017.02

EndoStars

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101

8 (800) 555-56-57
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-stars.ru
www.endo-stars.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

APT 9437.31286

ЗАВ.№ 20150407/185

2015.02 - 2017.02

EndoStars

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101

8 (800) 555-56-57
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-stars.ru
www.endo-stars.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, (для удаления полипов),
в тефлоновом тубусе, 6-ти струнная, двойная струна,
ромбовидной формы, высота 70 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 6-ти струнная, двойная струна,
спиралевидной формы, высота 40 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 6-ти струнная, двойная струна,
ромбовидной формы, высота 70 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.31287

ЗАВ.№ 20150407/186

2015.02 - 2017.02

EndoStars

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101

8 (800) 555-56-57
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-stars.ru
www.endo-stars.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

APT 9437.31267

ЗАВ.№ 20150407/207

2015.02 - 2017.02

EndoStars

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101

8 (800) 555-56-57
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-stars.ru
www.endo-stars.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

APT 9437.31273

ЗАВ.№ 20150407/196

2015.02 - 2017.02

EndoStars

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101

8 (800) 555-56-57
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-stars.ru
www.endo-stars.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 6-ти струнная, двойная струна,
спиралевидной формы, высота 50 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 6-ти струнная, двойная струна,
спиралевидной формы, высота 60 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 6-ти струнная, двойная струна,
ромбовидной формы, высота 60 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.31268

ЗАВ.№ 20150407/202

2015.02 - 2017.02

EndoStars

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101

8 (800) 555-56-57
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-stars.ru
www.endo-stars.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

APT 9437.31269

ЗАВ.№ 20150407/203

2015.02 - 2017.02

EndoStars

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101

8 (800) 555-56-57
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-stars.ru
www.endo-stars.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

APT 9437.31291

ЗАВ.№ 20150407/201

2015.02 - 2017.02

EndoStars

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101

8 (800) 555-56-57
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-stars.ru
www.endo-stars.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Корзина для разрушения и захвата камней
однофазного применения, из материала NITINOL™,
с портом для контрастного вещества, 6-ти струнная,
ромбовидной формы, высота 30 мм, Ø 1,8 мм,
по ТУ 9431-003-89134710-2014

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, из материала NITINOL™
с портом для контрастного вещества, 6-ти струнная,
ромбовидной формы, высота 40 мм, Ø 1,8 мм
по ТУ 9431-003-89134-10-2014

Корзина для разрушения и захвата камней
однокатриного применения, из материала NITINOL, с
портлом для контрастного вещества, 6-ти струнная,
ромбовидной формы, высота 60 мм, Ø 1,8 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.31161
3AB.No 20150407/310

APT 9437.31162
3AB.Nº 20150407/305

APT 9437.31164
3AB.Nº 20150407/307

 2015.02 - 2017.02


EndoStats
 Tools and Reports
 Software Manuals 27A
 CaseManager
 Pricelist 12/1/11

1 (800) 355-56-57
 info@mc1.com
 e-mail: info@mc1.com
 www.mc1-stat.ru



Endo
Factor

000 3600 0000
Bioscience Resource
Care-Manager
Factor, 197 101

8 000 555 56 87
www.endo.com
e-mail: info@endo.com
www.endo.com

[illegible]

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений у лапки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений улавливателя. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений или деформаций. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Корзина для разрушения и захвата камней
однокопчатого применения, из материала NITPOL™
с портом для контрастного вещества, 6-ти струнная,
ромбовидной формы, высота 50 мм, Ø 2,3 мм
по 79431-003-89134710-2014

Корзинки для разрушения и захвата камней
однократного применения, из материала NITINOL™
с портом для контрастного вещества, 6-ти струнная,
ромбовидной формы, высота 40 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-891 34-710-2014

Корзинки для разрушения и захвата камней
однократного применения, из материала NITINOL™
с поролом для контрастного вещества, 6-ти струнная,
ромбовидной формы, высота 60 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-891 34710-2014

APT 9437.31166
3AB.Nº 20150407/303

APT 9437.31165
3AB.Nº 20150407/302

APT 9437.31167
3AB.Nº 20150407/304

EndoStats

2015.02 - 2017.02

Reported by: **EndoStats**

CCC-Chang, China
Boschma-Boschma, JIA
Cancer-Chang, JIA
Phone: 197101

8 805 555-56-57
Tel/Fax: +1 8 805 55-56-57
e-mail: info@endo-stats.ru
www.endo-stats.ru

 2015.02 - 2017.02
 


[illegible]

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений уаиски. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений лакокрасочного покрытия. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению.

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений или деформации. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Корзина для разгрузки и захвата камней
однокоштного применения, из материала NITINOL™,
с портом для конструктивного вещества, 6-ти струнная,
спиральнойной формы. Высота 60 мм, Ø 2,3 мм,
с портом для проводника
по ТУ 9431-003-69134710-2014

Коринна для разрушения и захвата комков однократного применения, из материала NITINOL™ с портом для контрастного вещества, 6-ти струнный, спиральной формы, высота 40 мм, Ø 1,8 мм
по ТУ 9431-003-89134/10-2014

Корзина для разрушения и захвата камней
однофазного с применением, из материала ПИТНОЛ™
с пором для контрастного вещества, 6-ти струнная,
спиральевидной формы, высота 50 мм, Ø 2,3 мм,
с пором для промывания
по ТУ 9431-001-891-34-10-2014

APT	9437.31180
3AB.No	20150407/288

APT 9437.31182
3AB.Nº 20150407/290

APT 9437.31179
3AB.Nº 20150407/291

EndoStats

ISSN 1547-0202

2015-02 - 2017-02

1

2

INFO@ENDOSTATS.COM

800.555.6637

info@endo-stats.com

404.800.2526

info@endo-stats.com

157137

[illegible]

 2015-02 - 2017-02




















Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений улавливателя. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению.

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений указовки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Не рекомендуется использовать инструмент для хранения перфорированных проводов. Перфорированные провода должны храниться в специальных контейнерах.

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 6-ти струнная, двойная струна,
ромбовидной формы, высота 40 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.31271

3AB.Nº 20150407/199




Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений утюжков. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 6-ти струнная, монофильная
струна, ромбовидной формы, высота 60 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.31230

3AB.Nº 20150407/241



Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 6-ти струнная, монофильная
струна, ромбовидной формы, высота 70 мм, Ø 2,3 мм,
с портом для проводника
по ТУ 9431-003-89/14710-2014

APT 9437.31235

3AB.Nº 20150407/236



Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Корзина для разрушения и захвата камней одностороннего применения, для механического литопилтора спиральной формы 6 и струнная двойная струна, 400 см. Ø 2,6 мм, в телефонном трубе с портом для контрастного вещества, высота 70 мм.

PO TY 9431-003-89134710-2014

APT 9437.31122
3AB.Nº 20150407/174

2015.02 - 2017.02

EndoStarz

Information:
0000 +3600 0000
Bosnia Movenwala 27A
Camer "Tangofy"z
Poceni 97101

8 (000) 811 56-57
900 0000 +7 (812) 000-20-20
e-mail: info@endo-starz.ru
www.endo-starz.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Корзина для разрушения и захвата камней
однокопательного применения, для механического
питопитора спиральной формы, 6-ти струнная,
двойные струны, 400 см. Ø 3,4 мм, в телефонном
трубе с портом для контрольного вещества,
высота 60 мм
по ТУ 9431-003-89134-710-2014

APT 9437.31124
3AB.Nº 20150407/345

MM 2015.02 - 2017.02

Endogate

Endogate Corporation
10000 E. 15th Avenue
Denver, CO 80231
Tel: 303.755.5637
Fax: 303.755.5638
www.endogate.com

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений уставки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению.

Корзина для разрушения и заплата каменной
одноокрастного применения, для механического
лигнотриггера ромбовидной формы, 6-ти струнная
двойные струны, 400 см, Ø 3,4 мм, в телефонном
трубке с портом для контрастного вещества,
высота 70 мм

APT 9437.31131
3AB.Nº 20150407/340

2015.02 - 2017.02

Endogates

www.endogates.ru
ООО «Бейт-Супер»
Самарская область 27А
Самара-Чирковский
Россия 447193

8 (800) 515-55-57
mailto:info@e-78125005@yandex.ru
e-mail: info@endogates.ru
www.endogates.ru

He persanijetov ispolzovat' ispraznyj pri izmenenii porozhenij
ustanovki. Treba ispolzovat' neobhodimo blizoznachij
s puznost'jama po pravilam

Корзин для разрушения и захвата камней
однозначного применения, для механического
лигатора спиральной формы, 6 и струнвя,
двойные струны, 400 см, Ø 2,6 мм, в телефонном
трубе с портом для контрастного вещества,
высота 60 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.311121
3AB.Nº 20150407/173

2015.02 - 2017.02

EndoStar

www.endostar.ru
8 (800) 555-56-57
ООО «ЭндоСтар»
Булвар Мухометова 27А
Самара, Самарская
область, 443003
e-mail: info@endo-star.ru
Роспатент 97101

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений утаповки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Корзина для разрушения и заката камней
однократного применения, для механического
питопитора ромбовидной формы, 6-ти струнная,
двойные струны, 400 см. Ø 3,4 мм, в тейлорском
тубсе с портом для контрастного вещества,
высота 50 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT	9437.31129
3AB.Nº	20150407/338

2015.02 - 2017.02

EndoStarz

spoke@starz.com
800.555.66.51
info@starz.com
1.877.500.25.26
e-mail: info@starz.com
www.starz.com

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений
указов. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению.

Корзина для разрушения и заката камней
однократно, применив, для механического
латриатора ромбовидной формы 6-ти струнный
двойные струны L 400 см, Ø 3,4 мм, в фановом
трубе с спором для контрастного вещества.
Высота 60 мм
по ТУ 9431-003-8913476-2014

APT 9437.31130
3AB.Nº 20150407/339

MM 2015.02 - 2017.02

Endogates

regional offices

COO & Sales Director
Suzanne McWhorter 274
Cheryl Thompson
Phoenix, 1 (877) 371

8 (800) 555 554
toll free • 1 (877) 371-274
e-mail: info@endogates.com
www.endogates.com

Не пренебрегайте использованием инструктора при наличии соответствующей квалификации. Перед использованием инструктора обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Куртина для разрушения и захвата камней
органолетон® применяется для механического
лиготиригатора спиральной формы, 6-и струнная
двойные струны, 400 см, Ø 2,6 мм, в телефонном
трубе с портом для контрастного вещества,
высота 50 мм
по ТУ 9431-003-891-34/10-2014

APT 9437.311120
3AB.Nº 20150407/172

MM 2015.02 - 2017.02

EndoStarz

770.633.6770
OOO - Jaija Chandra
Business Development 2/16
CarringtonMortgage
Podcast: 197107

#1000 555-56-5
www.jaija.com
tel: jaija, +1 912-500-21-8
e-mail: info@jaija.com
www.endo-starz.com

Не рекомендуется использовать инструмент при наложении полимерной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению.

Корзинки для разрушения и захвата камней
однократного применения, для механического
питопропатора спиральной формы, 6-ти струнная
двойные струны, 400 см, Ø 3,4 мм, в телефонном
трубке с портлом для контрастного вещества,
высота 90 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.31123
3AB.Nº 20150407/344

2015.02 - 2017.02

EndoStar

2000 Abbott Center
Baltimore, Maryland 2120
Jesse C. Crawford
Tel: 410.528.7100
Fax: 410.528.7101
www.endo-star.com

8 000.881.6617
In Maryland: 410.528.7100
e-mail: info@endo-star.com
www.endo-star.com

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений
уплотнителя. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией
с руководством по применению!

Кормиле для разрушения и захвата камней
однократно применения, для механического
лигатора спиральной формы, 6-ти струнный
двойные струны, 400 см, Ø 3,4 мм, в телефонном
трубке с портом для контрастного вещества,
высота 70 мм

APT 9437.3112
3AB.Nº 20150407/346

2015.02 - 2017.02

Endogates

COO + Sales Offices
Business Development
Sales Engineering
Facilities Support

1-800-325-56-57
info@endogates.com
www.endogates.com

He presented the authors with the program for the morning breakfast in the restaurant. They all enjoyed the delicious breakfast and the beautiful view of the city.

Корзина для разрушения и захвата каменной
односекторного применения, из материала NITINOL[™],
с портом для контрастного вещества, 6-ти струнная,
спиралевидной формы, высота 60 мм, Ø 2,5 мм,
по ТУ 9431-003-89134710-2014

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, из материала NITINOL,™,
с пором для контрастного вещества, 6-ти струнная,
спиральнойной формы, высота 50 мм, Ø 2,3 мм,
с пором для проводника
по ТУ 9431-003-89154/710-2014

Корзина для разрушения и захвата камней
однокаплатного применения, из материала NITINOL™,
с портом для контрастного вещества, 6-ти струнная,
спиралевидной формы, высота 60 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.31190
3AB.Nº 20150407/280

APT 9437.31189
3AB.Nº 20150407/281

APT 9437.31187
3AB.Nº 20150407/283

M 2015-02 - 2017-02

EndoStats

Open Access Journals

DOI: 10.5682/endo
Business Managerial 7.9
Case Management
Pharmacology 197/101

8 (800) 555-5657
toll-free +1 (812) 600-2526
e-mail: info@endo-stats.com
www.endo-stats.com

(2)

EndoStats
2015.02 - 2017.02

Open to all
OOO: David Caputo
Bioscience Marketing 274
Caputo@unigov.edu
Phone: 507.001

2.6000.515.56.57
mofline: 312.600.21.26
e-mail: info@endo-stats.ru
www.endo-stats.ru

2

[illegible]

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений
упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению!

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений
указовки. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению!

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений укладываемой. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Корзинка для разрушения и захвата каменной однократного применения, из материала NITINOL, с портом для контрастного вещества, 6-ти струнная, спиральной формы, высота 40 мм, Ø 2,3 мм по ТУ 9431-003-89134710-2014

Корзинки для разбуривания и захвата камней
однократного применения, из материала NITPOLI™
с портом для контрастного вещества, 6-ти струнная,
спиралевидной формы, высота 50 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

Корзина для разрушения и захвата каменной
однофазного применения, с портом для
контрастного вещества, 6-ти струнная, монофильная
струна, спиральевидной формы, высота 40 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 94А11-003-891341710-2014

APT 9437.31185
3AB,Nº 20150407/287

APT	9437.31186
3AB.Nº	20150407/282

APT **9437.31217**
3AB.Nº **20150407/254**

Endoglyc

000 - Chapt. C1000
Boulevard Meunier n° 27A
Caen, France 14100
France 14100

8 000 555 56 57
www.endo.fr
e-mail: info@endo-france.com
www.endo-france.com

EndoStats

FORUM REQUEST:

OOO + Japen Chisao
Bichuan Shianwan 214
Caoer Chingyoy
Piscual (52710)

8 (800) 535-66-67
moldings: +7 812 605-24-26
e-mail: moldings@endo.ru
www.endo.ru

2015.02 - 2017.02

1

2

EndoStats

2015-02 - 2017-02

DOO - M&S C/OPS
Boulevard Kennedy 214
Caseri, Paraguay
Phone: +595 98511891

0003 355-56-67
fax: +595 21 800-25-26
e-mail: info@endo-stats.com
www.endo-stats.com

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений укладовки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством с руководством по применению!

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 6-ти струнная, монофильная
струна, спиральной формы. Высота 60 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-8931470-2014

Корзинка для разрушения и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 6-ти струнная, монофильная
струна, спиральная форма, высота 50 мм, Ø 1,8 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

Позвоните для расчета стоимости и заказа камня
однонаправленного применения, с портлом для
контрастного вещества, 6-ти струнный, монофильная
струна, спиральной формы, высота 50 мм, Ø 2,3 мм.
по ТУ 9431-003 89734710-2014

APT 9437.31219
3AB.Nº 20150407/252

APT	9437.31216
3AB.Nº	20150407/257

API 9437.31218
3AB.Nº 20150407/253

 2015-02 - 2017-02  

Registrations:
 0000 x Jhuo C Niroo
 Simoes Oliveira 27A
 Caixa Postal 1301
 Parnaíba, 64713-010
 A 8071 555-54-67
 nu@jhuo.c73@2009-25-26
 e-mail: jhuo@nuo.c73
 www.nuo.c73.br

EndoStax

Agencia de Marketing
OCC - Chap Chap Co.
Boulevard Montclair 719
Carter's Shopping Center
Piscataway, NJ 08854
Tel: 908-515-6447
Fax: 908-515-2526
e-mail: info@endo-stax.com
www.endo-stax.com

 2015-02 - 2017-02


Endgigra
www.endgigra.nl
 DOO • Vaput (Neder)
 Bovenweg 278
 4161 BT Breda
 Phone: 0175/117101
 8 3005 035 594-57
 800 000 000 000 000 000
 800 000 000 000 000 000
 800 000 000 000 000 000

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений на поверхности. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению с рисунком по применению!

Не представляется возможным использовать при нахождении погрешности уравнения Пирса непосредственно методологию анализа дисперсии с учетом влияния погрешности

He presentifica no mesmo dia
 a obra "Depos, introdução ao conhecimento da literatura
 grega", com o seguinte programa:

Корзина для разрушения и захвата камней
однокротного применения, с портом для
контрастного вещества, 6-ти струнная, монофильная
струна, ромбовидной формы, высота 40 мм, Ø 2,3 мм,
с портом для проводника
по ТУ 9431-003-89134710-2014

АРТ **9437.31232**
ЗАВ.№ **20150407/237**

2015.02 - 2017.02



EndoGraft

ООО «Эндоскоп»
Большая Вишняков 218, Москва, 127103
Смарт-Гидер
8 800 555 56 57
тел/факс +7 812 680 51 26
e-mail: info@endo-graft.ru
www.endo-graft.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной
упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению!

Корзина для разрушения и захвата камней
однокротного применения, с портом для
контрастного вещества, 6-ти струнная, монофильная
струна, ромбовидной формы, высота 50 мм, Ø 2,3 мм,
с портом для проводника
по ТУ 9431-003-89134710-2014

АРТ **9437.31233**
ЗАВ.№ **20150407/238**

2015.02 - 2017.02



EndoGraft

ООО «Эндоскоп»
Большая Вишняков 218, Москва, 127103
Смарт-Гидер
8 800 555 56 57
тел/факс +7 812 680 51 26
e-mail: info@endo-graft.ru
www.endo-graft.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной
упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению!

Корзина для разрушения и захвата камней
однокротного применения, с портом для
контрастного вещества, 6-ти струнная, двойная струна,
стиральной формы, высота 70 мм, Ø 2,3 мм,
по ТУ 9431-003-89134710-2014

АРТ **9437.31270**
ЗАВ.№ **20150407/204**

2015.02 - 2017.02



EndoGraft

ООО «Эндоскоп»
Большая Вишняков 218, Москва, 127103
Смарт-Гидер
8 800 555 56 57
тел/факс +7 812 680 51 26
e-mail: info@endo-graft.ru
www.endo-graft.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной
упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению!

Корзина для разрушения и захвата камней
однокопального применения, из материала NITINOL™,
с портом для контрастного вещества, 6-ти струнная,
спиралевидной формы, высота 40 мм, Ø 2,3 мм,
с портом для проводника
по ТУ 9431-003-89134710-2014

Корзина для разрушения и захвата камней
орпеховатого применения, из материала NITINOL™,
с портом для контрастного вещества, 6-ти струнная,
ромбовидной формы, высота 60 мм, Ø 2,3 мм,
с портом для проволочника
по ТУ 9431-003-89134710-2014

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, из материала NITROUL™
с портом для конструирования, 6-ти струнная,
ромбовидной формы, высота 50 мм, Ø 2,3 мм,
с портом для проводника
tel: 79431-003-89134710-2014

APT 9437.31178
3AB.Nº 20150407/292

APT 9437.31170
3AB.Nº 20150407/300

APT **9437.31169**
3AB.№ **20150407/301**

EndoStats

EndyStats

Endyfacts

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Не рекомендуется использовать инструмент при напавии поврежденной
улицею. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению!

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, из материала NITINOL™
с портом для контрастного вещества, 6-ти струнная,
ромбовидной формы, высота 40 мм, Ø 2,3 мм,
с портом для проводника
по ТУ 9431-003-69134-710-2014

Корзина для разрушения и захвата камней
однокротного применения, из материала PITINOL,
с портом для контрастного вещества, 6-ти струнная,
ромбовидной формы, высота 50 мм, Ø 1,8 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

Корзина для разбуривания и захвата камней
однократного применения из материала NITINOL™
с портом для контрастного вещества, 6-ти струнная,
спиральнойной формы, высота 40 мм, Ø 2,3 мм,
с портом для проводника
по ТУ 9431-003-85134-710-2014

APT	9437.31168
3AB.No	20150407/302

APT	9437.31163
3AB.No	20150407/306

APT 9437.31188
3AB.No 20150407/284

Endografts

MM 2015 02 - 2017

MM 2015.02 - 2017.02

Не представляется возможным использовать при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по применению с предостережением по применению.

Не представляется возможным использовать при наличии перечисленных недостатков Пиред для исследования необходимости ознакомления с руководством по применению!

Не переиздается, использовать вместо него Нормы поваров-поварих.
указаны. Перевод выполнен на основании Норм поваров-поварих
с учетом изменений по переизданию.

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, из материала NETINOL™,
с портом для контрастного вещества, 6-ти струнная,
спиральной формы, высота 50 мм, Ø 1,8 мм
ТУ 9431-003-89134710-2014

Корзина для разрушения и завала камней
одноразового применения, из материала ЛПНД, с
портлом для контрастного вещества, 6-ти струнная,
спиральнойной формы, высота 60 мм, Ø 1,8 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

орзини для разрушения и захвата камней
двухкратного применения, из материала NITINOL™,
портом для контрастного вещества, 6-ти струнная,
длина в сложенной форме, высота 30 мм, Ø 1,8 мм
по ТУ 9431-003-89134-710-2014

APT	9437.31183
3AB.Nº	20150407/285

APT 9437.31184
3AB No 20150407/286

APT 9437.31181
3AB.Nº 20150407/289

Endgültig

2015.02 - 2017.11


MM 2015.02 - 2017

EndyRats

He presented the initial results of the study at the National Conference on the Use of Computers in the Classroom, held in Washington, D.C., in 1971. The study was the first of its kind to be conducted on a national scale.

[illegible]

He previously worked in the research department of the National Institute of Standards and Technology (NIST) and the National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS).

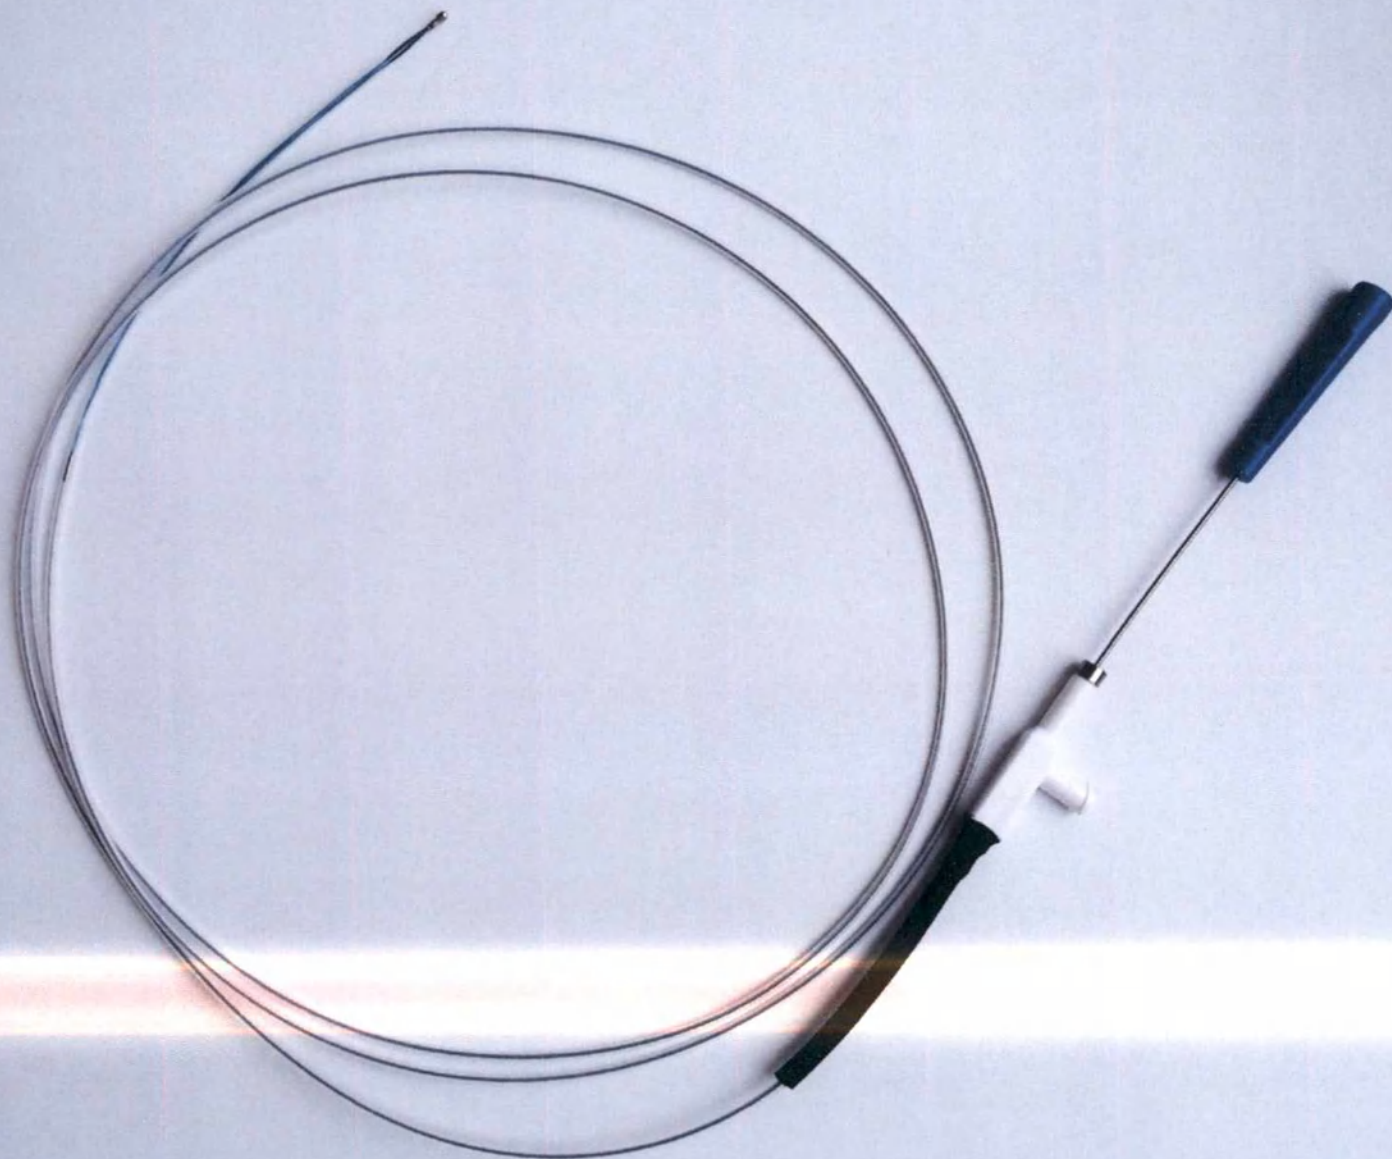

Корзина для удаления инородных тел 4-х струнная

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 4-х струнная, двойная струна,
ромбовидной формы, высота 50 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

АРТ 9437.31260
ЗАВ.№ 20150407/211

М 2015.02 - 2017.02 I 2

EndoStact
ООО «БелСтор»
Белая Вежа 218, м/р. 89134710-2014
См. ТУ 9431-003-89134710-2014
Рос. 187101

Не рекомендуется использовать инструмент при наложении повязочной
улики. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 4-х струнная, двойная струна,
ромбовидной формы, высота 50 мм, Ø 1,8 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

АРТ 9437.31257
ЗАВ.№ 20150407/214

М 2015.02 - 2017.02 I 2

EndoStact
ООО «БелСтор»
Белая Вежа 218, м/р. 89134710-2014
См. ТУ 9431-003-89134710-2014
Рос. 187101

Не рекомендуется использовать инструмент при наложении повязочной
улики. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 4-х струнная, двойная струна,
ромбовидной формы, высота 100 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

АРТ 9437.31258
ЗАВ.№ 20150407/213

М 2015.02 - 2017.02 I 2

EndoStact
ООО «БелСтор»
Белая Вежа 218, м/р. 89134710-2014
См. ТУ 9431-003-89134710-2014
Рос. 187101

Не рекомендуется использовать инструмент при наложении повязочной
улики. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 4-х струнная, двойная струна,
ромбовидной формы, высота 40 мм, Ø 2,3 мм,
с портом для проводника
по ТУ 9431-003-89134710-2014

АРТ 9437.31263
ЗАВ.№ 20150407/209

М 2015.02 - 2017.02 I 2

EndoStact
ООО «БелСтор»
Белая Вежа 218, м/р. 89134710-2014
См. ТУ 9431-003-89134710-2014
Рос. 187101

Не рекомендуется использовать инструмент при наложении повязочной
улики. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 4-х струнная, двойная струна,
ромбовидной формы, высота 60 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

АРТ 9437.31261
ЗАВ.№ 20150407/212

М 2015.02 - 2017.02 I 2

EndoStact
ООО «БелСтор»
Белая Вежа 218, м/р. 89134710-2014
См. ТУ 9431-003-89134710-2014
Рос. 187101

Не рекомендуется использовать инструмент при наложении повязочной
улики. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 4-х струнная, двойная струна,
ромбовидной формы, высота 70 мм, Ø 2,3 мм,
с портом для проводника
по ТУ 9431-003-89134710-2014

АРТ 9437.31266
ЗАВ.№ 20150407/206

М 2015.02 - 2017.02 I 2

EndoStact
ООО «БелСтор»
Белая Вежа 218, м/р. 89134710-2014
См. ТУ 9431-003-89134710-2014
Рос. 187101

Не рекомендуется использовать инструмент при наложении повязочной
улики. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 4-х струнная, двойная струна,
ромбовидной формы, высота 50 мм, Ø 2,3 мм,
с портом для проводника
по ТУ 9431-003-89134710-2014

АПТ 9437.31264
ЗАВ.№ 20150407/209

М 2015 02 - 2017 02 1 2
EndoGast
ООО «Эндоскоп»
Большая Вишня 27А, Москва +7 800 555 54 47
Смольный район, Петербург +7 812 300 21 26
РФ, 191101 www.endo-gast.ru

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 4-х струнная, двойная струна,
ромбовидной формы, высота 40 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

АПТ 9437.31259
ЗАВ.№ 20150407/210

М 2015 02 - 2017 02 1 2
EndoGast
ООО «Эндоскоп»
Большая Вишня 27А, Москва +7 800 555 54 47
Смольный район, Петербург +7 812 300 21 26
РФ, 191101 www.endo-gast.ru

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 4-х струнная, двойная струна,
ромбовидной формы, высота 40 мм, Ø 1,8 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

АПТ 9437.31256
ЗАВ.№ 20150407/215

М 2015 02 - 2017 02 1 2
EndoGast
ООО «Эндоскоп»
Большая Вишня 27А, Москва +7 800 555 54 47
Смольный район, Петербург +7 812 300 21 26
РФ, 191101 www.endo-gast.ru

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 4-х струнная, двойная струна,
спиральной формы, высота 50 мм, Ø 2,3 мм,
с портом для проводника
по ТУ 9431-003-89134710-2014

АПТ 9437.31252
ЗАВ.№ 20150407/221

М 2015 02 - 2017 02 1 2
EndoGast
ООО «Эндоскоп»
Большая Вишня 27А, Москва +7 800 555 54 47
Смольный район, Петербург +7 812 300 21 26
РФ, 191101 www.endo-gast.ru

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 4-х струнная, двойная струна,
ромбовидной формы, высота 30 мм, Ø 1,8 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

АПТ 9437.31255
ЗАВ.№ 20150407/218

М 2015 02 - 2017 02 1 2
EndoGast
ООО «Эндоскоп»
Большая Вишня 27А, Москва +7 800 555 54 47
Смольный район, Петербург +7 812 300 21 26
РФ, 191101 www.endo-gast.ru

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 4-х струнная, двойная струна,
спиральной формы, высота 50 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

АПТ 9437.31248
ЗАВ.№ 20150407/223

М 2015 02 - 2017 02 1 2
EndoGast
ООО «Эндоскоп»
Большая Вишня 27А, Москва +7 800 555 54 47
Смольный район, Петербург +7 812 300 21 26
РФ, 191101 www.endo-gast.ru

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 4-х струнная, двойная струна,
ромбовидной формы, высота 60 мм, Ø 2,3 мм,
с портом для проводника
по ТУ 9431-003-89134710-2014

АПТ 9437.31265
ЗАВ.№ 20150407/205

М 2015 02 - 2017 02 1 2
EndoGast
ООО «Эндоскоп»
Большая Вишня 27А, Москва +7 800 555 54 47
Смольный район, Петербург +7 812 300 21 26
РФ, 191101 www.endo-gast.ru

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 4-х струнная, двойная струна,
ромбовидной формы, высота 70 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

АПТ 9437.31262
ЗАВ.№ 20150407/208

М 2015 02 - 2017 02 1 2
EndoGast
ООО «Эндоскоп»
Большая Вишня 27А, Москва +7 800 555 54 47
Смольный район, Петербург +7 812 300 21 26
РФ, 191101 www.endo-gast.ru

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 4-х струнная, двойная струна,
спиральной формы, высота 70 мм, Ø 2,3 мм,
с портом для проводника
по ТУ 9431-003-89134710-2014

АПТ 9437.31254
ЗАВ.№ 20150407/217

М 2015 02 - 2017 02 1 2
EndoGast
ООО «Эндоскоп»
Большая Вишня 27А, Москва +7 800 555 54 47
Смольный район, Петербург +7 812 300 21 26
РФ, 191101 www.endo-gast.ru


Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной
упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной
упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной
упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, из материала NITINOL™,
с портом для контрастного вещества, 4-х струнная,
ромбовидной формы, высота 50 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014


APT 9437.31156
ЗАВ.№ 20150407/311

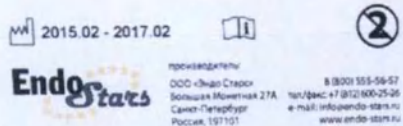

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, тип "МИНИ БАСКЕТ"
из материала NITINOL™, с портом для контрастного
вещества, 4-х струнная, спиралевидной формы,
высота раскрытия 40 мм, ширина раскрытия 20 мм,
Ø вводимого тefлонового тубуса 0,9 мм, длина 200 см
по ТУ 9431-003-89134710-2014


APT 9437.31149
ЗАВ.№ 20150407/322

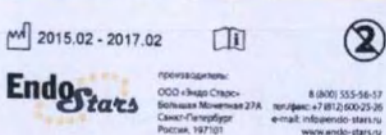

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, для механического
литотриптора ромбовидной формы, усиленная,
4-х струнная, двойные струны, L 400 см, Ø 2,6 мм,
в тefлоновом тубусе с портом для контрастного
вещества, высота 40 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014


APT 9437.31140
ЗАВ.№ 20150407/329

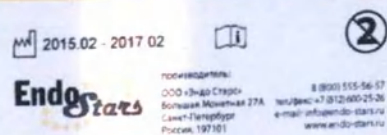

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, для механического
литотриптора ромбовидной формы, усиленная,
4-х струнная, двойные струны, L 400 см, Ø 2,6 мм,
в тefлоновом тубусе с портом для контрастного
вещества, высота 50 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014


APT 9437.31141
ЗАВ.№ 20150407/326

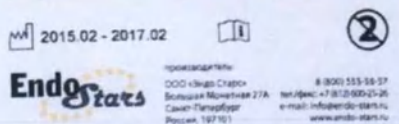

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, из материала NITINOL™,
с портом для контрастного вещества, 4-х струнная,
ромбовидной формы, высота 50 мм, Ø 1,8 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014


APT 9437.31153
ЗАВ.№ 20150407/314

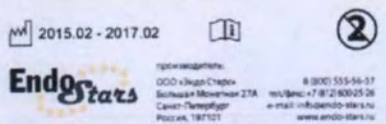

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, из материала NITINOL™,
с портом для контрастного вещества, 4-х струнная,
ромбовидной формы, высота 60 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014


APT 9437.31157
ЗАВ.№ 20150407/312

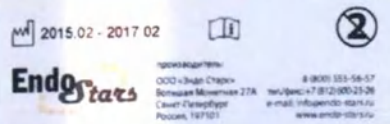

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, из материала NITINOL™,
с портом для контрастного вещества, 4-х струнная,
спиралевидной формы, высота 50 мм, Ø 1,8 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014


APT 9437.31173
ЗАВ.№ 20150407/299



Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, из материала NITINOL™,
с портом для контрастного вещества, 4-х струнная,
спиралевидной формы, высота 30 мм, Ø 1,8 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014


APT 9437.31171
ЗАВ.№ 20150407/297



Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, из материала NITINOL™,
с портом для контрастного вещества, 4-х струнная,
ромбовидной формы, высота 50 мм, Ø 2,3 мм,
с портом для проводника
по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.31159
ЗАВ.№ 20150407/308



Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, (для удаления полипов),
в тефлоновом тубусе, 4-х струнная, двойная струна,
ромбовидной формы, высота 110 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, (для удаления полипов),
в тефлоновом тубусе, 4-х струнная, двойная струна,
ромбовидной формы, высота 70 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, (для удаления полипов),
в тефлоновом тубусе, 4-х струнная, двойная струна,
ромбовидной формы, высота 60 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.31285

ЗАВ.№ 20150407/184

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старкс»
Большая Мокшанская 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101

8 (800) 555-56-57
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденных упаковок. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

APT 9437.31284

ЗАВ.№ 20150407/189

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старкс»
Большая Мокшанская 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101

8 (800) 555-56-57
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденных упаковок. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

APT 9437.31283

ЗАВ.№ 20150407/188

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старкс»
Большая Мокшанская 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101

8 (800) 555-56-57
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденных упаковок. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 4-х струнная, двойная струна,
спиралевидной формы, высота 40 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 4-х струнная, двойная струна,
спиралевидной формы, высота 30 мм, Ø 1,8 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 4-х струнная, двойная струна,
спиралевидной формы, высота 40 мм, Ø 1,8 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.31247

ЗАВ.№ 20150407/222

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старкс»
Большая Мокшанская 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101

8 (800) 555-56-57
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденных упаковок. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

APT 9437.31244

ЗАВ.№ 20150407/225

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старкс»
Большая Мокшанская 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101

8 (800) 555-56-57
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденных упаковок. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

APT 9437.31245

ЗАВ.№ 20150407/226

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старкс»
Большая Мокшанская 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101

8 (800) 555-56-57
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденных упаковок. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 4-х струнная, двойная струна,
спиралевидной формы, высота 40 мм, Ø 2,3 мм,
с портом для проводника
по ТУ 9431-003-89134710-2014

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 4-х струнная, двойная струна,
спиралевидной формы, высота 70 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 4-х струнная, двойная струна,
спиралевидной формы, высота 60 мм, Ø 2,3 мм,
с портом для проводника
по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.31251

ЗАВ.№ 20150407/220

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старкс»
Большая Мокшанская 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101

8 (800) 555-56-57
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденных упаковок. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

APT 9437.31250

ЗАВ.№ 20150407/219

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старкс»
Большая Мокшанская 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101

8 (800) 555-56-57
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденных упаковок. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

APT 9437.31253

ЗАВ.№ 20150407/216

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старкс»
Большая Мокшанская 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101

8 (800) 555-56-57
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденных упаковок. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Корзина для разрушения и захвата камней
одноократного применения из материала NITINOL™,
с портом для контрастного вещества, 4-х струнная,
ромбовидной формы, высота 40 мм, Ø 2,3 мм,
с портом для проводника
по ТУ 9431-003-89134710-2014

АРТ 9437.31158
ЗАВ.№ 20150407/313

М 2015.02 - 2017.02



EndoGastr

производитель:
ООО «Айра-Стар»
Большая Мещеряя 27А, м/п.б.с. +7 (812) 803-2526
Санкт-Петербург
Ростов, 197101
www.endo-gastr.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной
улитки. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению

Корзина для разрушения и захвата камней
одноократного применения, из материала NITINOL™,
с портом для контрастного вещества, 4-х струнная,
ромбовидной формы, высота 40 мм, Ø 1,8 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

АРТ 9437.31152
ЗАВ.№ 20150407/319

М 2015.02 - 2017.02



EndoGastr

производитель:
ООО «Айра-Стар»
Большая Мещеряя 27А, м/п.б.с. +7 (812) 803-2526
Санкт-Петербург
Ростов, 197101
www.endo-gastr.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной
улитки. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению

Корзина для разрушения и захвата камней
одноократного применения, тип "МЯКИЙ БАСКЕТ"
из материала NITINOL™, с портом для контрастного
вещества, 4-х струнная, спиральной формы,
высота раскрытия 30 мм, ширина раскрытия 15 мм,
Ø вводного телефонного трубка 0,9 мм, длина 230 см
по ТУ 9431-003-89134710-2014

АРТ 9437.31150
ЗАВ.№ 20150407/317

М 2015.02 - 2017.02



EndoGastr

производитель:
ООО «Айра-Стар»
Большая Мещеряя 27А, м/п.б.с. +7 (812) 803-2526
Санкт-Петербург
Ростов, 197101
www.endo-gastr.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной
улитки. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению

Корзина для разрушения и захвата камней
одноократного применения, из материала NITINOL™,
с портом для контрастного вещества, 4-х струнная,
ромбовидной формы, высота 60 мм, Ø 1,8 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

АРТ 9437.31154
ЗАВ.№ 20150407/315

М 2015.02 - 2017.02



EndoGastr

производитель:
ООО «Айра-Стар»
Большая Мещеряя 27А, м/п.б.с. +7 (812) 803-2526
Санкт-Петербург
Ростов, 197101
www.endo-gastr.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной
улитки. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению

Корзина для разрушения и захвата камней
одноократного применения, из материала NITINOL™,
с портом для контрастного вещества, 4-х струнная,
ромбовидной формы, высота 40 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

АРТ 9437.31155
ЗАВ.№ 20150407/316

М 2015.02 - 2017.02



EndoGastr

производитель:
ООО «Айра-Стар»
Большая Мещеряя 27А, м/п.б.с. +7 (812) 803-2526
Санкт-Петербург
Ростов, 197101
www.endo-gastr.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной
улитки. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению

Корзина для разрушения и захвата камней
одноократного применения, для механического
диспергирования ромбовидной формы, усилена,
4-х струнная, двойные струны, L 400 см, Ø 3,4 мм,
в телефонном трубе с портом для контрастного
вещества, высота 60 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

АРТ 9437.31144
ЗАВ.№ 20150407/325

М 2015.02 - 2017.02



EndoGastr

производитель:
ООО «Айра-Стар»
Большая Мещеряя 27А, м/п.б.с. +7 (812) 803-2526
Санкт-Петербург
Ростов, 197101
www.endo-gastr.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной
улитки. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению

Корзина для разрушения и захвата камней
одноократного применения, из материала NITINOL™,
с портом для контрастного вещества, 4-х струнная,
ромбовидной формы, высота 30 мм, Ø 1,8 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

АРТ 9437.31151
ЗАВ.№ 20150407/318

М 2015.02 - 2017.02



EndoGastr

производитель:
ООО «Айра-Стар»
Большая Мещеряя 27А, м/п.б.с. +7 (812) 803-2526
Санкт-Петербург
Ростов, 197101
www.endo-gastr.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной
улитки. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению

Корзина для разрушения и захвата камней
одноократного применения, для механического
диспергирования ромбовидной формы, усилена,
4-х струнная, двойные струны, L 400 см, Ø 3,4 мм,
в телефонном трубе с портом для контрастного
вещества, высота 70 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

АРТ 9437.31145
ЗАВ.№ 20150407/324

М 2015.02 - 2017.02



EndoGastr

производитель:
ООО «Айра-Стар»
Большая Мещеряя 27А, м/п.б.с. +7 (812) 803-2526
Санкт-Петербург
Ростов, 197101
www.endo-gastr.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной
улитки. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению

Корзина для разрушения и захвата камней
одноократного применения, тип "МЯКИЙ БАСКЕТ"
из материала NITINOL™, с портом для контрастного
вещества, 4-х струнная, спиральной формы,
высота раскрытия 30 мм, ширина раскрытия 15 мм,
Ø вводного телефонного трубка 0,9 мм, длина 200 см
по ТУ 9431-003-89134710-2014

АРТ 9437.31148
ЗАВ.№ 20150407/321

М 2015.02 - 2017.02



EndoGastr

производитель:
ООО «Айра-Стар»
Большая Мещеряя 27А, м/п.б.с. +7 (812) 803-2526
Санкт-Петербург
Ростов, 197101
www.endo-gastr.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной
улитки. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению

Корзина для разрушения и захвата каменной
однокапюльной прикладной, с портом для
контрастного вещества, 4 х струнная, монофильная
струна, спиральной формы, высота 70 мм, Ø 2,3 мм,
с портом для проводной
по ТУ 9431-003-89134-70-2014

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 4-х струнная, монофильная
струна, ромбовидной формы, высота 40 мм, Ø 1,8 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

Корзина для разрушения и заката камней
однокротного применения, с портом для
контрастного вещества, 4-х струнная, монофильная
струна, ромбовидной формы, высота 30 мм, Ø 1,8 мм
по ТУ 9431-003-89134-10-2014

APT 9437.31202
3AB.Nº 20150407/269

APT **9437.31204**
3AB.Nº **20150407/267**

APT 9437.31203
3AB.Nº 20150407/268

EndoStats

2015-02 - 2017-02

© 2015 EndoStats

8 800.555.96-87
toll-free 1-813.600.52-26
e-mail: info@endo-stats.ru
www.endo-stats.ru

 2015-02-2017-02


EndoStats
 R package for:
 ODC + Naps-Crigo
 Bolonha-Bernardes 21A
 Cervei - Vinçny
 Paredes (37131)
 8 3005 555 56 57
 tlf:0035 +8121 600 931 26
 e-mail: info@endo-stats.ru
 www.endo-stats.ru




EndoStats
 Your endo ally!
 Dr. J. Inge Clague
 Bolinas, Bolinas 374
 EndoStats
 Email: info@endo-stats.ru
 Phone: (907) 01

8 (800) 555-56-57
 info@endo-stats.ru
 e-mail: info@endo-stats.ru
 www.endo-stats.ru

2015-02 - 2017-02

2

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению.

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений
устройства. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению!

Корзина для разрушения и захвата камней
однокатного применения, с портом для
контрастного вещества, 4-х струнная, монофильная
струна, ромбовидной формы, высота 60 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

Корзина для разрушения и захвата камней
однокопчатного применения, с портом для
контрастного вещества, 4-х струнная, монофильная
струна, рабмовидной формы, высота 50 мм, Ø 2,3 мм
с портом для проводника
по ТУ 9431-003-89134710-2014

Корзина для разрушения и захвата камней
однокатного применения, с портом для
контрастного вещества, 4-х струнная монофильная
струна, ромбовидной формы, высота 70 мм, Ø 2,3 мм,
с портом для проводника
по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT **9437.31208**
3AB.Nº 20150407/261

APT 9437.31211
3AB.Nº 20150407/258

APT **9437.31213**
3AB.NP **20150407/260**

 2015.02 - 2017.02
 

EndoRats

responsible persons:

CEO: Julia Cigna
 Business Manager: JTA
 Camp "Pamirgort"
 Phone: +37201

B 8005 555 56 57
 mcs@mc.com +3720025120
 e-mail: info@mc.com
 www.endo-rats.com



 2015-02 - 2017-02



EndoStart
DCC • 1420 C/NP/00
Bismutha 80g/250ml 278
Email: endo@endo-start.com

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений
уплотнения. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению!

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Не представляется возможным инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.

Корзина для разрушения и захвата камней
одноокрастного применения, с портом для
контрастного вещества, 4-х струнная, монофильная
струна, ромбовидной формы, высота 60 мм, Ø 2,3 мм
с портом для проводника
по ТУ 9431-003-89134710-2014

Корзина для разрушения и заплата каменной
однокопчатого применения, с портом для
контрастного вещества, 4-х струйная, двойная струна,
спиральная форма, высота 60 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-69134710-2014

Корзина для разгрузочных и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 4-х струнная, двойная струна,
спиральной ф. разд., высота 50 мм, Ø 1,8 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT	9437.31212
3AB.Nº	20150407/259

APT	9437.31249
3AB.Nº	20150407/1224

APT 9437.31246

EndoStax

© 2015, 02 - 2017, 02

11

2

© 2015, 02 - 2017, 02

11

2

EndoStays

COO + Sales Manager
Brynna M. Williams, DVM
Chief, EndoStays

800.515.64.57
ms@endo-stays.com
www.endo-stays.com

2015-02-2017-02

1

2

[illegible]

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием убедитесь, что вы знакомы с правилами по применению.

He presented the following results and figures for his presentation:

He pronounced the words with the purity of his native language.
 "I have been looking for you for a long time."
 "I have been looking for you for a long time."

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, из материала NTINOL™,
с портом для контрастного вещества, 4-х струнная,
спиральевидной формы, высота 40 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.31175
3AB.Nº 20150407/295

2015.02 - 2017.02

EndoStats

Specialists in:
DOO & Intra-Cranial
Biomatrix Monitoring
Case Management
Case Transfer

8 (800) 515-5657
www.qlac.com
e-mail: info@endo-stats.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений ушка. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению.

Корзинка для разрушения и захвата камней
однородного применения, для механического
диопитратора рыхлосвальной формы, 4 х струнная,
двойные струны, L 400 см, Ø 6 мм, в тельном
тубуса с портом для контрольного вещества,
высота 70 мм, с каналом для проводника
по 19 9431-003-69134710-2014

APT	9437.31134
3AB.Nº	20150407/335

2015.02 - 2017.02

EndoStats
 info@endo-stats.com
 800.615.5637
 1944 Quince + 781.214.6525
 #EndoStats

Не представляется возможным использовать эти данные при наличии подражательных реакций. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.

Корзина для разрушения и тавела камней
однокротного применения. Для механического
литогригатора ромбоидальной формы, 4 х струнная,
двойные струны, L 400 см, Ø 2,6 мм, в тейлловом
трубке с портом для конденсатора вещества,
высота 80 мм, с каналою для проводника
по ТУ 9431-003-89134.710-2014

APT **9437.31135**
3AB,Nº **20150407/332**

MM 2015.02 - 2017.02

Endo
Syrates

Specialized
COC • Dual-Choice
Bioscience Laboratories, LTD.
Carroll, CT 06330
Phone: 1-877-911-
8800 FAX: 203-345-5151
www.endosyrates.com

He pashchenniyetsa vostochnykh veystranyt nra narynnyy razpredelnyy ymashov. Pripazh vostochnykh nedyshnykh shlyachnykh shlyachnykh s shlyachnykh na shlyachnykh

Корзина для разрушения и захвата камней
однокартного применения, из материала NITINOL™,
с портом для контрастного вещества, 4-х струнная,
стерилизуемой формы, высота 60 мм, Ø 1,8 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT **9437.31174**
3AB.Nº **20150407/294**

MM 2015.02 - 2017.02

EndoGrafx

PO Box 1000
OOO • Anguilla, Crago
Bermuda Waters • 21A
Crest, P.O. Box 1000
A (800) 555-56-57
www.angr.com
Tel: (412) 605-25-26
E-mail: info@endo-grafx.com

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению.

Корзи для разрушения и заглава камней
однокаптного применения, для механического
литопитора ромбоидальной формы, 4-х струнная
двойные струны, L 400 см, Ø 2,6 мм, в телефонном
трубе с портом для контрастного вещества,
высота 60 мм, с каналом для проводника
по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.31133
3AB.Nº 20150407/336

2015.02 - 2017.02

EndoStats

DOO • Niall C. O'Keefe
EndoStats Management 27A
Carmel, Pennsylvania
Pittsburgh, PA 15201

800.255.56.57
info@endo-stats.com
e-mail: info@endo-stats.com
www.endo-stats.com

He рекомендуется использовать этот продукт при наличии противопоказаний. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.

Корзина для разрушения и заката комовой однокорнотого растения, для механического дробления ромбовидной формы, усиленная, 4-х стропила, двойная струна, L 400 см, Ø 2,6 мм, в телефонном трубе с торсом для контрастного вещества, высота 70 мм

APT 9437.31143
3AB No 20150407/328

2015-02-2017-02

Endogates

0000 Abasco Canyon
Boulevard, Suite 217
Crested Butte, CO 81004
Phone: 970.337.1111

800.337.5555
Fax: 970.337.1111
E-mail: info@endogates.com
Web: www.endogates.com

He preiznaje i pita, a potom i kaže: "Pitam te, a ti mi odgovoraj!"
 "Pitam te, a ti mi odgovoraj!"
 "Pitam te, a ti mi odgovoraj!"

Корзина для разрушения и захвата камней
однокротного применения, из материала NITINOL™
с портом для контрольного вещества, 4-х струнная,
спиральной формы, высота 50 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-891 34710-2014

APT 9437.31176
3AB.Nº 20150407/296

2015.02 - 2017.02

Endografts
 1100 N. 1st St., Suite 200
 St. Louis, MO 63102
 Tel: 314.436.1100
 Fax: 314.436.1101
 Email: info@endograft.com

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений участка. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Корзина для разрушения и лавала каменной однократного применения, для механического литолизатора ромбовидной формы, 4-х струнная, двойные струны, L 400 см, Ø 2,6 мм, в телефонном трубе с портом для контрастного вещества, высота 50 мм; с началом для проводника по 9431 001; с началом для проводника по 89134710-2014

APT 9437.31132
3AB.Nº 20150407/337

MM 2015.02 - 2017.02

Endogate

2001 • Budget Choice
600 South Main Street 214
Lawrenceville, GA 30046
Tel: 770.962.7111

800.515.5647
www.endogate.com
info@endogate.com
e-mail: info@endogate.com
www.endogate.com

Не рекомендуется использовать этот препарат при наличии повышенной чувствительности к компонентам препарата. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией к препарату, так как препарат не предназначен для приема внутрь.

Корзинки для разлушения и заглава камней
диаметром до 10 см, для механического
разрушения и разлушения камней
интенсивности размолаивания формы усиленная,
4 струнная, двойные струны, L 400 см, Ø 2,6 мм,
в телефонном боксе с портом для контрастного
цветного, высота 60 см

APT **9437.31142**
3AB.Nº **20150407/327**

2015.02 - 2017.02

Endogates

TREC • Endo Systems
800-675-9276 ext. 274
Email: sales@endosys.com
Web: www.endosys.com

[illegible]

Корзина для разрушения и захвата камней
однокартного применения, с портом для
контрастного вещества, 4-х струнная, монофильная
струна, спиральной формы, высота 50 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-89134-70-2014

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 4-х струнная, монофильная
струна, спиральевидной формы, высота 60 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-89134.710-2014

Корзина для разрушения и захвата камней
однокаплетное применение, с портом для
контрастного вещества, 4 х струнная, монофильная
струна, спиралевидной формы, высота 50 мм Ø 2,3 мм,
с портом для проводника
по ТУ 9431-00- 89134710-2014

APT 9437.31196
3AB Nº 20150407/275

APT 9437.31197
3AB.Nº 20150407/274

APT 9437.31200
3AB, № 20150407/271

 2015-02 - 2017-02
 
 registered address:
 CCC • Incub 1 Crd 04
 Box 10000
 Columbia, Maryland 21046
 Call: 410-326-7171
 E-mail: info@ccc-incub.com
 Web: www.ccc-incub.com

EndosTaz

Representative:
OOO & Supply Services
Business Development
Crest-Chicago
Chicago, IL 60611
www.endosTaz.com

800.555.5657
toll-free 1-877-600-2526
e-mail: info@endosTaz.com
www.endosTaz.com


 2015-02-2017-02
 1
 2

Корзина для разрушения и захвата камней
однокатанного применения, с портом для
контрастного вещества, 4 х струнная, монофильная
струна, спиральной формы, высота 40 мм, Ø 2,3 мм
с портом для проводника
по ТУ 9431-003-89134-710-2014

Корзина для разрушения и захвата камней
окислительного применения, с портом для
контрастного вещества, 4-х струнная, монофильная
струна, ромбовидной формы, высота 50 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-89134-710-2014

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, с портом для
контрастного вещества, 4-х струнная, монофильная
струна, ромбовидной формы, высота 50 мм, Ø 1,8 мм,
по ТУ 9431-003-8914.710-2014

APT	9437.31199
3AB.Nº	20150407/270

APT 9437.31207
3AB № 20150407/266

APT 9437.31205
3AB № 20150407/264




800.555.5647
 800.555.5647
 800.555.5647

 2015-02 - 2017-02



EndoStar
 2015-02-20 / 02
 8 000 133 56 10
 www.endo-star.it
 e-mail: info@endo-star.it
 2015-02-20 / 02

На протяжении истории были известны три основных направления в развитии теории множеств: интуитивизм, аксиоматический и формальный. Теория множеств является фундаментом современной математики с точки зрения не только математики, но и информатики.

He pashchivayetsya vtoroy kachestvennoy tipologii pri raznykh kompozitsionnykh yadakh. Priroda vnutrennykh i vneshnykh meditsionnykh prikladov. (Pripada k vnutrennyim i vneshnyim meditsionnyim prikladam)

Университет Пешта и Вишegrad
и Вишegrad, и Вишegrad, и Вишegrad
и Вишegrad, и Вишegrad, и Вишegrad

Корзина для разрушения и захвата клонной
однозаритного применения, с портом для
контрастного вещества, 4-х струнная, монофилная
струна, разбавленная форма, высота 40 мм, Ø 2,3 мм
Страна: Россия
Тел: +7 (495) 313-8913
Факс: +7 (495) 313-8914
E-mail: info@medtronic.ru
Сайт: www.medtronic.ru

Корзина для разрушения и завалка камней
однокатного применения, с тросом для
контростанции вывешива, 4 х струна, монофильная
струна, разбавленная ферма, высота 70 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

Коринна для разрушения и захвата камней
однофазного применения, с портом для
контрастного вещества, 4-х струйная, монофазная
струя, ровнотонная фирма, высота 40 мм, Ø 2,3 мм,
с портом для промывания

APT 9437.31206
3ABN[®] 20150407/265

APT	9437.31209
3AB MW	20150407/262

APT 9437.31210
3AB No 20150407/263

EndoRay

2015-02 - 2017-02

QOS - Check Center
Sobremonte Bernardino 219
Calle 7, Bogotá
Código: 110011

A 3000 000 004
No. QOS: 418 2000121
e-mail: info@endo-ray.com
www.endo-ray.com


 2015-02-2017 02

EndoStats

1-800-393-6344
 www.mhprofessional.com
 1-800-393-6344
 www.mhprofessional.com

EndoStar


The present study was designed to investigate the effects of a 12-week training program on the physical and psychological health of young adults. The results of the study are presented in the following sections.

The present study addresses the question of whether the presence of a female partner affects the relationship between the presence of a female partner and the presence of a female partner.

prace: *Prace z historii i geografii*
(1920-1921) i (1922-1923)

Корзина для разрушения и захвата камней
однократного применения, из материала NITINOL™,
с портом для контрастного вещества, 4-х струнная,
спиралевидной формы, высота 60 мм, Ø 2,3 мм
по ТУ 9431-003-89134710-2014

[illegible]

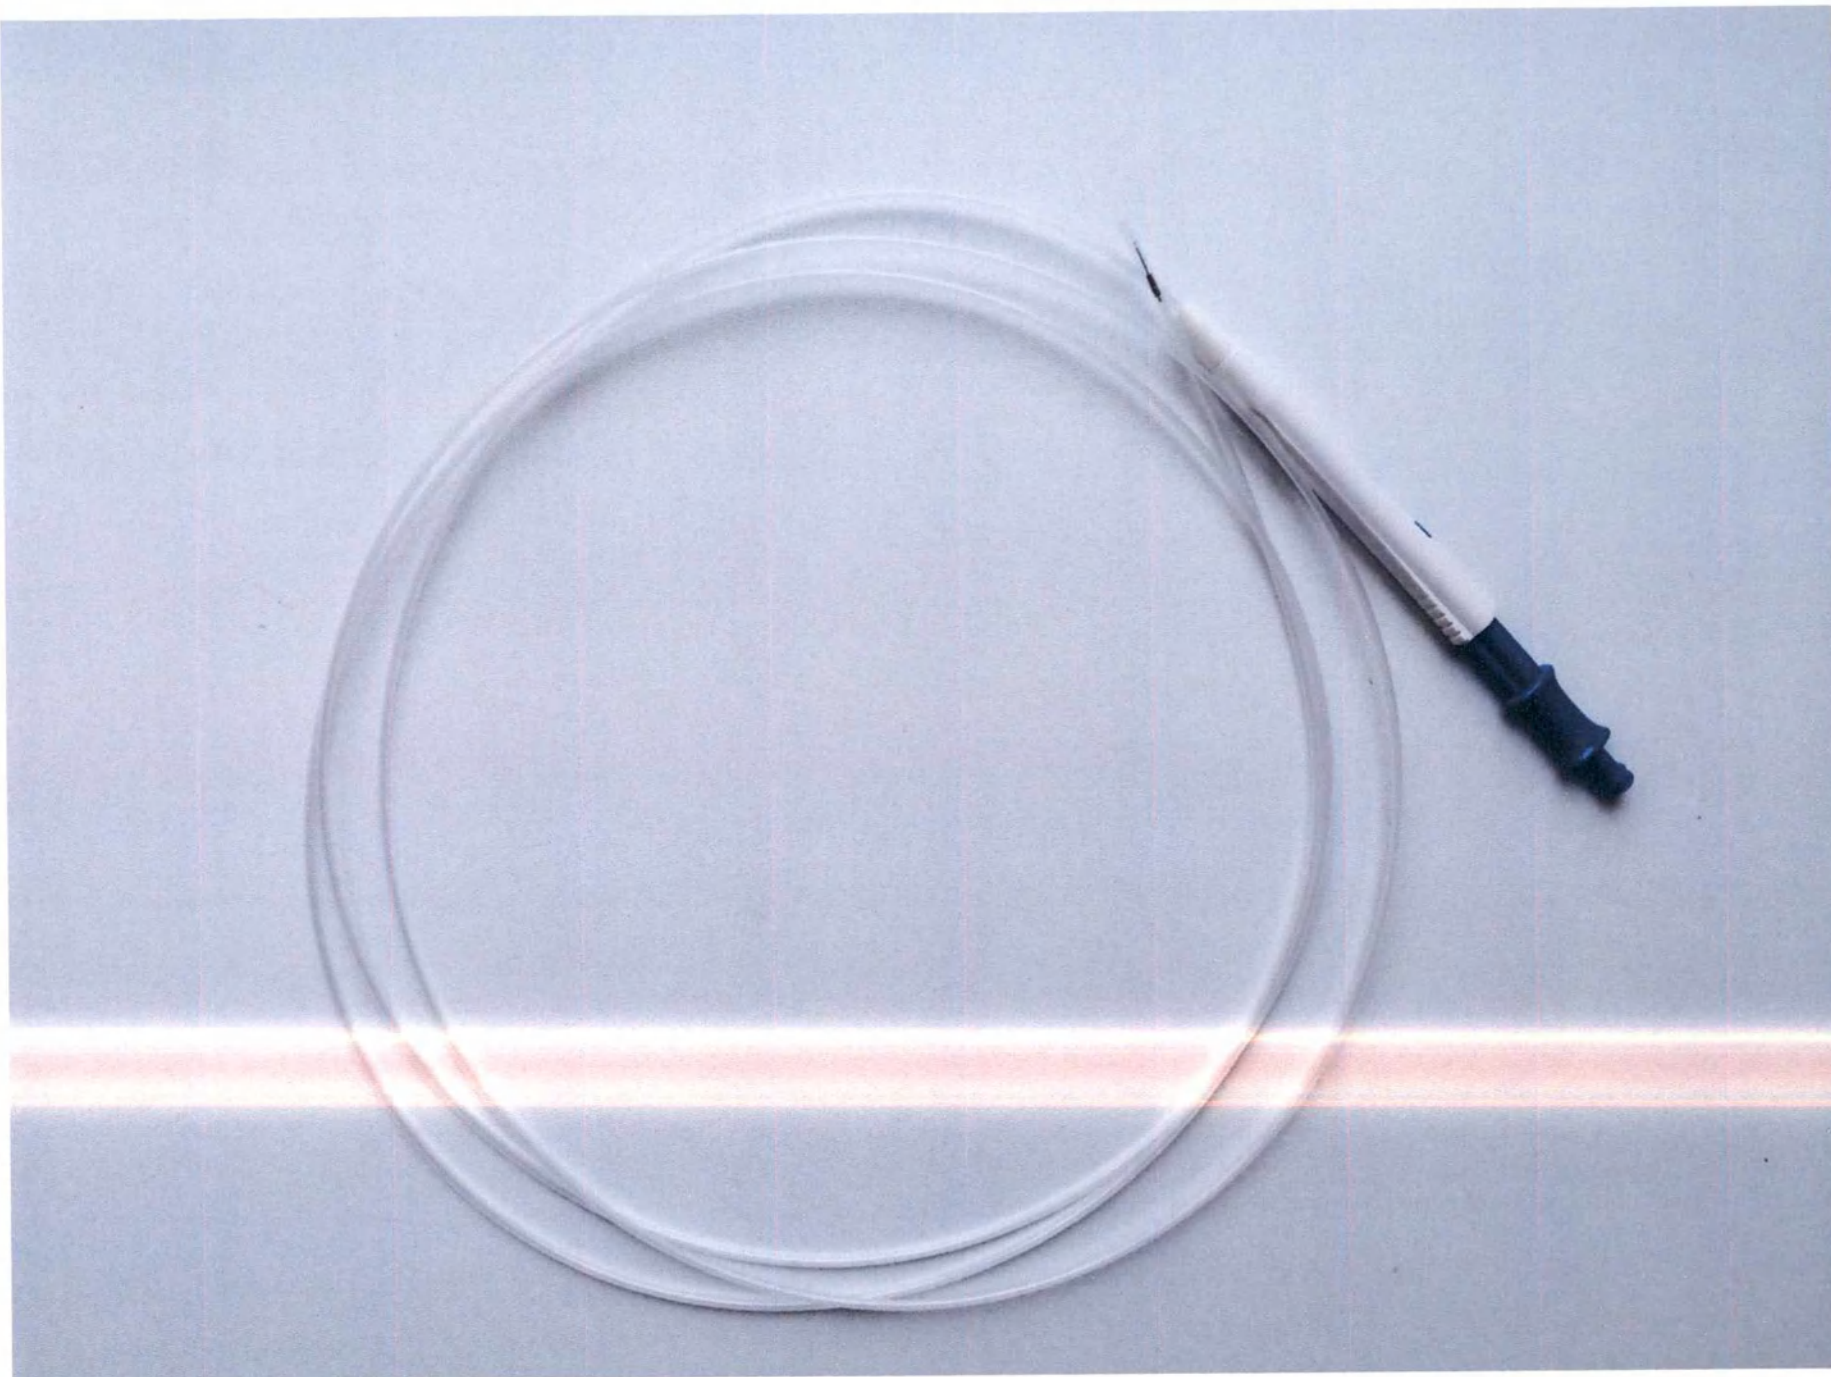

Инъектор

ООО ЦРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Инъектор однократного применения, диаметр иглы 0,7 мм, длина иглы 4 мм, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 180 см, тип 1

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.51123

ЗАВ.№ 20150407/358

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
8 (800) 555-56-57
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Инъектор однократного применения, диаметр иглы 0,7 мм, длина иглы 4 мм, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 180 см, тип 2

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.51119

ЗАВ.№ 20150407/354

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
8 (800) 555-56-57
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Инъектор однократного применения, с двумя раздельными иглами диаметром 0,8/0,65 мм, длина иглы 6 мм, диаметр 2,6 мм, для канала 2,8 мм, длина 180 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.51136

ЗАВ.№ 20150407/365

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
8 (800) 555-56-57
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Инъектор однократного применения, со сменной внешней иглой диаметром 0,8 мм на резьбовом соединении, длина иглы 6 мм, диаметр 2,6 мм, для канала 2,8 мм, длина 230 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.51140

ЗАВ.№ 20150407/369

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
8 (800) 555-56-57
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Инъектор однократного применения, трансбронхиальный, диаметр иглы 0,7 мм, длина иглы 6 мм, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 120 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.51142

ЗАВ.№ 20150407/371

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
8 (800) 555-56-57
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Инъектор однократного применения, с двумя раздельными иглами диаметром 0,8/0,65 мм, длина иглы 6 мм, диаметр 2,6 мм, для канала 2,8 мм, длина 160 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.51135

ЗАВ.№ 20150407/364

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
8 (800) 555-56-57
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Инъектор однократного применения, со сменной внешней иглой диаметром 0,8 мм на резьбовом соединении, длина иглы 6 мм, диаметр 2,6 мм, для канала 2,8 мм, длина 180 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.51139

ЗАВ.№ 20150407/368

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
8 (800) 555-56-57
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Инъектор однократного применения, диаметр иглы 0,7 мм, длина иглы 6 мм, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 230 см, тип 1

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.51126

ЗАВ.№ 20150407/361

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
8 (800) 555-56-57
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Инъектор однократного применения, диаметр иглы 0,7 мм, длина иглы 4 мм, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 230 см, тип 1

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.51125

ЗАВ.№ 20150407/360

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
8 (800) 555-56-57
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Инъектор однократного применения, трансбронхиальный, диаметр иглы 0,9 мм, длина иглы 6 мм, диаметр 1,8 мм, для канала 2,0 мм, длина 120 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.51143

ЗАВ.№ 20150407/372

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
телефон: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru



Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Инъектор однократного применения, диаметр иглы 0,7 мм, длина иглы 4 мм, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 160 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.51154

ЗАВ.№ 20150407/381

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
телефон: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru



Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Инъектор однократного применения, трансбронхиальный, диаметр иглы 0,9 мм, длина иглы 6 мм, диаметр 1,8 мм, для канала 2,0 мм, длина 120 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.51146

ЗАВ.№ 20150407/374

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
телефон: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru



Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Инъектор однократного применения, трансбронхиальный, диаметр иглы 0,7 мм, длина иглы 6 мм, диаметр 1,8 мм, для канала 2,0 мм, длина 120 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.51141

ЗАВ.№ 20150407/370

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
телефон: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru



Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Инъектор однократного применения, со сменной внешней иглой диаметром 0,8 мм на резьбовом соединении, длина иглы 6 мм, диаметр 2,6 мм, для канала 2,8 мм, длина 160 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.51138

ЗАВ.№ 20150407/367

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
телефон: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru



Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Инъектор однократного применения, диаметр иглы 0,7 мм, длина иглы 5 мм, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 230 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.51148

ЗАВ.№ 20150407/376

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
телефон: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru



Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Инъектор однократного применения, диаметр иглы 0,6 мм, длина иглы 4 мм, диаметр 1,8 мм, для канала 2,0 мм, длина 180 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.51150

ЗАВ.№ 20150407/377

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
телефон: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru



Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Инъектор однократного применения, с двумя раздельными иглами диаметром 0,8/0,65 мм, длина иглы 6 мм, диаметр 2,6 мм, для канала 2,8 мм, длина 180 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.51137

ЗАВ.№ 20150407/366

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
телефон: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru



Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Инъектор однократного применения, диаметр иглы 0,7 мм, длина иглы 5 мм, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 180 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.51147

ЗАВ.№ 20150407/375

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
телефон: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru



Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Инъектор однократного применения, диаметр иглы
0,6 мм, длина иглы 4 мм, диаметр 1,8 мм, для канала
2,0 мм, длина 160 см, тип 1

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.51111

ЗАВ.№ 20150407/176

ММ 2015.02 - 2017.02



EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старкс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
телефон: +7 (812) 555-56-57
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений
упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению!

Инъектор однократного применения, диаметр иглы
0,6 мм, длина иглы 6 мм, диаметр 1,8 мм, для канала
2,0 мм, длина 160 см, тип 1

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.51112

ЗАВ.№ 20150407/177

ММ 2015.02 - 2017.02



EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старкс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
телефон: +7 (812) 555-56-57
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений
упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению!

Инъектор однократного применения, диаметр иглы
0,7 мм, длина иглы 4 мм, диаметр 2,3 мм, для канала
2,8 мм, длина 160 см, тип 2

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.51118

ЗАВ.№ 20150407/353

ММ 2015.02 - 2017.02



EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старкс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
телефон: +7 (812) 555-56-57
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений
упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению!

Инъектор однократного применения, диаметр иглы
0,7 мм, длина иглы 4 мм, диаметр 2,3 мм, для канала
2,8 мм, длина 160 см, тип 1

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.51121

ЗАВ.№ 20150407/356

ММ 2015.02 - 2017.02



EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старкс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
телефон: +7 (812) 555-56-57
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений
упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению!

Инъектор однократного применения, диаметр иглы
0,7 мм, длина иглы 4 мм, диаметр 2,3 мм, для канала
2,8 мм, длина 230 см, тип 2

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.51120

ЗАВ.№ 20150407/355


ММ 2015.02 - 2017.02



EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старкс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
телефон: +7 (812) 555-56-57
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений
упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению!

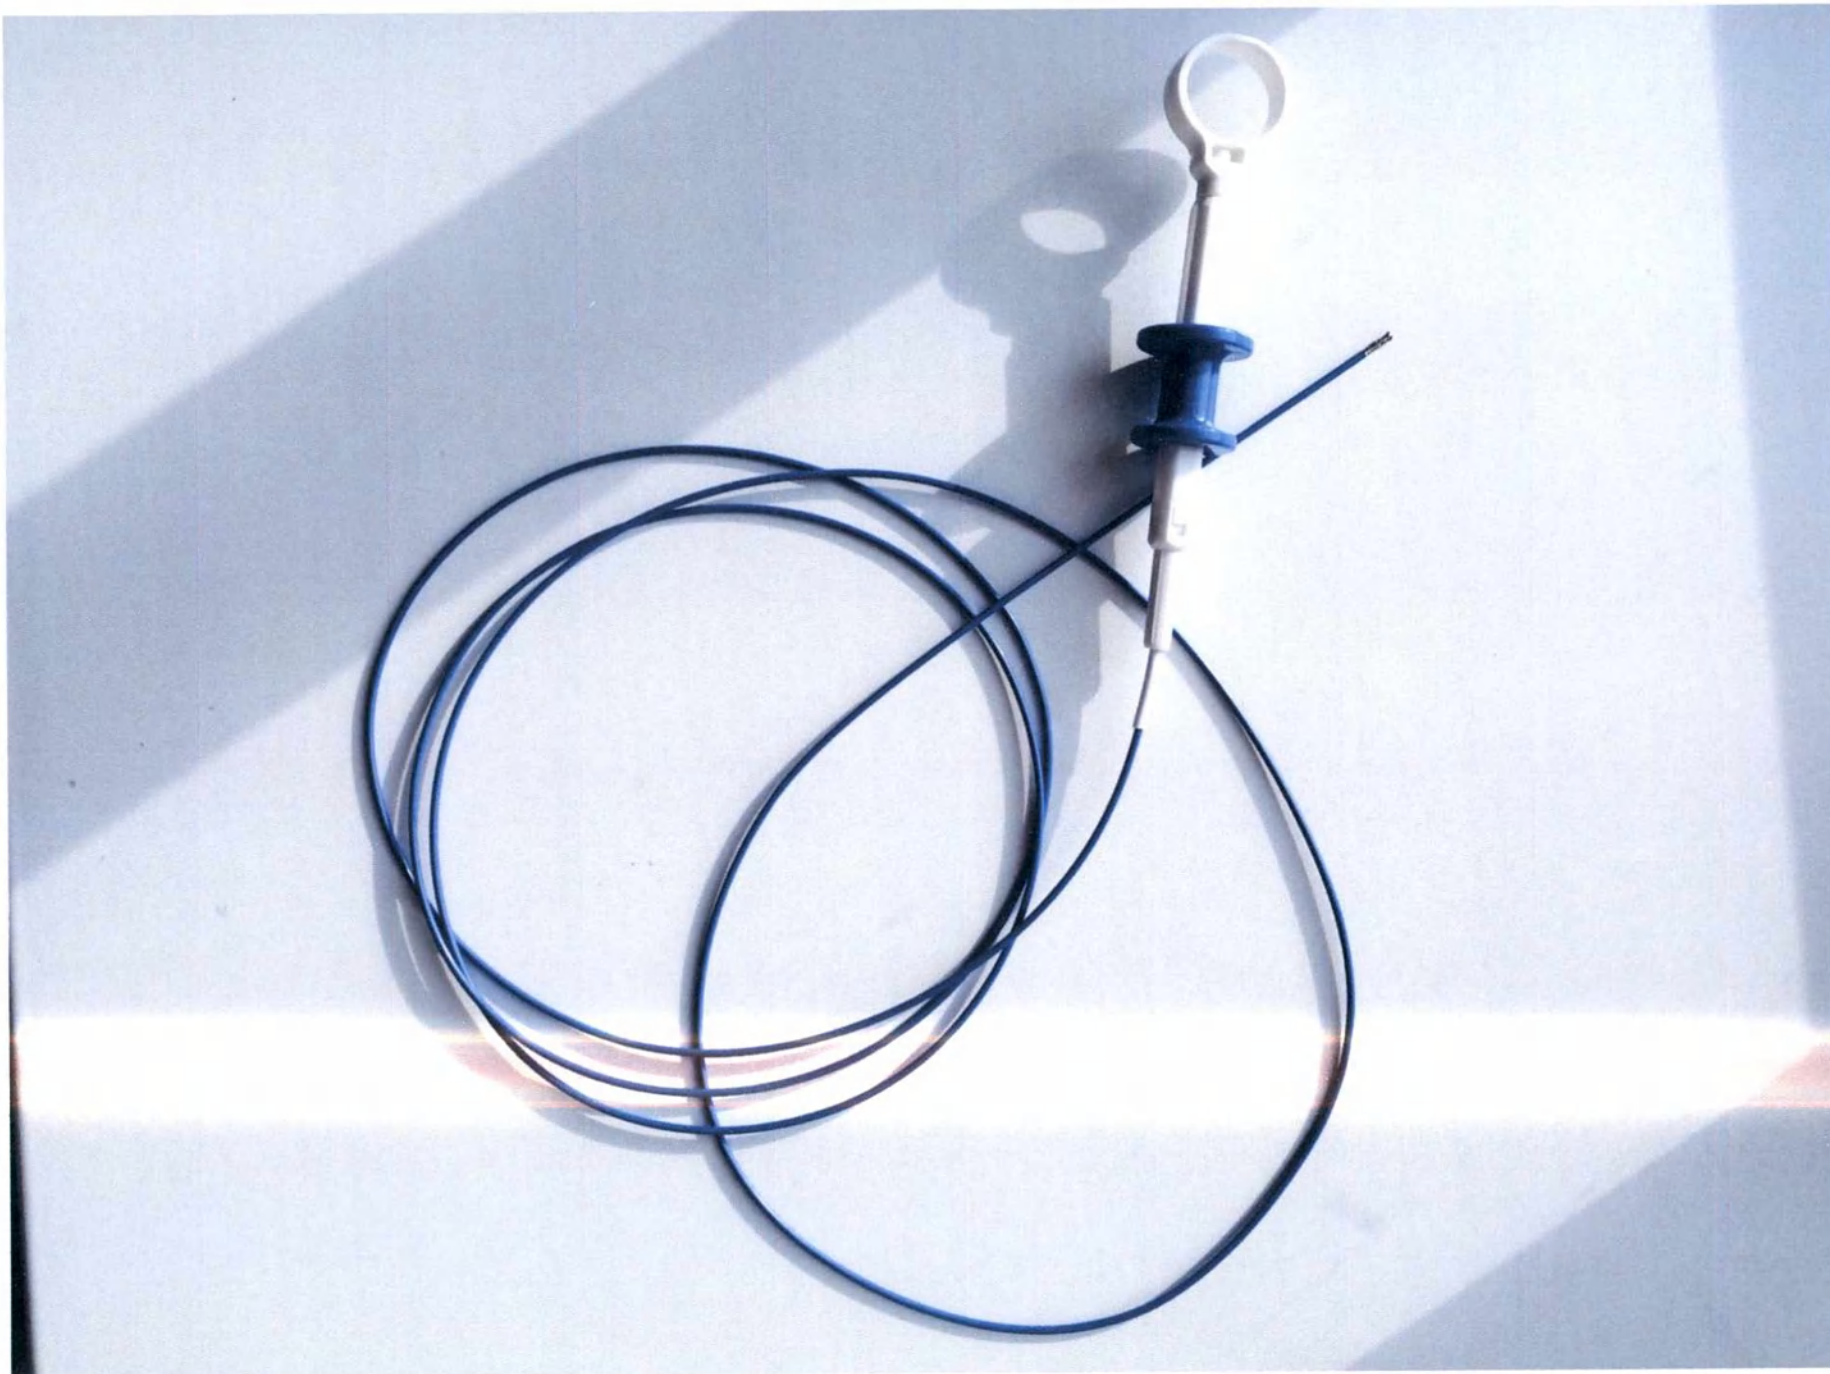

Захват лапковый

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Захват для удаления инородных тел однократного применения, четырех-лапковый, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 230 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.29126

ЗАВ.№ 20150407/161

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндостарс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
телефон: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Захват для удаления инородных тел однократного применения, пяти-лапковый, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 180 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.29124

ЗАВ.№ 20150407/159

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндостарс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
телефон: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Захват для удаления инородных тел однократного применения, трех-лапковый, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 230 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.29125

ЗАВ.№ 20150407/160

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндостарс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
телефон: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Захват для удаления инородных тел однократного применения, трех-лапковый, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 160 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.29119

ЗАВ.№ 20150407/154

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндостарс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
телефон: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Захват для удаления инородных тел однократного применения, пяти-лапковый, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 230 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.29127

ЗАВ.№ 20150407/162

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндостарс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
телефон: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Захват для удаления инородных тел однократного применения, четырех-лапковый, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 160 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.29120

ЗАВ.№ 20150407/155

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндостарс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
телефон: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Захват для удаления инородных тел однократного применения, трех-лапковый, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 120 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.29116

ЗАВ.№ 20150407/151

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндостарс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
телефон: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Захват для удаления инородных тел однократного применения, четырех-лапковый, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 120 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.29117

ЗАВ.№ 20150407/152

2015.02 - 2017.02

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндостарс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
телефон: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!



Захват типа «крысиный зуб», «ножницы»

Захват для удаления инородных тел однократного применения, тип "ножницы", диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 180 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.25113
ЗАВ.№ 20150407/120

2015.02 - 2017.02



EndoStarts

производитель:
ООО «Эндостарс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Захват для удаления инородных тел однократного применения, тип "крысиный зуб", диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 230 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.24118
ЗАВ.№ 20150407/117

2015.02 - 2017.02



EndoStarts

производитель:
ООО «Эндостарс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Захват для удаления инородных тел однократного применения, тип "ножницы", диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 120 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.25111
ЗАВ.№ 20150407/118

2015.02 - 2017.02




EndoStarts

производитель:
ООО «Эндостарс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Маркировка (Захват типа «крысиный зуб», «ножницы»)

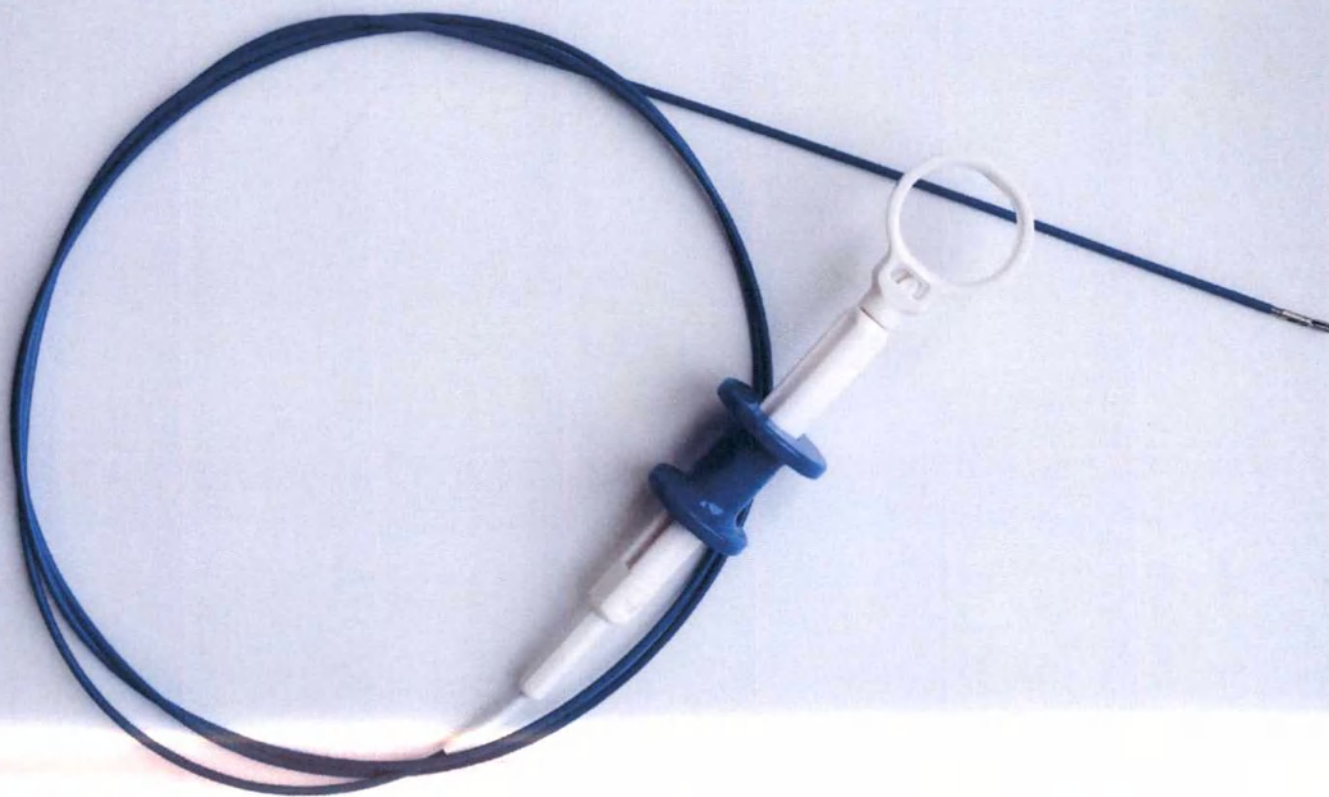

Захват вилкообразный

ООО ЦРПМ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Захват для удаления инородных тел однократного применения, тип "вилкообразный 2:2", диаметр 1,8 мм, для канала 2,0 мм, длина 160 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.27112

ЗАВ.№ 20150407/131

2015.02 - 2017.02

EndoStars

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Мочевая 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
8 (800) 555-56-57
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-stars.ru
www.endo-stars.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Захват для удаления инородных тел однократного применения, тип "вилкообразный 2:2", диаметр 1,8 мм, для канала 2,0 мм, длина 180 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.27113

ЗАВ.№ 20150407/132

2015.02 - 2017.02

EndoStars

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Мочевая 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
8 (800) 555-56-57
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-stars.ru
www.endo-stars.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Захват для удаления инородных тел однократного применения, тип "вилкообразный 2:1", диаметр 1,8 мм, для канала 2,0 мм, длина 120 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.26111

ЗАВ.№ 20150407/122

2015.02 - 2017.02

EndoStars

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Мочевая 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
8 (800) 555-56-57
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-stars.ru
www.endo-stars.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Захват для удаления инородных тел однократного применения, тип "вилкообразный 2:2", диаметр 1,8 мм, для канала 2,0 мм, длина 120 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.27111

ЗАВ.№ 20150407/130

2015.02 - 2017.02

EndoStars

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Мочевая 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
8 (800) 555-56-57
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-stars.ru
www.endo-stars.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Захват для удаления инородных тел однократного применения, тип "вилкообразный 2:2", диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 120 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.27115

ЗАВ.№ 20150407/134

2015.02 - 2017.02

EndoStars

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Мочевая 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
8 (800) 555-56-57
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-stars.ru
www.endo-stars.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Захват для удаления инородных тел однократного применения, тип "вилкообразный 2:1", диаметр 1,8 мм, для канала 2,0 мм, длина 230 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.26114

ЗАВ.№ 20150407/125

2015.02 - 2017.02

EndoStars

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Мочевая 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
8 (800) 555-56-57
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-stars.ru
www.endo-stars.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Захват для удаления инородных тел однократного применения, тип "вилкообразный 2:2", диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 230 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.27118

ЗАВ.№ 20150407/137


2015.02 - 2017.02

EndoStars

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Мочевая 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
8 (800) 555-56-57
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-stars.ru
www.endo-stars.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Маркировка (Захват вилкообразный)

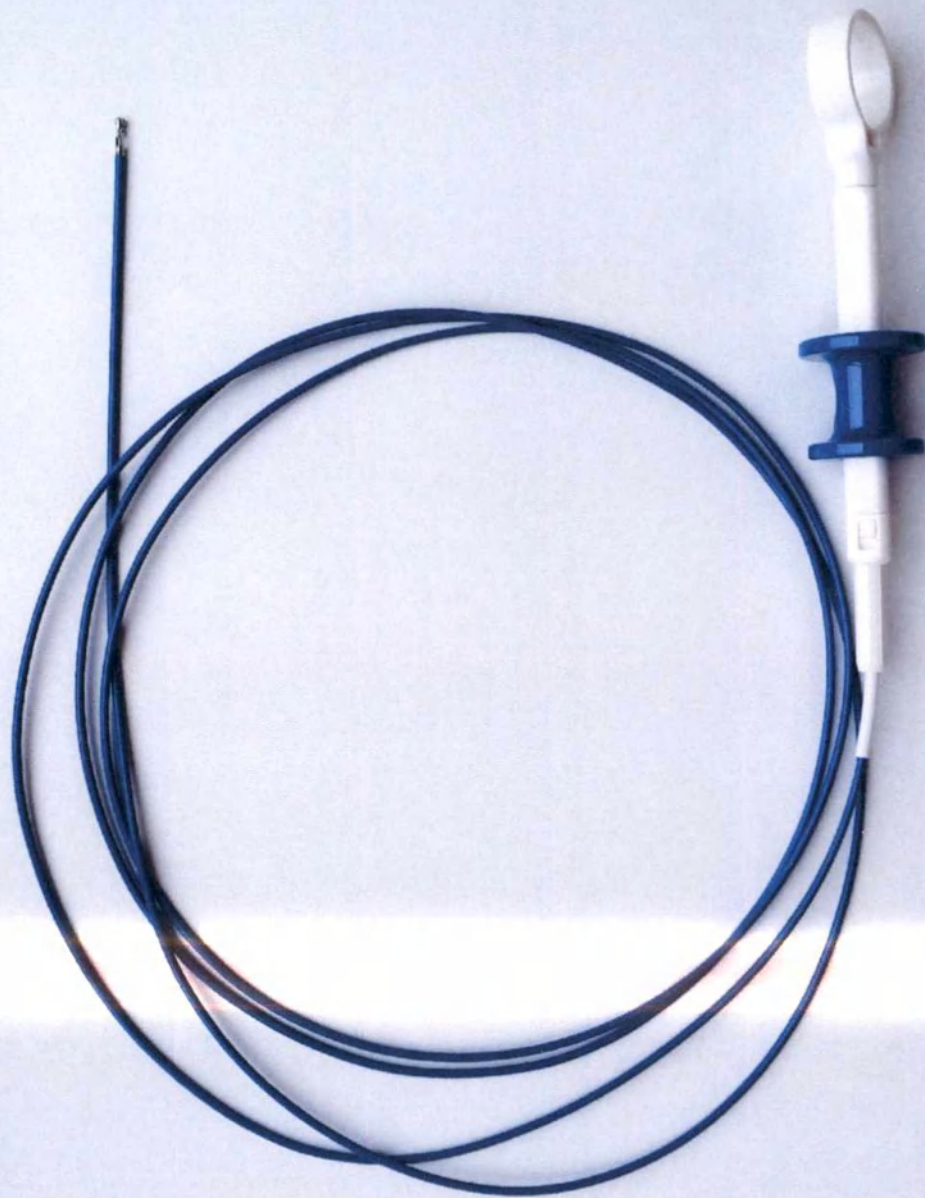

Захват тип «аллигатор»

ООО ЦРПМ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Захват для удаления инородных тел однократного применения, тип "аллигатор, конический", диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 120 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.28116
ЗАВ.№ 20150407/143




Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Захват для удаления инородных тел однократного применения, тип "аллигатор, конический", диаметр 1,8 мм, для канала 2,0 мм, длина 160 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.28112
ЗАВ.№ 20150407/139

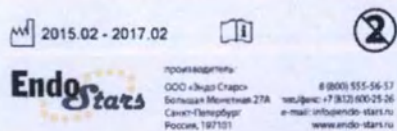


Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Захват для удаления инородных тел однократного применения, тип "аллигатор, конический", диаметр 1,8 мм, для канала 2,0 мм, длина 180 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.28113
ЗАВ.№ 20150407/140

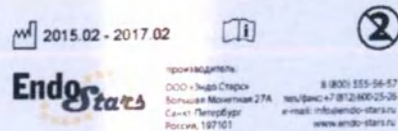


Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Захват для удаления инородных тел однократного применения, тип "аллигатор, конический", диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 230 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.29111
ЗАВ.№ 20150407/146




Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Захват для удаления инородных тел однократного применения, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 160 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.21111
ЗАВ.№ 20150407/091




Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Захват для удаления инородных тел однократного применения, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 180 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.21112
ЗАВ.№ 20150407/092




Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Захват для удаления инородных тел однократного применения, тип "аллигатор", диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 180 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.22117
ЗАВ.№ 20150407/100




Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Захват для удаления инородных тел однократного применения, тип "аллигатор", диаметр 1,8 мм, для канала 2,0 мм, длина 180 см

по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.22113
ЗАВ.№ 20150407/096




Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Захват для удаления инородных тел однократного применения, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 230 см


по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.21113
ЗАВ.№ 20150407/093



Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Маркировка (Захват тип «аллигатор»)

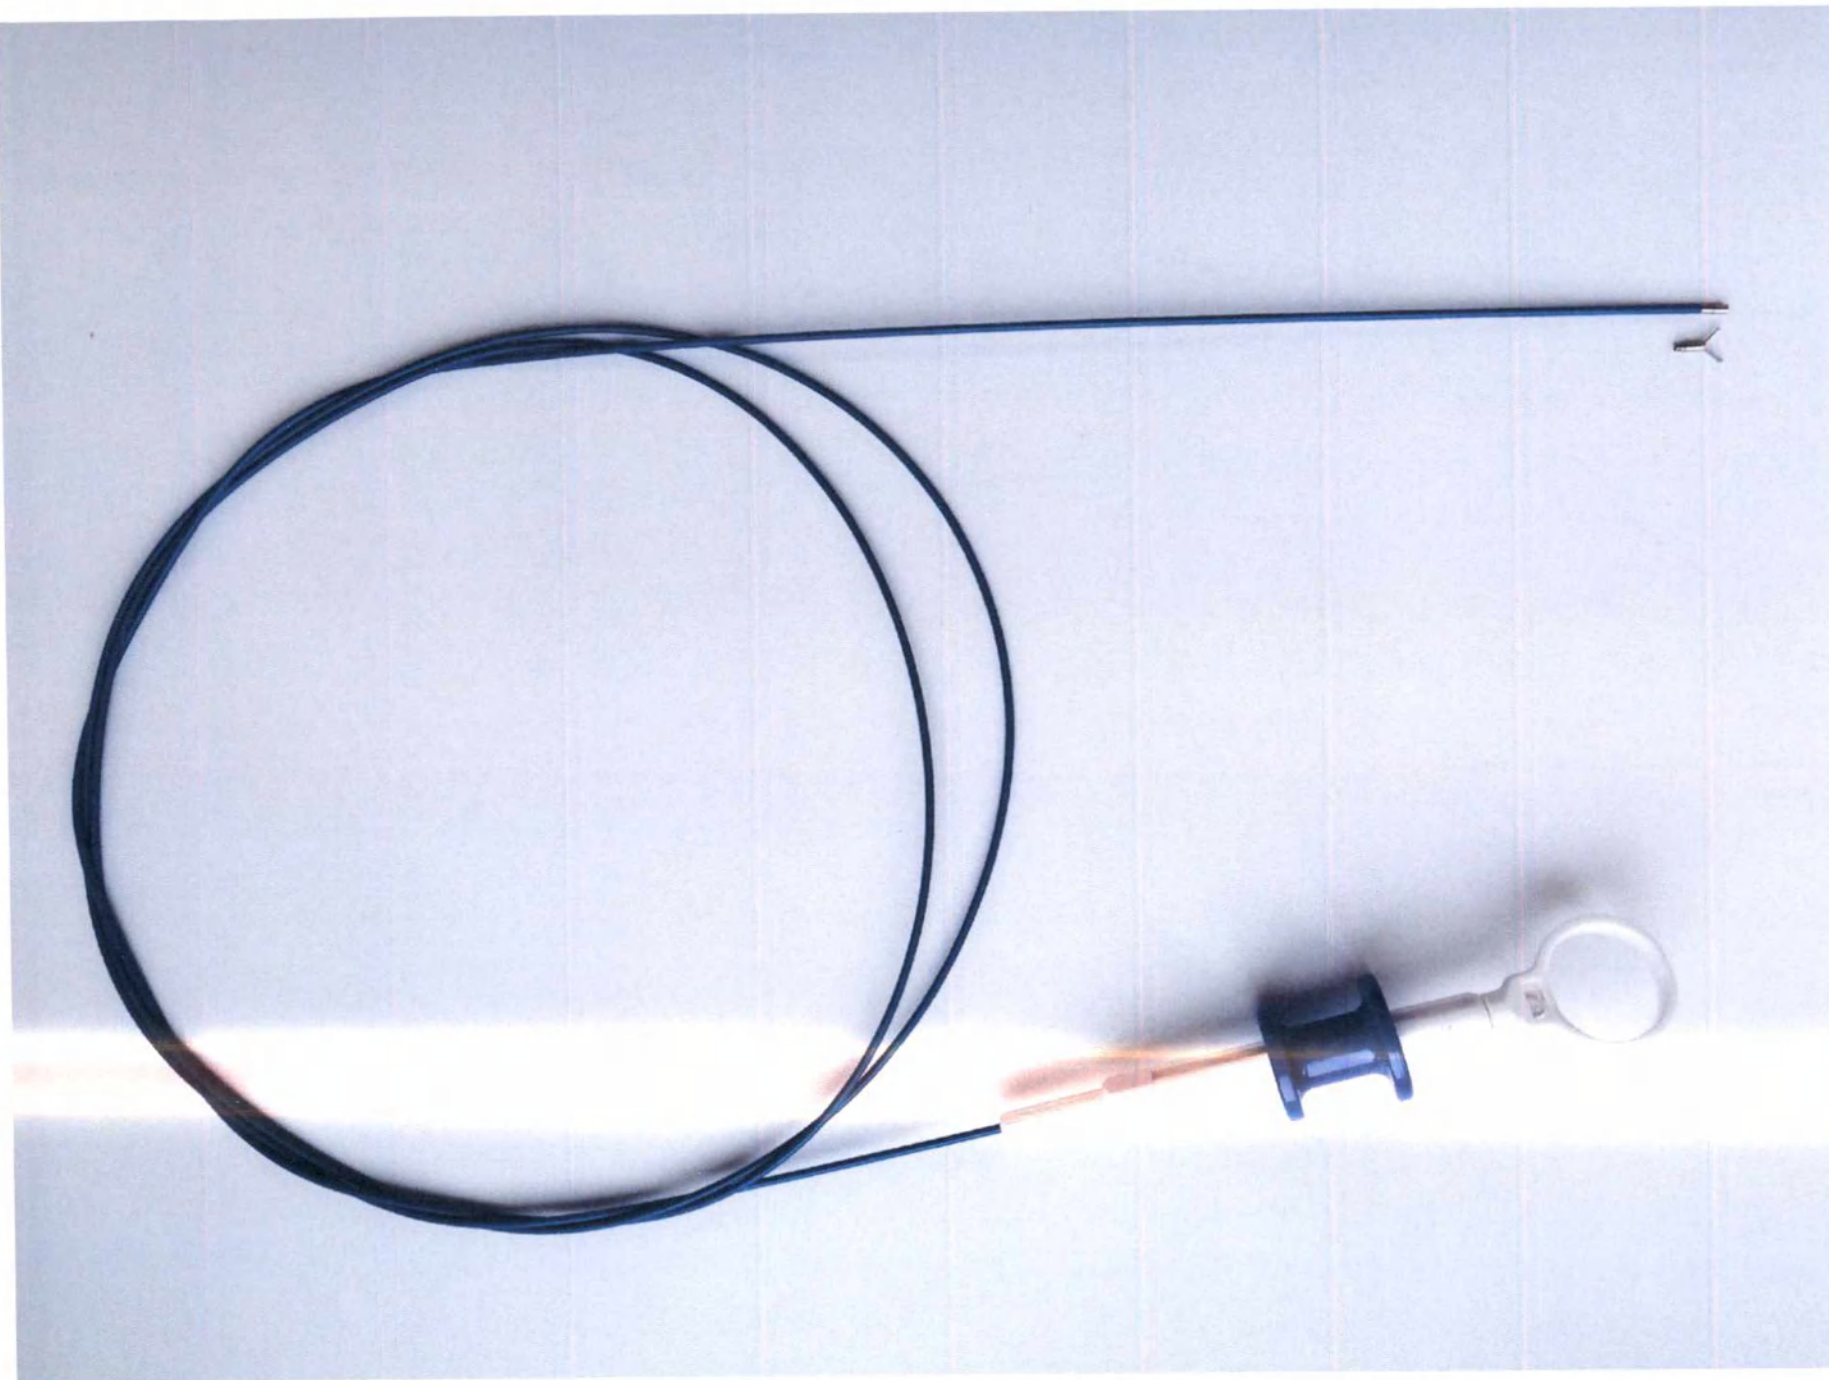

Гемоклипатор

Гемоклипатор к гибким эндоскопам однократного применения для канала 2,8 мм длиной 2300 мм максимальный диаметр 9 мм, угол раскрытия клипсы 135°
по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.91127

ЗАВ.№ 20150407/175

 2015.02 - 2017.02



EndoStars

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
8 (800) 555-56-57
тел./факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-stars.ru
www.endo-stars.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Гемоклипатор к гибким эндоскопам однократного применения для канала 2,8 мм длиной 2300 мм максимальный диаметр 11 мм, угол раскрытия клипсы 135°
по ТУ 9431-003-89134710-2014

APT 9437.91117

ЗАВ.№ 20150407/180

 2015.02 - 2017.02



EndoStars

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
8 (800) 555-56-57
тел./факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-stars.ru
www.endo-stars.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Прошито и пронумеровано

62 (шестьдесят два) листа

Генеральный Директор

ООО «Эндо Старс»

Самарец В.С.

