



Набора реагентов «Диагностикум эритроцитарный шигеллезный Флекснера 1-5 антигенный, жидкий» (Тест Флекснера 1-5 РПГА)

Комплект №1 рассчитан на 10 определений: серийный номер 030915 годен до 05.2017 г.


Вид с лицевой стороны упаковки

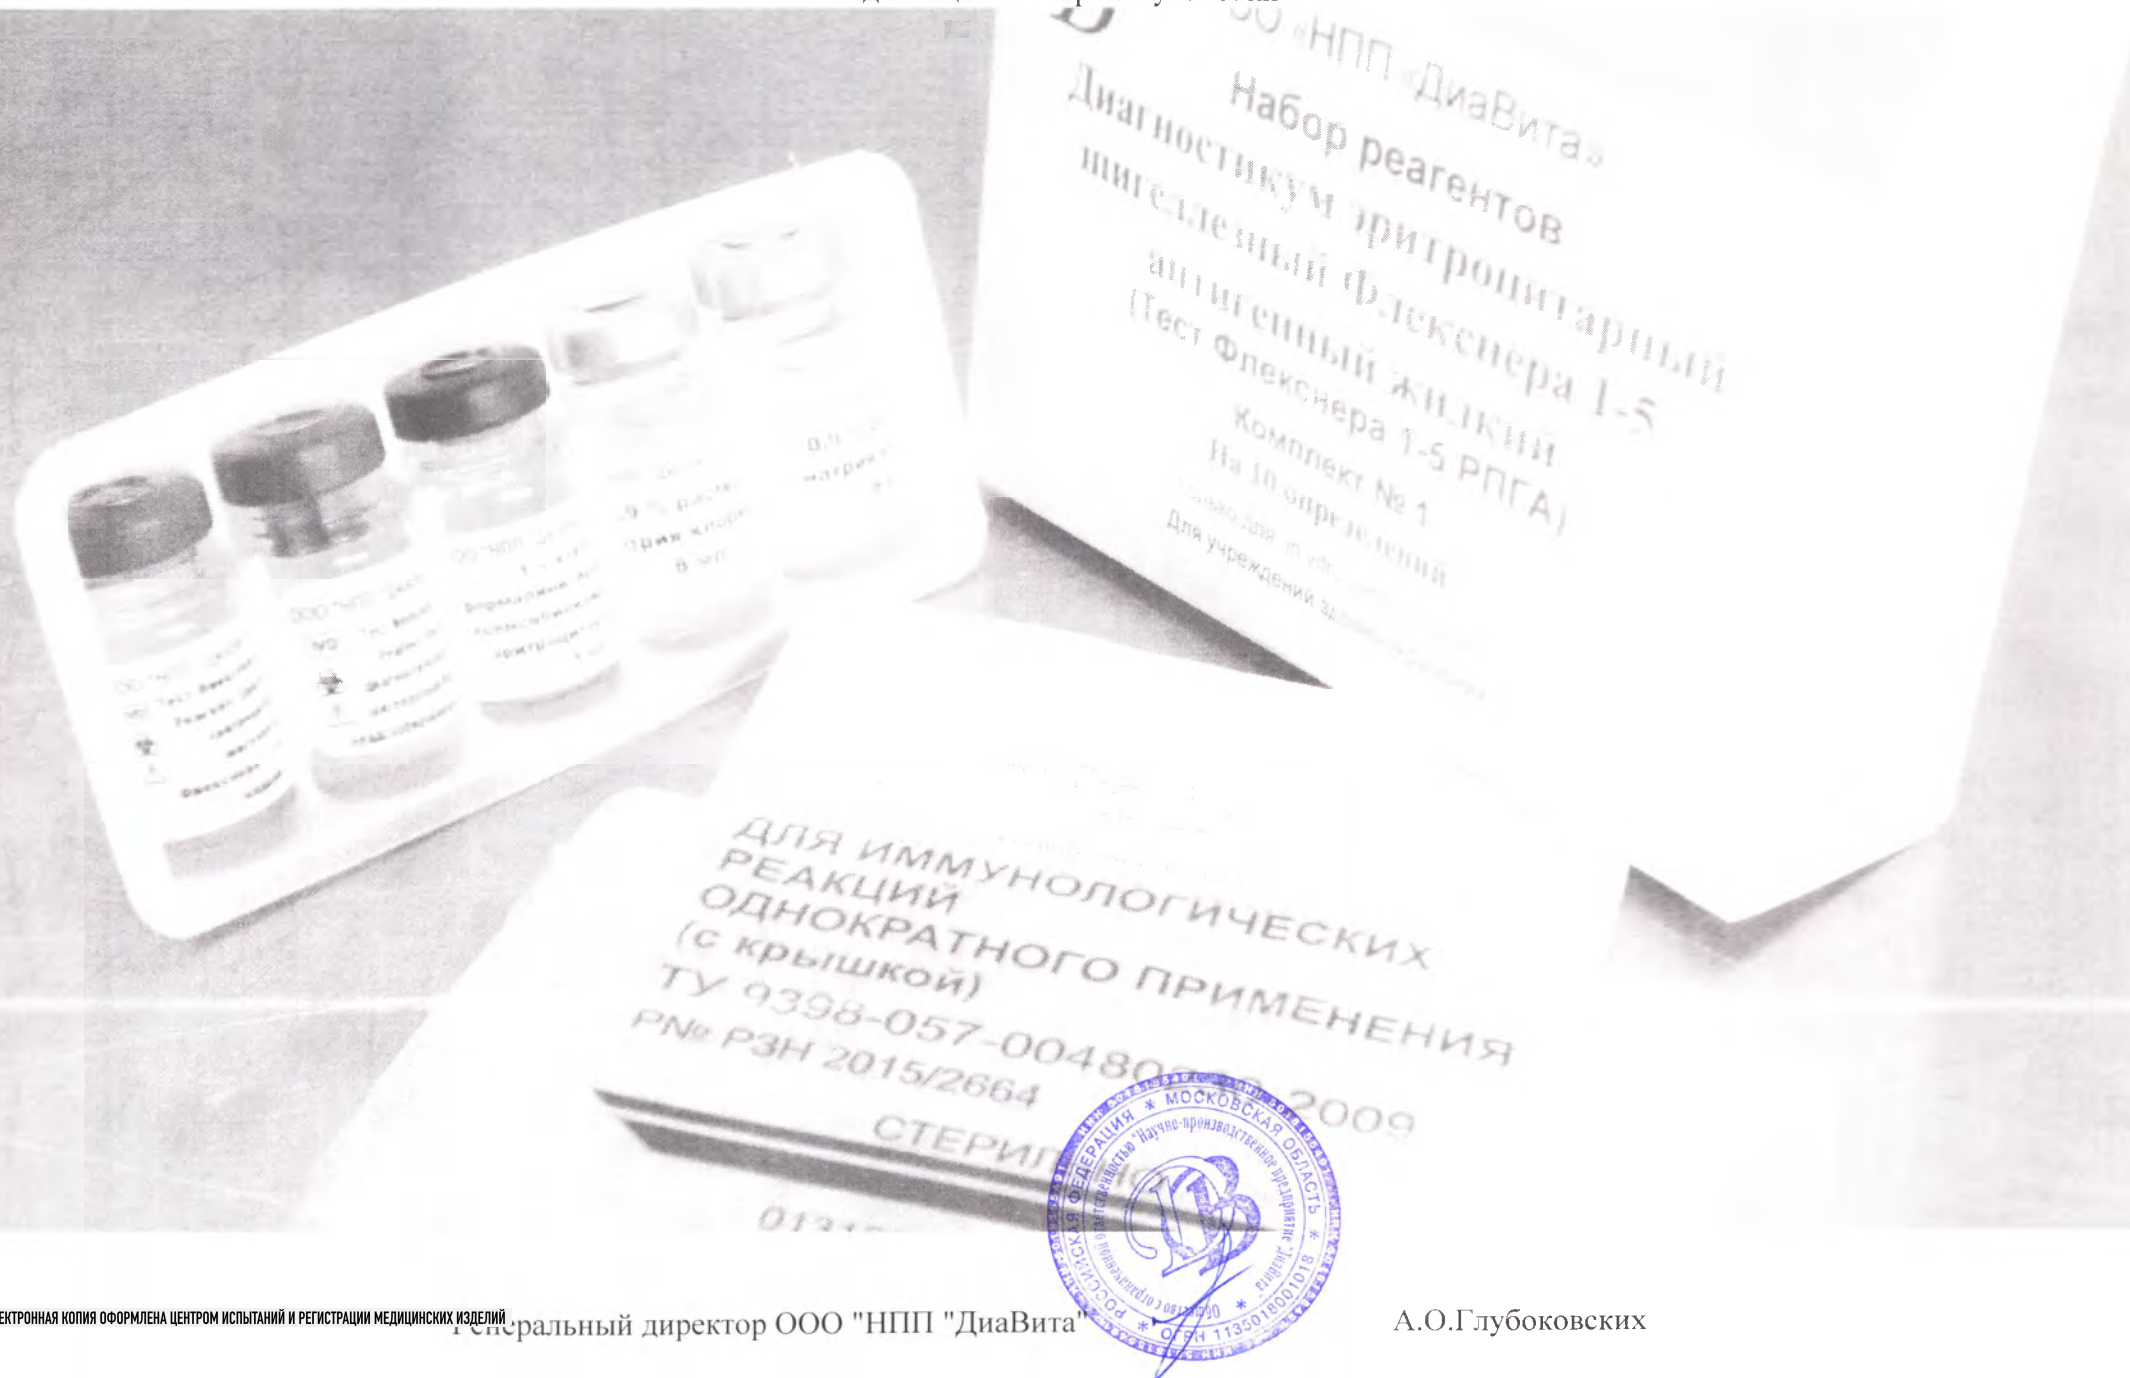


Набора реагентов «Диагностикум эритроцитарный шигеллезный Флекснера 1-5 антигенный, жидкий» (Тест Флекснера 1-5 РИП А)
Комплект №1 рассчитан на 10 определений: серийный номер 030915 годен до 05.2017 г.
Вид с обратной стороны упаковки

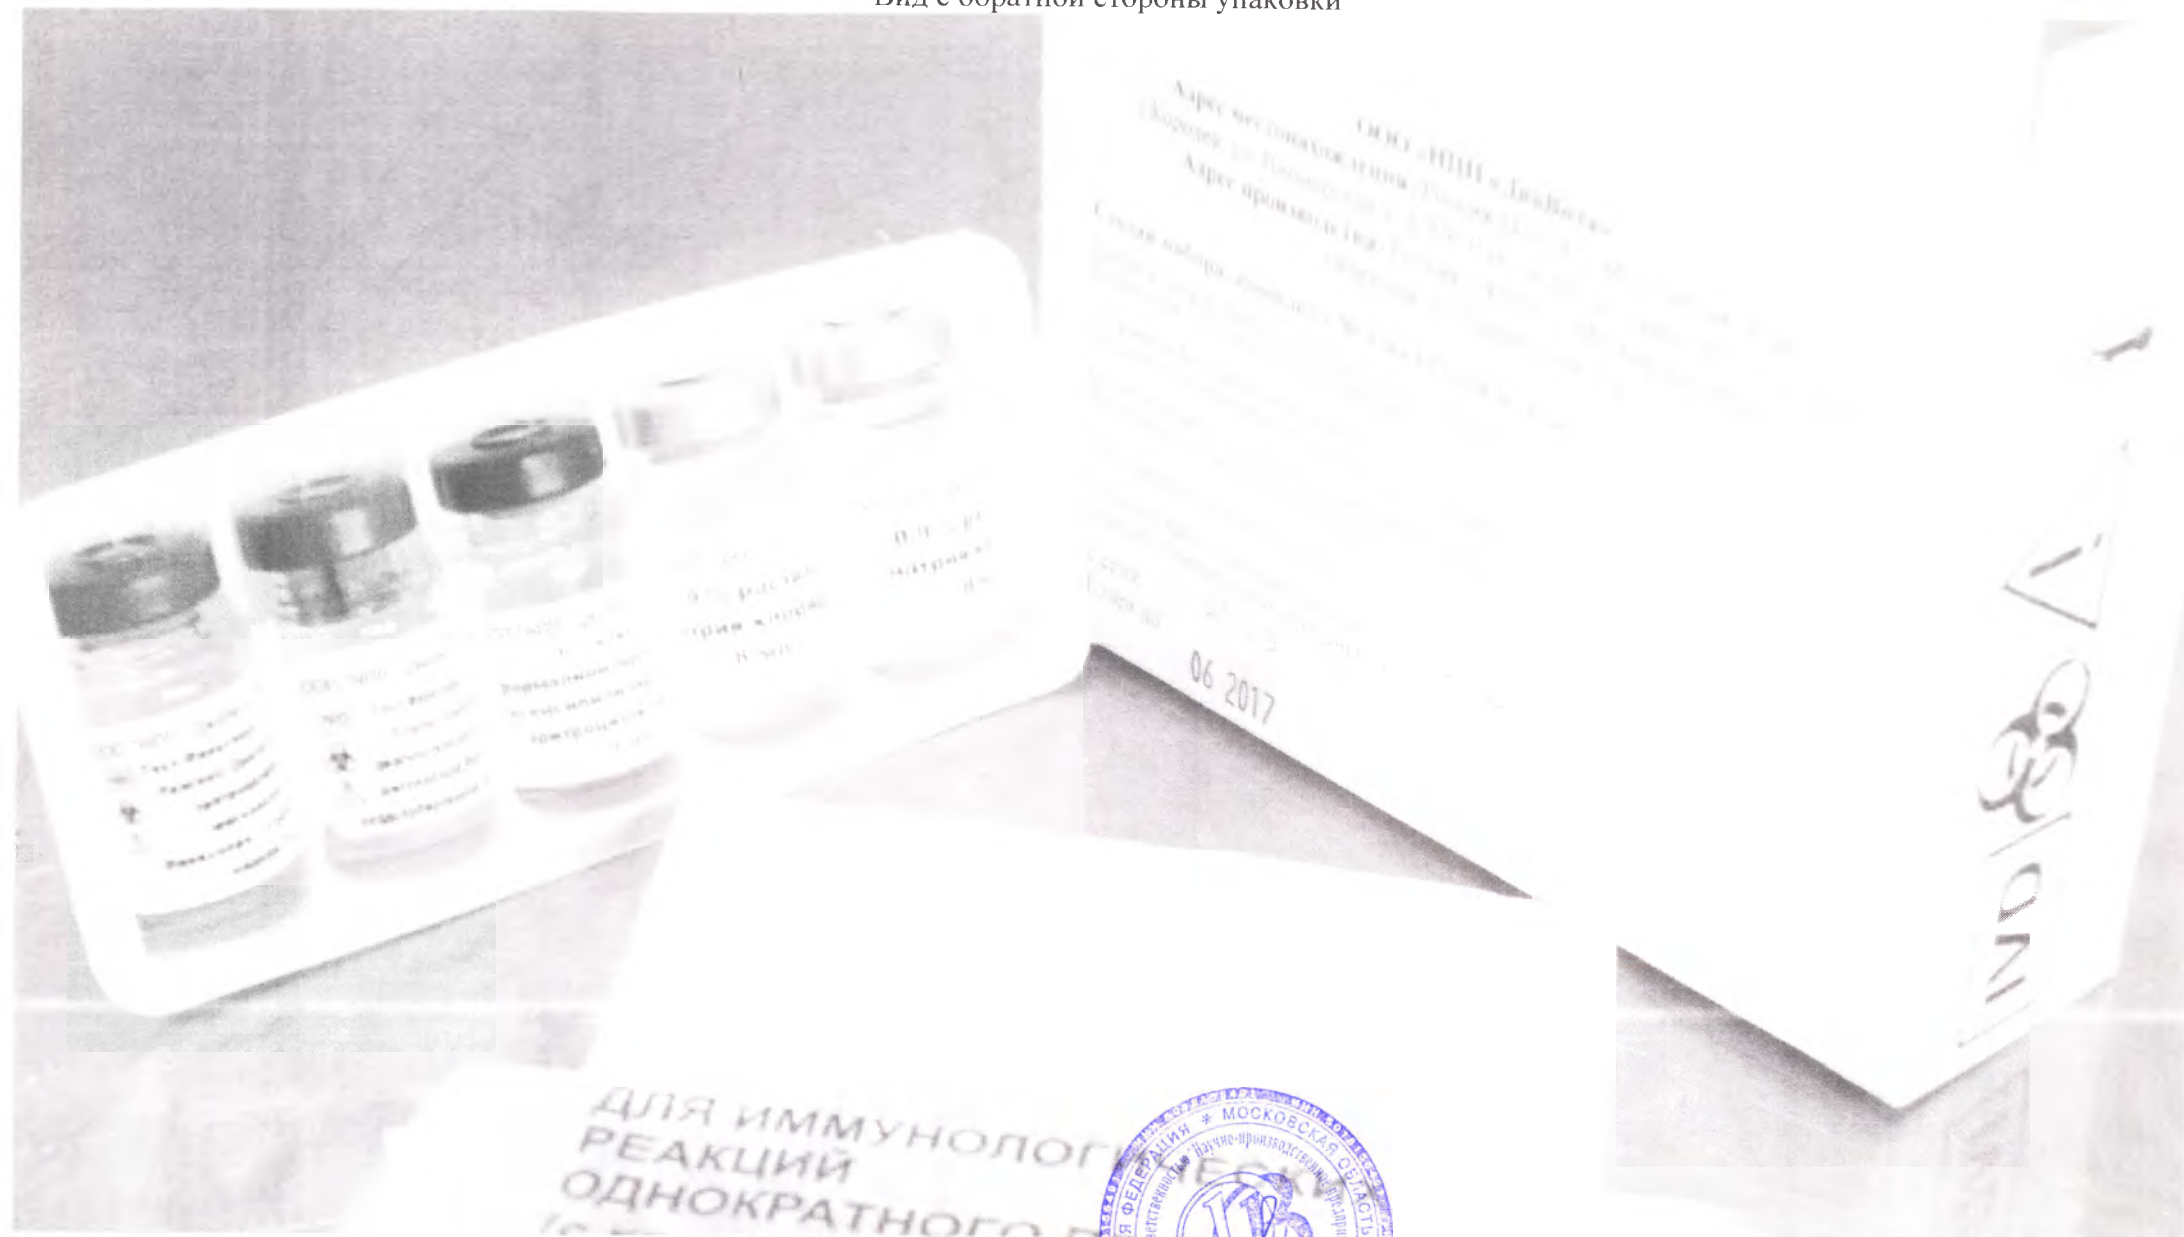

Набора реагентов «Диагностикум эритроцитарный шигеллезный Флекснера 1-5 антигенный, жидкий» (Тест Флекснера 1-5 РПГА)
 Комплект №1 рассчитан на 10 определений: серийный номер 041015 годен до 06.2017 г.
 Вид с лицевой стороны упаковки

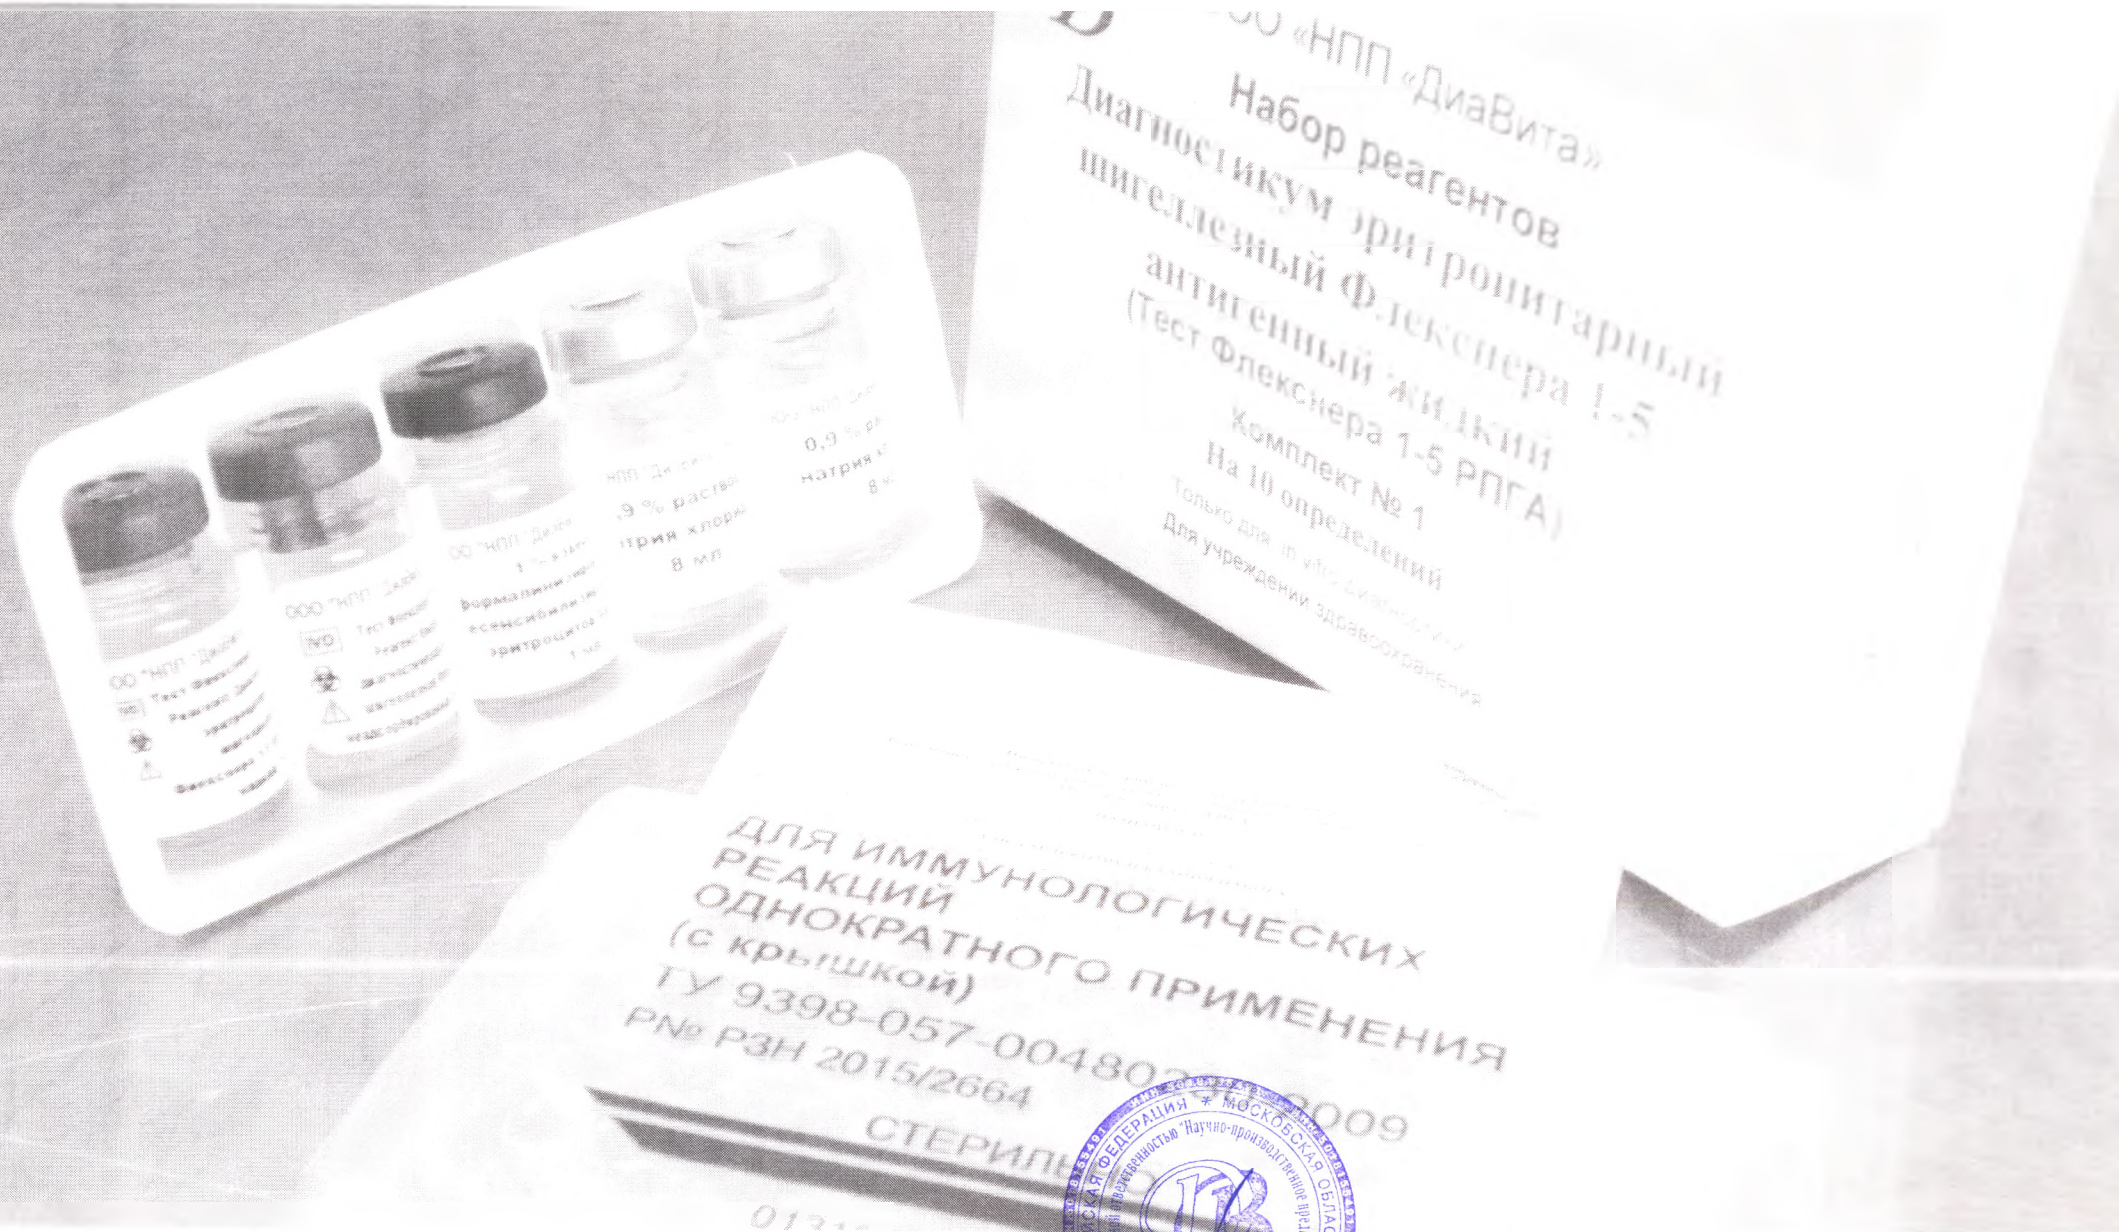

Набора реагентов «Диагностикум эритроцитарный шигеллезный Флекснера 1-5 антигенный, жидкий» (тест Флекснера 1-5 ГИИ ГА)
Комплект №1 рассчитан на 10 определений: серийный номер 041015 годен до 06.2017 г.
Вид с обратной стороны упаковки

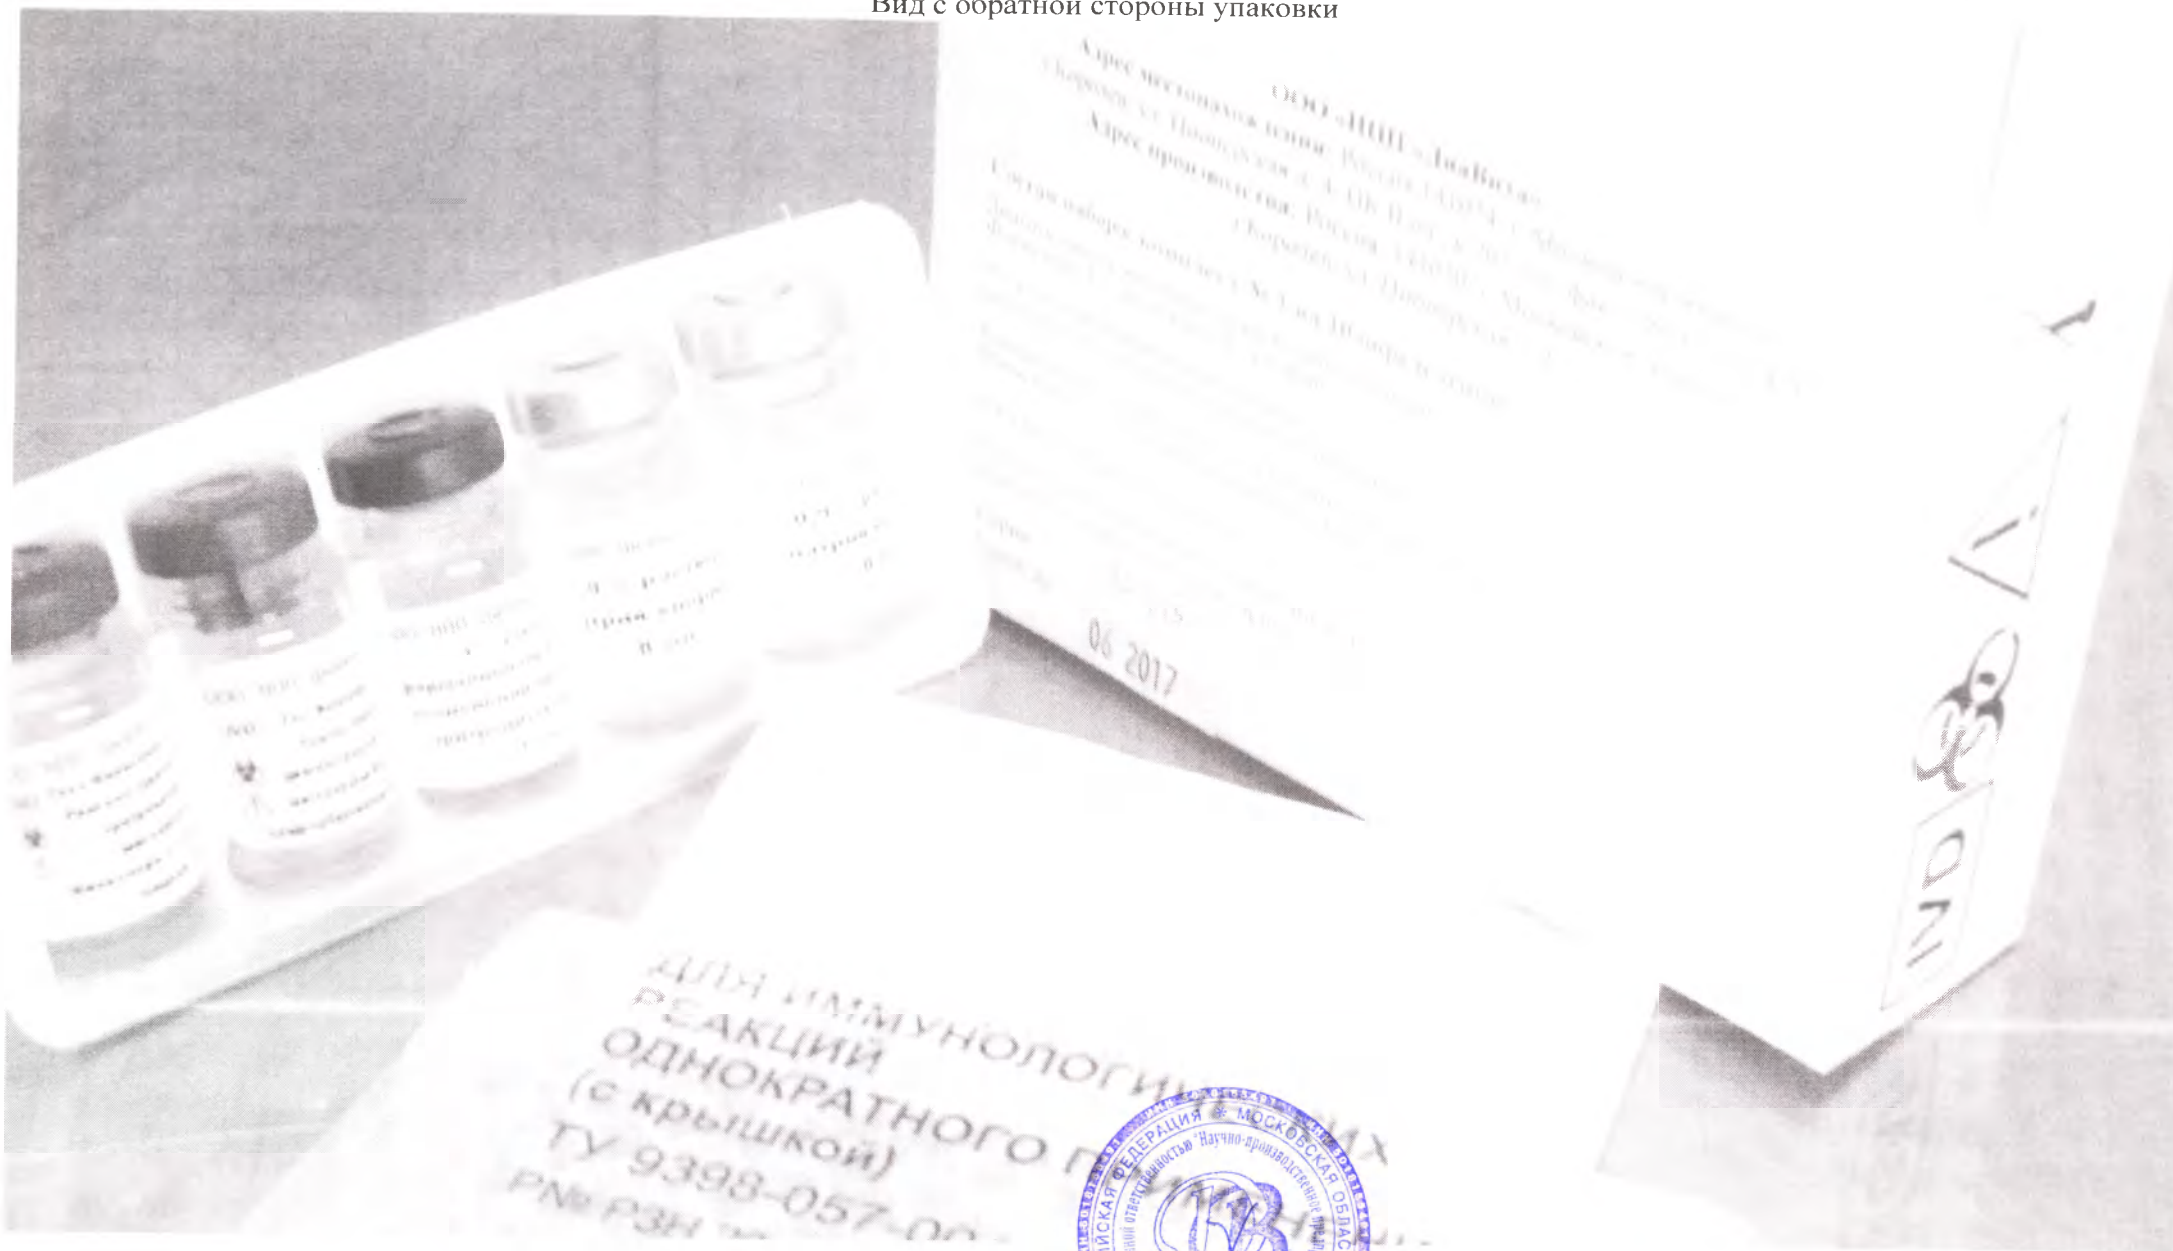


Генеральный директор ООО "НПП "ДиаВита"

А.О.Глубоковских



Набора реагентов «Диагностикум эритролитарный шигеллезный Флекснера 1-5 антигенный, жидкий» (тест Флекснера 1-5 РПГА),
Комплект №2 рассчитан на 16 определений: серийный номер 030915 годен до 05.2017 г.
Вид с лицевой стороны упаковки

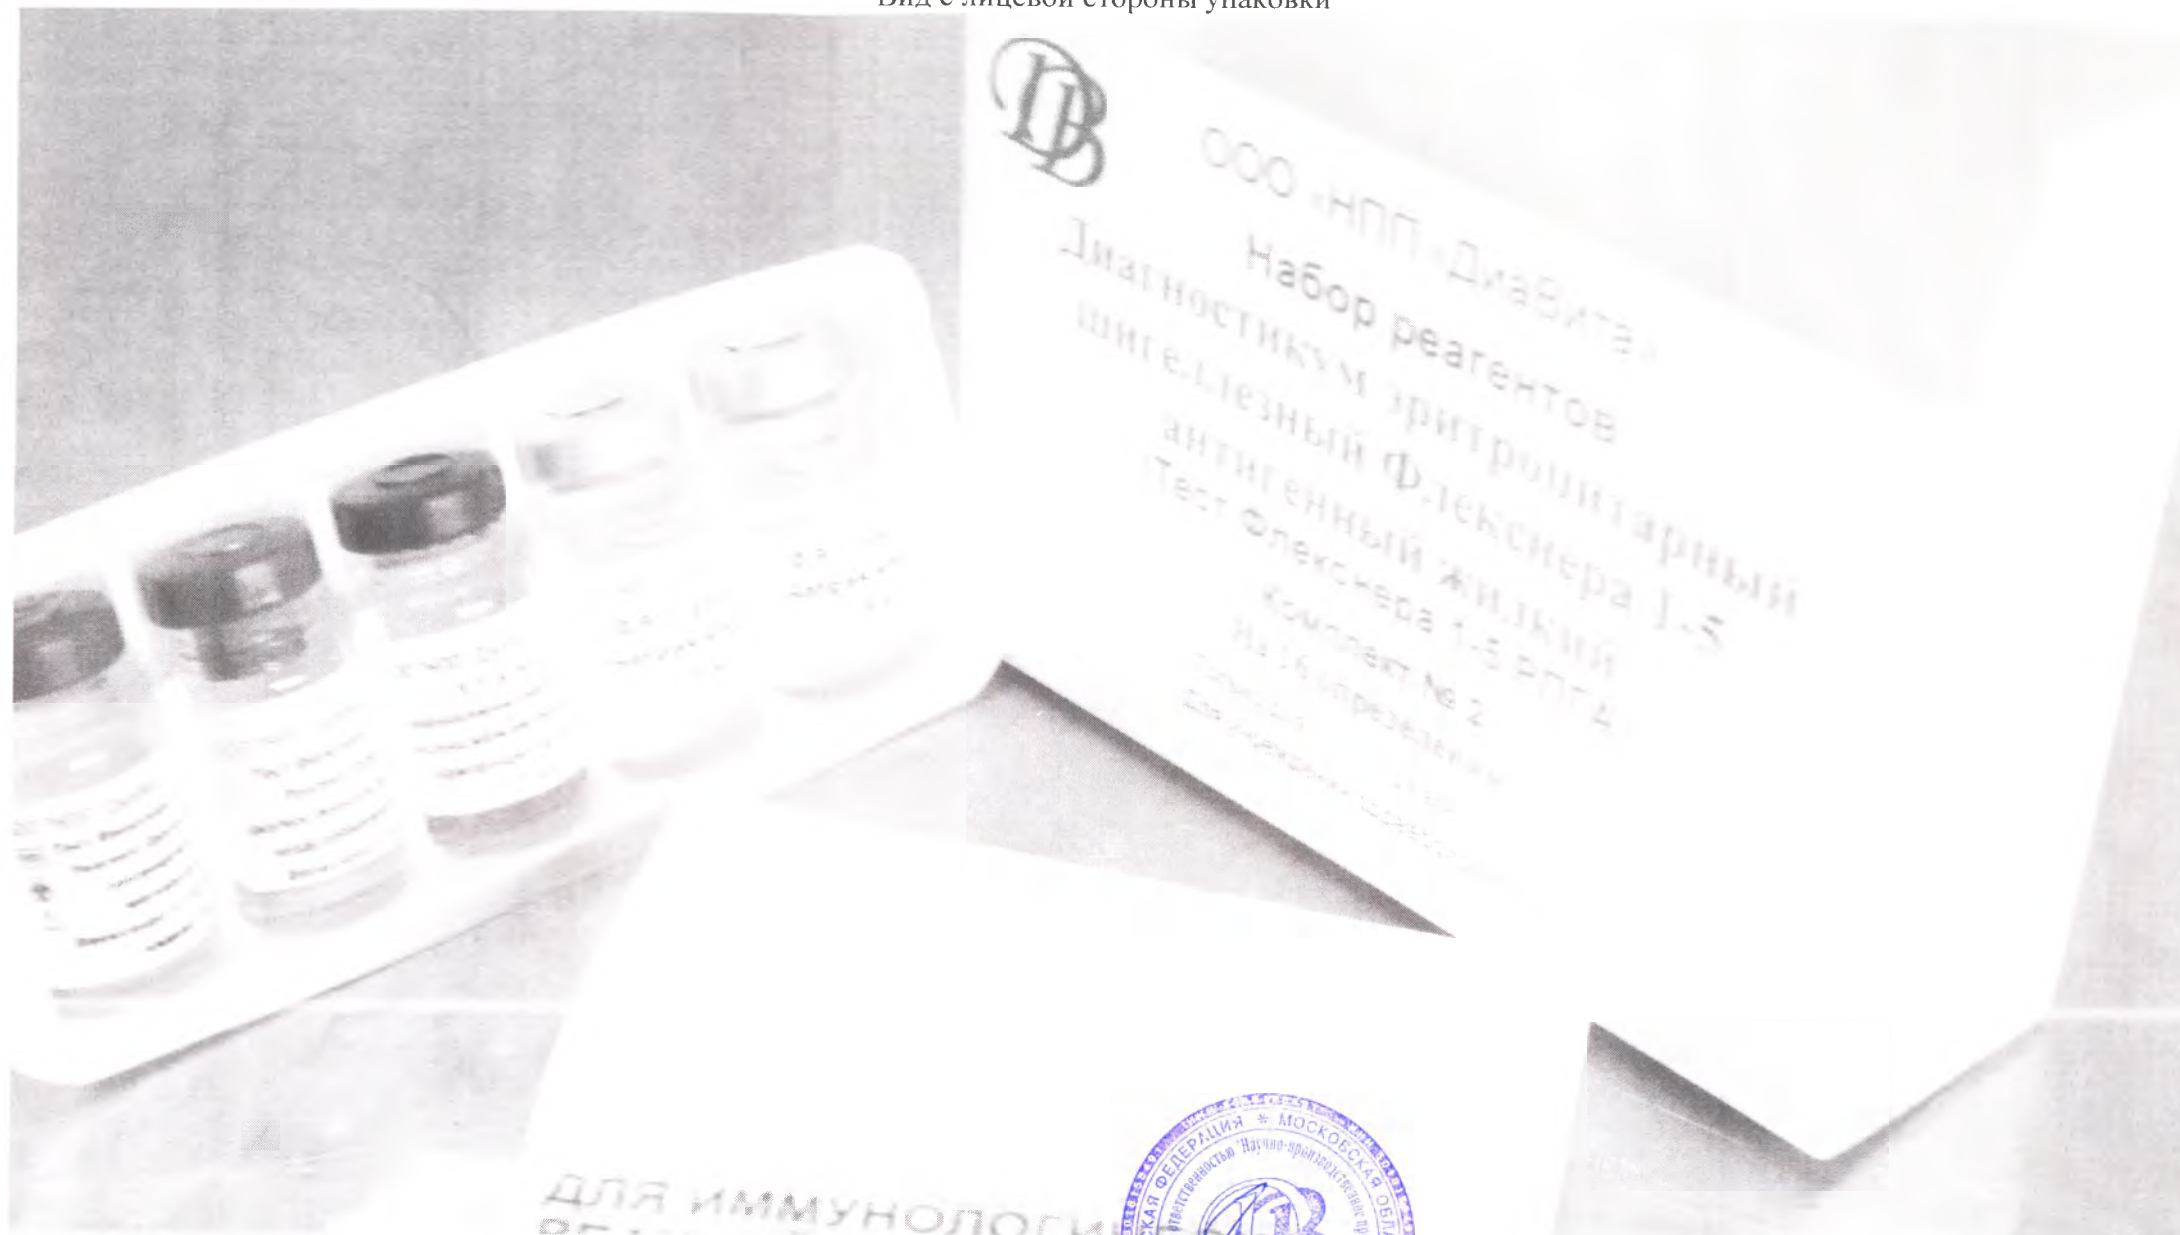


Генеральный директор ООО "НПП "ДиаВита"

А.О.Глубоковских




набора реагентов «диагностикум эритроцитный шигеллезный Флекснера 1-5 антигенный, жидкий» (Тест Флекснера 1-5 1 мл),
Комплект №2 рассчитан на 16 определений: серийный номер 030915 годен до 05.2017 г.
Вид с обратной стороны упаковки

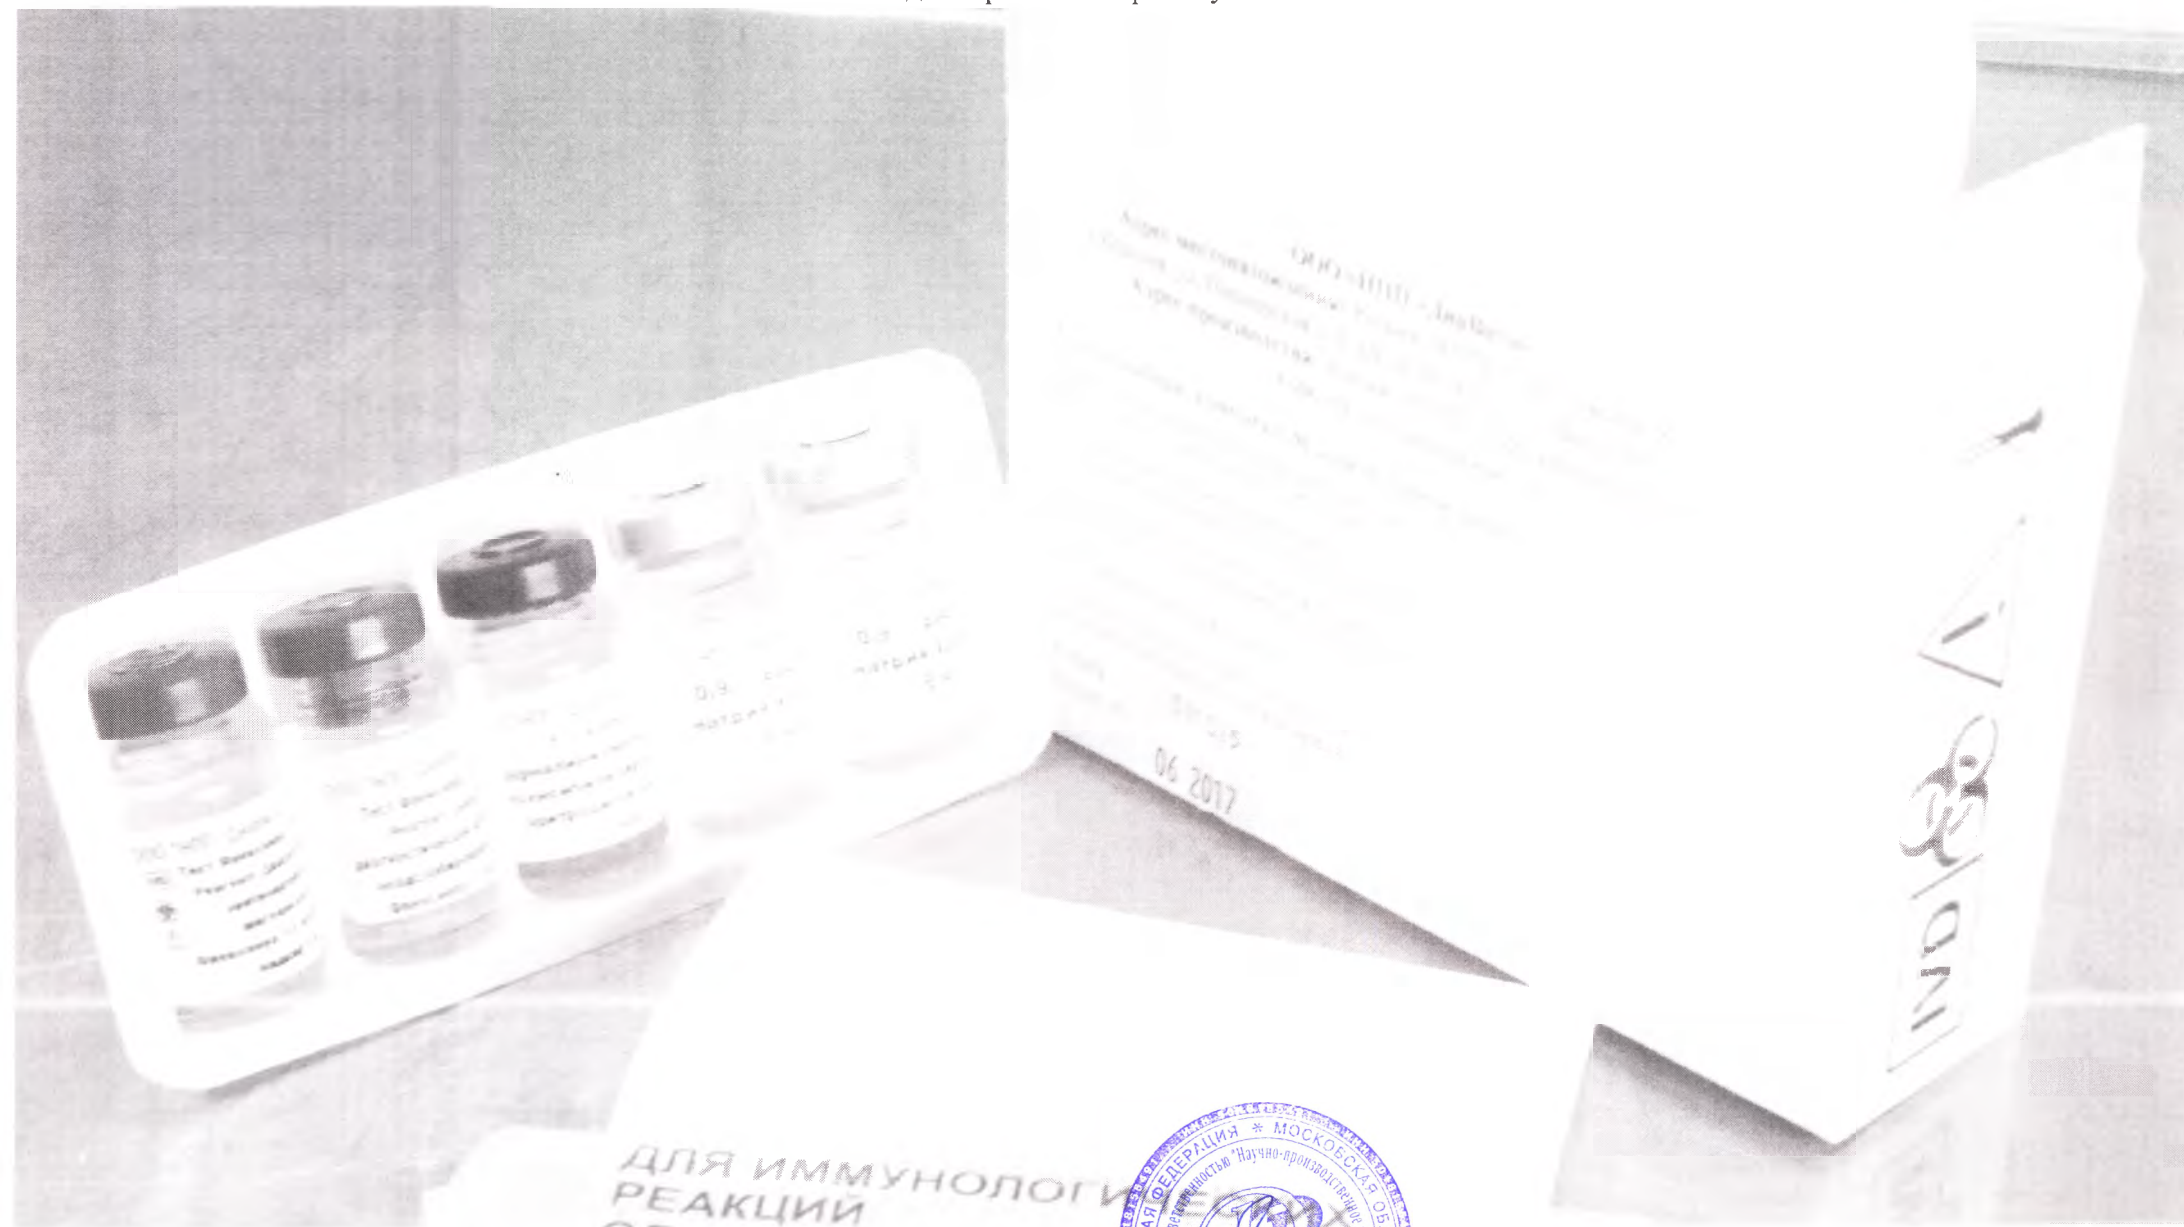


Набора реагентов «Диагностикум эритрошигеллезный Флекснера 1-5 антигенный, жидкий» (Тест Флекснера 1-5 РПН А)
Комплект №2 рассчитан на 16 определений: серийный номер 041015 годен до 06.2017 г.

Вид с лицевой стороны упаковки

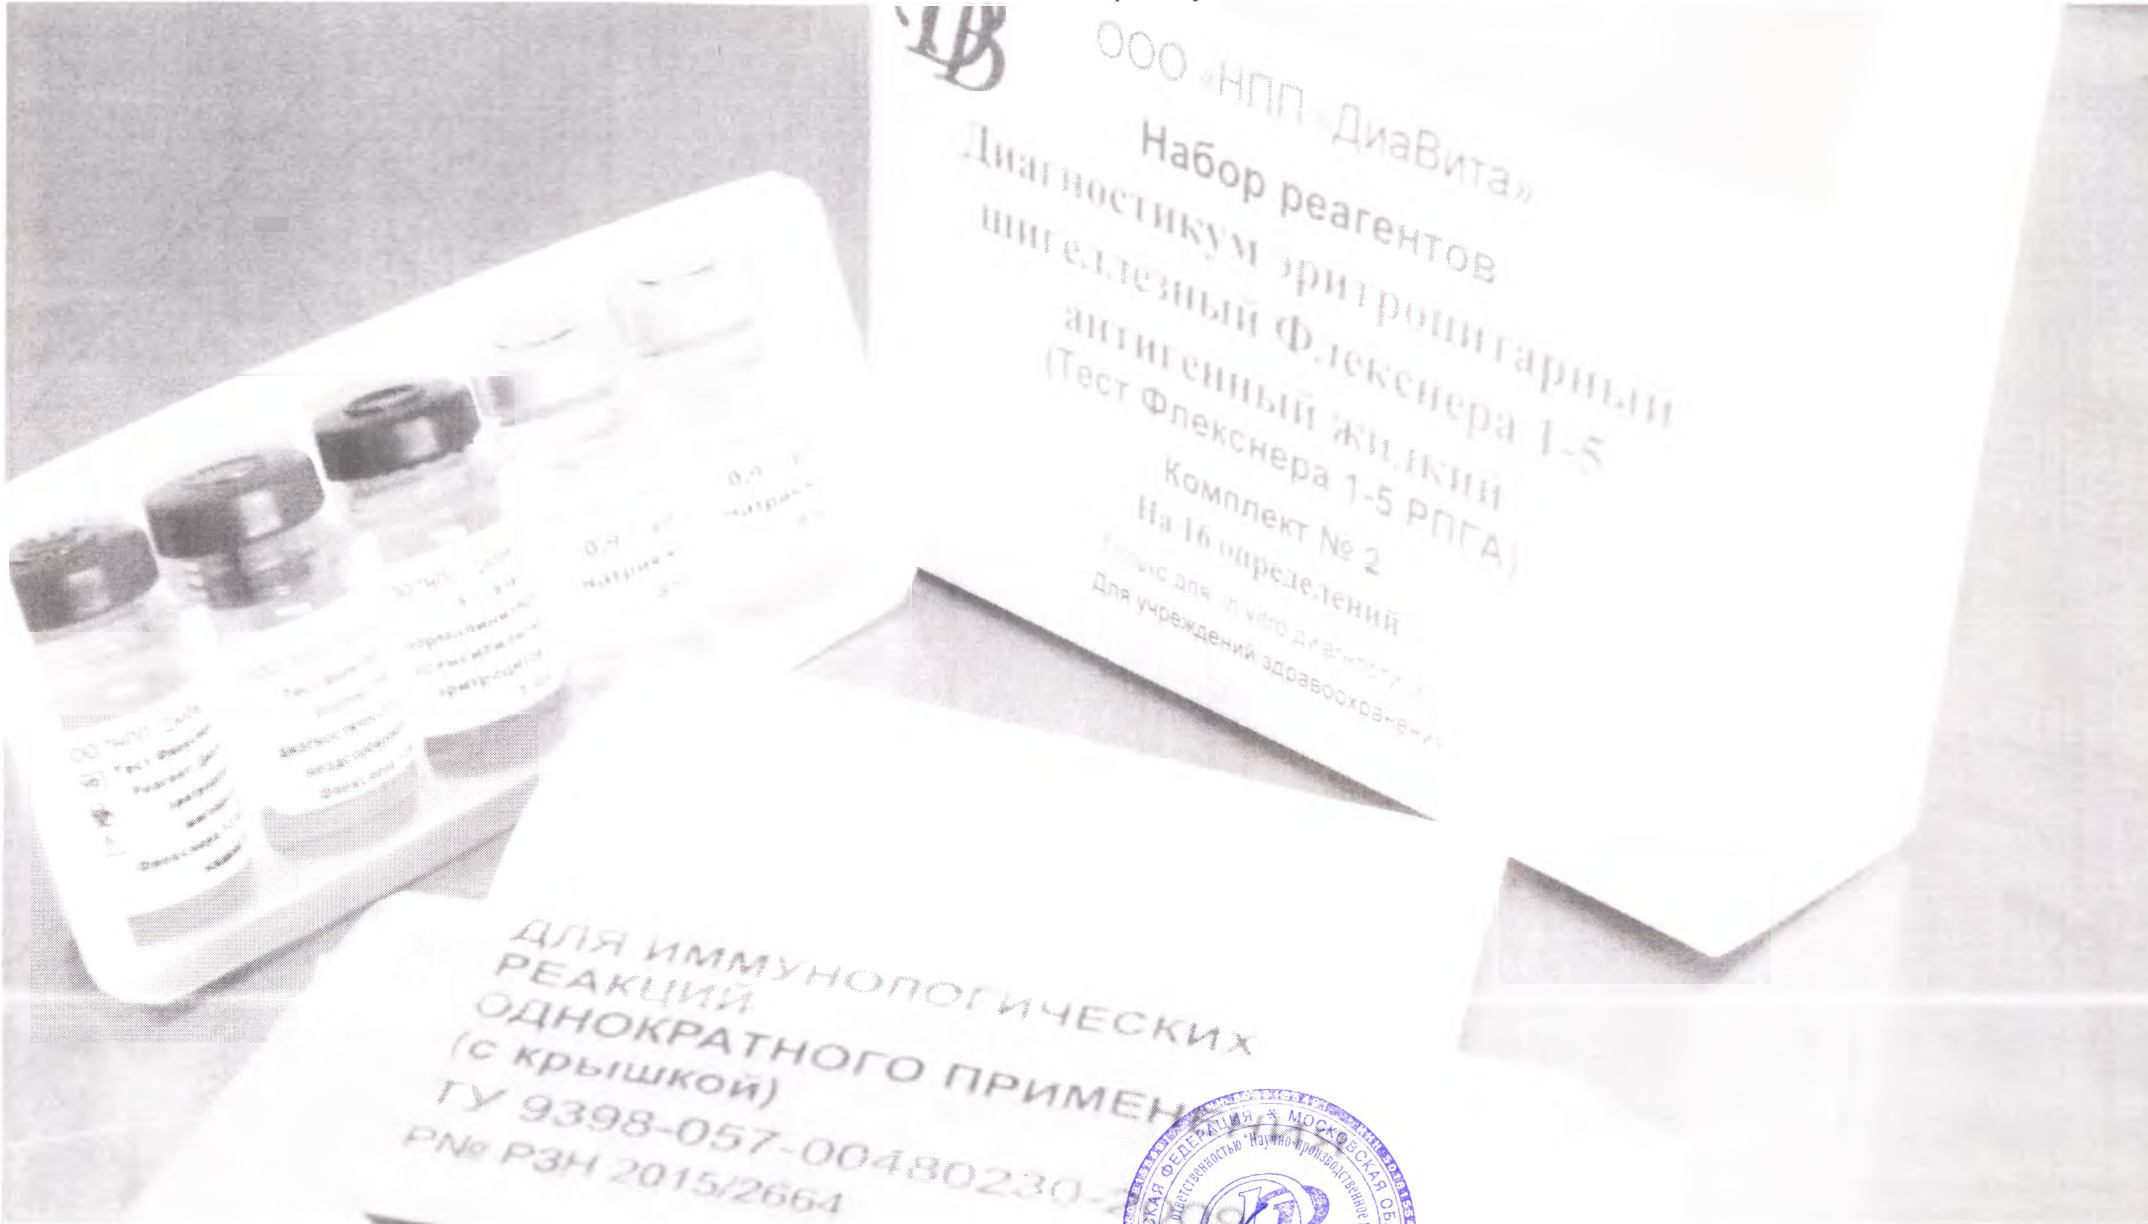

Набора реагентов «Диагностикум эритроцитарный шигеллезный Флекснера 1-5 антигенный, жидкий» (Тест Флекснера 1-5 РПГА)
Комплект №2 рассчитан на 16 определений: серийный номер 041015 годен до 06.2017 г.
Вид с обратной стороны упаковки

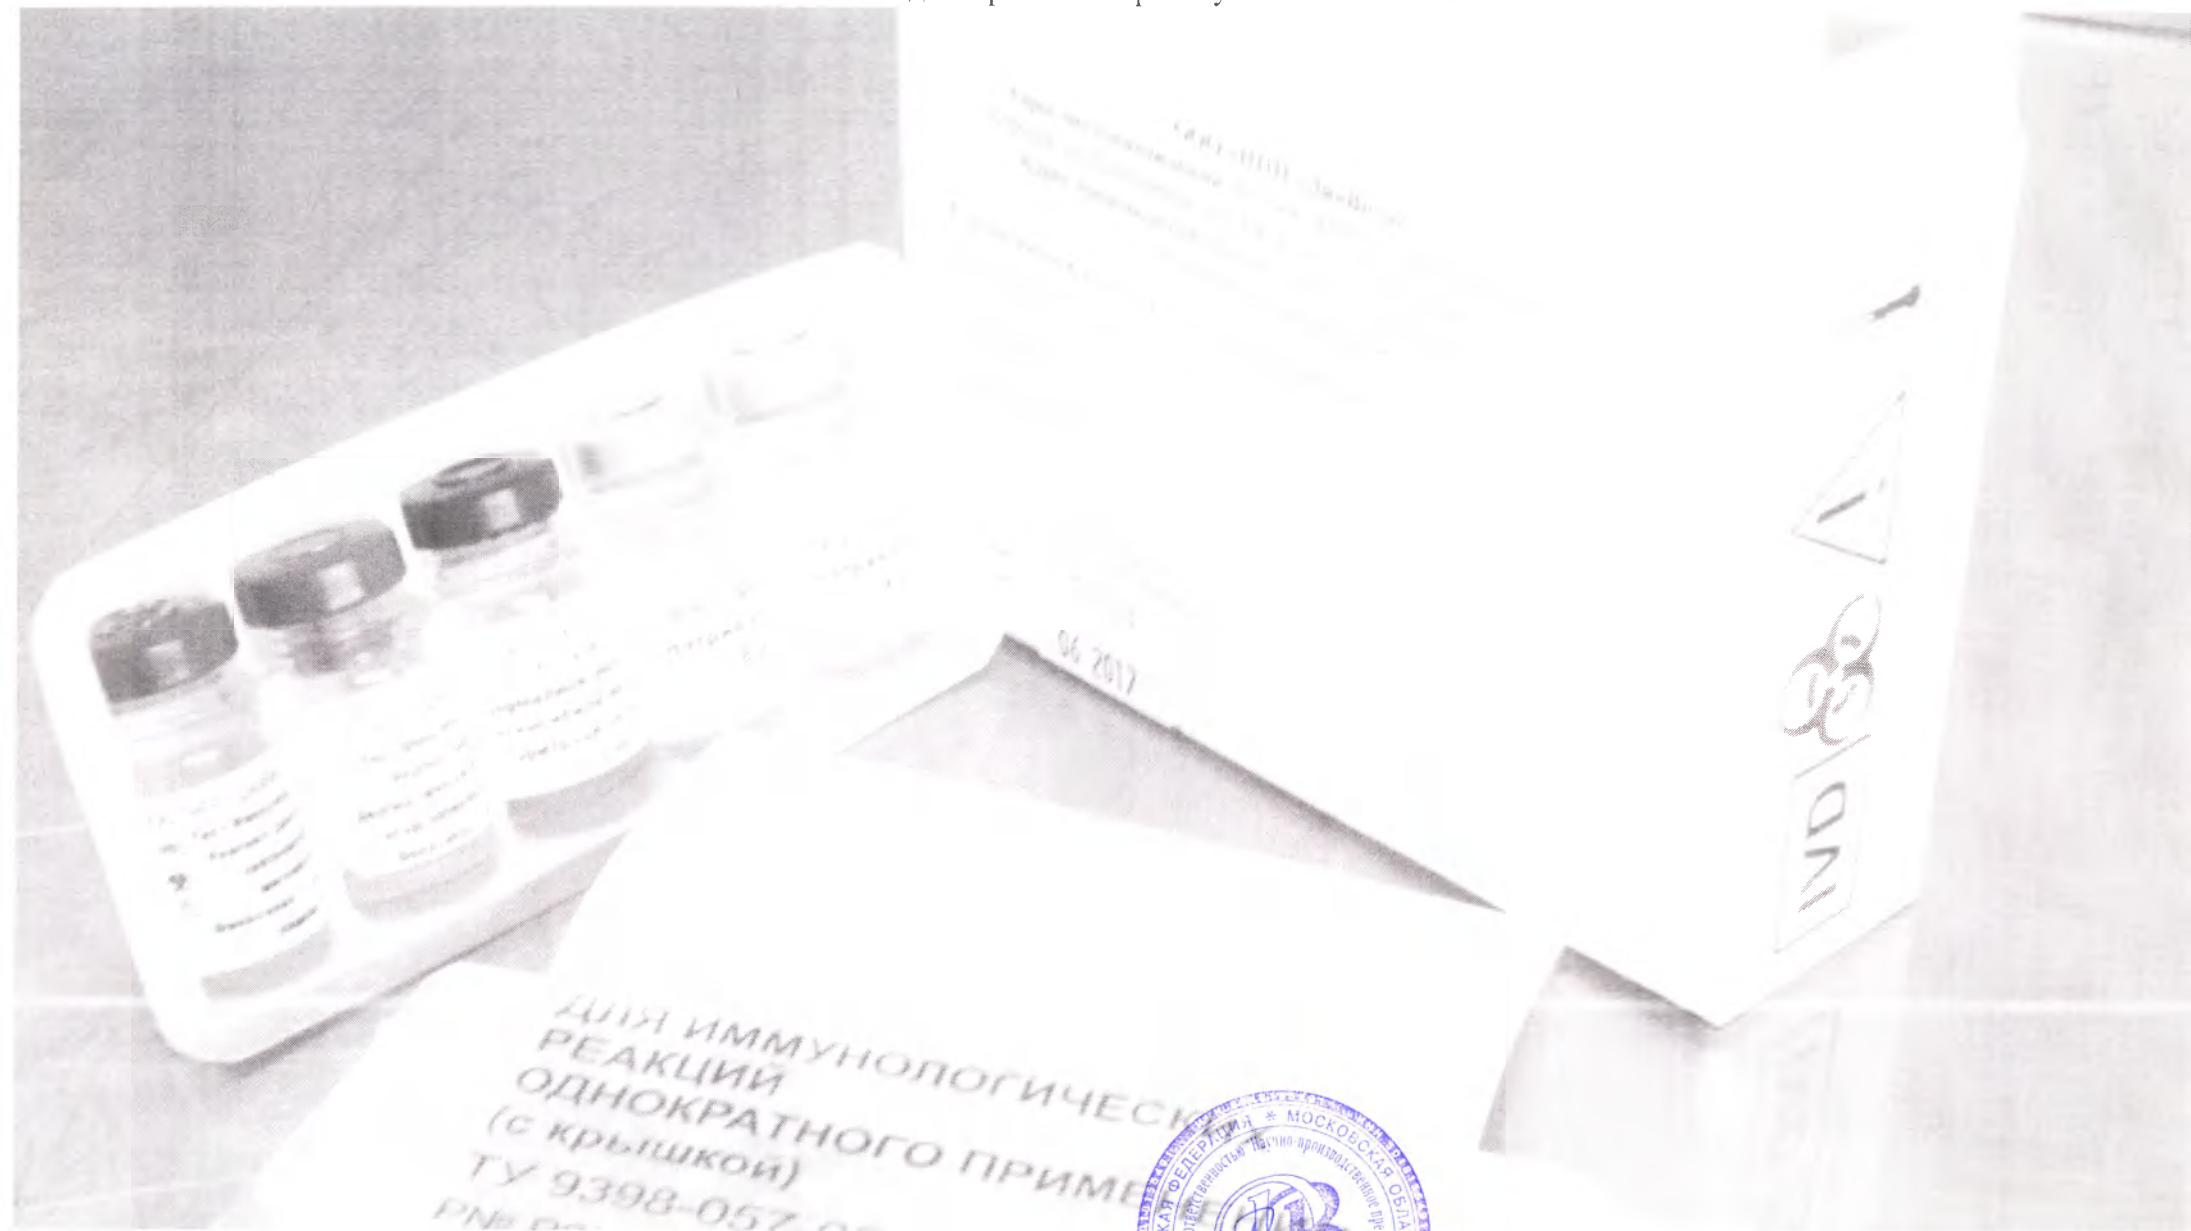


Генеральный директор ООО "НПП "ДиаВита"

А.О.Глубоковских

набора реагентов «Диагностикум эритроцитарный шигеллезный Флекснера 1-5 антигенный, жидкий» (Тест Флекснера 1-5 РПГА)

Комплект №3 рассчитан на 23 определений: серийный номер 030915 годен до 05.2017 г.


Вид с лицевой стороны упаковки

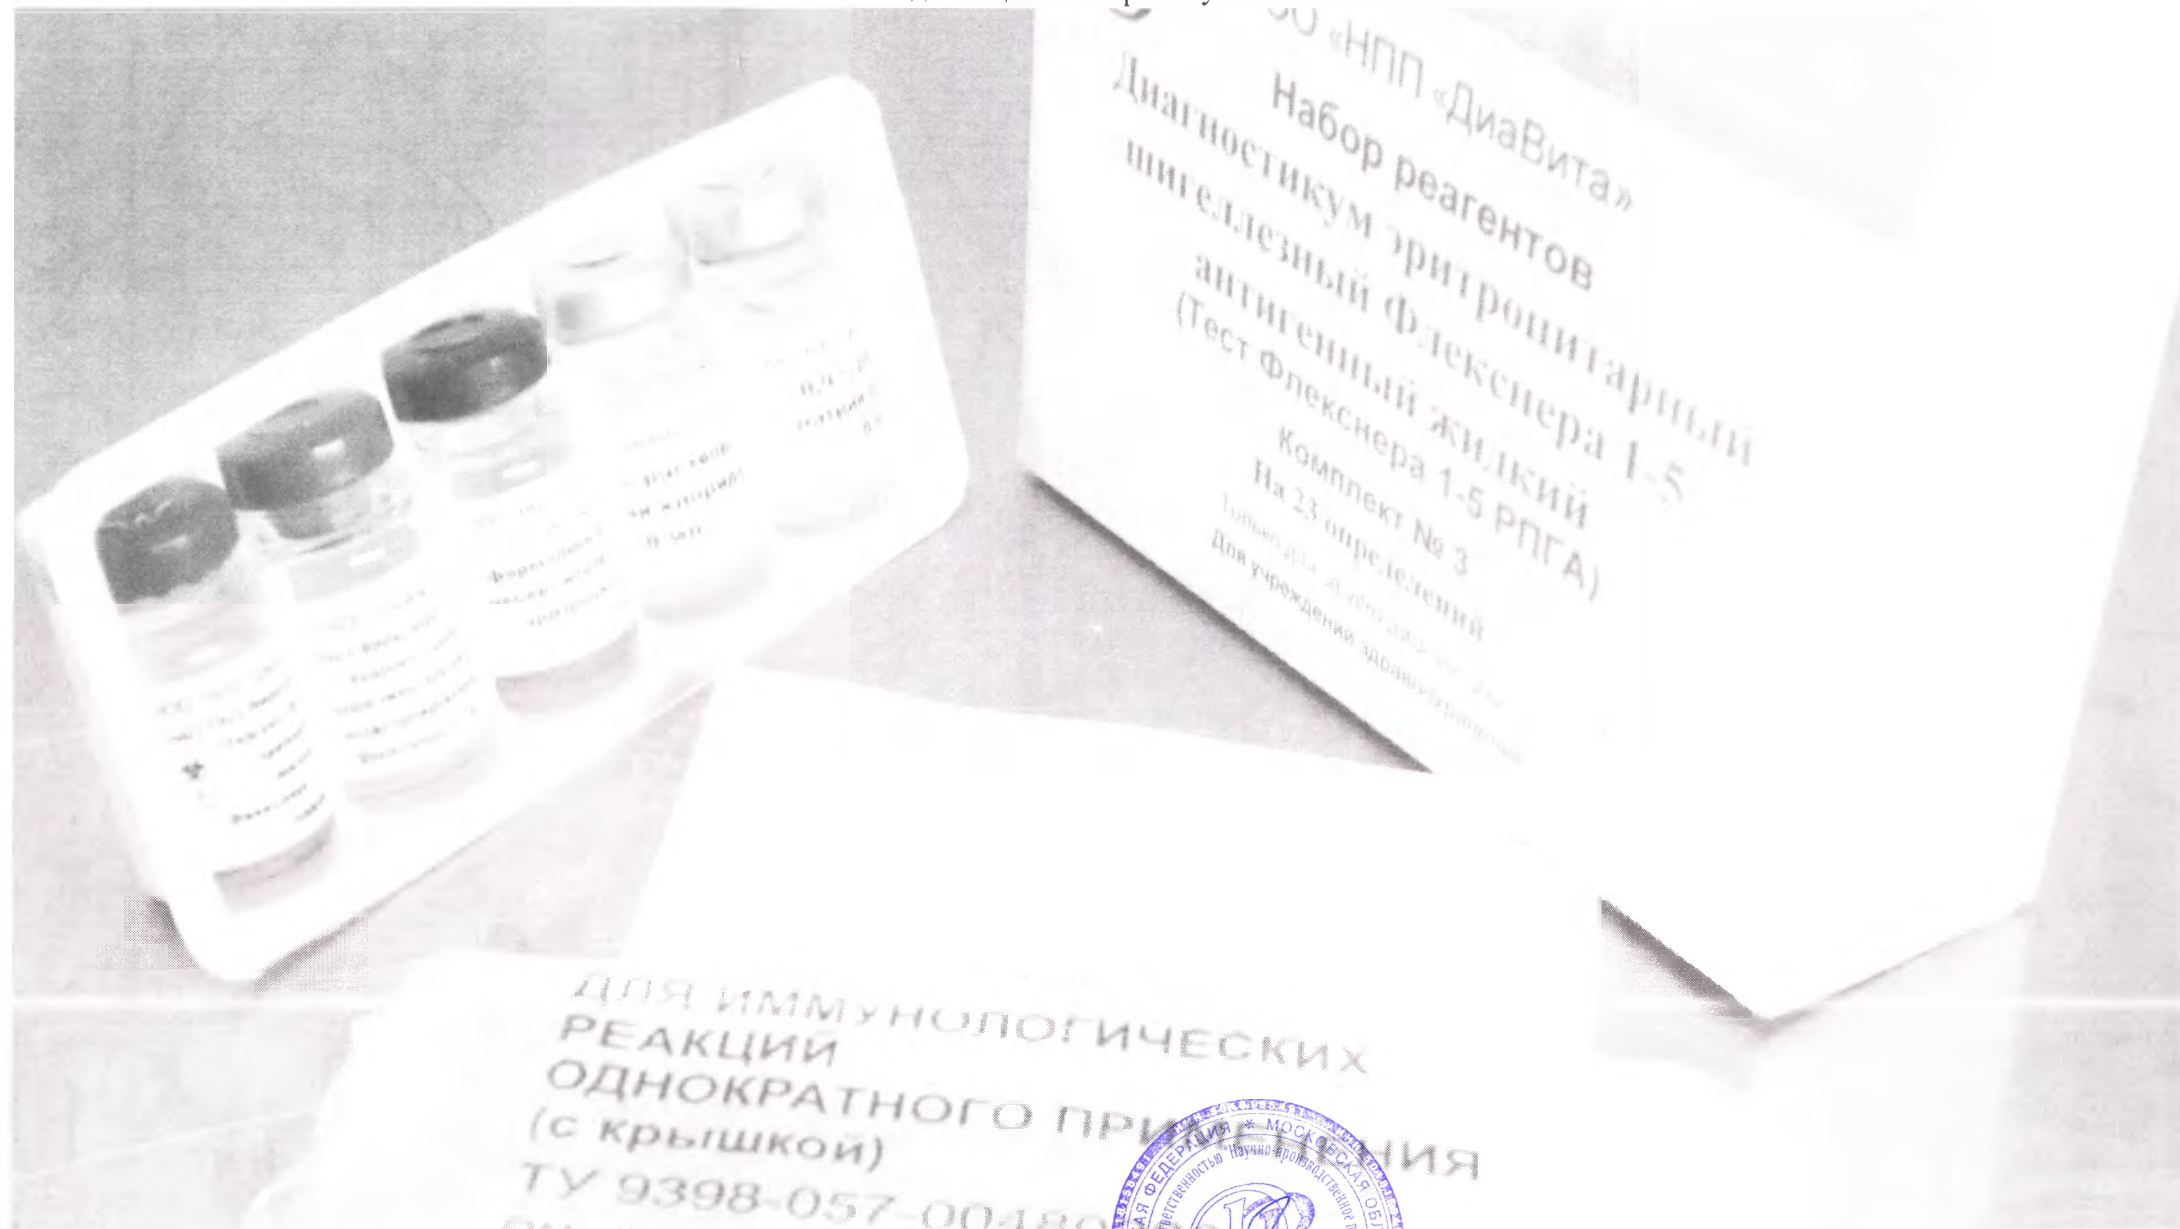

Набор реагентов «Диагностика эритроцитов» (архивный иммунологический Флекенера 1-3 анти-С-титры, жидкий) (Тест Флекенера 1-3 Р1П А)

Комплект №3 рассчитан на 23 определений: серийный номер 030915 годен до 05.2017 г.

Вид с лицевой стороны упаковки

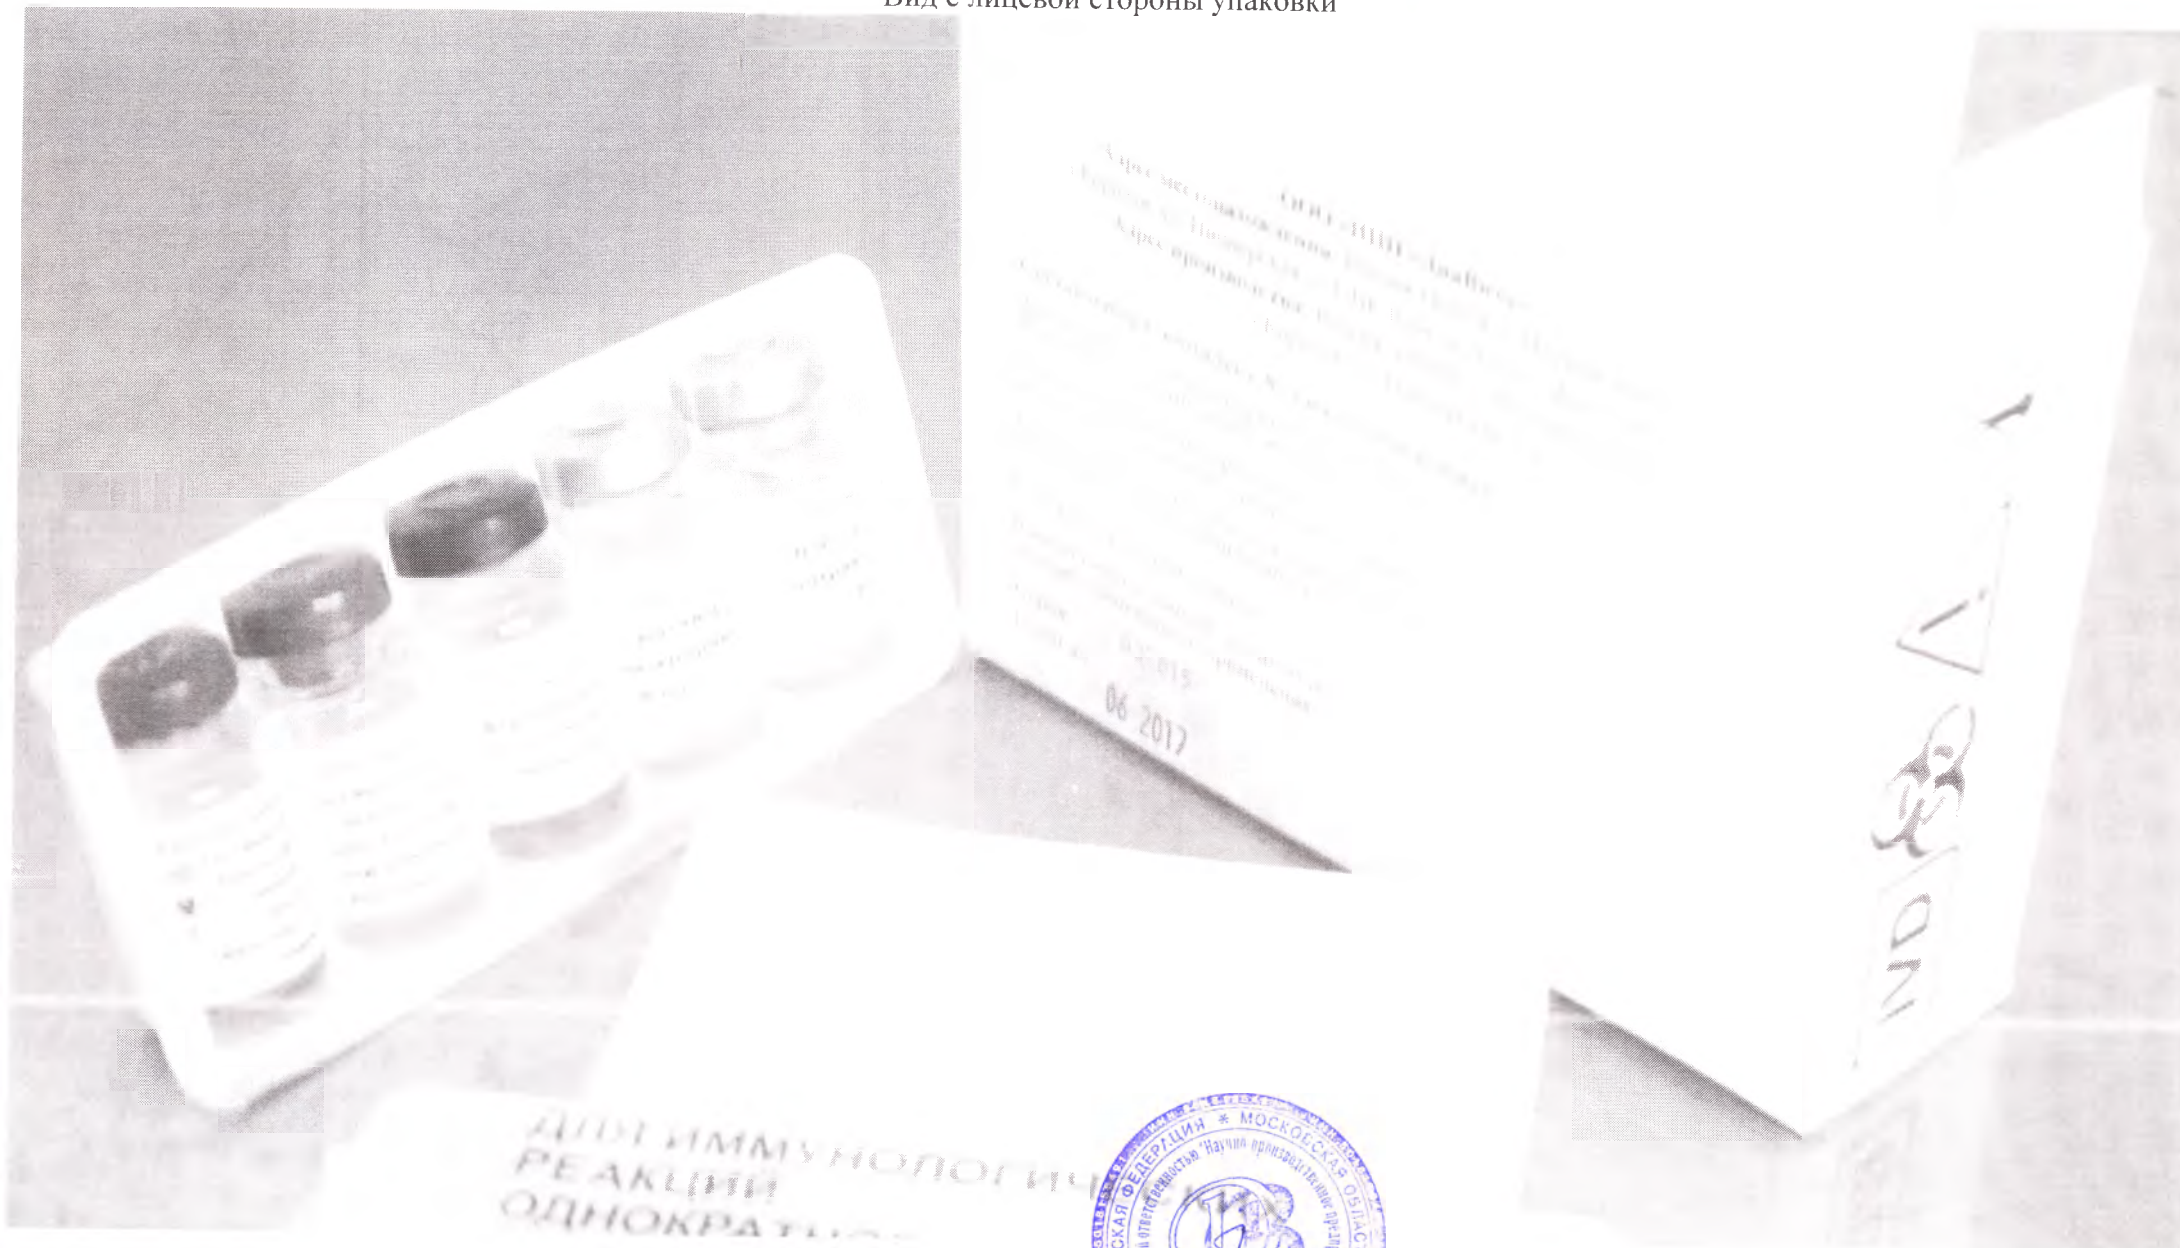

набора реагентов «Диагностикум эритроцитарный шигеллезный Флекснера 1-5 антигенный, жидкий» (Тест Флекснера 1-5 ГПА)

Комплект №3 рассчитан на 23 определений: серийный номер 041015 годен до 06.2017 г.


Вид с лицевой стороны упаковки



Набора реагентов «Диагностикум эритроцитарных шигеллезных Флекснера 1-5 антигенных, жидкий» (тест Флекснера 1-5 Р111 А)

Комплект №3 рассчитан на 23 определений: серийный номер 041015 годен до 06.2017 г.

Вид с лицевой стороны упаковки

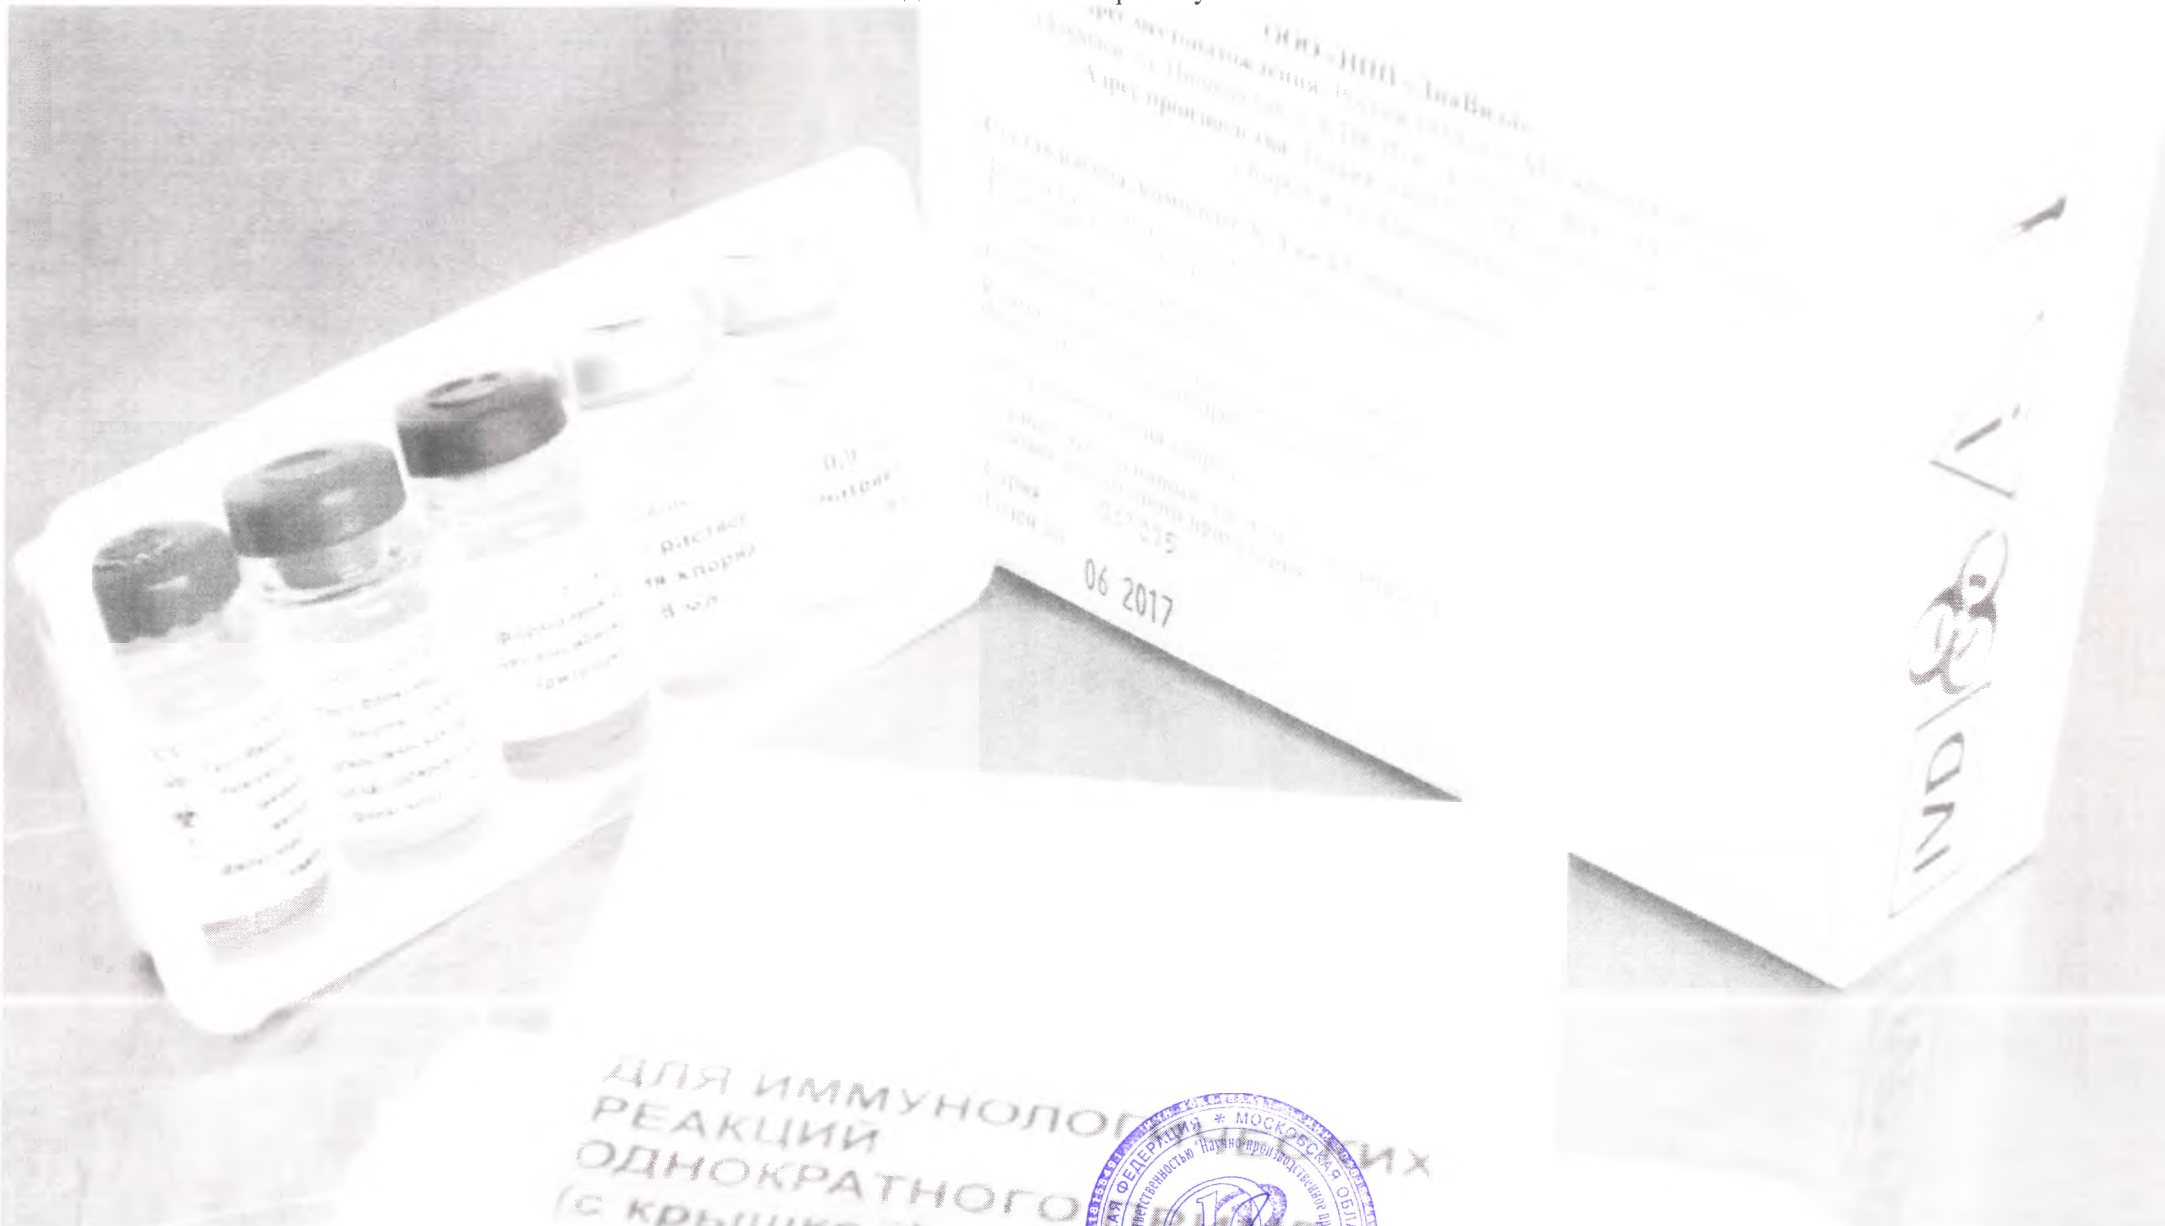

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

12 лист 06.



Генеральный директор ООО
НПН «ДиаВита»

Глубоковских А.О.

14 ноября 2017 г.

Макеты этикеток и эскиз кроя коробки
Набор реагентов «Диагностикум эритроцитарный шигеллезный
Флекснера 1-5 антигенный жидкий (Тест Флекснера 1-5 РПГА)
по ТУ 9398-002-96299156-2015



ООО "НПП "ДиаВита" г.Королев Тест Зонне РПГА Реагент: Диагностикум эритроцитарный шигеллезный Флекснера 1-5 антигенный жидкий 3 мл	С. 031015 Годен до 06.2017
--	---

ООО "НПП "ДиаВита" г.Королев 1 % взвесь формализированных, несенсибилизированных эритроцитов барана 1 мл	С. 031015 Годен до 06.2017
--	---

ООО "НПП "ДиаВита" г.Королев Тест Зонне РПГА Реагент: Контрольная диагностическая сыворотка шигеллезная Флекснера 1-5 неадсорбированная сухая из 0,1 мл	Серия 010215 Тип 1/6400 Годен до 02.2020
---	---

ООО "НПП "ДиаВита" г.Королев 0,9 % раствор натрия хлорида 8 мл	С. 010215 Годен до 02.2020
--	---

Генеральный директор ООО «НПП «ДиаВита»

Тлубоковских А.О.



Макеты этикеток и эскиз кроя коробки
Набор реагентов «Диагностикум эритроцитарный шигеллезный
Флекснера 1-5 антигенный жидкий (Тест Флекснера 1-5 РПГА)
по ТУ 9398-002-96299156-2015



ООО "НПП "ДиаВита" г.Королев IVD Тест Зонне РПГА Реагент: Диагностикум эритроцитарный шигеллезный Флекснера 1-5 антигенный жидкий 5 мл  	С. 010215 Голен до 10.2016
---	--

ООО "НПП "ДиаВита" г.Королев 1 % взвесь формализированных, несенсибилизированных эритроцитов барана 1 мл	С. 010215 Голен до 10.2016
--	--

ООО "НПП "ДиаВита" г.Королев IVD Тест Зонне РПГА Реагент: Контрольная диагностическая сыворотка шигеллезная Флекснера 1-5 неадсорбированная сухая из 0,1 мл  	Серия 010215 Титр 1/2560 Голен до 02.2020
--	--


ООО "НПП "ДиаВита" г.Королев 0,9 % раствор натрия хлорида 8 мл	С. 010215 Голен до 02.2020
--	--

Генеральный директор ООО «НПП «ДиаВита»

Глубоковских А.О.



Макеты этикеток и эскиз края коробки
Набор реагентов «Диагностикум эритроцитарный шигеллезный
Флекснера 1-5 антигенный жидкий (Тест Флекснера 1-5 РПГА)
по ТУ 9398-002-96299156-2015

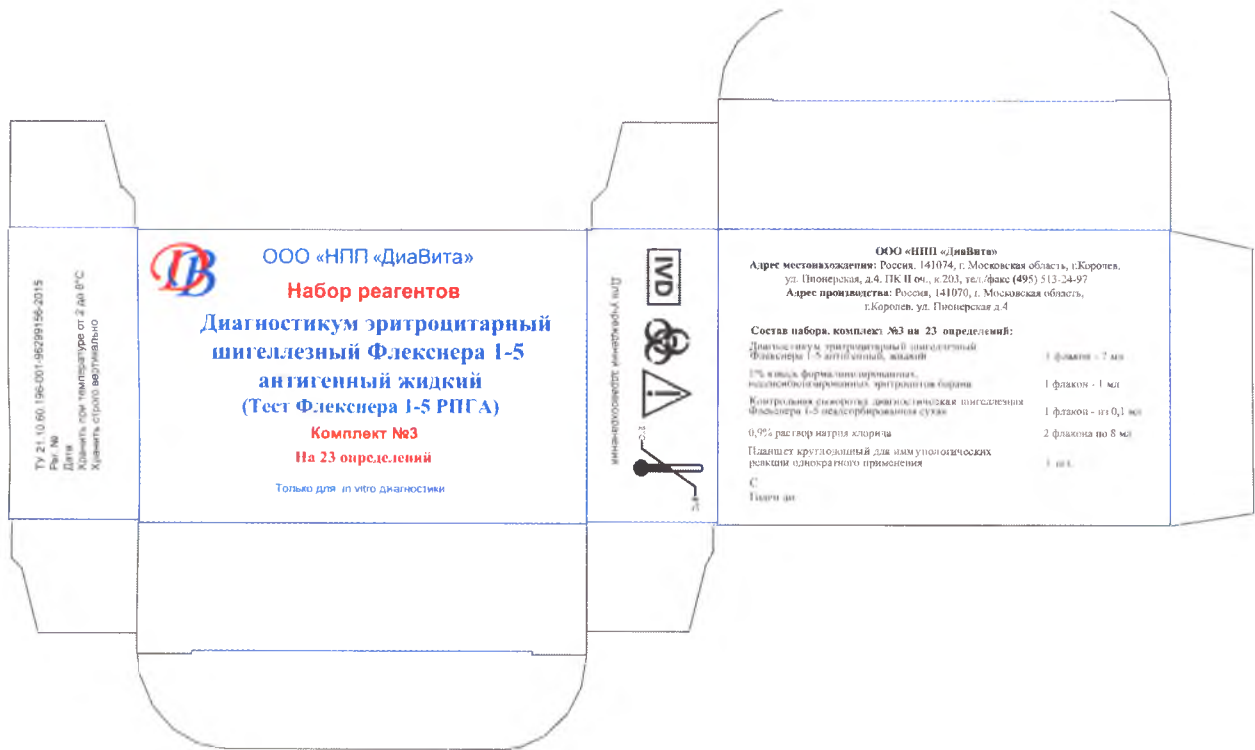

ООО "НПП "ДиаВита" г.Королев IVD Тест Зонне РПГА Реагент: Диагностикум эритроцитарный шигеллезный Флекснера 1-5 антигенный жидкий 7 мл	С. 010215 Годен до 10.2016
---	---

ООО "НПП "ДиаВита" г.Королев 1 % взвесь формалинизированных, несенсибилизированных эритроцитов барана 1 мл	С. 010215 Годен до 10.2016
--	---

ООО "НПП "ДиаВита" г.Королев IVD Тест Зонне РПГА Реагент: Контрольная диагностическая сыворотка шигеллезная Флекснера 1-5 неадсорбированная сухая из 0,1 мл	Серия 010215 Титр 1/2560 Годен до 02.2020
--	--

ООО "НПП "ДиаВита" г.Королев 0,9 % раствор натрия хлорида 8 мл	С. 010215 Годен до 02.2020
--	---

Генеральный директор ООО «НПП «ДиаВита»

Глубоковских А.О.



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

3 лист 4

Генеральный директор ООО
«НПП «ДиаВита»

Глубоковских А.О.

10 декабря 2017г.

