



**Фотографические изображения общего вида  
медицинского изделия вместе с принадлежностями  
необходимыми для применения медицинского изделия  
по назначению, в т.ч. в комплекте SIMSYS (СИМСИС).**

Пролито и  
протерено

126 миде ООО "Абул" 4

Синяев




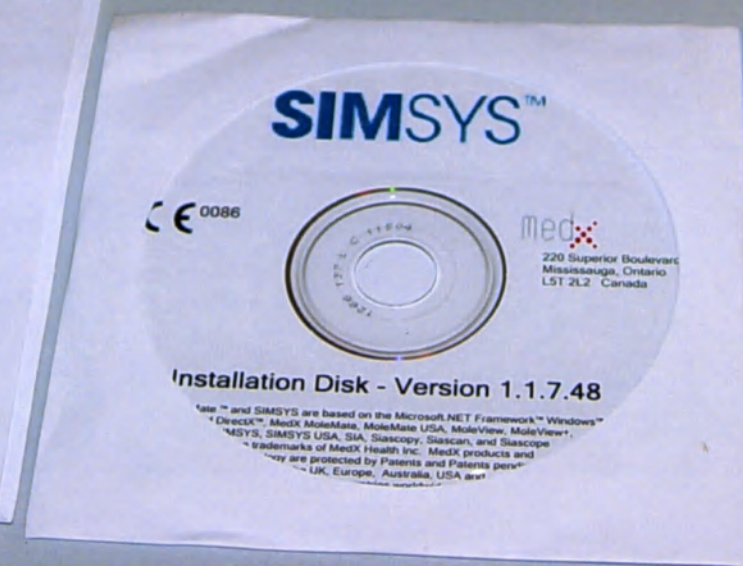

**I. Оборудование медицинское дерматоскопическое  
диагностическое SIAscope V (СИАскоп V) в комплектах:**


**Комплект SIMSYS (СИМСИС):**  
(старое наименование: Комплект MoleView (МоуЛью))

1. Сканер СИАскоп V.
2. Держатель для сканера СИАскоп V.
3. USB – кабель.
4. Иммерсионная жидкость.
5. Лицензионный ключ.
6. Программное обеспечение «СИМСИС» CD диске.
7. Данные для калибровки насадки сканера СИАскоп V на CD диске.
8. Инструкция – 1 шт.

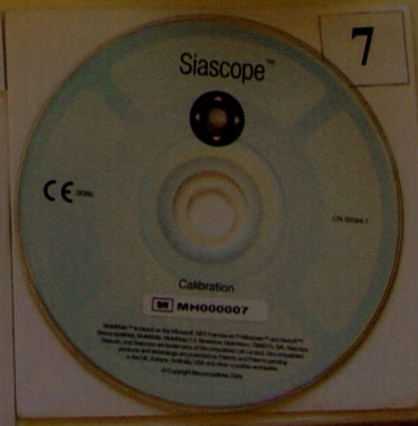

# 1. Подъёмный фильтр



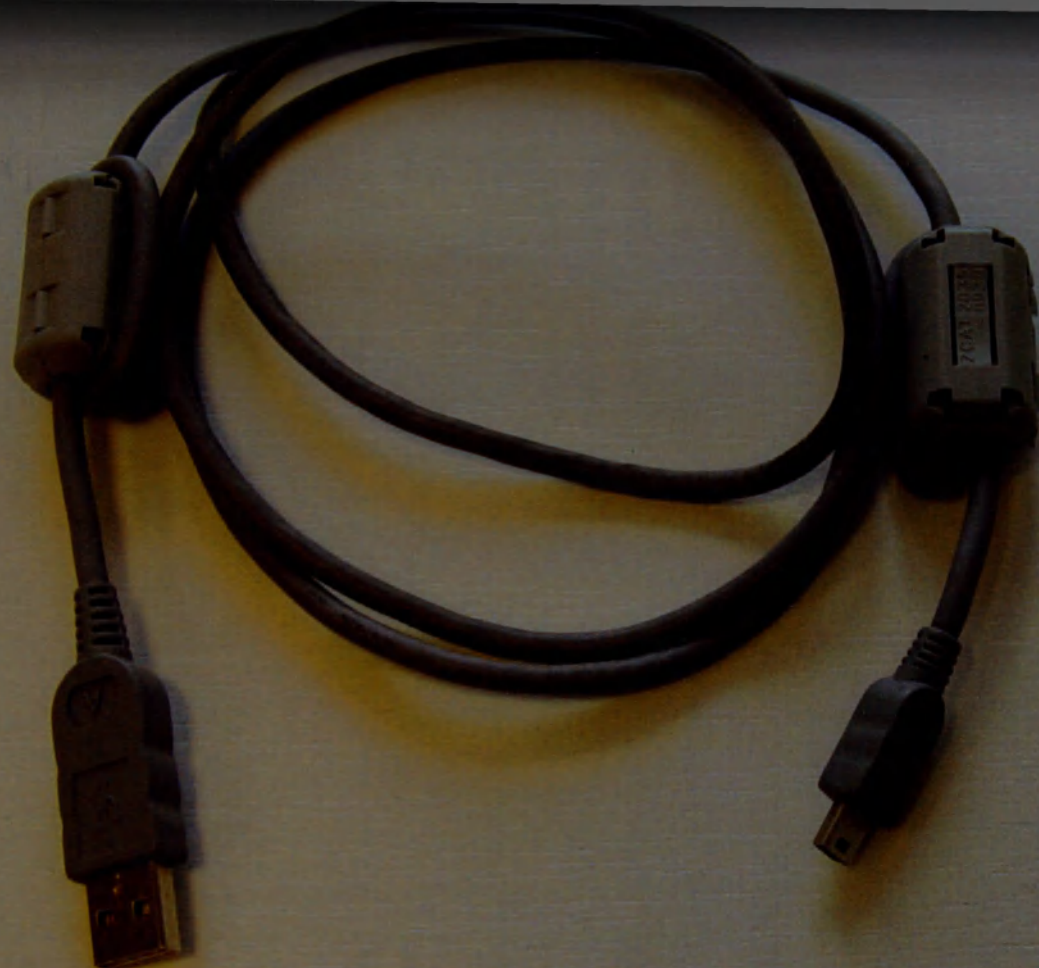

**2. Кабель для камеры**



### 3. Кабель для сканера СИАскоп V






4. Шнур сетевой



**5. USB кабель**



**6. USB HUB кабель**





## 8. Держатель для сканера.



## 9. Иммерсионная жидкость

# ООО «ЛАБИТЭ»

101000 г. Москва, Мясницкая ул. 30/1/2 стр.1  
тел. 729-63-32, 968-46-71

## ДОВЕРЕННОСТЬ № 36

Москва

«21» мая 2015 года

Общество с ограниченной ответственностью «Лабитэ» в лице генерального директора Глазачевой Татьяны Риамировны, действующей на основании Устава, доверяет

Глазачевой Татьяне Риамировне (паспорт № 46 11 026524, отделом УФМС России по Московской области в гор. Жуковском, Код подразделения 500-036, дата выдачи 28.10.2010 г.)

представлять интересы ООО «Лабитэ» в Росздравнадзоре, в связи с этим предоставляет право предавать и получать документы, расписываться и совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения.

Доверенность действительна в течение 70 календарных дней от даты выдачи.

Подпись представителя \_\_\_\_\_ заверяю.

Генеральный директор  
ООО «Лабитэ»


Татьяна Риамировна Глазачева



патентованная технология **Спектрофотометрического Интрадермального Анализа**  
(Великобритания – Кембридж)


# ДерматоСИАскопия

**УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЙ КОЖИ**  
**БЫСТРО И БЕЗБОЛЕЗНЕННО загляните на 2 мм внутрь кожи**

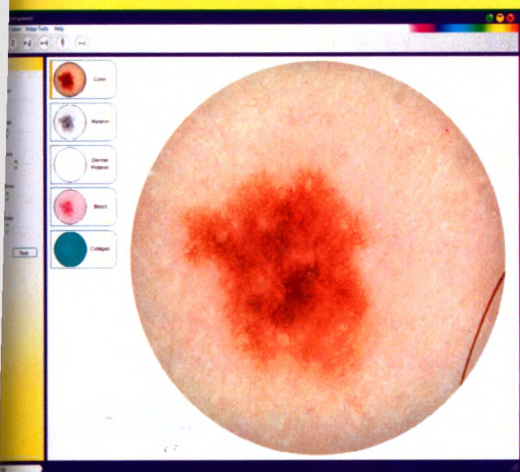


**СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПОЗВОЛЯЕТ ДОСТИЧЬ 96% ТОЧНОСТИ ДИАГНОСТИКИ НОВООБРАЗОВАНИЙ**

Точность диагностики новообразований

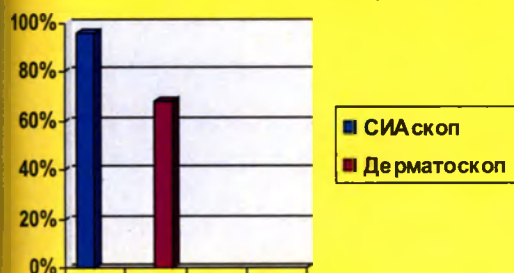

Точность определения меланомы

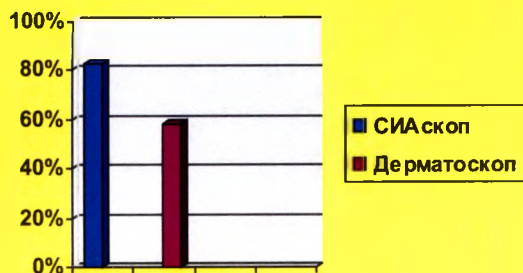

## ВОЗМОЖНОСТИ дерматоСИАскопии

### Рак кожи

- Диагностика злокачественной меланомы: поверхностно-распространяющейся, узловой типа злокачественного лентиго, акрально-лентигинозной.
- Диагностика и контроль за базально-клеточным раком.

### Заболевания кожи

- Диагностика и контроль за папилломатозным дермальным невусом, врожденным невусом спитц-невусом, атипичным меланоцитарным невусом, голубым невусом, себорейным кератозом, гемангиомой, ангиокератомой, дерматофибромой.
- Диагностика и контроль за экземой.
- Диагностика и контроль за псориазом.
- Диагностика и контроль за акне.
- Диагностика, контроль за лечением чесотки и педикулеза.
- Диагностика и контроль за лечением бородавок.


### Здоровье кожи

- Контроль за заживлением ран.

### Косметические средства

- Оценка возраста кожи.
- Косметология.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ МоулМейт

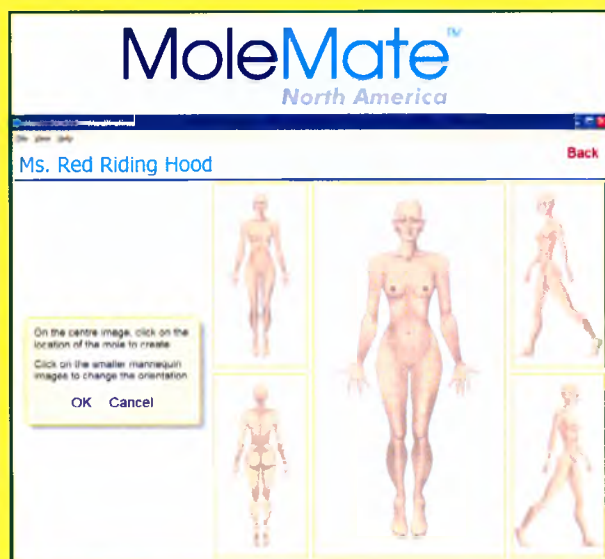

### КОМПЛЕКТАЦИЯ СимСис С БАЗОЙ ДАННЫХ ПАЦИЕНТОВ



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Прибор                 | Неинвазивный, сканирующий                             |
| Технология считывания  | Спектрофотометрический Интрадермальный Анализ         |
| Сканер                 | Ручной сенсор со сканирующей областью диаметром 11 мм |
| Излучаемая длина волны | От 440 нм до 960 нм                                   |
| Разрешение             | Более 25 микрон                                       |
| Время сканирования     | Сканирование – 3 с, обработка данных – 3 с            |
| Калибровка             | Заводская                                             |
| Габариты               | Длина – 240 мм, диаметр – 65 мм                       |
| Вес                    | 250 г                                                 |
| Видеоискатель          | Цветной                                               |

### ООО «Лабитэ»

Эксклюзивный дистрибьютор в России и странах СНГ

Россия, 101000, Москва, ул. Мясницкая 30/1/2, стр. 1. Тел.: (495) 623-14-77, 968-46-71

e-mail: labi-te@mail.ru www.skinmed.ru










## 14. Лицензионный ключ.

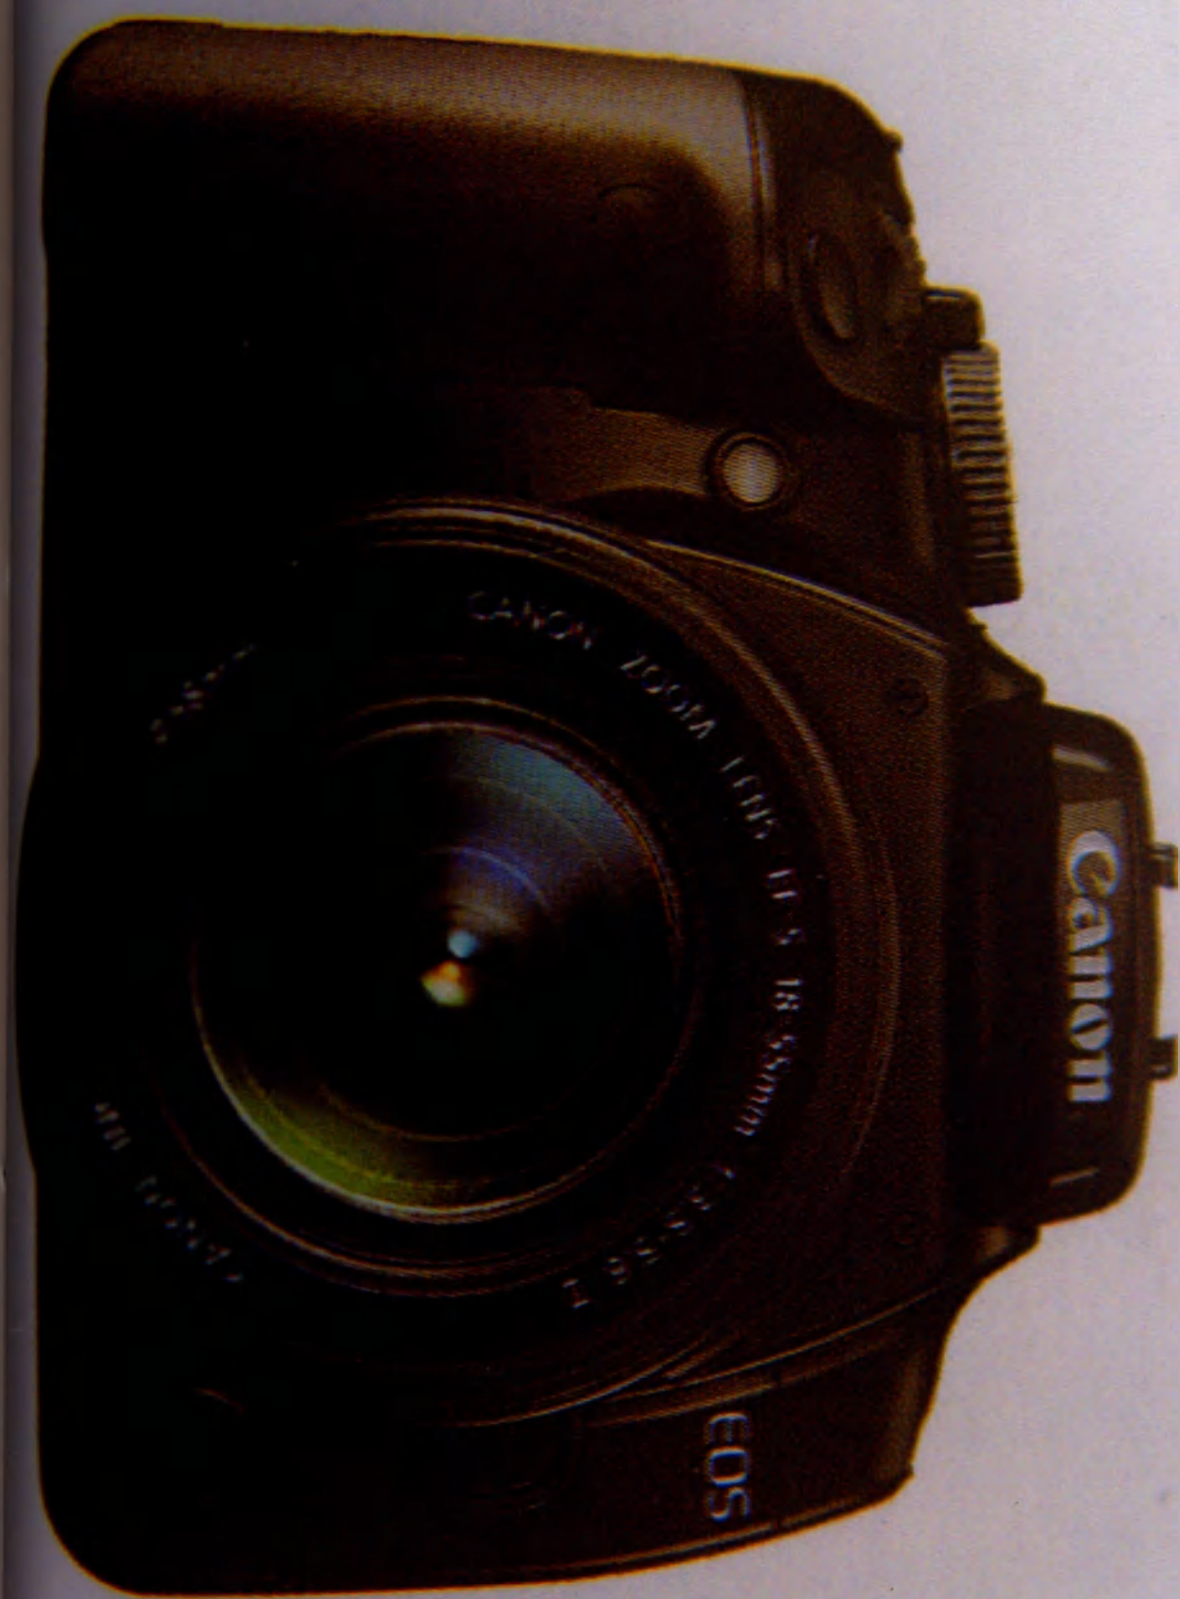

**17. Цифровая зеркальная фотокамера  
Кэнон (Canon EOS 400 D).**

## 22. Вспышка для выявления возрастных изменений.

DERMETRICS Development

File Edit View Image Capture Image Tools Help

Dermetrics

Is the image correct?

Save

Capture




Awaiting input ...





**20. Объектив для цифровой фотокамеры.**

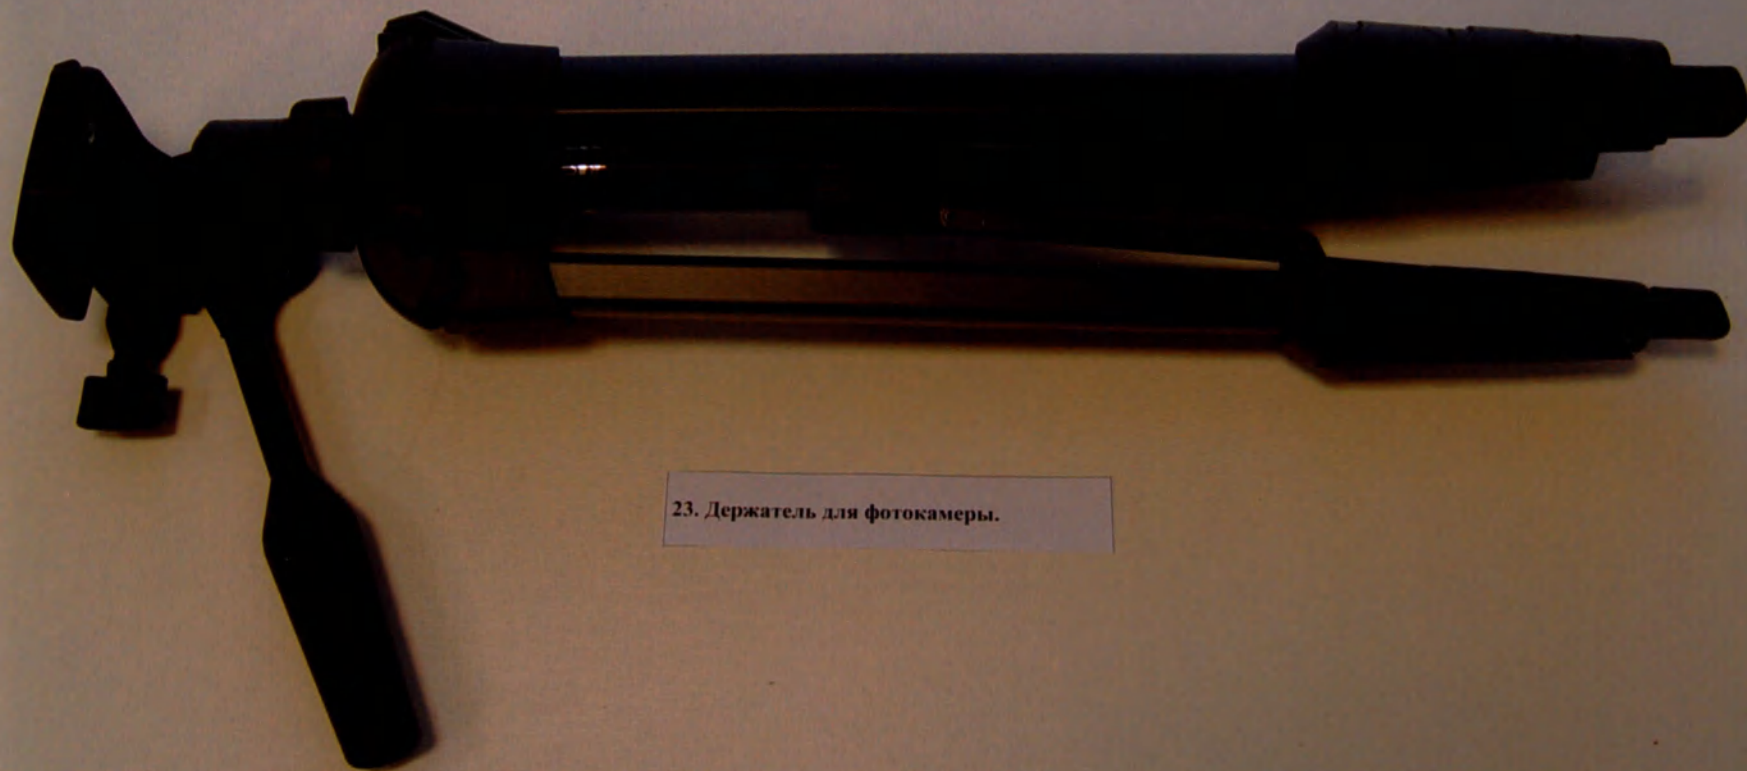

23. Держатель для фотокамеры.



**24. Зарядное устройство для фотокамер  
Канон.**

## 27. Рукоятка для фотокамеры.




**Программное обеспечение на CD дисках  
(позиции 33-64 из перечня Принадлежностей), в т.ч.:**




**33. Данные для калибровки сканера СИАскоп V на CD диске.**

**33. Программное обеспечение «МоулМейт» на CD диске**

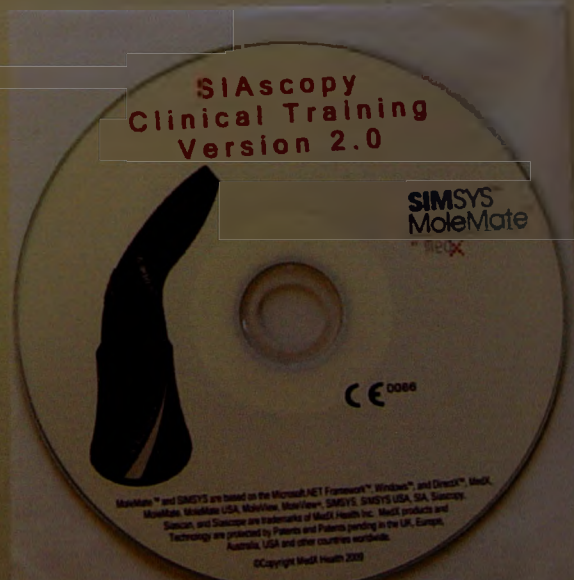

**34. Программное обеспечение «СИМСИС» на CD диске**

**50. Обучающий программный модуль на CD диске**

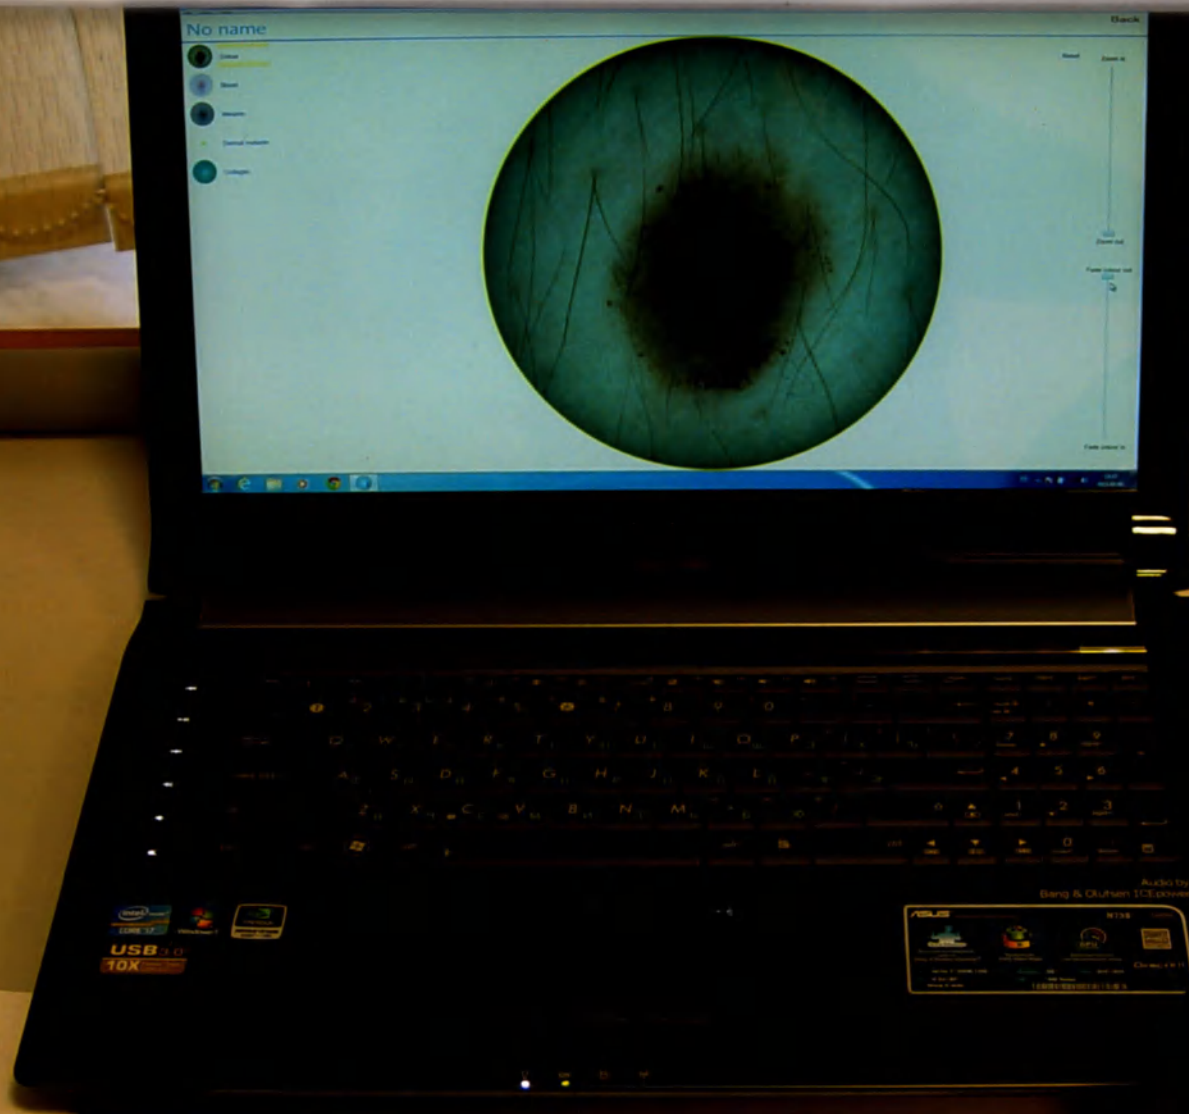

**SIMSYS**<sup>TM</sup>  
Image Management System

Operating Guide

