





ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОЛИПЭКТОМИИ		ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОЛИПЭКТОМИИ		ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОЛИПЭКТОМИИ		ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОЛИПЭКТОМИИ	
Петля для полипэктомии, тип "шестиугольная", ширина раскрытия 35 мм, с изолированным носиком, вращающаяся, без ручки, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 180 см по ТУ 9433-005-89134710-2015		Петля для полипэктомии, тип "шестиугольная", ширина раскрытия 35 мм, с изолированным носиком, вращающаяся, без ручки, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 230 см по ТУ 9433-005-89134710-2015		Петля для полипэктомии, тип "шестиугольная", ширина раскрытия 20 мм, с изолированным носиком, без ручки, диаметр 1,8 мм, для канала 2,0 мм, длина 180 см по ТУ 9433-005-89134710-2015		Петля для полипэктомии, тип "шестиугольная", ширина раскрытия 35 мм, без ручки, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 230 см по ТУ 9433-005-89134710-2015	
АРТ	94331130	АРТ	94331131	АРТ	94331061	АРТ	94331060
ЛОТ	20150316/109	ЛОТ	20150316/110	ЛОТ	20150316/049	ЛОТ	20150316/048
 2015.03 - 2018.03 		 2015.03 - 2018.03 		 2015.03 - 2018.03 		 2015.03 - 2018.03 	
 производитель: ООО «Эндостарт» Болшое Московское 27А Санкт-Петербург Россия, 197101 телефон: +7 (812) 555-56-57 e-mail: info@endo-start.ru www.endo-start.ru		 производитель: ООО «Эндостарт» Болшое Московское 27А Санкт-Петербург Россия, 197101 телефон: +7 (812) 555-56-57 e-mail: info@endo-start.ru www.endo-start.ru		 производитель: ООО «Эндостарт» Болшое Московское 27А Санкт-Петербург Россия, 197101 телефон: +7 (812) 555-56-57 e-mail: info@endo-start.ru www.endo-start.ru		 производитель: ООО «Эндостарт» Болшое Московское 27А Санкт-Петербург Россия, 197101 телефон: +7 (812) 555-56-57 e-mail: info@endo-start.ru www.endo-start.ru	
Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!		Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!		Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!		Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!	

ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОЛИПЕКТОМИИ

Петля для полипектомии, тип "шестигранная", ширина раскрытия 35 мм, с изолированными ножками, без ручки, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 180 см

no TУ 9433-005-09134710-2015

APT	94331069
LOT	20150316/057

№ 2015 03 - 2018 03

Endo Stats

Организатор:
ООО "Эндоскоп" г. Москва
Вольная Мысовая 17А
д. 17А
г. Москва, 125125

8-800-555-55-52
Москва: +7 (495) 500-25-25
e-mail: info@endo-stat.ru
www.endo-stat.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо убедиться в соответствии с руководством по применению.

ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОЛИЭКОТМИИ

Петля для полиэкотмии, тип "шестиугольная", шириной раскрытия 25 мм, с изогнутым носиком, без ручки, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 230 см

по ТУ 9433-005-89134710-2015

АРТ	94331068
ЛОТ	20150316/056

 2015.03 - 2018.03
 




представитель:

ООО "Эндостат"
 Торговое представительство 218
 ул. Ленинградская, 10
 Россия, 191301

ИНН 33/016 57
 ОГРН 1043301657
 e-mail: info@endostat.ru
 www.endostat.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по применению!

ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОЛИИПТЕОМИИ

Петля для полииптеомии, тип "шестиугольная", ширина раскрытия 25 мм, с изолирующей ножкой, без ручки, диаметр 2,3 мм, шаг канала 2,8 мм, длина 180 см
по ТУ 943-005-891-34710-2015

APT	94331067
ЛОТ	20150316/055

МФ 2015.03 - 2018.03

EndoStat

госрегистрация:
ООО «ЭндоСтатус»
Киевская область, г. Киев,
Левый берег, 15А
Киев, Украина, 04011

ВНИЗКО ООО «Байотек»
г. Москва, ул. Рязанский в-л, д. 10
e-mail: info@endo-stat.ru
www.endo-stat.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений
уставки Петли; использование небезопасно со стороны

ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОЛИПЭКТОМИИ

Петля для полипектомии, тип "Стигмусольман",
ширина раскрытия 20 см, с изолированными носками,
без ручки, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм,
длина 230 см

по ТУ 9433-005-89134710-2015

APT	94331066
ЛОТ	20150316/054

 2015.03. - 2018.03





Endo
Stats

Самостоятельно
2015-2016 года
Владимир Мельник 274
Самое Популярное
Россия - 97 563

8 800 100 50 52
мск. +7 (495) 20 20 20
e-mail: info@endo-stats.ru
www.endo-stats.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии патологических
утолщений. Перед использованием необходимо ознакомиться с

ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОЛИПЕКТОМИИ

Петля для полипектомии, тип "шестигугольная",
ширина раскрытия 25 мм, с изолированным носиком,
без ручки, диаметр 1,8 мм, для канала 2,0 мм,
длина 180 см

по ТУ 9433-005-89134710-2015

APT	94331063
ЛОТ	20150316051

№ 2015.03.2018.03

EndoStarz

Генеральный
дистрибьютор
в Республике Беларусь
Савен Петр Павлович
Минск, Беларусь

тел: +375 29 511 10 17
e-mail: info@endo-starz.by
www.endo-starz.by

не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений
упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться
с инструкцией по применению.

ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОЛИПЕКТОМИИ

Петля для полипектомии, тип "шестиступенчатая",
ширина раскрытия 25 мм, без ручки, диаметр 2,3 мм,
для канала 2,8 мм, длина 180 см.

по ТУ 9433-005-8919470-2015

APT	94331057
LOT	20150316/04S

WVI | 2015.03 - 2016.03

EndoStats

Информация:
©2015 EndoStat Systems
10000 E. Harvard Ave., Suite 174
Denver, CO 80231
(303) 755-1970

E-mail: info@endo-stats.com
www.endo-stats.com

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии противопоказаний к применению. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОЛИПЕКТОМИИ

Петля для полипектомии, тип "шестигранная",
ширина раскрытия 20 мм, без ручки, диаметр 2,3 мм,
для канала 2,8 мм, длина 230 см

№ТУ 9433-005-69134710-2015

APT	94331056
ЛЮТ	20150306/044

ИД 2015.03 - 2018.03

EndoStar

Исключительно:
ООО "Эндоскоп"
Воскресенский м-п, 178
Самара, 446107
Самара, 446107

8 8000 031 06 07
тел./факс: +7 (812) 060 20 40
e-mail: info@endo-star.ru
www.endo-star.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений
указаний. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению.

ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОЛИПЭКТОМИИ

Петля для полипэктомии, тип "шестиугольный",
ширина раскрытия 35 мм, без ручки, диаметр 2,3 мм,
для канала 2,8 мм, длина 180 см

по ТУ 9433-005-89134710-2015

APT	94331059
LOT	201503/047


2015.03 2018.03



EndoStar

производитель:
ООО «Эндо-Стар»
Польше-Мокшанский ул. 218
г. Пенза, 440010
Тел: 7472101

г. Москва 105081-67
тел: +7 (495) 253-2536
e-mail: info@endo-star.ru
www.endo-star.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений
указаны. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению

ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОЛИПЕКТОМИИ

Петля для полипектомии, тип "шестигольная",
ширина раскрытия 25 мм, без ручки, диаметр 1,8 мм,
длина канала 2,0 мм, длина 230 см

по ТУ 9433-005-89134710-2015

APT	94331054
ЛЮТ	20150316/042

 2015.03 - 2018.03

EndoStar

государственный
ООО «Эндоскоп»
Большое Московское 178
Савинское Покрово,
Рязань, 38700

8-800 155 56 57
факс: 812 905 25 38
e-mail: info@endo-star.ru
www.endo-star.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений
узелков. Перед использованием необходимо убедиться
в соответствии по маркировке!

ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОЛИПЭКТОМИИ

Петля для полипэктомии, тип "шестиступенчатая", ширина раскрытия 20 мм, с изогнутым носиком без ручки, диаметр 1,8 мм, для канала 2,0 мм, длина 230 см

по ТУ 9433-005-8913471-2015

APT	94331062
ЛОТ	20150316/050

№ 2015.03 - 2018.03

EndoStart

ООО "Сити-Сервис"
Болотное Мостовое 27А
Санкт-Петербург
Россия, 127070

8 (800) 535 56 57
телефакс: +7 (812) 663-25-26
e-mail: info@endo-start.ru
www.endo-start.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений
уставки. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению!

ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОЛИПЭКТОМИИ

Петля для полипэктомии, тип "шестигульная",
ширина раскрытия 20 мм, с изогнутым носиком,
без ручки, диаметр 2,5 мм, для канала 2,8 мм,
длина 180 см

по ТУ 9433-005-89134710-2015

APT	94331065
ЛОТ	20150316/053

 2015.03 - 2018.03





применяется:
1000-4400 г (чашка)
Большая Медицинская Чаша
Система Ретроград
Резекция, 19700

т. 8000 100 50 52
ф. 8122 00 00 28
e-mail: info@endo-stat.ru
www.endo-stat.ru

не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений
уставки. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению.

ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОЛИПЕКТОМИИ

Петля для полипектомии, тип "защелкивающийся",
ширина раскрытия 25 мм, с изолирующим носиком,
без ручки, диаметр 1,8 мм, для канала 2,0 мм,
длина 230 см

no TY 9433-005-89134710-2015

APT 94331064

LOT 20150316/052


мф 2015-03 - 2016-03

EndoStat
PacStat


производитель:
ENDO STAT
PacStat Medical 274
Crest, Германия
России, 109101

т. (495) 335-86-57
факс: +7 (495) 450-29-81
e-mail: info@endo-stat.ru
www.endo-stat.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

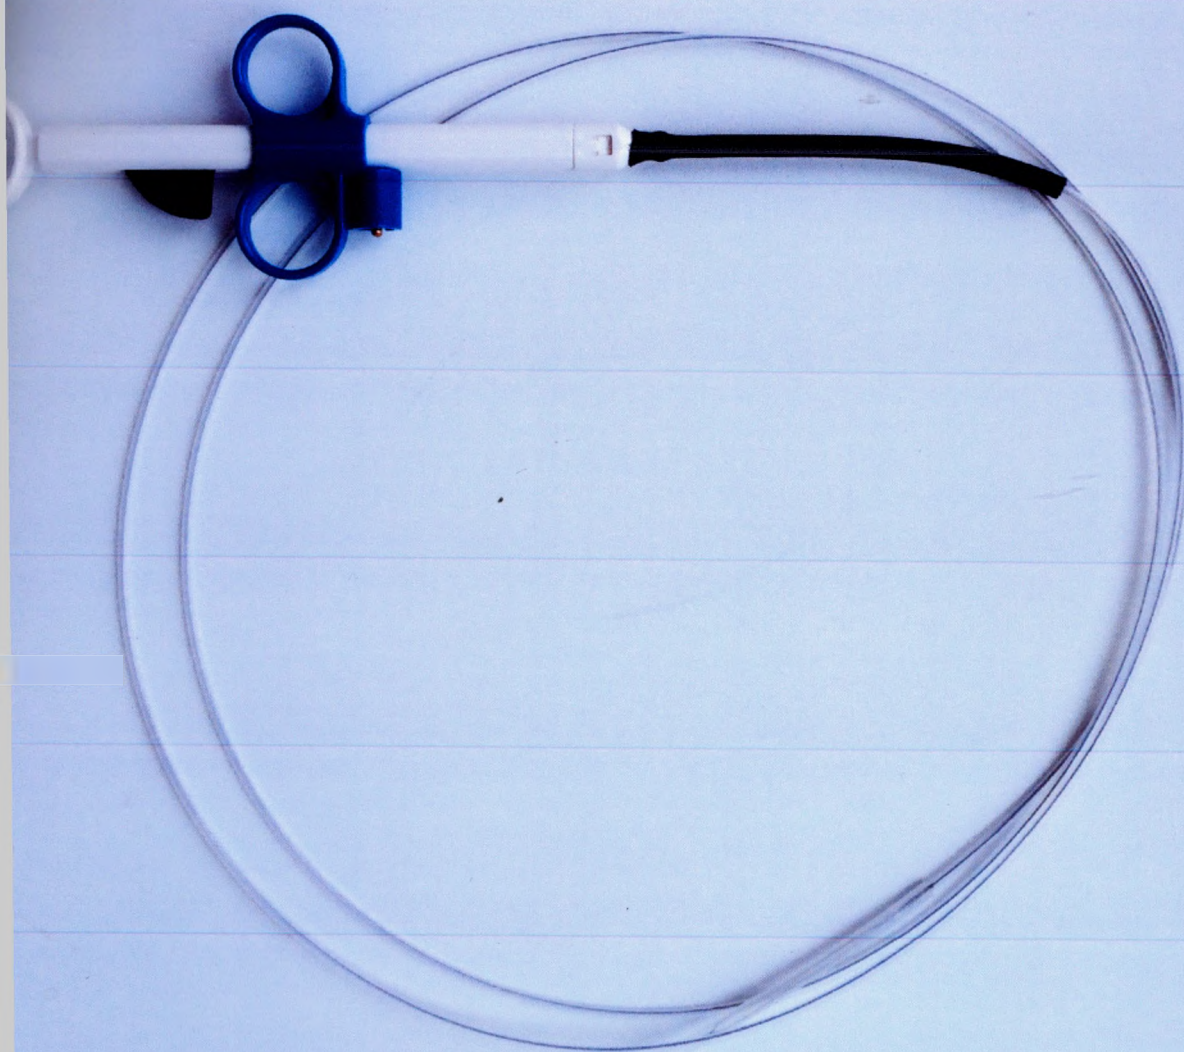

я полипэктомии, тип "овальная полужесткая"

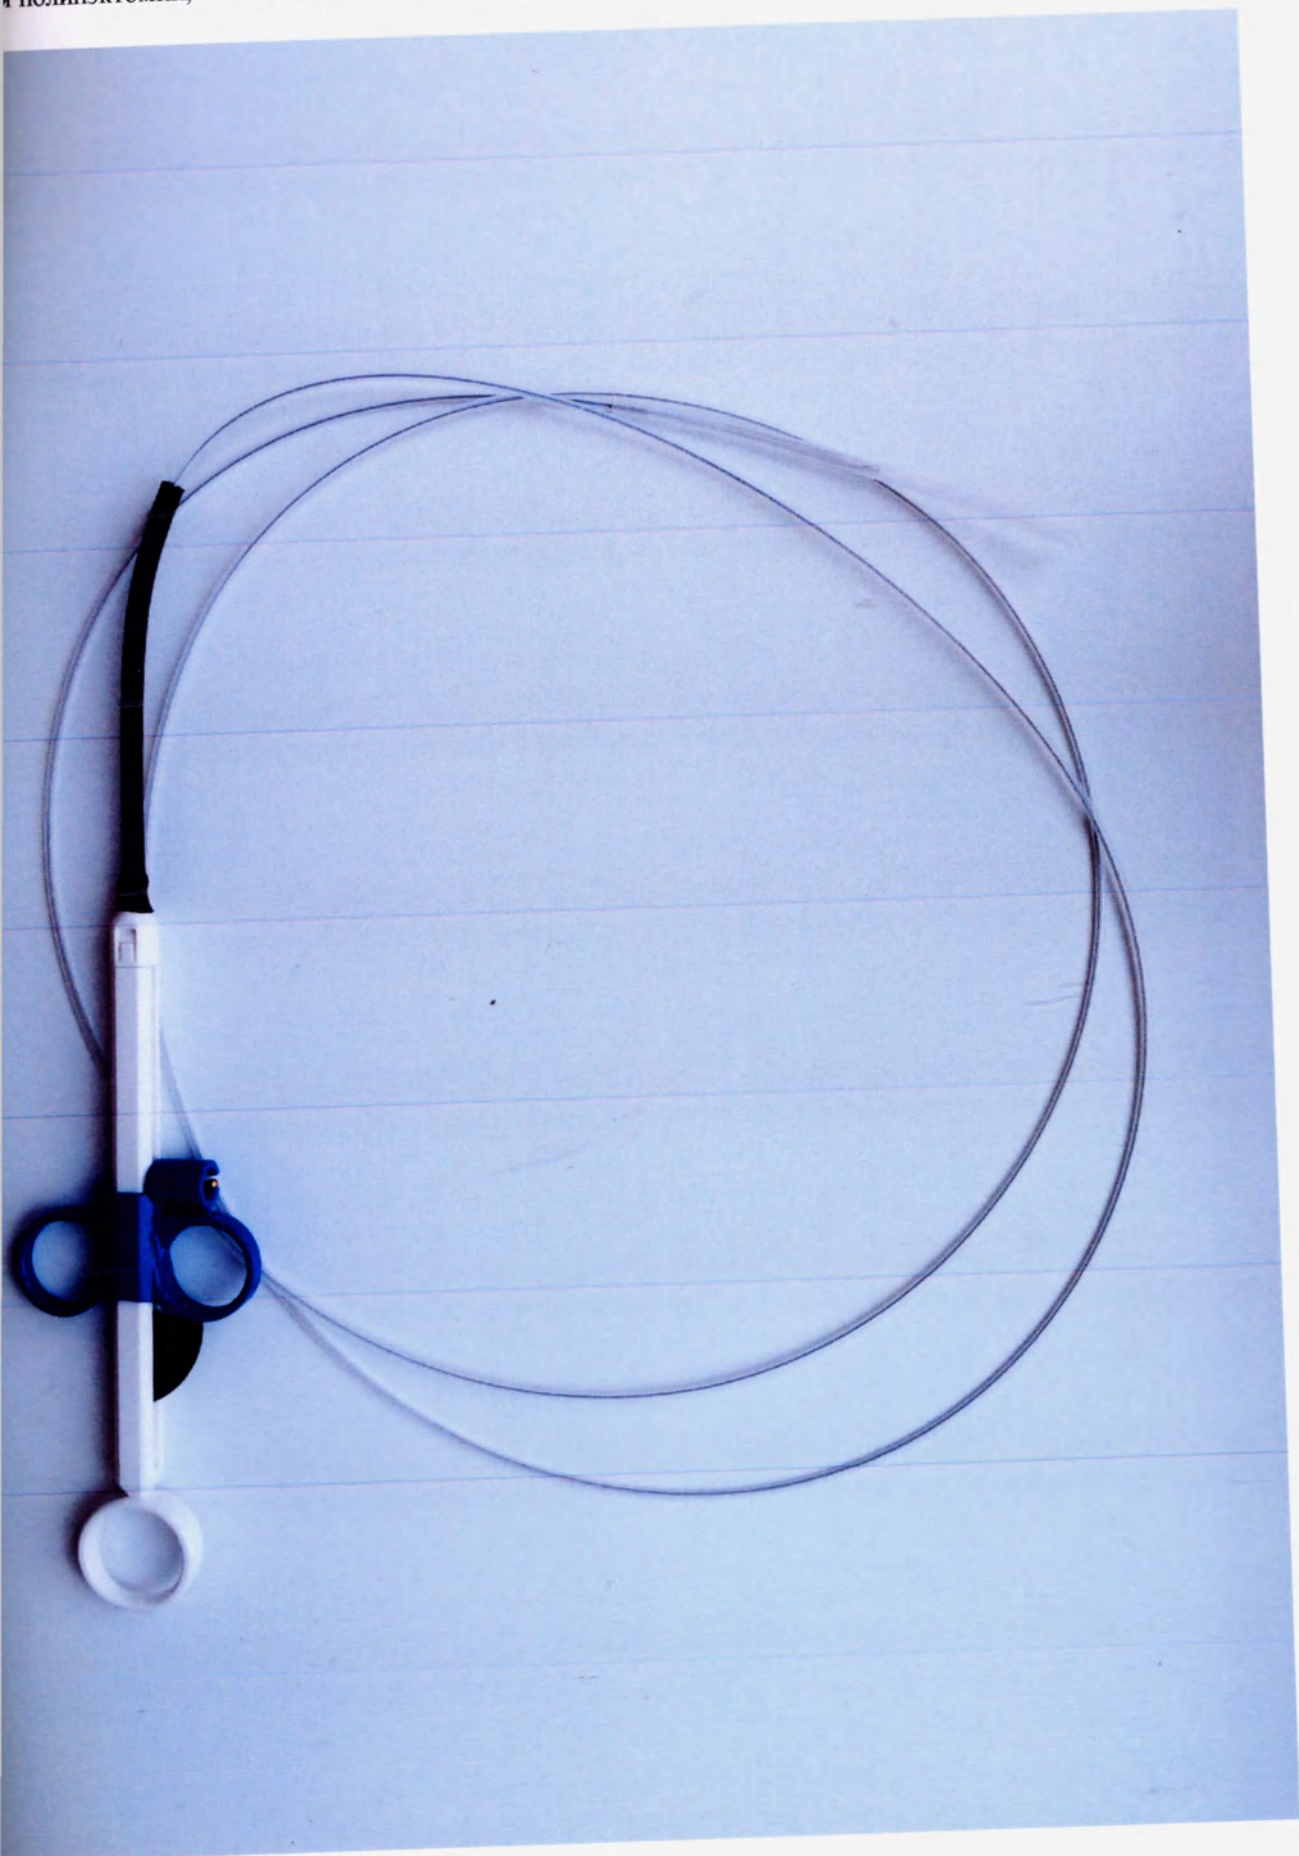

ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОЛИПЭКТОМИИ

Петля для полипэктомии, тип "овальная, полужесткая",
ширина раскрытия 35 мм, с двойными струнами,
в сборе с несъемной ручкой, с плоскими боками,
с каналом для промывания, диаметр 2,3 мм,
для канала 2,8 мм, длина 230 см
по ТУ 9433-005-89134710-2015

АПТ 94331172

ЛОТ 20150316/151


2015.03 - 2018.03

EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Стартс»
Большая Монетная 17А
Санкт-Петербург
Россия, 197101


8 (800) 553-56-57
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений
упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению!

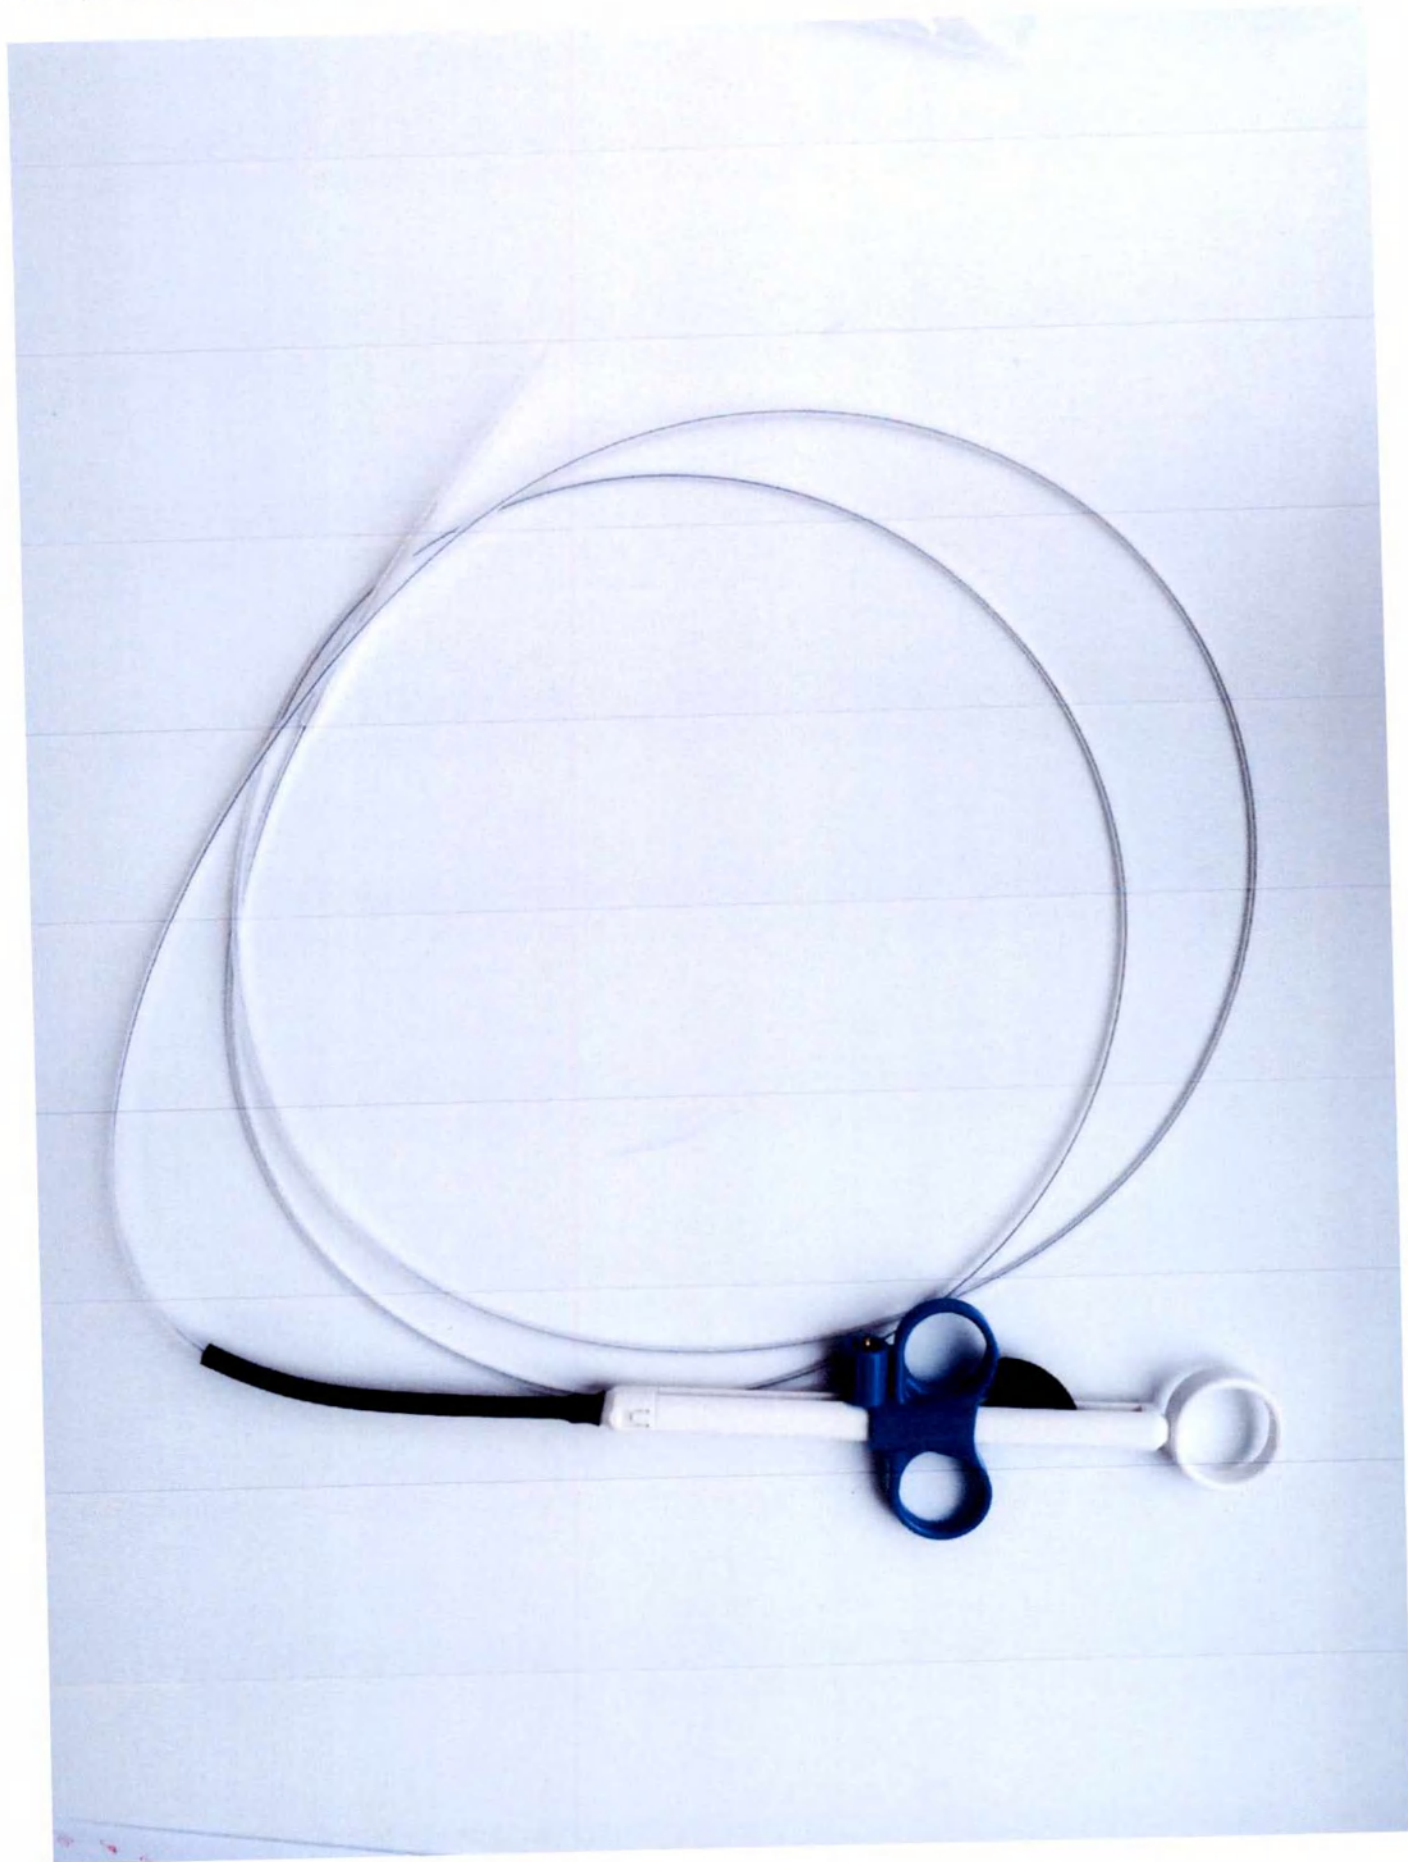

[illegible]


ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОЛИПЭКТОМИИ Петля для полипэктомии, тип "овальная", ширина раскрытия 20 мм, без ручки, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 180 см по ТУ 9433-005-89134710-2015 APT 94331032 ЛОТ 20150316/027 2015.03 - 2018.03 EndoStarts производитель: ООО «Эндо Стартс» Большая Монетная 27А Санкт-Петербург Россия, 197101 т/факс: +7 812 600 25 26 e-mail: info@endo-starts.ru www.endo-starts.ru Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!	ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОЛИПЭКТОМИИ Петля для полипэктомии, тип "овальная", ширина раскрытия 20 мм, с монофильной струной, без ручки, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 230 см по ТУ 9433-005-89134710-2015 APT 94331035 ЛОТ 20150316/030 2015.03 - 2018.03 EndoStarts производитель: ООО «Эндо Стартс» Большая Монетная 27А Санкт-Петербург Россия, 197101 т/факс: +7 812 600 25 26 e-mail: info@endo-starts.ru www.endo-starts.ru Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!	ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОЛИПЭКТОМИИ Петля для полипэктомии, тип "овальная", ширина раскрытия 20 мм, без ручки, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 230 см по ТУ 9433-005-89134710-2015 APT 94331033 ЛОТ 20150316/028 2015.03 - 2018.03 EndoStarts производитель: ООО «Эндо Стартс» Большая Монетная 27А Санкт-Петербург Россия, 197101 т/факс: +7 812 600 25 26 e-mail: info@endo-starts.ru www.endo-starts.ru Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!
ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОЛИПЭКТОМИИ Петля для полипэктомии, тип "овальная", ширина раскрытия 35 мм, с изолированным носиком, без ручки, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 180 см по ТУ 9433-005-89134710-2015 APT 94331030 ЛОТ 20150316/025 2015.03 - 2018.03 EndoStarts производитель: ООО «Эндо Стартс» Большая Монетная 27А Санкт-Петербург Россия, 197101 т/факс: +7 812 600 25 26 e-mail: info@endo-starts.ru www.endo-starts.ru Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!	ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОЛИПЭКТОМИИ Петля для полипэктомии, тип "овальная", ширина раскрытия 20 мм, с монофильной струной, без ручки, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 180 см по ТУ 9433-005-89134710-2015 APT 94331034 ЛОТ 20150316/029 2015.03 - 2018.03 EndoStarts производитель: ООО «Эндо Стартс» Большая Монетная 27А Санкт-Петербург Россия, 197101 т/факс: +7 812 600 25 26 e-mail: info@endo-starts.ru www.endo-starts.ru Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!	ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОЛИПЭКТОМИИ Петля для полипэктомии, тип "овальная", ширина раскрытия 25 мм, с изолированным носиком, без ручки, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 280 см по ТУ 9433-005-89134710-2015 APT 94331028 ЛОТ 20150316/023 2015.03 - 2018.03 EndoStarts производитель: ООО «Эндо Стартс» Большая Монетная 27А Санкт-Петербург Россия, 197101 т/факс: +7 812 600 25 26 e-mail: info@endo-starts.ru www.endo-starts.ru Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

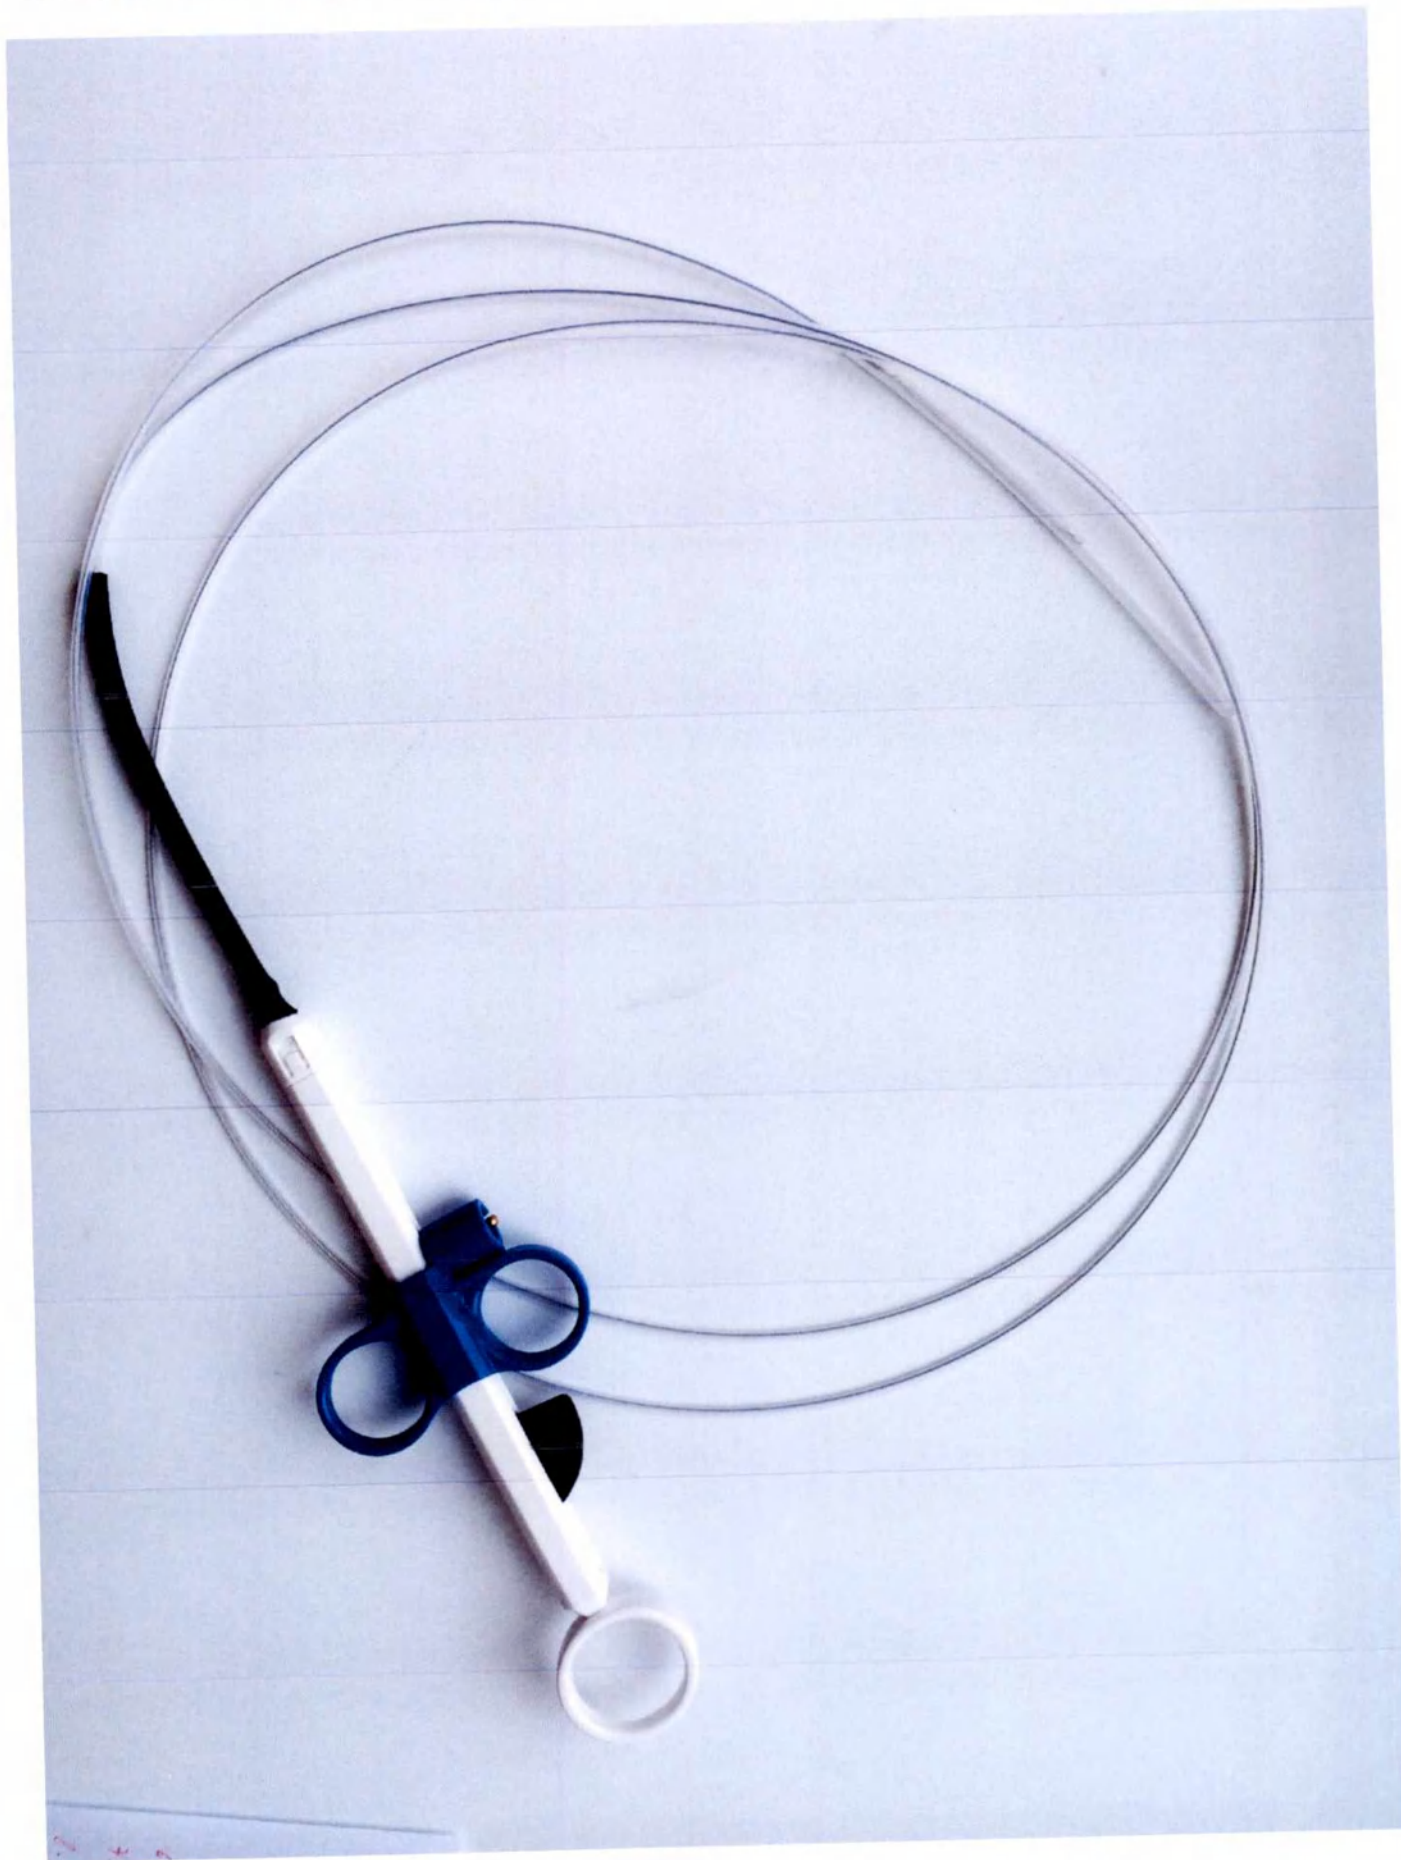


[illegible]


ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОЛИПЕКТОМИИ		ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОЛИПЕКТОМИИ		ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОЛИПЕКТОМИИ		ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОЛИПЕКТОМИИ	
Петля для полипектомии, тип "асимметричная", ширина раскрытия 15 мм, без ручки, износостойкая, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 230 см по TV 9433-005-89134710-2015		Петля для полипектомии, тип "асимметричная", ширина раскрытия 60 мм, с изолированными носиками, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 230 см по TV 9433-005-89134710-2015		Петля для полипектомии, тип "асимметричная", ширина раскрытия 25 мм, в сборе с несъемной ручкой, с каналообразователем, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 230 см по TV 9433-005-89134710-2015		Петля для полипектомии, тип "асимметричная", ширина раскрытия 15 мм, без ручки, износостойкая, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 230 см по TV 9433-005-89134710-2015	
АПТ	94331093	АПТ	94331085	АПТ	94331095	АПТ	94331092
ЛОТ	20150316/072	ЛОТ	20150316/064	ЛОТ	20150316/074	ЛОТ	20150316/071
№	2015.03.-2018.03.	№	2015.03.-2018.03.	№	2015.03.-2018.03.	№	2015.03.-2018.03.
EndurTact ООО "Спец.Служба" Брянская область, г. Брянск ул. Мухоморова, д. 17А Смарт-Петербург РФ, 241033 8 800 153 54 42 8 800 153 54 43 8 800 153 54 44 8 800 153 54 45 8 800 153 54 46 8 800 153 54 47 8 800 153 54 48 8 800 153 54 49 8 800 153 54 50 8 800 153 54 51 8 800 153 54 52 8 800 153 54 53 8 800 153 54 54 8 800 153 54 55 8 800 153 54 56 8 800 153 54 57 8 800 153 54 58 8 800 153 54 59 8 800 153 54 60 8 800 153 54 61 8 800 153 54 62 8 800 153 54 63 8 800 153 54 64 8 800 153 54 65 8 800 153 54 66 8 800 153 54 67 8 800 153 54 68 8 800 153 54 69 8 800 153 54 70 8 800 153 54 71 8 800 153 54 72 8 800 153 54 73 8 800 153 54 74 8 800 153 54 75 8 800 153 54 76 8 800 153 54 77 8 800 153 54 78 8 800 153 54 79 8 800 153 54 80 8 800 153 54 81 8 800 153 54 82 8 800 153 54 83 8 800 153 54 84 8 800 153 54 85 8 800 153 54 86 8 800 153 54 87 8 800 153 54 88 8 800 153 54 89 8 800 153 54 90 8 800 153 54 91 8 800 153 54 92 8 800 153 54 93 8 800 153 54 94 8 800 153 54 95 8 800 153 54 96 8 800 153 54 97 8 800 153 54 98 8 800 153 54 99 8 800 153 54 00		EndurTact ООО "Спец.Служба" Брянская область, г. Брянск ул. Мухоморова, д. 17А Смарт-Петербург РФ, 241033 8 800 153 54 42 8 800 153 54 43 8 800 153 54 44 8 800 153 54 45 8 800 153 54 46 8 800 153 54 47 8 800 153 54 48 8 800 153 54 49 8 800 153 54 50 8 800 153 54 51 8 800 153 54 52 8 800 153 54 53 8 800 153 54 54 8 800 153 54 55 8 800 153 54 56 8 800 153 54 57 8 800 153 54 58 8 800 153 54 59 8 800 153 54 60 8 800 153 54 61 8 800 153 54 62 8 800 153 54 63 8 800 153 54 64 8 800 153 54 65 8 800 153 54 66 8 800 153 54 67 8 800 153 54 68 8 800 153 54 69 8 800 153 54 70 8 800 153 54 71 8 800 153 54 72 8 800 153 54 73 8 800 153 54 74 8 800 153 54 75 8 800 153 54 76 8 800 153 54 77 8 800 153 54 78 8 800 153 54 79 8 800 153 54 80 8 800 153 54 81 8 800 153 54 82 8 800 153 54 83 8 800 153 54 84 8 800 153 54 85 8 800 153 54 86 8 800 153 54 87 8 800 153 54 88 8 800 153 54 89 8 800 153 54 90 8 800 153 54 91 8 800 153 54 92 8 800 153 54 93 8 800 153 54 94 8 800 153 54 95 8 800 153 54 96 8 800 153 54 97 8 800 153 54 98 8 800 153 54 99 8 800 153 54 00		EndurTact ООО "Спец.Служба" Брянская область, г. Брянск ул. Мухоморова, д. 17А Смарт-Петербург РФ, 241033 8 800 153 54 42 8 800 153 54 43 8 800 153 54 44 8 800 153 54 45 8 800 153 54 46 8 800 153 54 47 8 800 153 54 48 8 800 153 54 49 8 800 153 54 50 8 800 153 54 51 8 800 153 54 52 8 800 153 54 53 8 800 153 54 54 8 800 153 54 55 8 800 153 54 56 8 800 153 54 57 8 800 153 54 58 8 800 153 54 59 8 800 153 54 60 8 800 153 54 61 8 800 153 54 62 8 800 153 54 63 8 800 153 54 64 8 800 153 54 65 8 800 153 54 66 8 800 153 54 67 8 800 153 54 68 8 800 153 54 69 8 800 153 54 70 8 800 153 54 71 8 800 153 54 72 8 800 153 54 73 8 800 153 54 74 8 800 153 54 75 8 800 153 54 76 8 800 153 54 77 8 800 153 54 78 8 800 153 54 79 8 800 153 54 80 8 800 153 54 81 8 800 153 54 82 8 800 153 54 83 8 800 153 54 84 8 800 153 54 85 8 800 153 54 86 8 800 153 54 87 8 800 153 54 88 8 800 153 54 89 8 800 153 54 90 8 800 153 54 91 8 800 153 54 92 8 800 153 54 93 8 800 153 54 94 8 800 153 54 95 8 800 153 54 96 8 800 153 54 97 8 800 153 54 98 8 800 153 54 99 8 800 153 54 00		EndurTact ООО "Спец.Служба" Брянская область, г. Брянск ул. Мухоморова, д. 17А Смарт-Петербург РФ, 241033 8 800 153 54 42 8 800 153 54 43 8 800 153 54 44 8 800 153 54 45 8 800 153 54 46 8 800 153 54 47 8 800 153 54 48 8 800 153 54 49 8 800 153 54 50 8 800 153 54 51 8 800 153 54 52 8 800 153 54 53 8 800 153 54 54 8 800 153 54 55 8 800 153 54 56 8 800 153 54 57 8 800 153 54 58 8 800 153 54 59 8 800 153 54 60 8 800 153 54 61 8 800 153 54 62 8 800 153 54 63 8 800 153 54 64 8 800 153 54 65 8 800 153 54 66 8 800 153 54 67 8 800 153 54 68 8 800 153 54 69 8 800 153 54 70 8 800 153 54 71 8 800 153 54 72 8 800 153 54 73 8 800 153 54 74 8 800 153 54 75 8 800 153 54 76 8 800 153 54 77 8 800 153 54 78 8 800 153 54 79 8 800 153 54 80 8 800 153 54 81 8 800 153 54 82 8 800 153 54 83 8 800 153 54 84 8 800 153 54 85 8 800 153 54 86 8 800 153 54 87 8 800 153 54 88 8 800 153 54 89 8 800 153 54 90 8 800 153 54 91 8 800 153 54 92 8 800 153 54 93 8 800 153 54 94 8 800 153 54 95 8 800 153 54 96 8 800 153 54 97 8 800 153 54 98 8 800 153 54 99 8 800 153 54 00	
Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению.		Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению.		Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению.		Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению.	

ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОЛИПЕКТОМИИ	ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОЛИПЕКТОМИИ	ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОЛИПЕКТОМИИ	ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОЛИПЕКТОМИИ
Петля для полипектомии, тип "экземплярная", ширина раскрытия 60 мм, с изолированным носиком, в комплекте с ручкой, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 180 см по ТУ 9433-005-89134710-2015	Петля для полипектомии, тип "экземплярная", ширина раскрытия 40 мм, с изолированным носиком, в комплекте с ручкой, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 230 см по ТУ 9433-005-89134710-2015	Петля для полипектомии, тип "экземплярная", ширина раскрытия 40 мм, в комплекте с ручкой, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 230 см по ТУ 9433-005-89134710-2015	Петля для полипектомии, тип "экземплярная", ширина раскрытия 40 мм, в комплекте с ручкой, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 180 см по ТУ 9433-005-89134710-2015
АПТ 94331189 ПОТ 20150316/168	АПТ 94331186 ПОТ 20150316/165	АПТ 94331188 ПОТ 20150316/167	АПТ 94331187 ПОТ 20150316/166
2015.03.-2018.03.  	2015.03.-2018.03.  	2015.03.-2018.03.  	2015.03.-2018.03.  
EndyTact ООО "Энд-Такт" г. Москва, ул. Мухоморова, д. 23А Смарт-Петербург РФ, 127213 8 (800) 151 54 17 www.endytact.ru	EndyTact ООО "Энд-Такт" г. Москва, ул. Мухоморова, д. 23А Смарт-Петербург РФ, 127213 8 (800) 151 54 17 www.endytact.ru	EndyTact ООО "Энд-Такт" г. Москва, ул. Мухоморова, д. 23А Смарт-Петербург РФ, 127213 8 (800) 151 54 17 www.endytact.ru	EndyTact ООО "Энд-Такт" г. Москва, ул. Мухоморова, д. 23А Смарт-Петербург РФ, 127213 8 (800) 151 54 17 www.endytact.ru
Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!	Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!	Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!	Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!
ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОЛИПЕКТОМИИ	ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОЛИПЕКТОМИИ	ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОЛИПЕКТОМИИ	ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОЛИПЕКТОМИИ
Петля для полипектомии, тип "экземплярная", ширина раскрытия 40 мм, с изолированным носиком, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 180 см по ТУ 9433-005-89134710-2015	Петля для полипектомии, тип "экземплярная", ширина раскрытия 15 мм, без ручки, с изолированным носиком, вращающийся, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 230 см по ТУ 9433-005-89134710-2015	Петля для полипектомии, тип "экземплярная", ширина раскрытия 60 мм, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 180 см по ТУ 9433-005-89134710-2015	Петля для полипектомии, тип "экземплярная", ширина раскрытия 55 мм, без ручки, с изолированным носиком, вращающийся, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 180 см по ТУ 9433-005-89134710-2015
АПТ 94331080 ПОТ 20150316/059	АПТ 94331089 ПОТ 20150316/066	АПТ 94331086 ПОТ 20150316/065	АПТ 94331090 ПОТ 20150316/069
2015.03.-2018.03.  	2015.03.-2018.03.  	2015.03.-2018.03.  	2015.03.-2018.03.  
EndyTact ООО "Энд-Такт" г. Москва, ул. Мухоморова, д. 23А Смарт-Петербург РФ, 127213 8 (800) 151 54 17 www.endytact.ru	EndyTact ООО "Энд-Такт" г. Москва, ул. Мухоморова, д. 23А Смарт-Петербург РФ, 127213 8 (800) 151 54 17 www.endytact.ru	EndyTact ООО "Энд-Такт" г. Москва, ул. Мухоморова, д. 23А Смарт-Петербург РФ, 127213 8 (800) 151 54 17 www.endytact.ru	EndyTact ООО "Энд-Такт" г. Москва, ул. Мухоморова, д. 23А Смарт-Петербург РФ, 127213 8 (800) 151 54 17 www.endytact.ru
Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!	Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!	Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!	

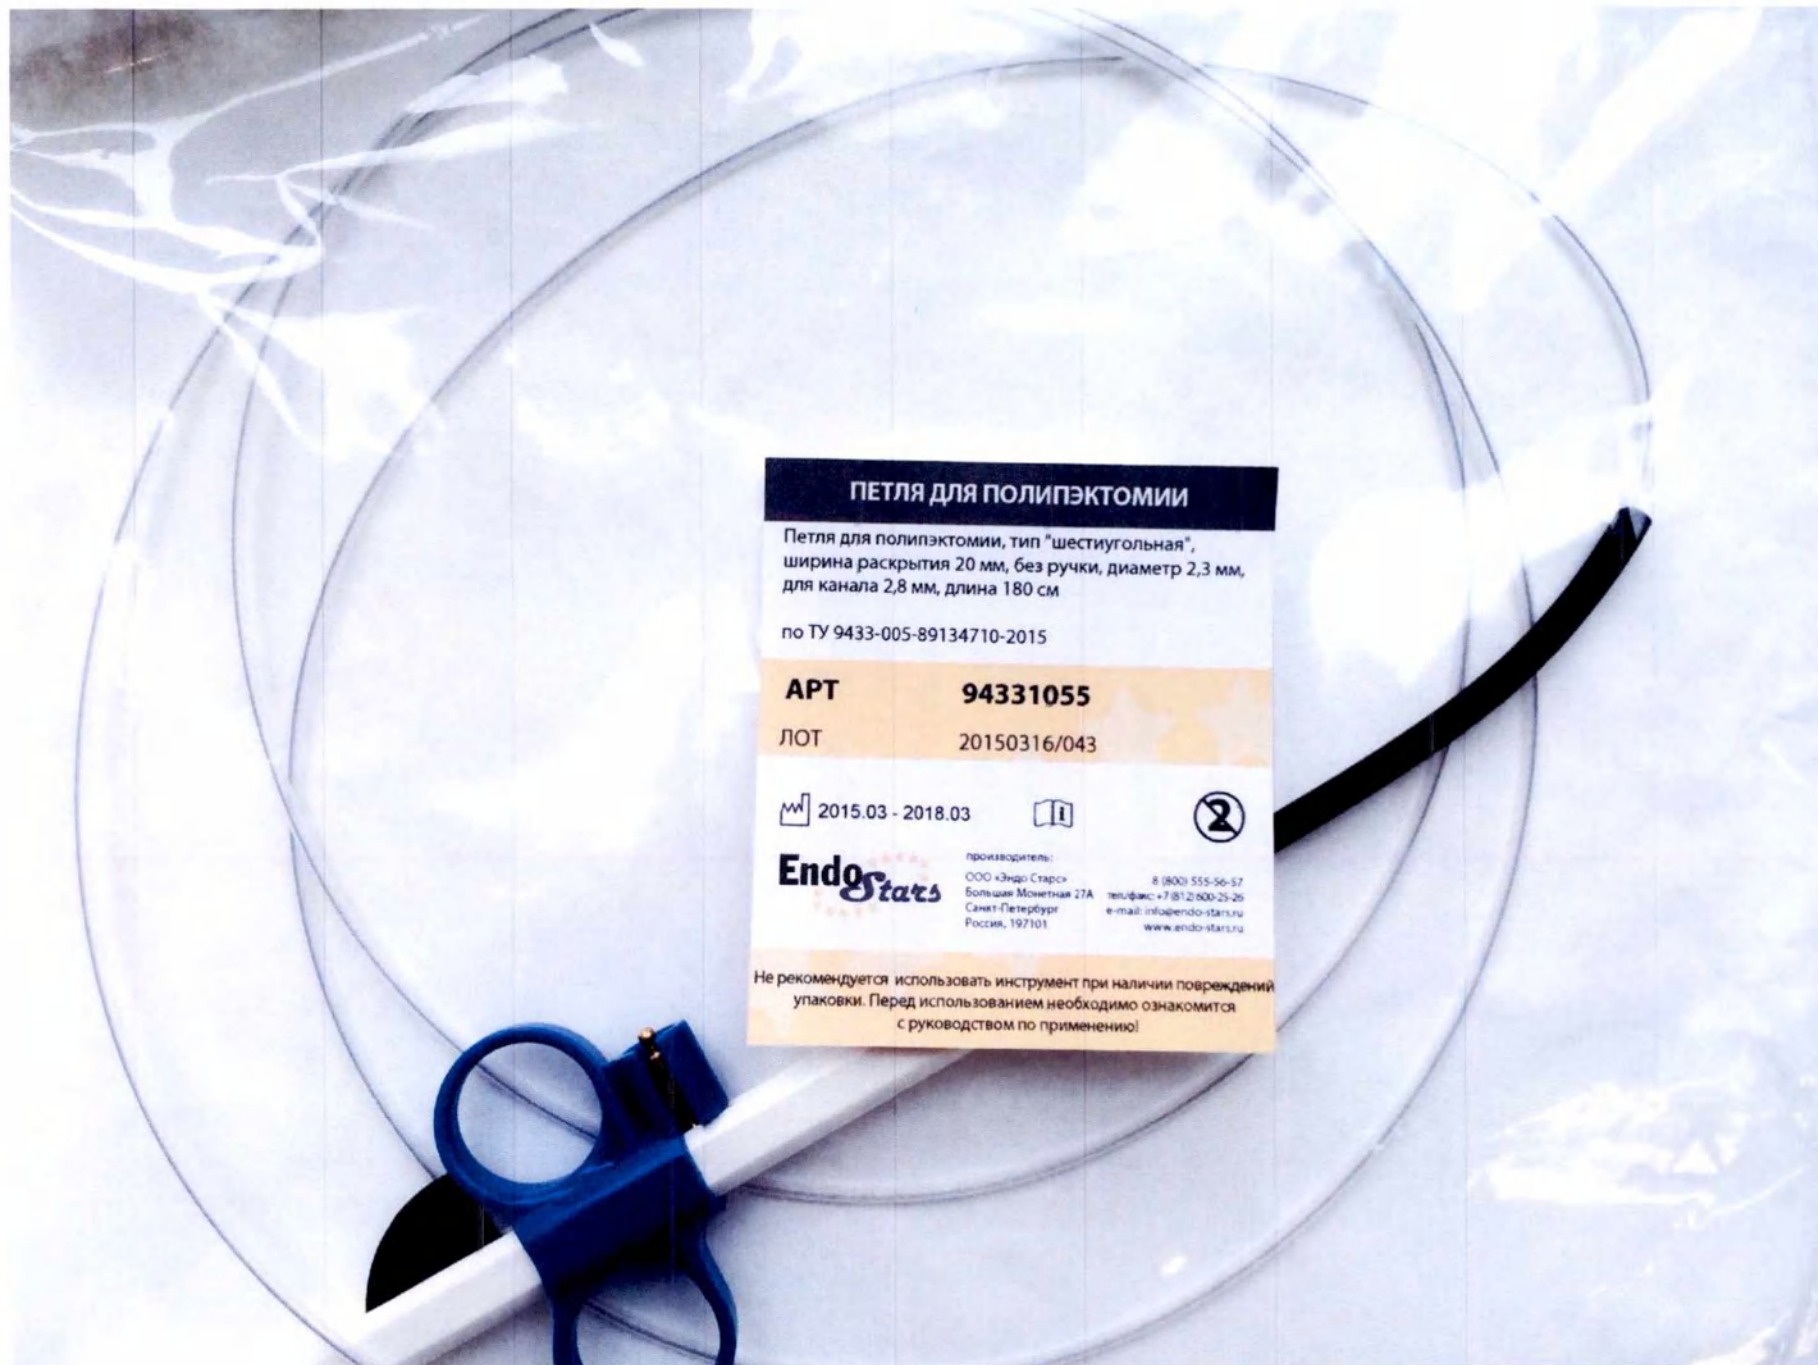

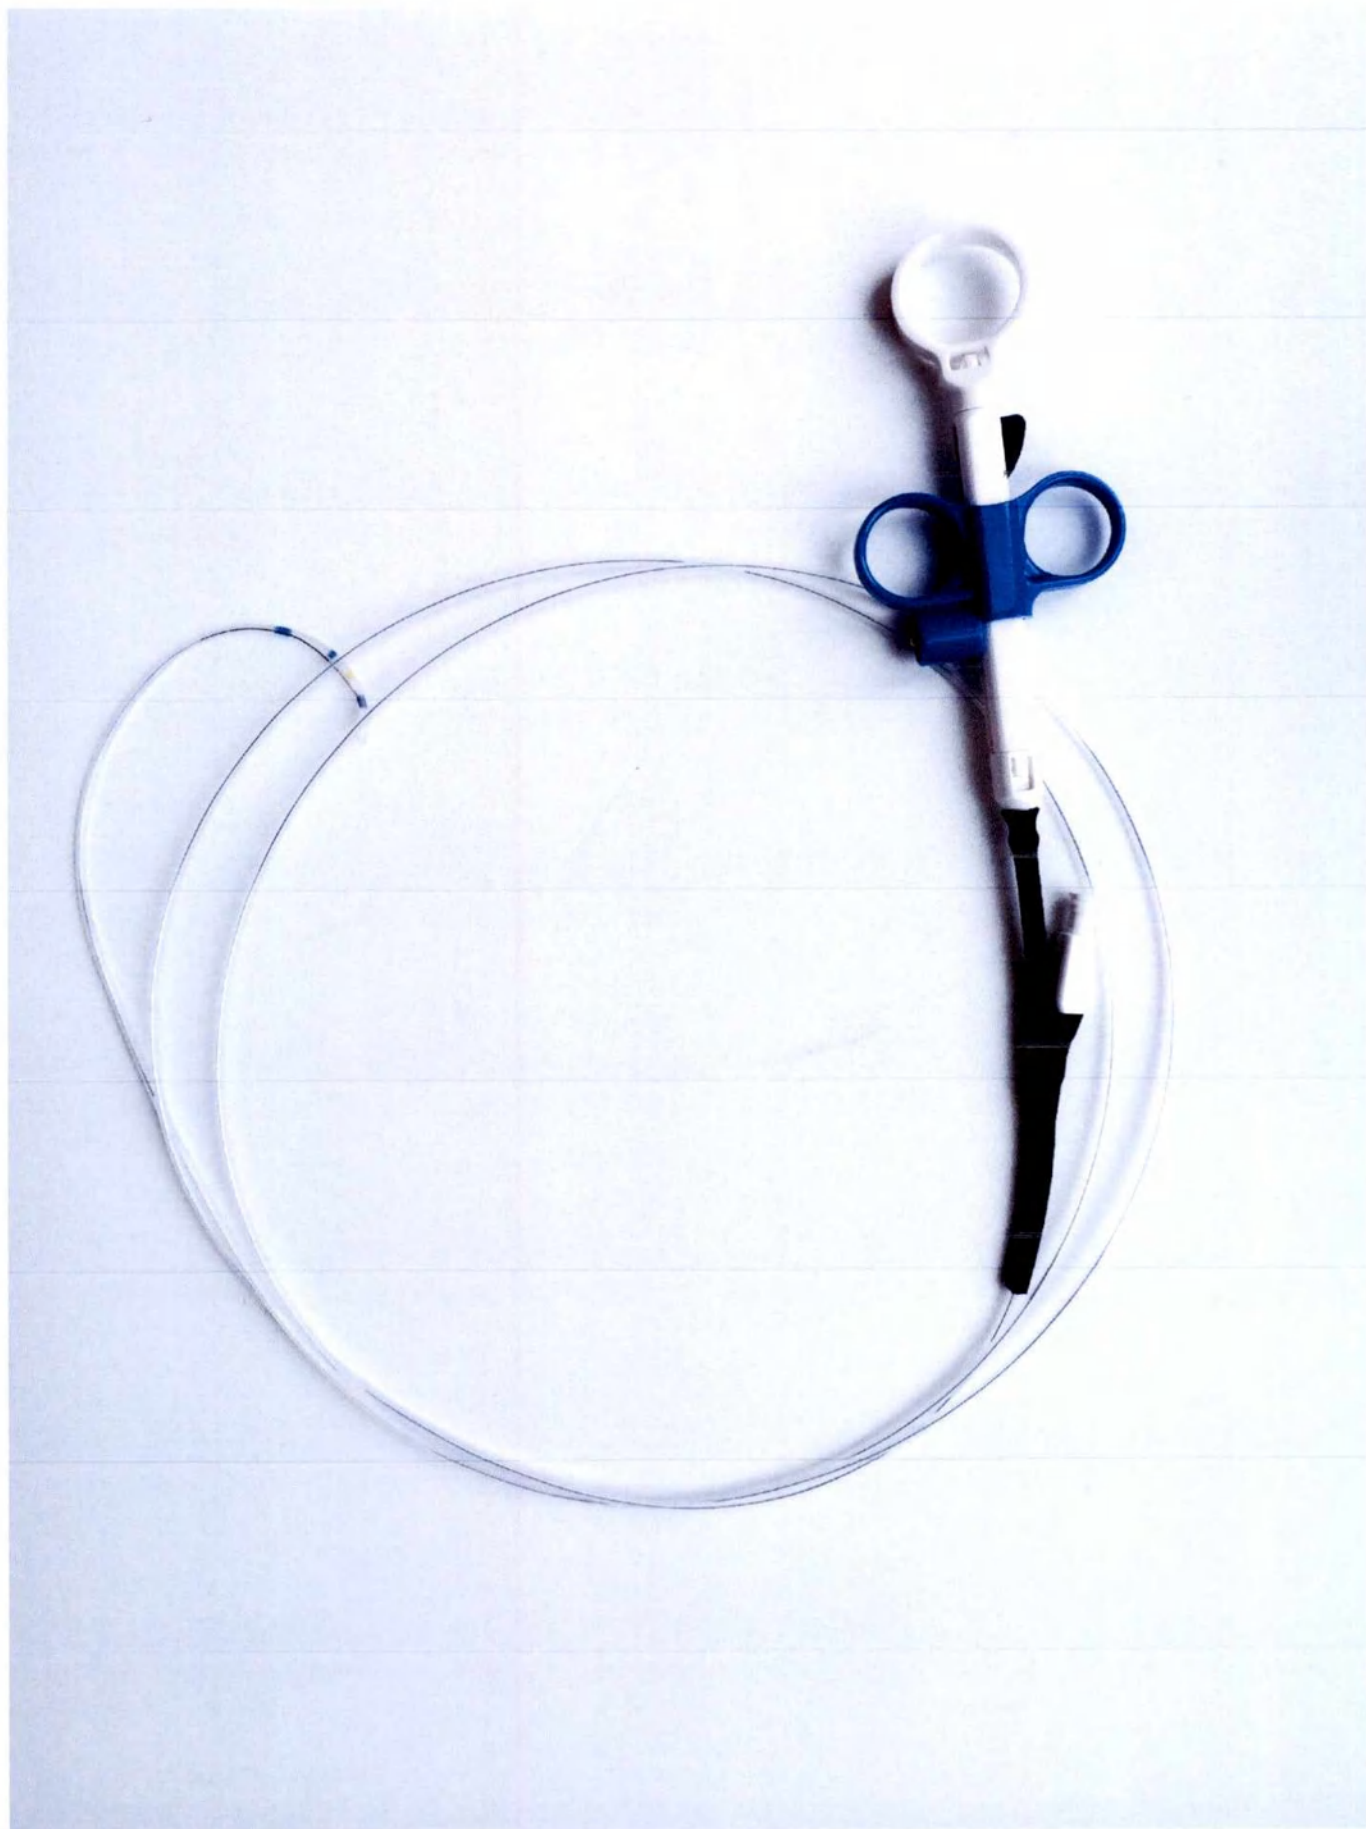

СФИНКТЕРОТ	
Сфинктеротом, тип "многофункциональный - ВII", с каналом для проводника, односторонний, с каналом для прошивания и податки ретинеконтактного в.в. Длина не изолированной части струны 20 мм, в сборе с несъемной ручкой, диаметр 2,2 мм, для канала 2,8 мм, длина 210 мм, по ТУ 9433-005-89134/10-2015	
АРТ	94332039
ЛОТ	20150315/039
2015.03 - 2018.03	2015.03 - 2018.03
Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению.	

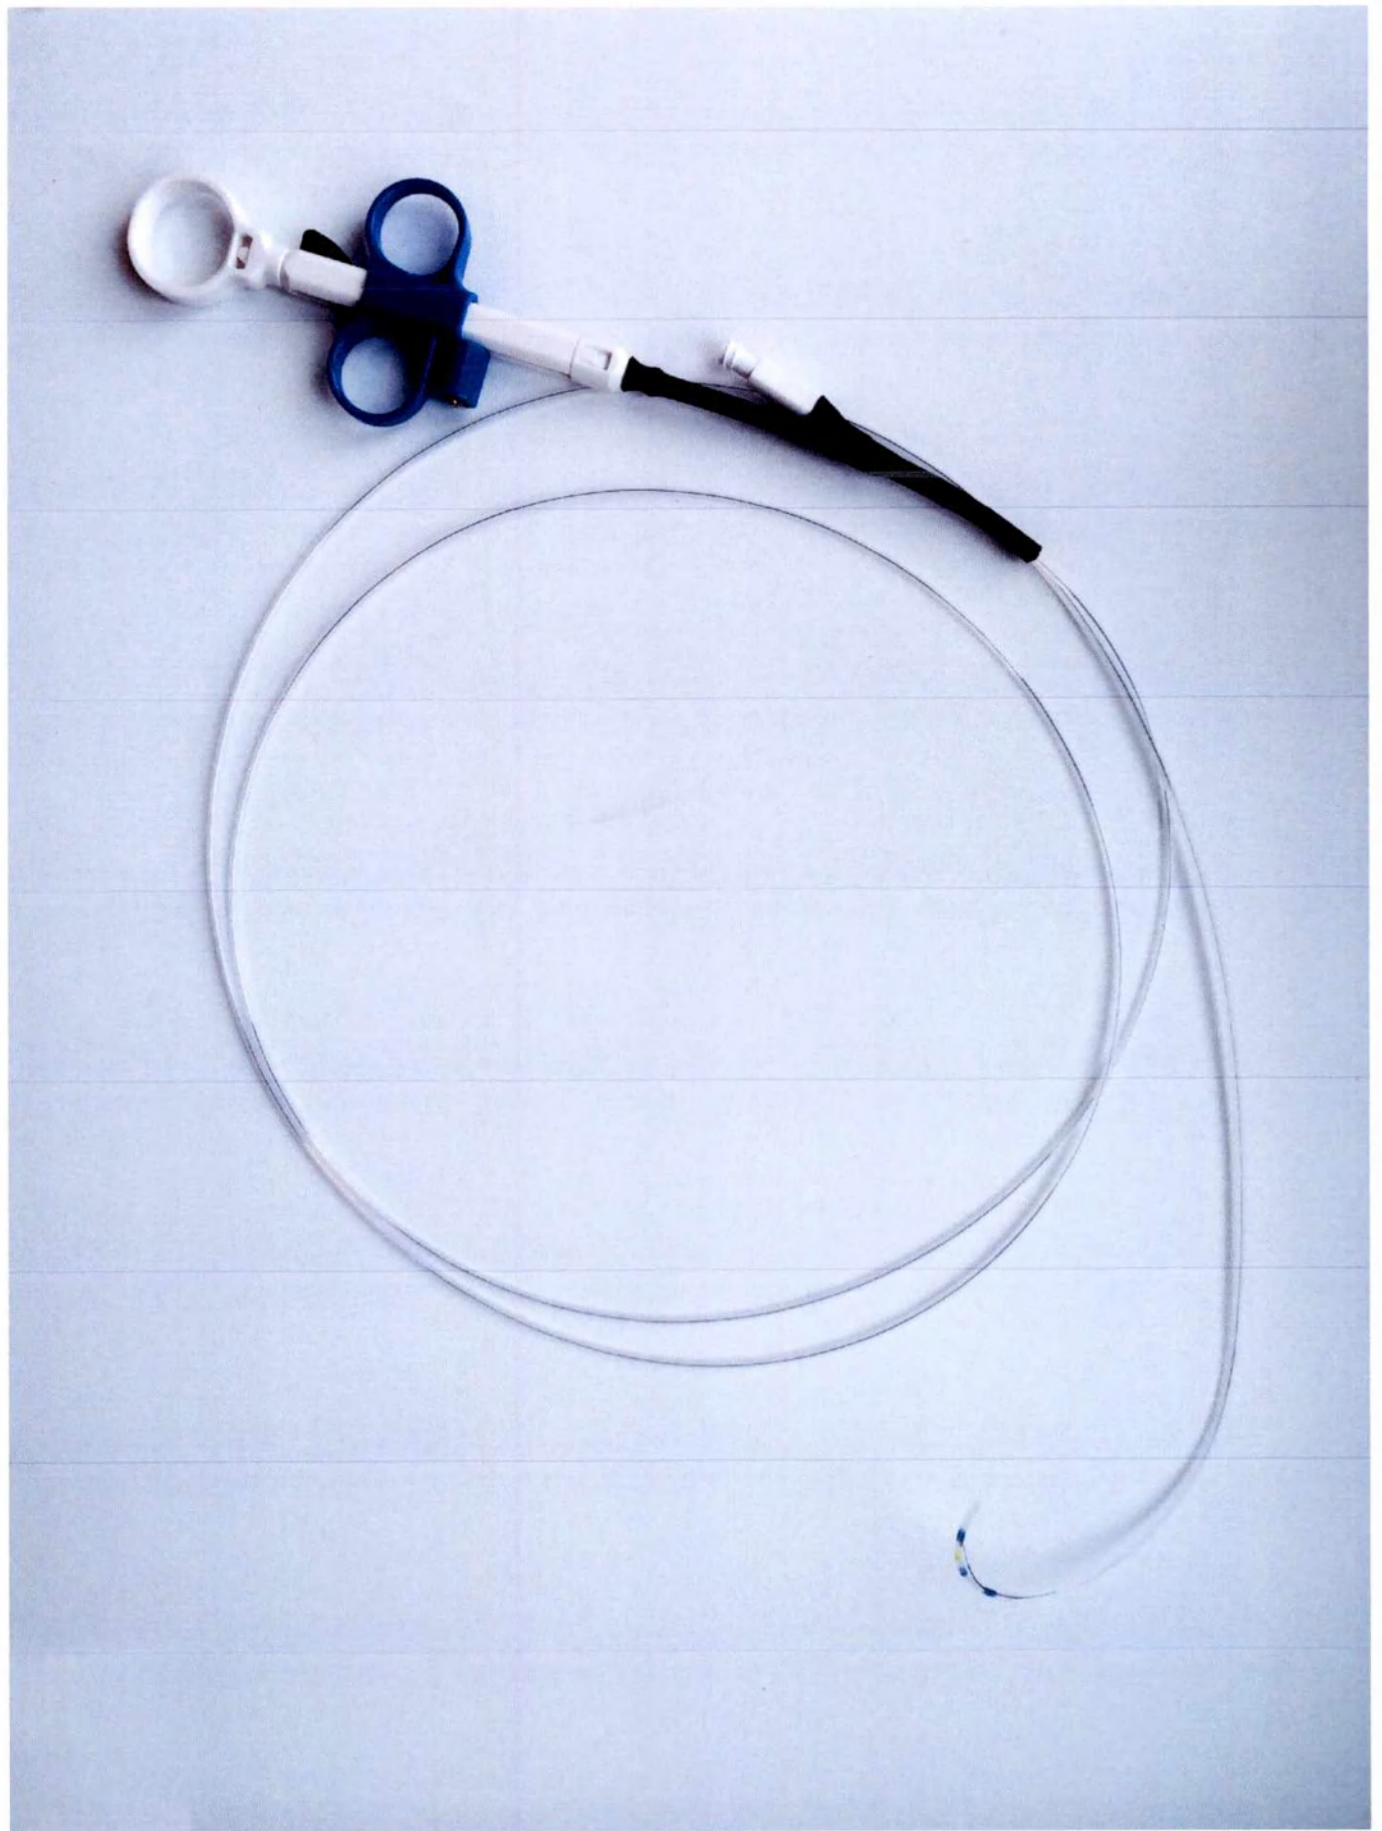

[illegible]

СФИНКТЕРОТОМ

Сфинктеротом, с каналом для проводника, без носика, дист. часть катетера цилиндрической формы, двухпросветный, с каналом для промывания и подачи рентгеноконтрастного в-ва, длина струны 30 мм, в сборе с несъемной ручкой, Ø катетера 2,2 мм, Ø дист. конца 1,8 мм, для канала 2,8 мм, длина 210 см, по ТУ 9433-005-89134710-2015

АРТ	94332045
ЛОТ	20150315/045


2015.03 - 2018.03

EndoStarts


производитель:
ООО «Эндо-Старс»
Болшадь Мометная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101

8 (800) 555-56-57
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru


Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

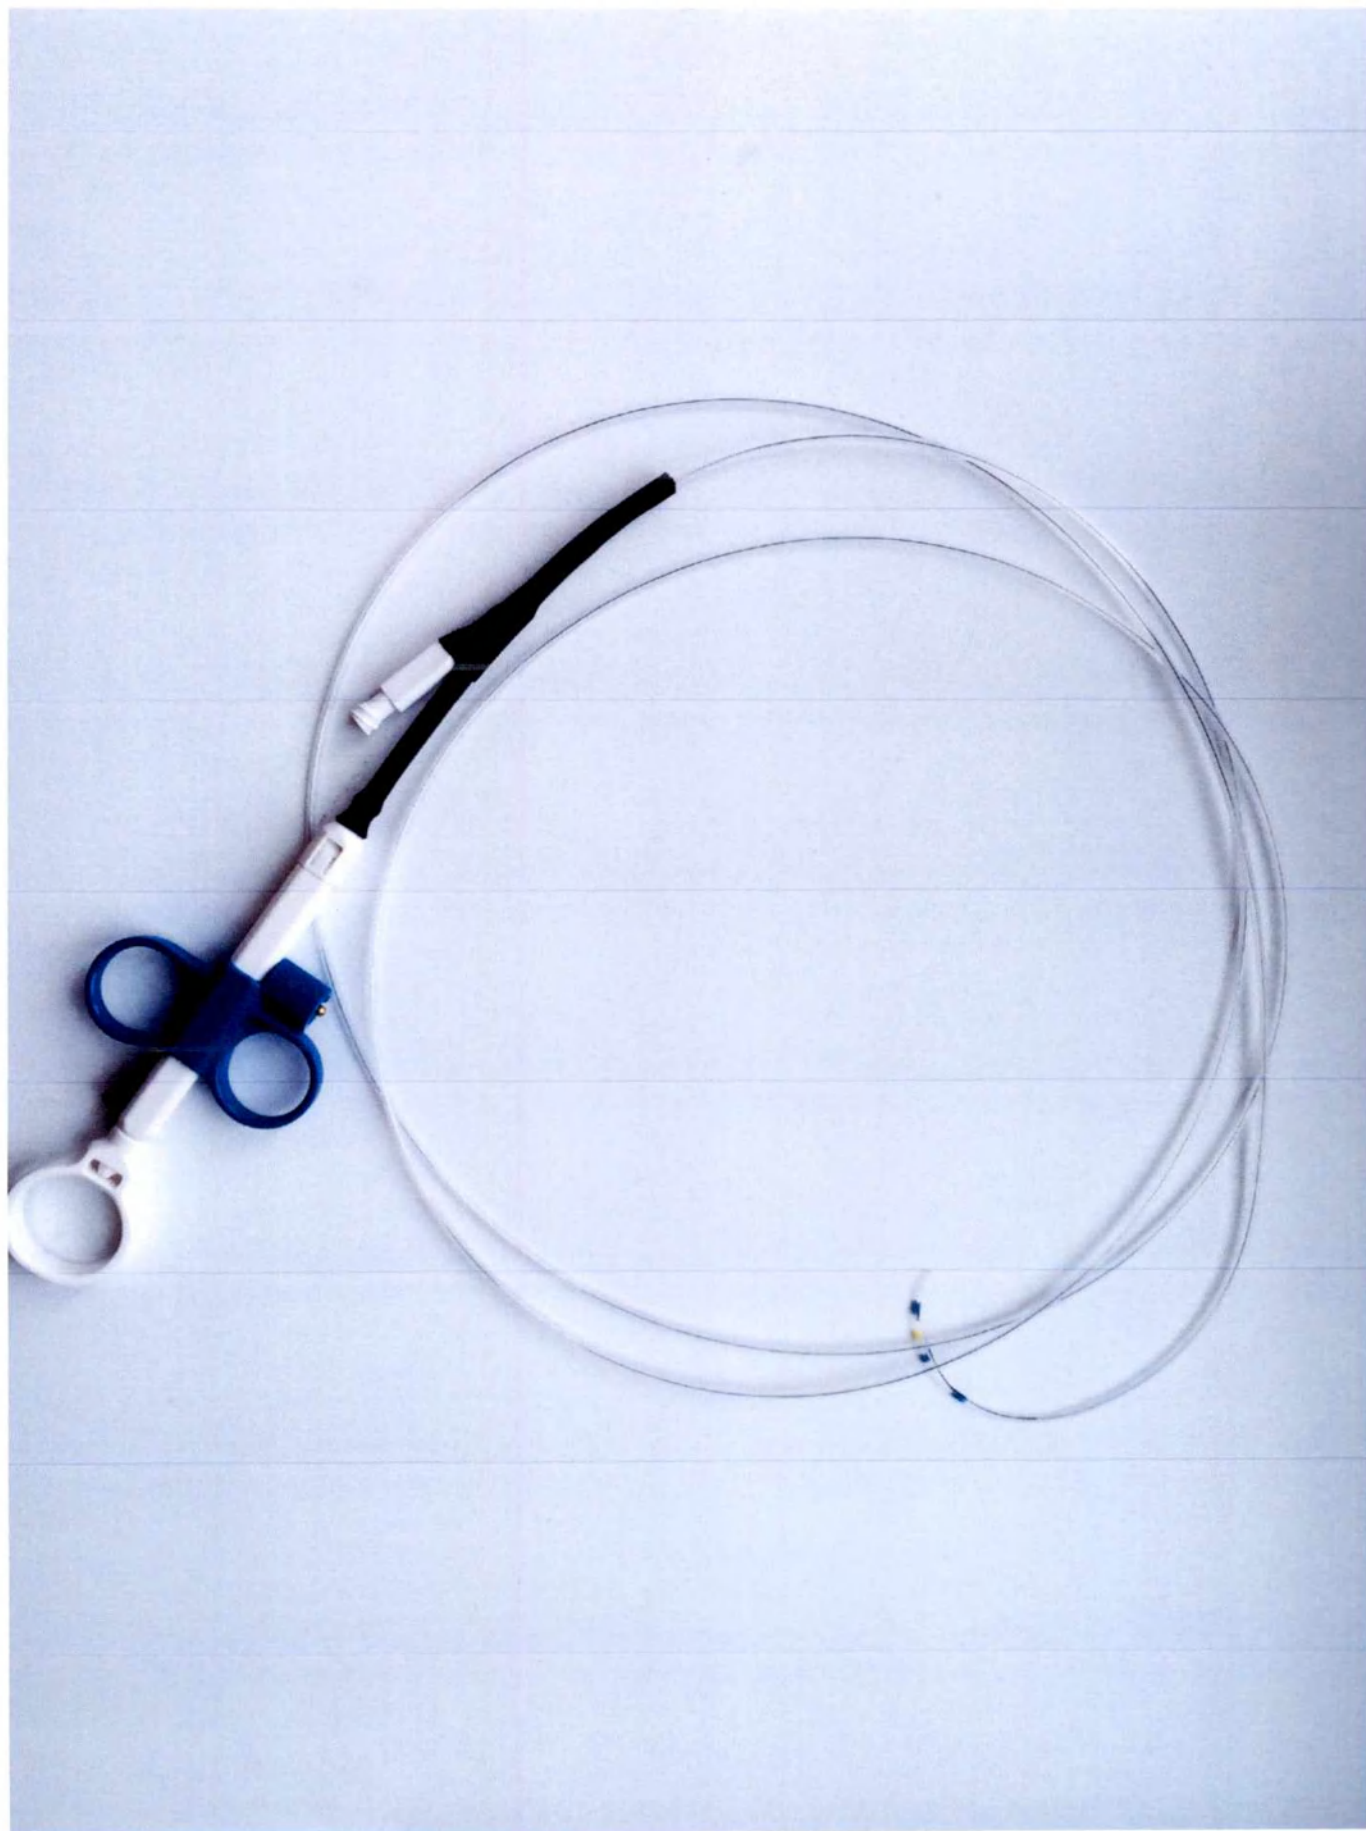


СФИНКТЕРОМ	СФИНКТЕРОМ	СФИНКТЕРОМ	СФИНКТЕРОМ
Папиллотом, игольчатого типа, с каналом для проводника, двухпросветный, длина иглы 6 мм, в сборе с несъемной ручкой, с каналом для промывания и подачи рентгеноконтрастного вещества, диаметр катетера 2,2 мм, диаметр дистальной части 1,8 мм, для канала 2,8 мм, длина 210 см, по ТУ 9433-005-89134710-2015	Папиллотом, игольчатого типа, длина иглы 6 мм, в сборе с несъемной ручкой, с каналом для промывания и подачи рентгеноконтрастного вещества, однопросветный, диаметр 1,8 мм, для канала 2,0 мм, длина 210 см, по ТУ 9433-005-89134710-2015	Сфинктером, тип «игольчатый», с каналом для проводника, двухпросветный, с каналом для промывания и подачи рентгеноконтрастного вещества, длина режущей части 6 мм, в сборе с несъемной ручкой, Ø катетера 2,2 мм, диаметр дистального конца 1,8 мм, для канала 2,8 мм, длина 210 см, по ТУ 9433-005-89134710-2015	Сфинктером, тип «игольчатый», с каналом для промывания и подачи рентгеноконтрастного вещества, длина режущей части 3 мм, в сборе с несъемной ручкой, Ø 1,8 мм, для канала 2,0 мм, длина 210 см, по ТУ 9433-005-89134710-2015
АПТ 94332035	АПТ 94332034	АПТ 94332068	АПТ 94332067
ЛОТ 20150315/035	ЛОТ 20150315/034	ЛОТ 20150315/068	ЛОТ 20150315/067
 2015.03 - 2018.03  	 2015.03 - 2018.03  	 2015.03 - 2018.03  	 2015.03 - 2018.03  
EndoStarts производитель: ООО «Эндо Старс» Большая Монетная 27А Санкт-Петербург Россия, 197101 Тел: (800) 555-56-57 Тел/факс: +7 (812) 900-25-26 e-mail: info@endo-starts.ru www.endo-starts.ru	EndoStarts производитель: ООО «Эндо Старс» Большая Монетная 27А Санкт-Петербург Россия, 197101 Тел: (800) 555-56-57 Тел/факс: +7 (812) 900-25-26 e-mail: info@endo-starts.ru www.endo-starts.ru	EndoStarts производитель: ООО «Эндо Старс» Большая Монетная 27А Санкт-Петербург Россия, 197101 Тел: (800) 555-56-57 Тел/факс: +7 (812) 900-25-26 e-mail: info@endo-starts.ru www.endo-starts.ru	EndoStarts производитель: ООО «Эндо Старс» Большая Монетная 27А Санкт-Петербург Россия, 197101 Тел: (800) 555-56-57 Тел/факс: +7 (812) 900-25-26 e-mail: info@endo-starts.ru www.endo-starts.ru
Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!	Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!	Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!	Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

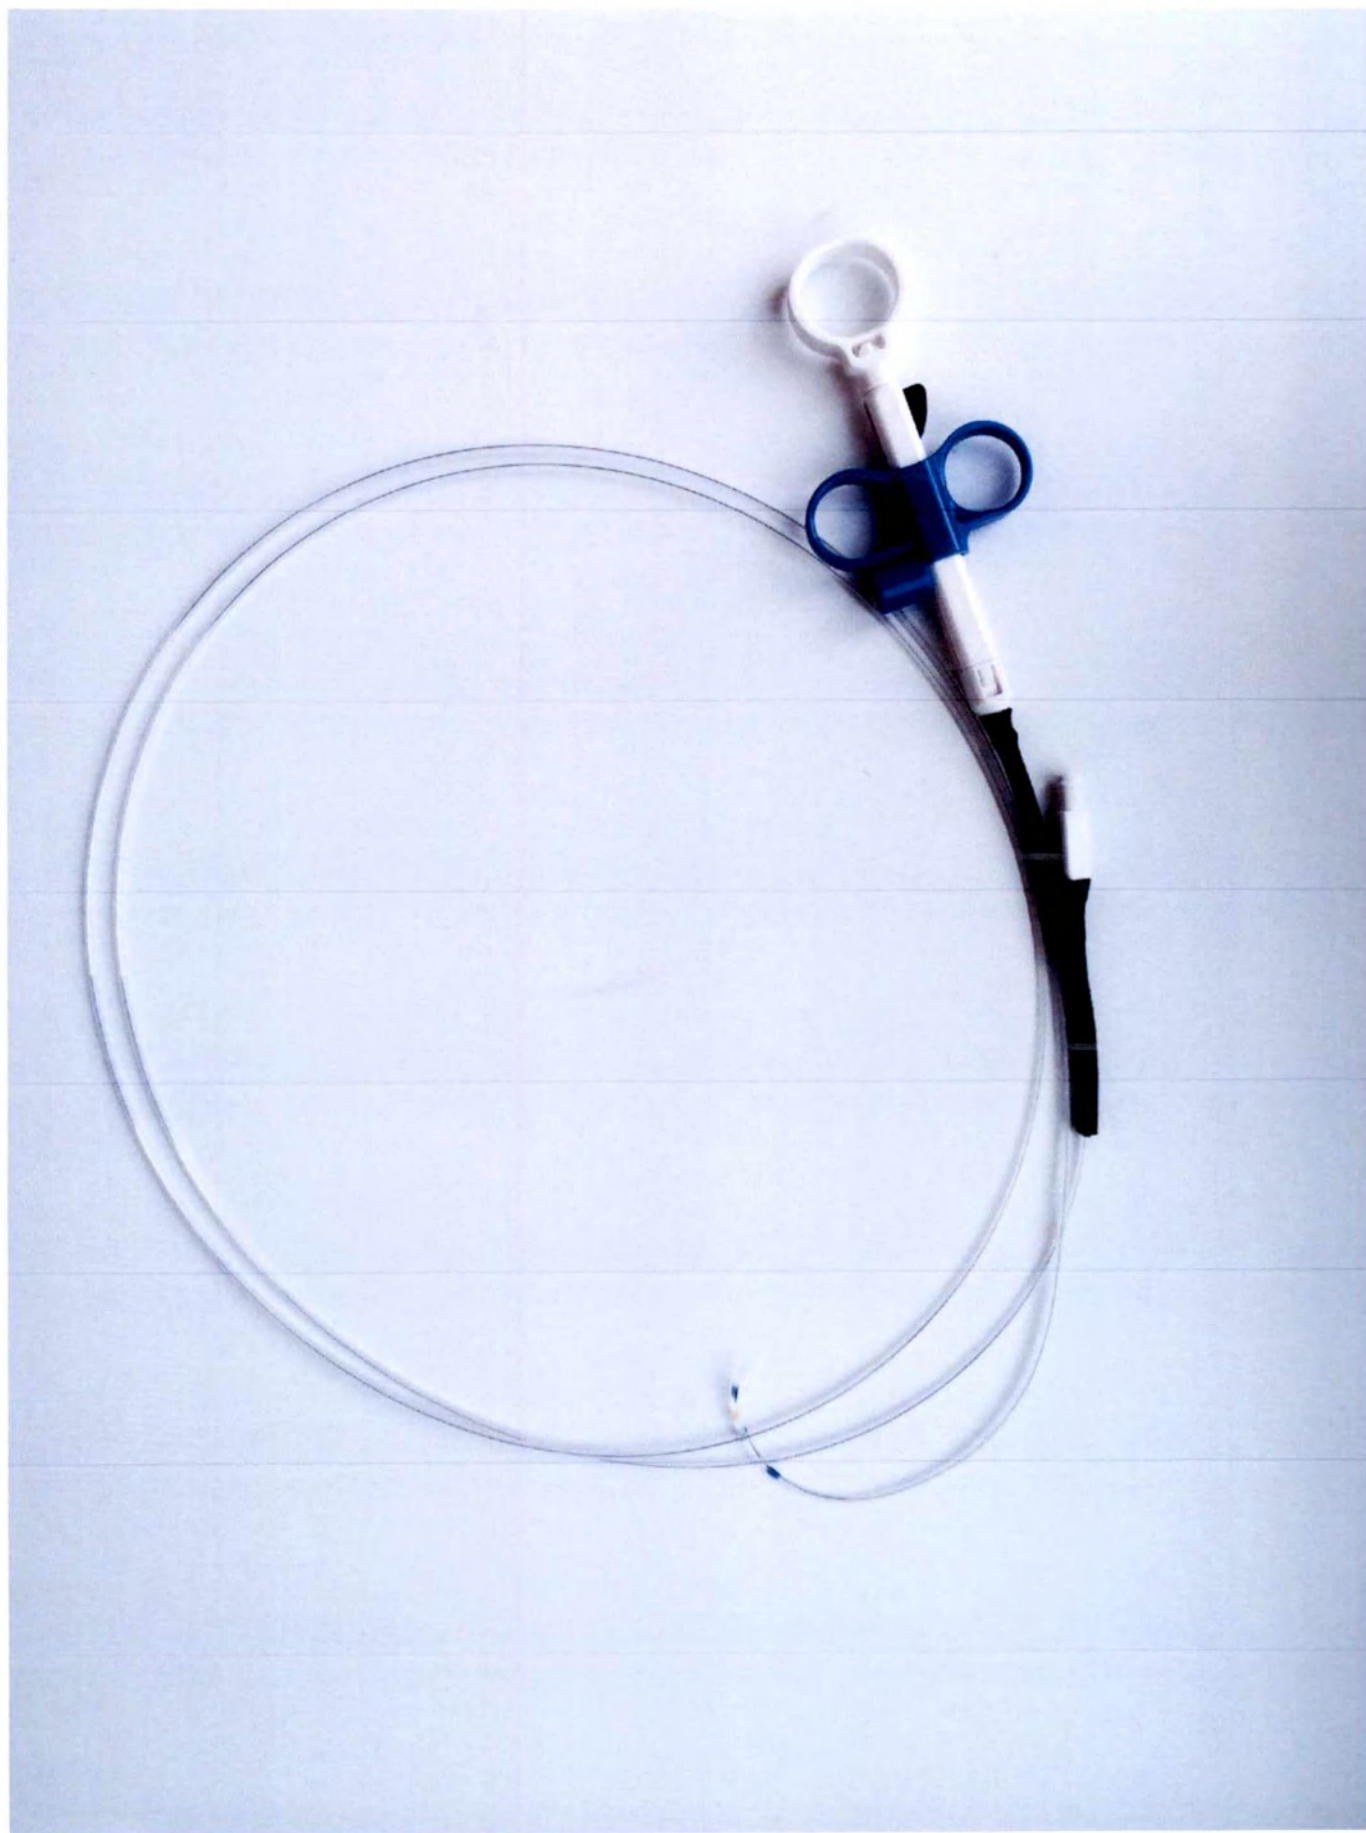

СФИНКТЕРОТОМ			
Сфинктеротом, тип "плоский нож", односторонний, с каналом для прошивания и подачи рентгеноконтрастного вещества, длина режущей части 6 мм, сбор с несъемной ручкой, диаметр 1,8 мм, для канала 2,0 мм, длина 210 см, по ТУ 9433-005-89134710-2015			
АРТ	94332036		
ЛОТ	20150315/036		
М	2015.03 - 2018.03	И	2
EndOrga ООО "ЭндОргэ" (полное наименование) Юридический адрес: 125080, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 21А, стр. 1 Контактный телефон: 8 (800) 555-56-57 Контактный e-mail: info@endorga.ru Контактный сайт: www.endorga.ru Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.			
СФИНКТЕРОТОМ			
Сфинктеротом, тип "ЕМН-нож", с изолированными разставными концами, с каналом для прошивания и подачи рентгеноконтрастного вещества, длина режущей части 6 мм, сбор с несъемной ручкой, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 210 см, по ТУ 9433-005-89134710-2015			
АРТ	94332069		
ЛОТ	20150315/069		
М	2015.03 - 2018.03	И	2
EndOrga ООО "ЭндОргэ" (полное наименование) Юридический адрес: 125080, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 21А, стр. 1 Контактный телефон: 8 (800) 555-56-57 Контактный e-mail: info@endorga.ru Контактный сайт: www.endorga.ru Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.			
СФИНКТЕРОТОМ			
Сфинктеротом, тип "плоский нож", с каналом для прошивания и подачи рентгеноконтрастного вещества, длина режущей части 3 мм, сбор с несъемной ручкой, диаметр 1,8 мм, для канала 2,0 мм, длина 210 см, по ТУ 9433-005-89134710-2015			
АРТ	94332070		
ЛОТ	20150315/070		
М	2015.03 - 2018.03	И	2
EndOrga ООО "ЭндОргэ" (полное наименование) Юридический адрес: 125080, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 21А, стр. 1 Контактный телефон: 8 (800) 555-56-57 Контактный e-mail: info@endorga.ru Контактный сайт: www.endorga.ru Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.			

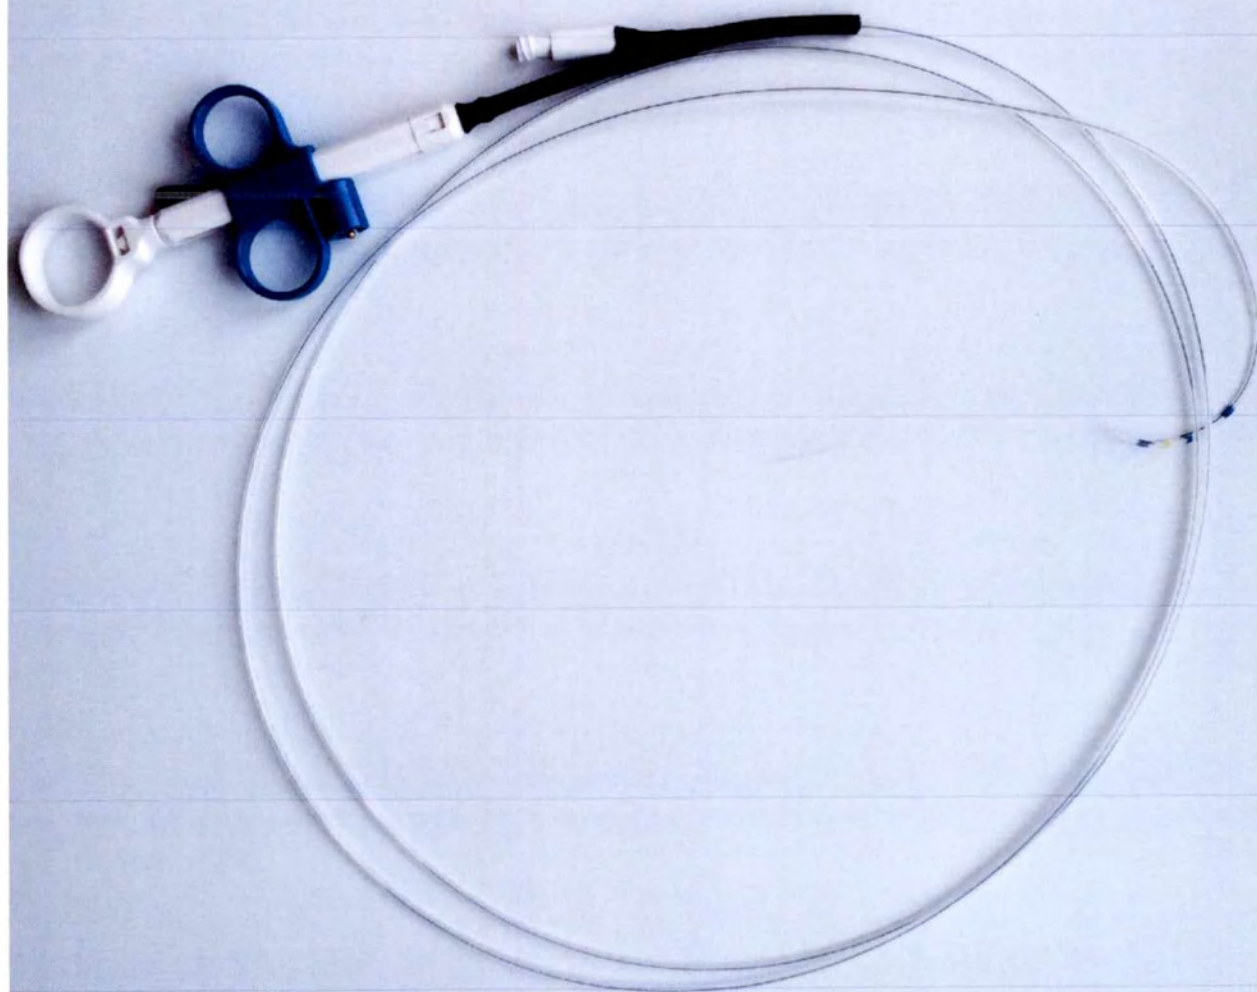


[illegible]

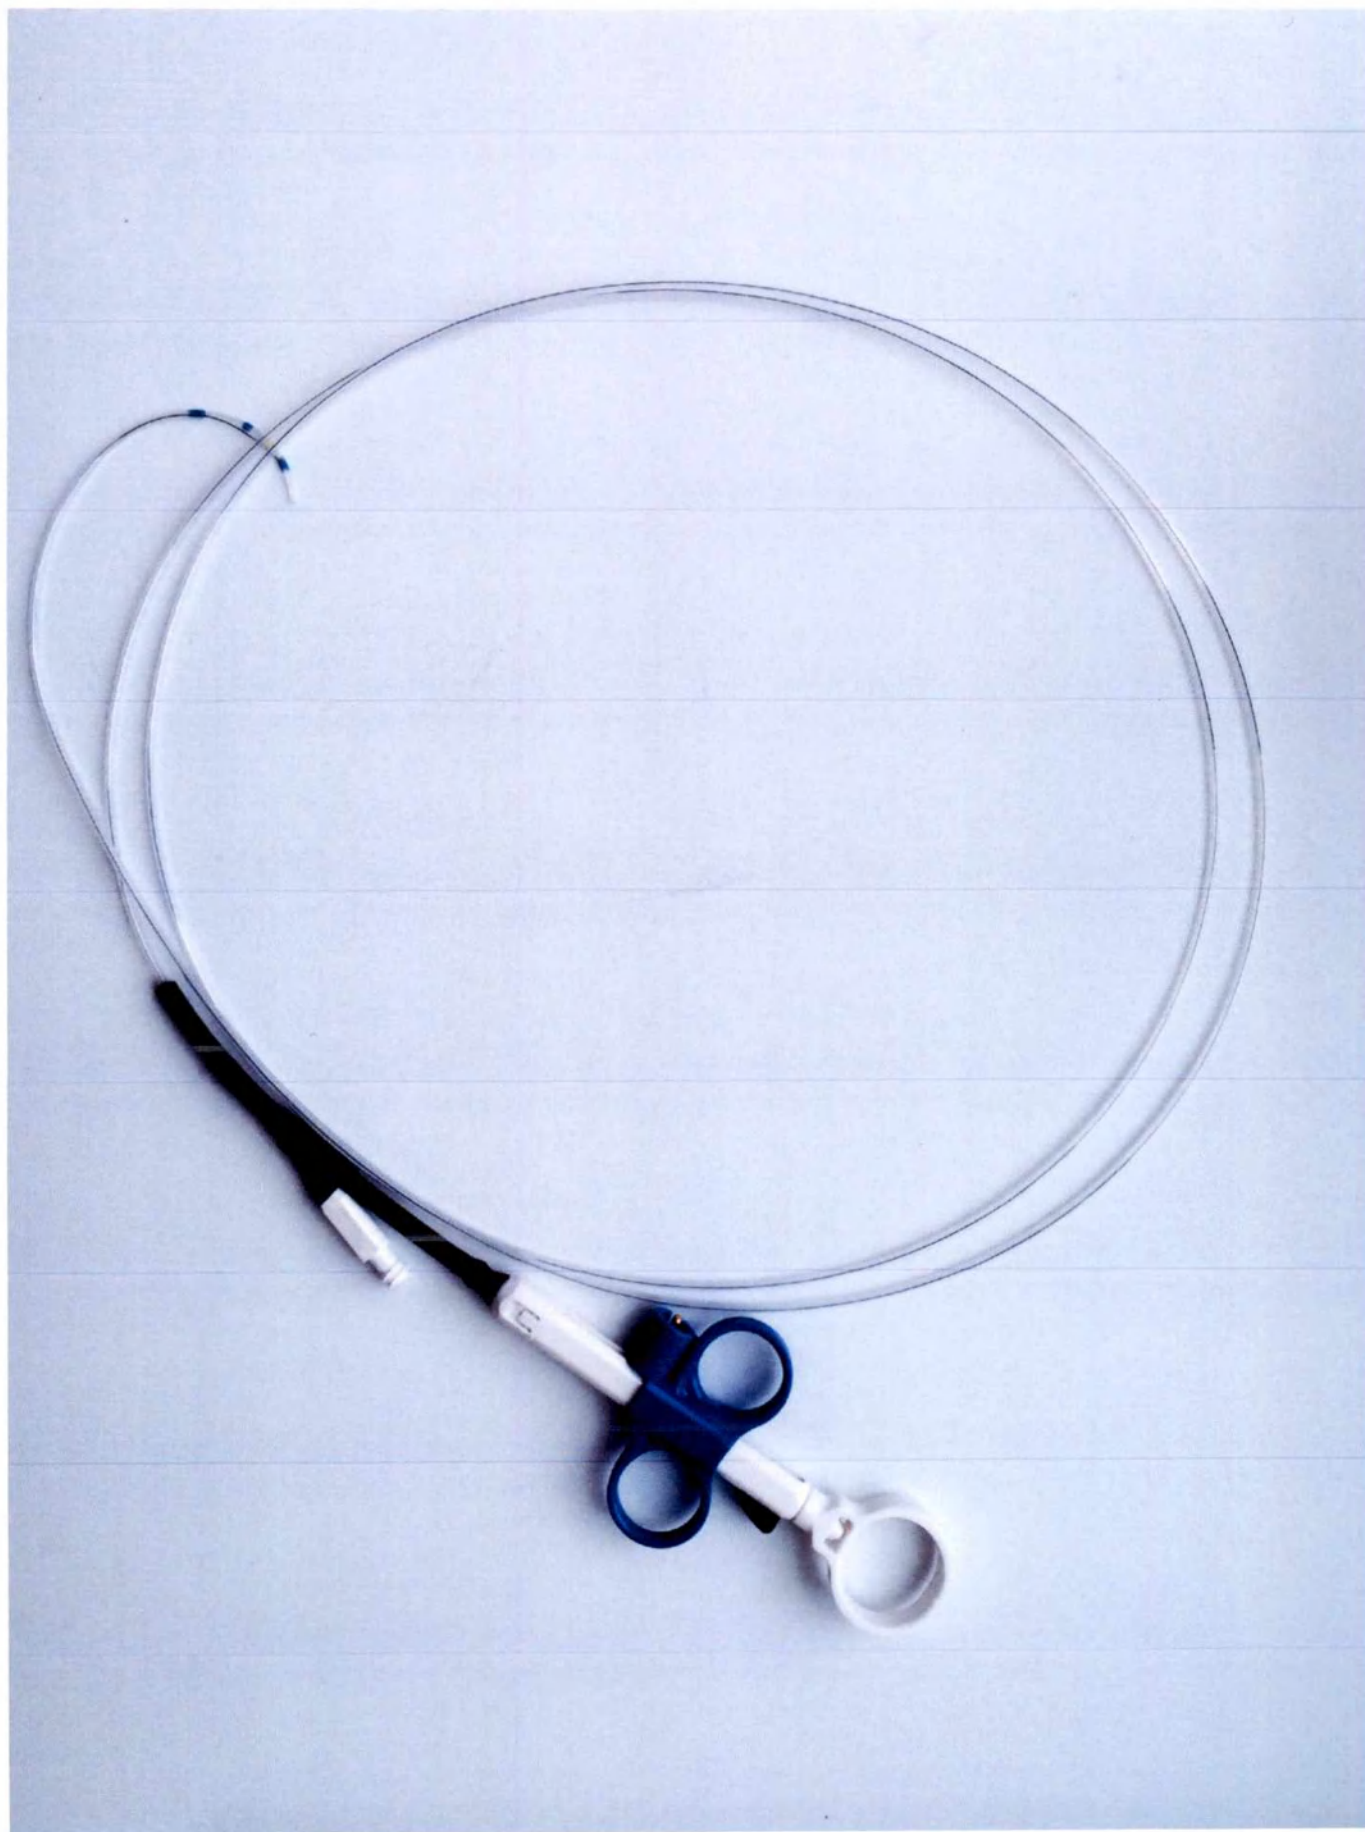

СФИНКТЕРОТОМ		СФИНКТЕРОТОМ		СФИНКТЕРОТОМ		СФИНКТЕРОТОМ	
Сфинктеротом, с коническим носиком, однострунный, с каналообразителем для промывания и подачи рентгеноконтрастного вещества, длина струны 30 мм, в сборе с несъемной ручкой, Ø 1,8 мм, для канала 2,0 мм, длина 210 см, по ТУ 9433-005-89134710-2015		Сфинктеротом, с каналообразителем для промывания и подачи рентгеноконтрастного вещества, длина струны 30 мм, в сборе с несъемной ручкой, Ø 1,8 мм, для канала 2,8 мм, длина 210 см, по ТУ 9433-005-89134710-2015		Сфинктеротом, с каналообразителем для промывания и подачи рентгеноконтрастного вещества, длина струны 20 мм, в сборе с несъемной ручкой, Ø 1,8 мм, для канала 2,8 мм, длина 210 см, по ТУ 9433-005-89134710-2015		Сфинктеротом, с каналообразителем для промывания и подачи рентгеноконтрастного вещества, длина струны 30 мм, в сборе с несъемной ручкой, Ø 1,8 мм, для канала 2,8 мм, длина 210 см, по ТУ 9433-005-89134710-2015	
APT	94332021	APT	94332030	APT	94332027	APT	94332029
LOT	20150315/021	LOT	20150315/030	LOT	20150315/027	LOT	20150315/029
2015.03 - 2018.03		2015.03 - 2018.03		2015.03 - 2018.03		2015.03 - 2018.03	
EndoZact		EndoZact		EndoZact		EndoZact	
ООО «ЭндоЗакт» г. Москва, ул. Мухоморова, д. 17А тел./факс: +7 (495) 555-56-17 e-mail: info@endozact.ru www.endozact.ru		ООО «ЭндоЗакт» г. Москва, ул. Мухоморова, д. 17А тел./факс: +7 (495) 555-56-17 e-mail: info@endozact.ru www.endozact.ru		ООО «ЭндоЗакт» г. Москва, ул. Мухоморова, д. 17А тел./факс: +7 (495) 555-56-17 e-mail: info@endozact.ru www.endozact.ru		ООО «ЭндоЗакт» г. Москва, ул. Мухоморова, д. 17А тел./факс: +7 (495) 555-56-17 e-mail: info@endozact.ru www.endozact.ru	
Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.		Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.		Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.		Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.	
СФИНКТЕРОТОМ		СФИНКТЕРОТОМ		СФИНКТЕРОТОМ		СФИНКТЕРОТОМ	
Сфинктеротом, с каналообразителем для промывания и подачи рентгеноконтрастного вещества, длина струны 30 мм, в сборе с несъемной ручкой, Ø 1,8 мм, для канала 2,8 мм, длина 210 см, по ТУ 9433-005-89134710-2015		Сфинктеротом, с каналообразителем для промывания и подачи рентгеноконтрастного вещества, длина струны 20 мм, в сборе с несъемной ручкой, Ø 1,8 мм, для канала 2,8 мм, длина 210 см, по ТУ 9433-005-89134710-2015		Сфинктеротом, с каналообразителем для промывания и подачи рентгеноконтрастного вещества, длина струны 30 мм, в сборе с несъемной ручкой, Ø 1,8 мм, для канала 2,8 мм, длина 210 см, по ТУ 9433-005-89134710-2015		Сфинктеротом, с каналообразителем для промывания и подачи рентгеноконтрастного вещества, длина струны 30 мм, в сборе с несъемной ручкой, Ø 1,8 мм, для канала 2,8 мм, длина 210 см, по ТУ 9433-005-89134710-2015	
APT	94332053	APT	94332054	APT	94332051		
LOT	20150315/053	LOT	20150315/054	LOT	20150315/051		
2015.03 - 2018.03		2015.03 - 2018.03		2015.03 - 2018.03			
EndoZact		EndoZact		EndoZact			
ООО «ЭндоЗакт» г. Москва, ул. Мухоморова, д. 17А тел./факс: +7 (495) 555-56-17 e-mail: info@endozact.ru www.endozact.ru		ООО «ЭндоЗакт» г. Москва, ул. Мухоморова, д. 17А тел./факс: +7 (495) 555-56-17 e-mail: info@endozact.ru www.endozact.ru		ООО «ЭндоЗакт» г. Москва, ул. Мухоморова, д. 17А тел./факс: +7 (495) 555-56-17 e-mail: info@endozact.ru www.endozact.ru			
Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.		Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.		Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.			

[illegible]

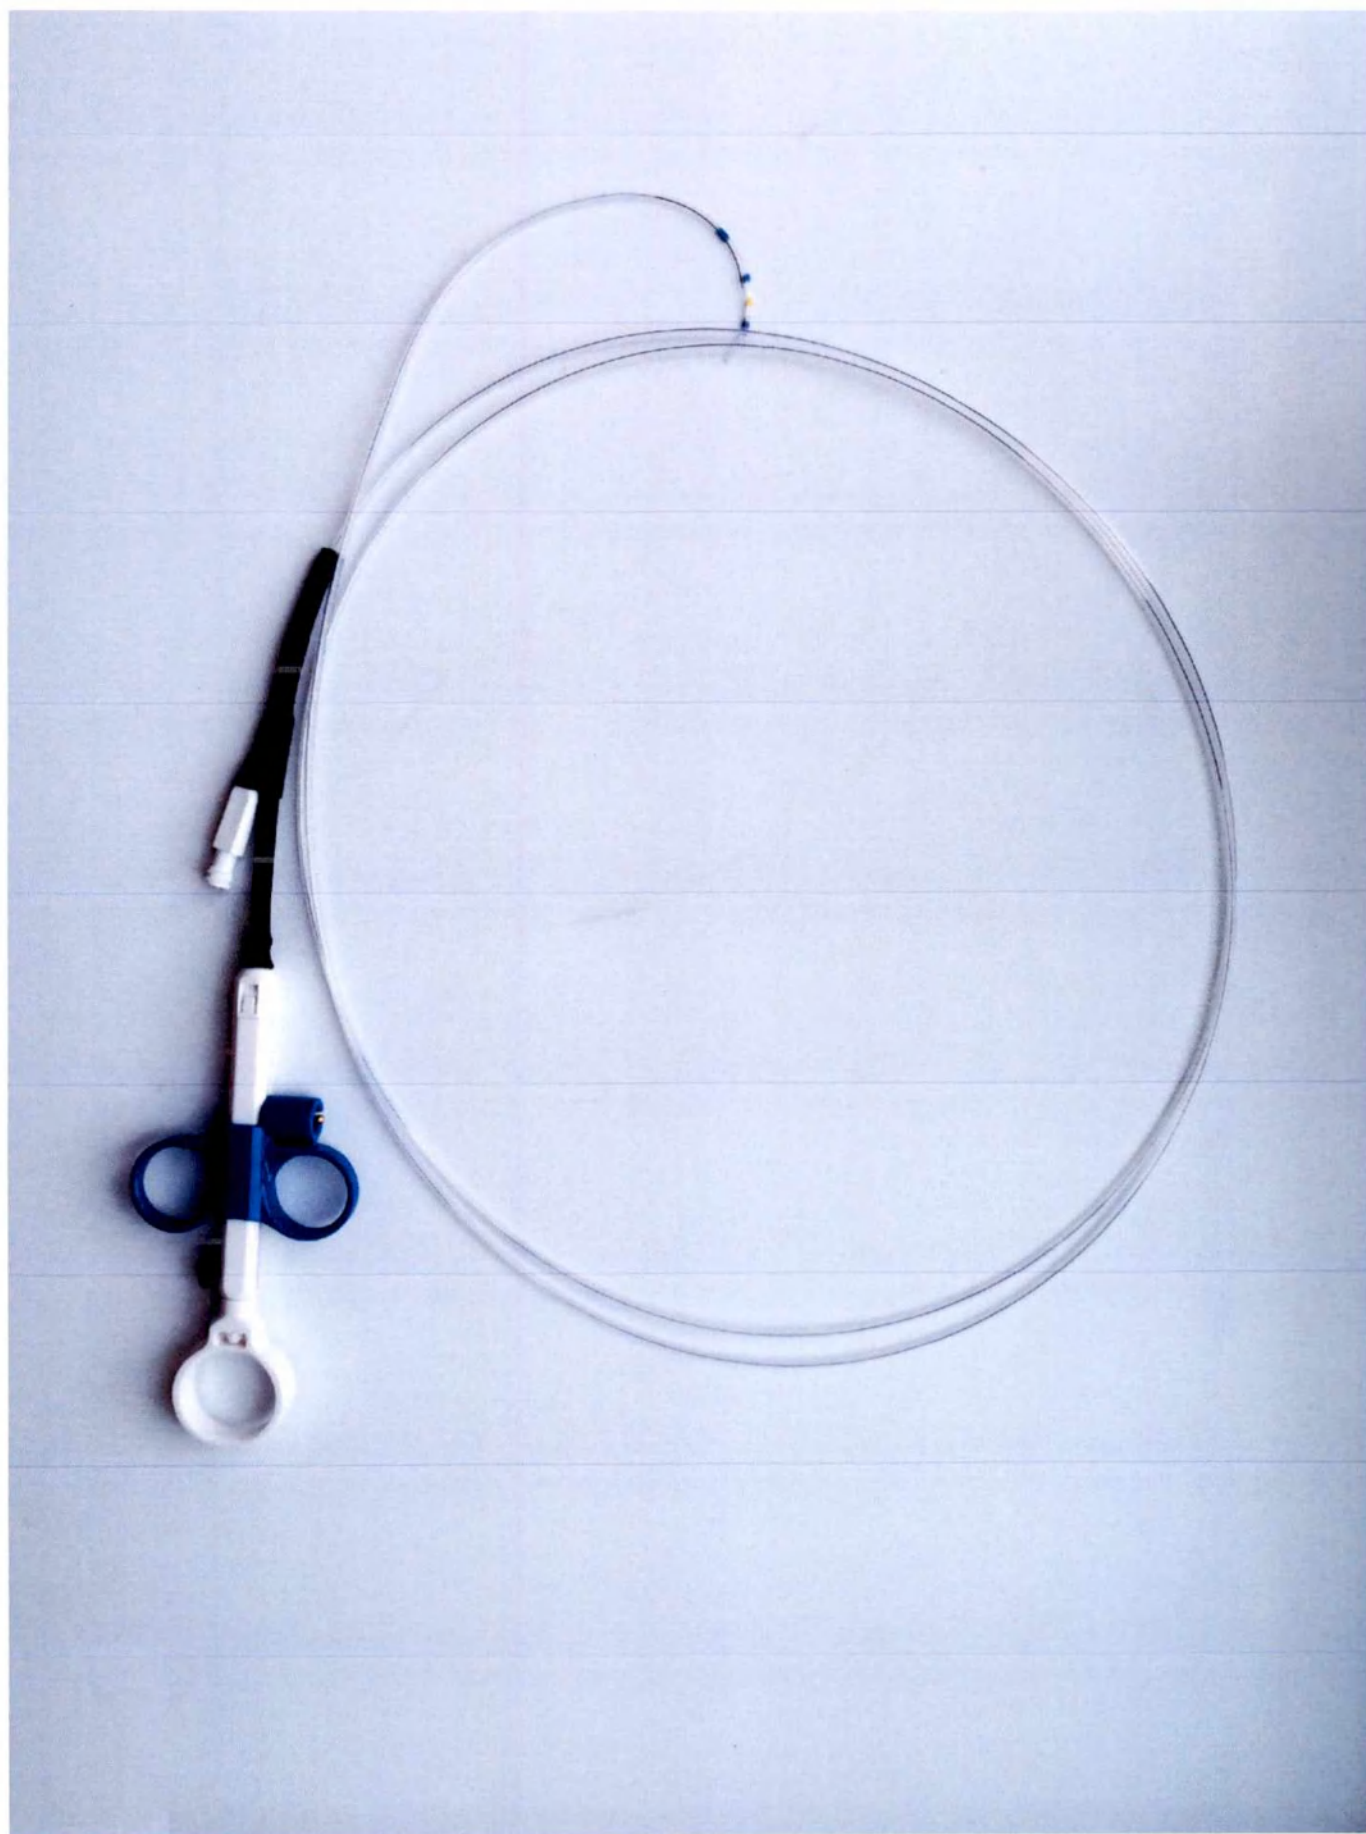

[illegible]



СФИНКТЕРОТОМ

Сфинктеротом, тип «СМАРТКАТ», с коническим носиком, трехпросветный, с каналом для подачи рентгеноконтрастного вещества, длина струны 20 мм/длина изопроявленной части 10 мм, каналом для 035 дюралюминиевого проводника, в сборе с несъемной ручкой, Ø сужающийся 2,2мм > 1,8 мм, длина 210 см, по ТУ 9433-005-89134710-2015

АПТ **94332060**
ЛОТ 20150315/060

М 2015.03 - 2018.03



EndoGates

ООО «Эндоскоп»
Брянская область, г. Брянск
ул. Мухоморова, 7/8
г. Брянск, 241000
т. 47-20-00-25, 47-20-00-26
ф. 47-20-00-25, 47-20-00-26
www.endogates.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

СФИНКТЕРОТОМ

Сфинктеротом, тип «СМАРТКАТ», с коническим носиком, двухпросветный, с каналом для подачи рентгеноконтрастного вещества, длина струны 30 мм/длина изопроявленной части 15 мм, каналом для 035 дюралюминиевого проводника, в сборе с несъемной ручкой, Ø сужающийся 2,2мм > 1,8 мм, длина 210 см, по ТУ 9433-005-89134710-2015

АПТ **94332059**
ЛОТ 20150315/059

М 2015.03 - 2018.03



EndoGates

ООО «Эндоскоп»
Брянская область, г. Брянск
ул. Мухоморова, 7/8
г. Брянск, 241000
т. 47-20-00-25, 47-20-00-26
ф. 47-20-00-25, 47-20-00-26
www.endogates.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

СФИНКТЕРОТОМ

Сфинктеротом, тип «СМАРТКАТ», с коническим носиком, трехпросветный, с каналом для подачи рентгеноконтрастного вещества, длина струны 30 мм/длина изопроявленной части 15 мм, каналом для 035 дюралюминиевого проводника, в сборе с несъемной ручкой, Ø сужающийся 2,2 > 1,8 мм, длина 210 см, по ТУ 9433-005-89134710-2015

АПТ **94332062**
ЛОТ 20150315/062

М 2015.03 - 2018.03



EndoGates

ООО «Эндоскоп»
Брянская область, г. Брянск
ул. Мухоморова, 7/8
г. Брянск, 241000
т. 47-20-00-25, 47-20-00-26
ф. 47-20-00-25, 47-20-00-26
www.endogates.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

СФИНКТЕРОТОМ

Сфинктеротом, тип «СМАРТКАТ», с коническим носиком, двухпросветный, с каналом для подачи рентгеноконтрастного вещества, длина струны 20 мм/длина изопроявленной части 10 мм, каналом для 035 дюралюминиевого проводника, в сборе с несъемной ручкой, Ø сужающийся 2,2мм > 1,8 мм, длина 210 см, по ТУ 9433-005-89134710-2015

АПТ **94332057**
ЛОТ 20150315/057

М 2015.03 - 2018.03



EndoGates

ООО «Эндоскоп»
Брянская область, г. Брянск
ул. Мухоморова, 7/8
г. Брянск, 241000
т. 47-20-00-25, 47-20-00-26
ф. 47-20-00-25, 47-20-00-26
www.endogates.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

СФИНКТЕРОТОМ

Сфинктеротом, тип «СМАРТКАТ», с коническим носиком, трехпросветный, с каналом для подачи рентгеноконтрастного вещества, длина струны 25 мм/длина изопроявленной части 10 мм, каналом для 035 дюралюминиевого проводника, в сборе с несъемной ручкой, Ø сужающийся 2,2мм > 1,8 мм, длина 210 см, по ТУ 9433-005-89134710-2015

АПТ **94332061**
ЛОТ 20150315/061

М 2015.03 - 2018.03



EndoGates

ООО «Эндоскоп»
Брянская область, г. Брянск
ул. Мухоморова, 7/8
г. Брянск, 241000
т. 47-20-00-25, 47-20-00-26
ф. 47-20-00-25, 47-20-00-26
www.endogates.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

СФИНКТЕРОТОМ

Сфинктеротом, тип «СМАРТКАТ», с коническим носиком, двухпросветный, с каналом для подачи рентгеноконтрастного вещества, длина струны 25 мм/длина изопроявленной части 10 мм, каналом для 035 дюралюминиевого проводника, в сборе с несъемной ручкой, Ø сужающийся 2,2мм > 1,8 мм, длина 210 см, по ТУ 9433-005-89134710-2015

АПТ **94332058**
ЛОТ 20150315/058


М 2015.03 - 2018.03





EndoGates

ООО «Эндоскоп»
Брянская область, г. Брянск
ул. Мухоморова, 7/8
г. Брянск, 241000
т. 47-20-00-25, 47-20-00-26
ф. 47-20-00-25, 47-20-00-26
www.endogates.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

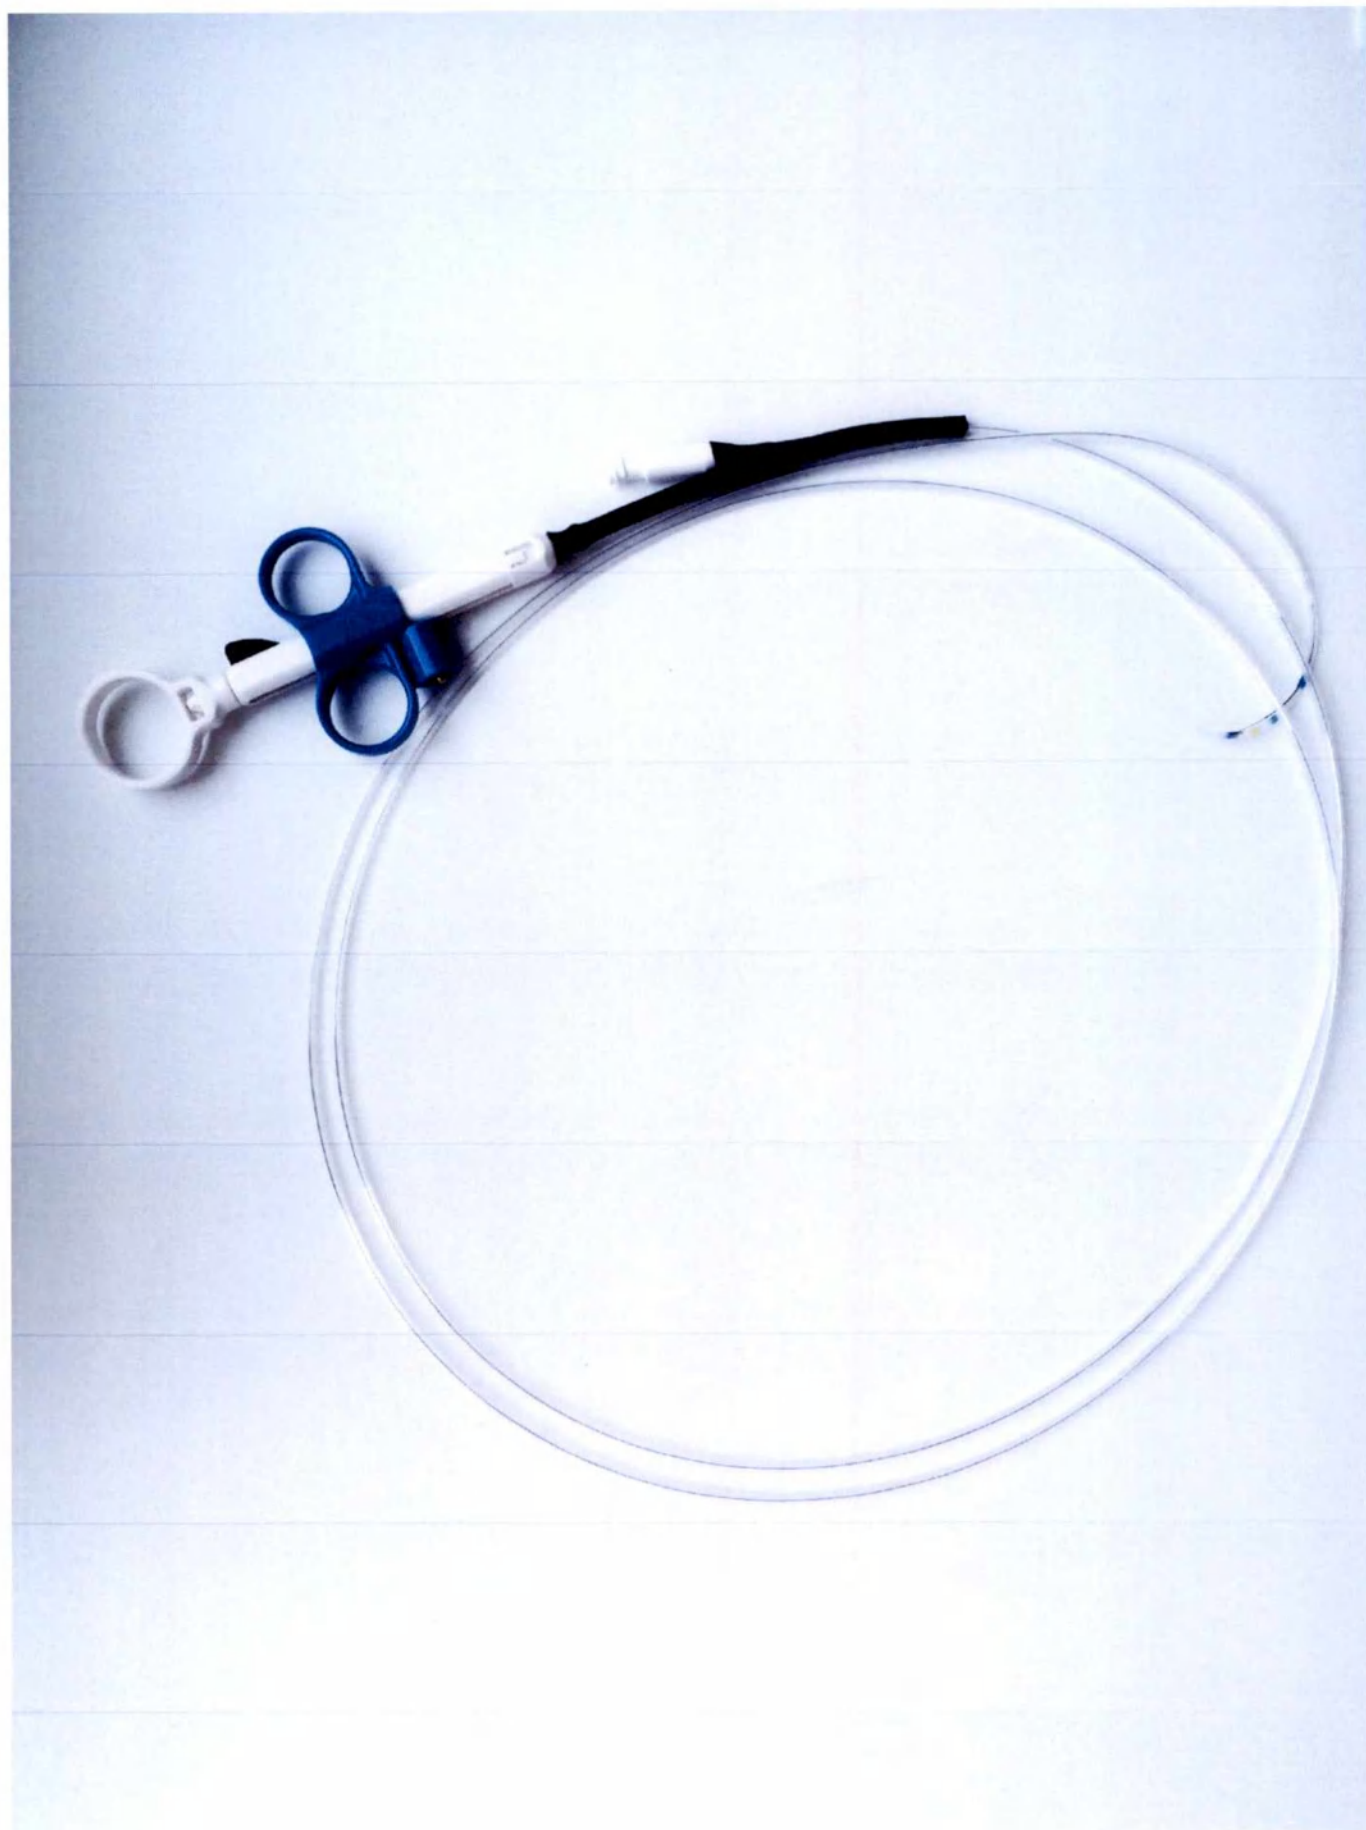

СФИНКТЕРОТОМ		СФИНКТЕРОТОМ	
Сфинктеротом, тип "ВІІ", однопросветный, с каналом для промывания и подачи рентгеноконтрастного вещества, длина не изолированной части струны 20 мм, в сборе с несъемной ручкой, диаметр 2,2 мм, для канала 2,8 мм, длина 210 см, по ТУ 9433-005-89134710-2015		Сфинктеротом, тип "ВІІ", однопросветный, с каналом для промывания и подачи рентгеноконтрастного вещества, длина не изолированной части струны 20 мм, в сборе с несъемной ручкой, диаметр 1,8 мм, для канала 2,0 мм, длина 210 см, по ТУ 9433-005-89134710-2015	
АРТ	94332038	АРТ	94332037
ЛОТ	20150315/038	ЛОТ	20150315/037
 2015.03 - 2018.03  		 2015.03 - 2018.03  	
 производитель: ООО «Эндо Старт» Большая Московская 27А Санкт-Петербург Россия, 197121 тел/факс: +7 (812) 600-25-26 e-mail: info@endo-start.ru www.endo-start.ru		 производитель: ООО «Эндо Старт» Большая Московская 27А Санкт-Петербург Россия, 197121 тел/факс: +7 (812) 600-25-26 e-mail: info@endo-start.ru www.endo-start.ru	
Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!		Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!	

СФИНКТЕРОТОМ

Сфинктеротом, тип "прекат", без носика, дист. часть катетера цилиндрической формы, с каналом для промывания и подачи рентгеноконтрастного вещества, длина струны 20 мм, в сборе с несъемной ручкой, диаметр 1,8 мм, для канала 2,0 мм, длина 210 см, по ТУ 9433-005-89134710-2015

АРТ	94332049
ЛОТ	20150315/049

 2015.03 - 2018.03



EndoStars

производитель:

ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101


8 (800) 555-56-57

тел/факс: +7 (812) 600-25-26

e-mail: info@endo-stars.ru

www.endo-stars.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

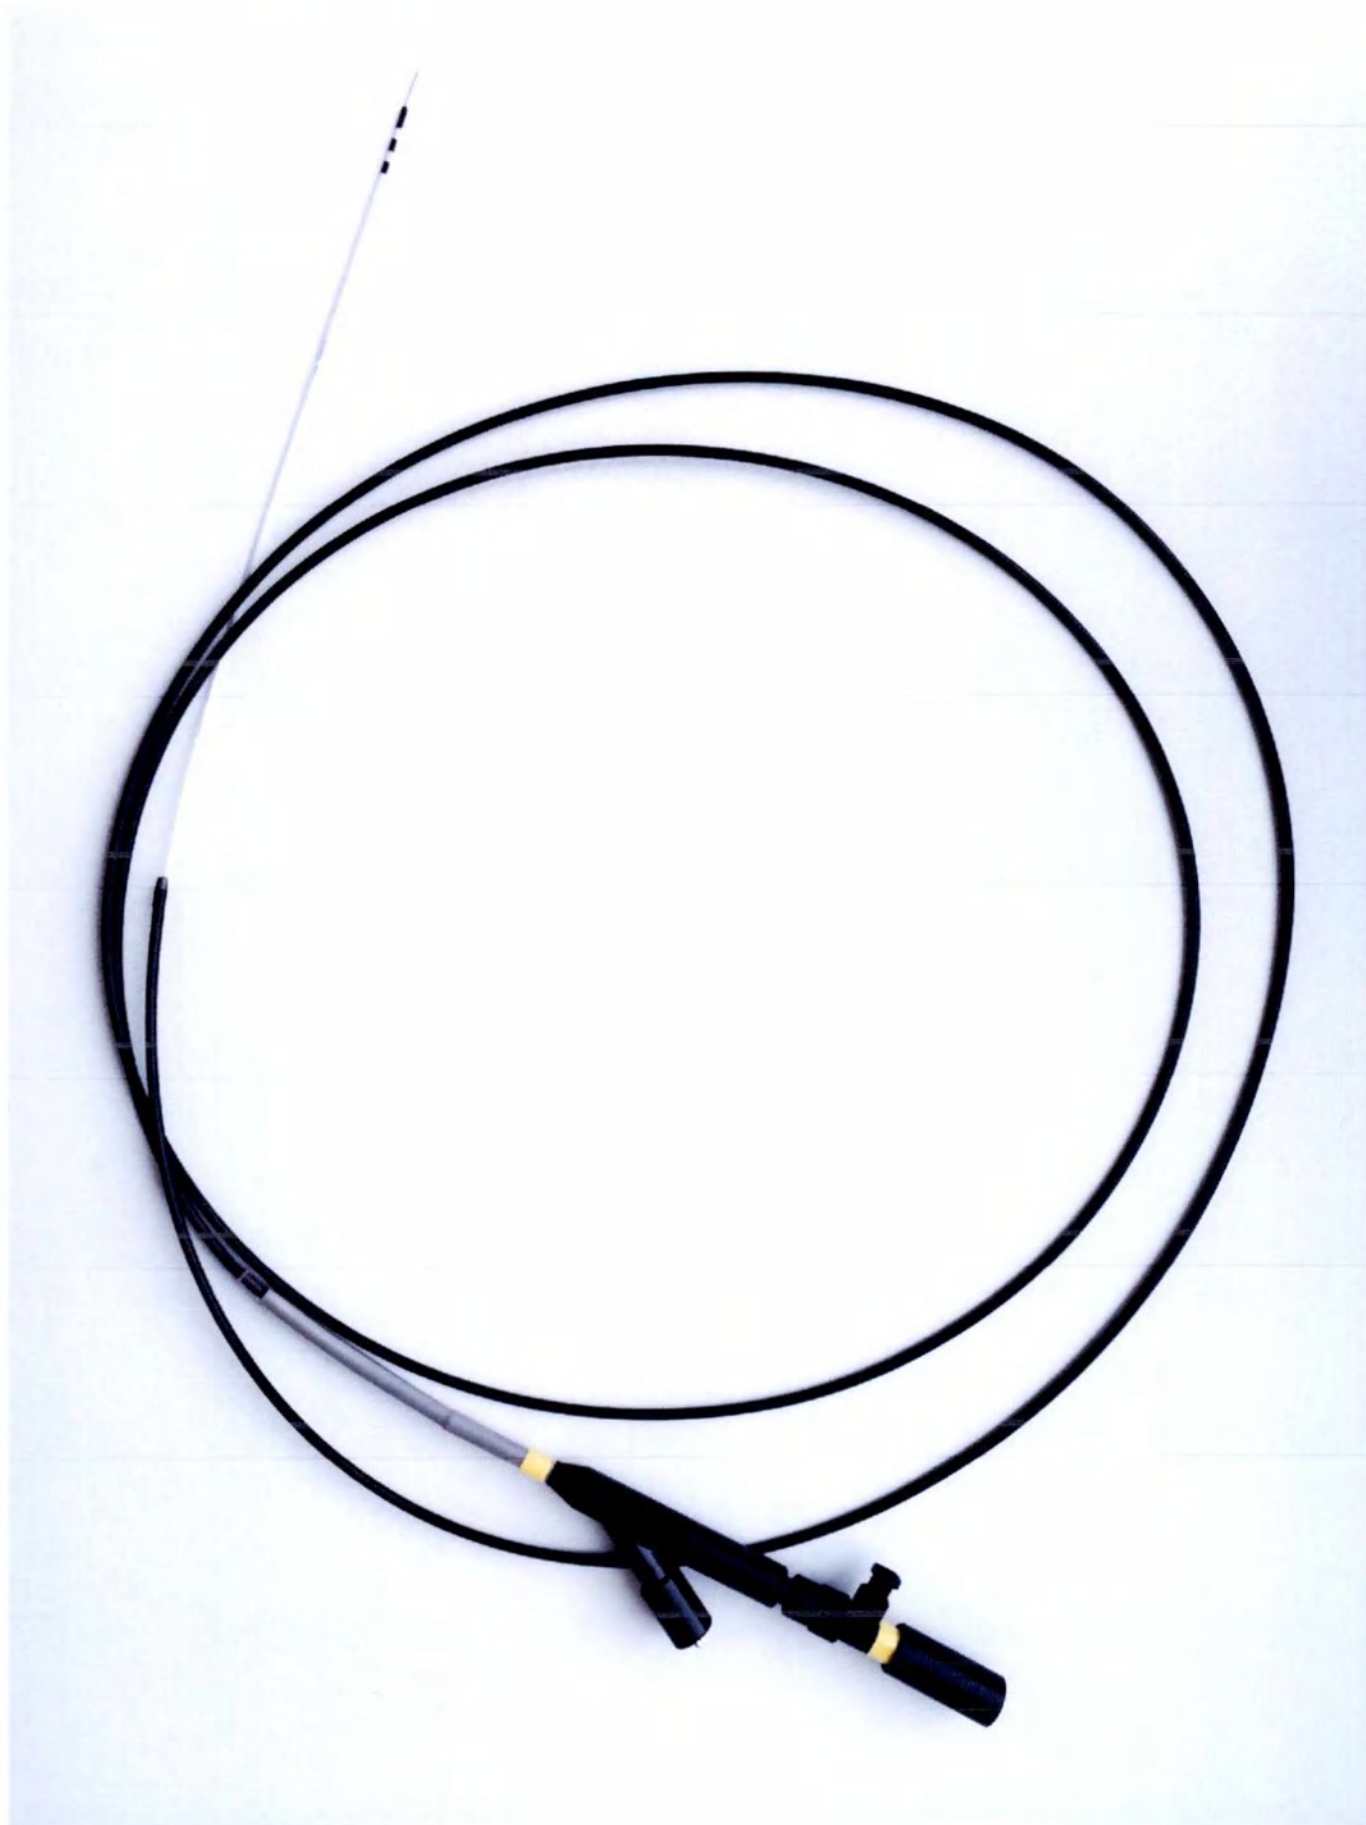

ЗОНД ДЛЯ КОАГУЛЯЦИИ

Зонд для коагуляции шарообразный, полностью покрытый тефлоном, ручка с каналом для промывания, с одним отверстием, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 160 см, по ТУ 9433-005-89134710-2015

АРТ	94333006
ЛОТ	20150314/006

ММ 2015.03 - 2018.03



EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101

8 (800) 555-56-57
тел./факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

ЗОНД ДЛЯ КОАГУЛЯЦИИ Зонд для коагуляции шарообразный, полностью покрытый тефлоном, ручка с каналом для промывания, с одним отверстием, диаметр 1,8 мм, для канала 2,0 мм, длина 120 см, по ТУ 9433-005-89134710-2015 APT 94333001 ЛОТ 20150314/001 2015.03 - 2018.03 EndoStars производитель: ООО «Эндо Старс» Большая Морская 27А Санкт-Петербург Россия, 197101 8 (800) 555-56-57 тел/факс: +7 (812) 900-25-26 e-mail: info@endo-stars.ru www.endo-stars.ru Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!	ЗОНД ДЛЯ КОАГУЛЯЦИИ Зонд для коагуляции шарообразный, полностью покрытый тефлоном, ручка с каналом для промывания, с одним отверстием, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 160 см, по ТУ 9433-005-89134710-2015 APT 94333006 ЛОТ 20150314/006 2015.03 - 2018.03 EndoStars производитель: ООО «Эндо Старс» Большая Морская 27А Санкт-Петербург Россия, 197101 8 (800) 555-56-57 тел/факс: +7 (812) 900-25-26 e-mail: info@endo-stars.ru www.endo-stars.ru Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!	ЗОНД ДЛЯ КОАГУЛЯЦИИ Зонд для коагуляции шарообразный, полностью покрытый тефлоном, ручка с каналом для промывания, с одним отверстием, диаметр 1,8 мм, для канала 2,0 мм, длина 160 см, по ТУ 9433-005-89134710-2015 APT 94333002 ЛОТ 20150314/002 2015.03 - 2018.03 EndoStars производитель: ООО «Эндо Старс» Большая Морская 27А Санкт-Петербург Россия, 197101 8 (800) 555-56-57 тел/факс: +7 (812) 900-25-26 e-mail: info@endo-stars.ru www.endo-stars.ru Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!	ЗОНД ДЛЯ КОАГУЛЯЦИИ Зонд для коагуляции шарообразный, полностью покрытый тефлоном, ручка с каналом для промывания, с одним отверстием, диаметр 1,8 мм, для канала 2,0 мм, длина 180 см, по ТУ 9433-005-89134710-2015 APT 94333003 ЛОТ 20150314/003 2015.03 - 2018.03 EndoStars производитель: ООО «Эндо Старс» Большая Морская 27А Санкт-Петербург Россия, 197101 8 (800) 555-56-57 тел/факс: +7 (812) 900-25-26 e-mail: info@endo-stars.ru www.endo-stars.ru Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!
ЗОНД ДЛЯ КОАГУЛЯЦИИ Зонд для коагуляции шарообразный, полностью покрытый тефлоном, ручка с каналом для промывания, с одним отверстием, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 230 см, по ТУ 9433-005-89134710-2015 APT 94333008 ЛОТ 20150314/008 2015.03 - 2018.03 EndoStars производитель: ООО «Эндо Старс» Большая Морская 27А Санкт-Петербург Россия, 197101 8 (800) 555-56-57 тел/факс: +7 (812) 900-25-26 e-mail: info@endo-stars.ru www.endo-stars.ru Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!	ЗОНД ДЛЯ КОАГУЛЯЦИИ Зонд для коагуляции шарообразный, полностью покрытый тефлоном, ручка с каналом для промывания, с одним отверстием, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 180 см, по ТУ 9433-005-89134710-2015 APT 94333007 ЛОТ 20150314/007 2015.03 - 2018.03 EndoStars производитель: ООО «Эндо Старс» Большая Морская 27А Санкт-Петербург Россия, 197101 8 (800) 555-56-57 тел/факс: +7 (812) 900-25-26 e-mail: info@endo-stars.ru www.endo-stars.ru Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!	ЗОНД ДЛЯ КОАГУЛЯЦИИ Зонд для коагуляции шарообразный, полностью покрытый тефлоном, ручка с каналом для промывания, с одним отверстием, диаметр 1,8 мм, для канала 2,0 мм, длина 230 см, по ТУ 9433-005-89134710-2015 APT 94333004 ЛОТ 20150314/004 2015.03 - 2018.03 EndoStars производитель: ООО «Эндо Старс» Большая Морская 27А Санкт-Петербург Россия, 197101 8 (800) 555-56-57 тел/факс: +7 (812) 900-25-26 e-mail: info@endo-stars.ru www.endo-stars.ru Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!	





РУЧКА ДЛЯ ПЕТЕЛЬ

Ручка для петель, универсальная с HF-коннектором,
по ТУ 9433-005-89134710-2015

АРТ	94334000
ЛОТ	20150313/001

 2015.03 - 2018.03



EndoStars

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101

8 (800) 555-56-57
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-stars.ru
www.endo-stars.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений
упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению!



РУЧКА ДЛЯ ПЕТЕЛЬ

Ручка для петель, универсальная с Н-коннектором,
по ТУ 9433-005-89134/10-2015

АРТ	94334000
ЛОТ	20150313/001

2015.03 - 2018.03

Endgate

производитель
ООО «Эндгейт»
г. Москва, ул. Мухоморова, д. 11А
Смольнинский район
Россия, 127191
т. 8 (495) 535-96-17
факс: 8 (495) 535-96-18
e-mail: info@endgate.ru
www.endgate.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденных
элементов. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению!



АКТИВНЫЙ ШНУР

Активный шнур, для ручки ERBE/T-Series,

по ТУ 9433-005-89134710-2015

APT 94335000**ЛОТ 20150313/002** 2015.03 - 2018.03**EndoStars**

производитель:

ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101



8 (800) 555-56-57

телефакс: +7 (812) 600-25-26

e-mail: info@endo-stars.ru

www.endo-stars.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

АКТИВНЫЙ ШНУР		АКТИВНЫЙ ШНУР	
Активный шнур, для ручки ERBE/T-Series, по ТУ 9433-005-89134710-2015		Активный шнур, для ручки Olympus, по ТУ 9433-005-89134710-2015	
АРТ	94335000	АРТ	94335001
ЛОТ	20150313/002	ЛОТ	20150313/003
 2015.03 - 2018.03  		 2015.03 - 2018.03  	
 проектирует: ООО «Эндо Старс» Болховская Монолитная 27А Санкт-Петербург Россия, 197101 телефон: +7 (800) 555-56-57 телефакс: +7 (812) 600-25-26 e-mail: info@endo-starts.ru www.endo-starts.ru		 проектирует: ООО «Эндо Старс» Болховская Монолитная 27А Санкт-Петербург Россия, 197101 телефон: +7 (800) 555-56-57 телефакс: +7 (812) 600-25-26 e-mail: info@endo-starts.ru www.endo-starts.ru	
Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!		Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!	

Прошито и пронумеровано

52 (пятьдесят два) листа

Генеральный Директор

ООО «Эндо Старс»

Самарец В.С.

