


Инструменты для установки имплантатов в наборах и в отдельных упаковках:

I. Инструменты для установки имплантатов в наборах:

Набор 1:




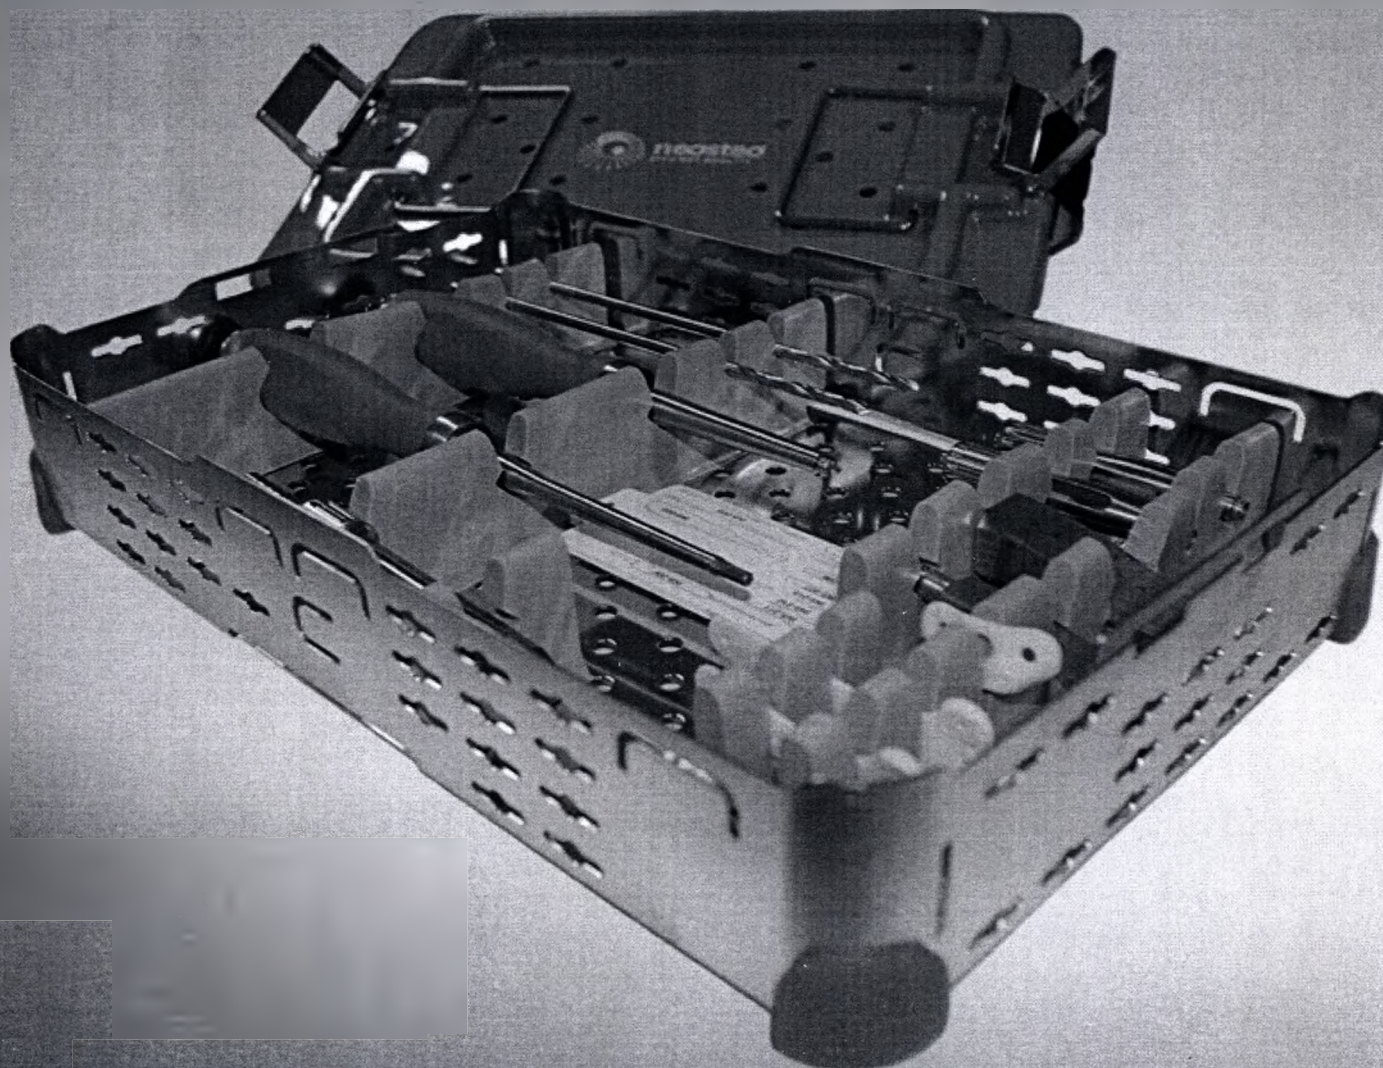

**Инструменты для установки имплантатов в наборах и в отдельных упаковках:**


**I. Инструменты для установки имплантатов в наборах:**

**Набор 1:**

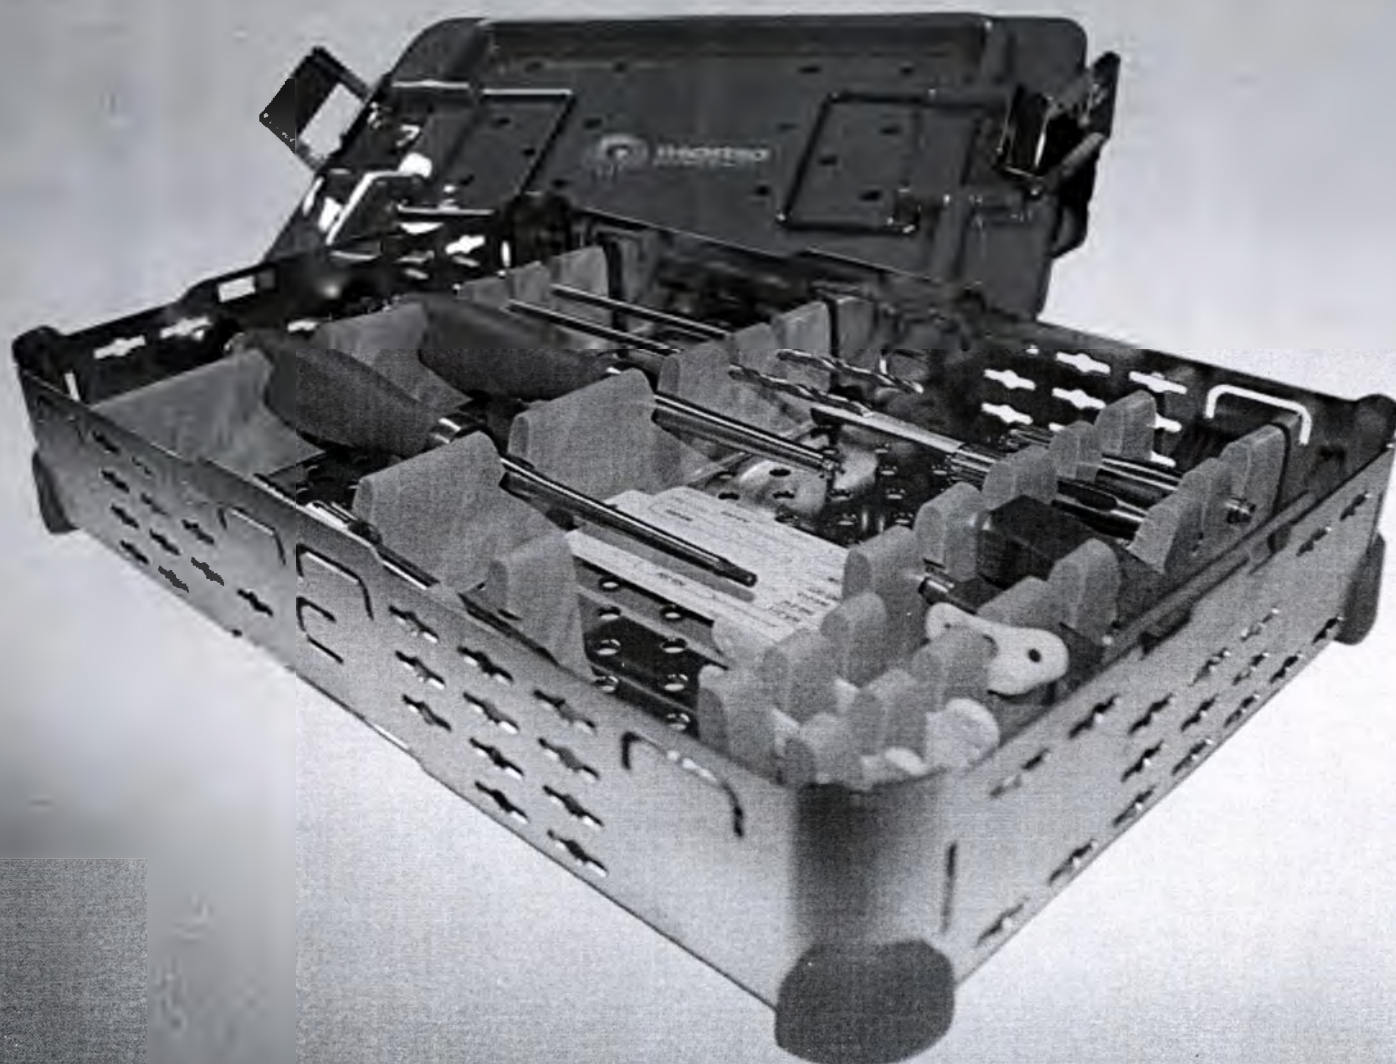



1 Шестигранная отвертка 3,5 мм- 1шт.

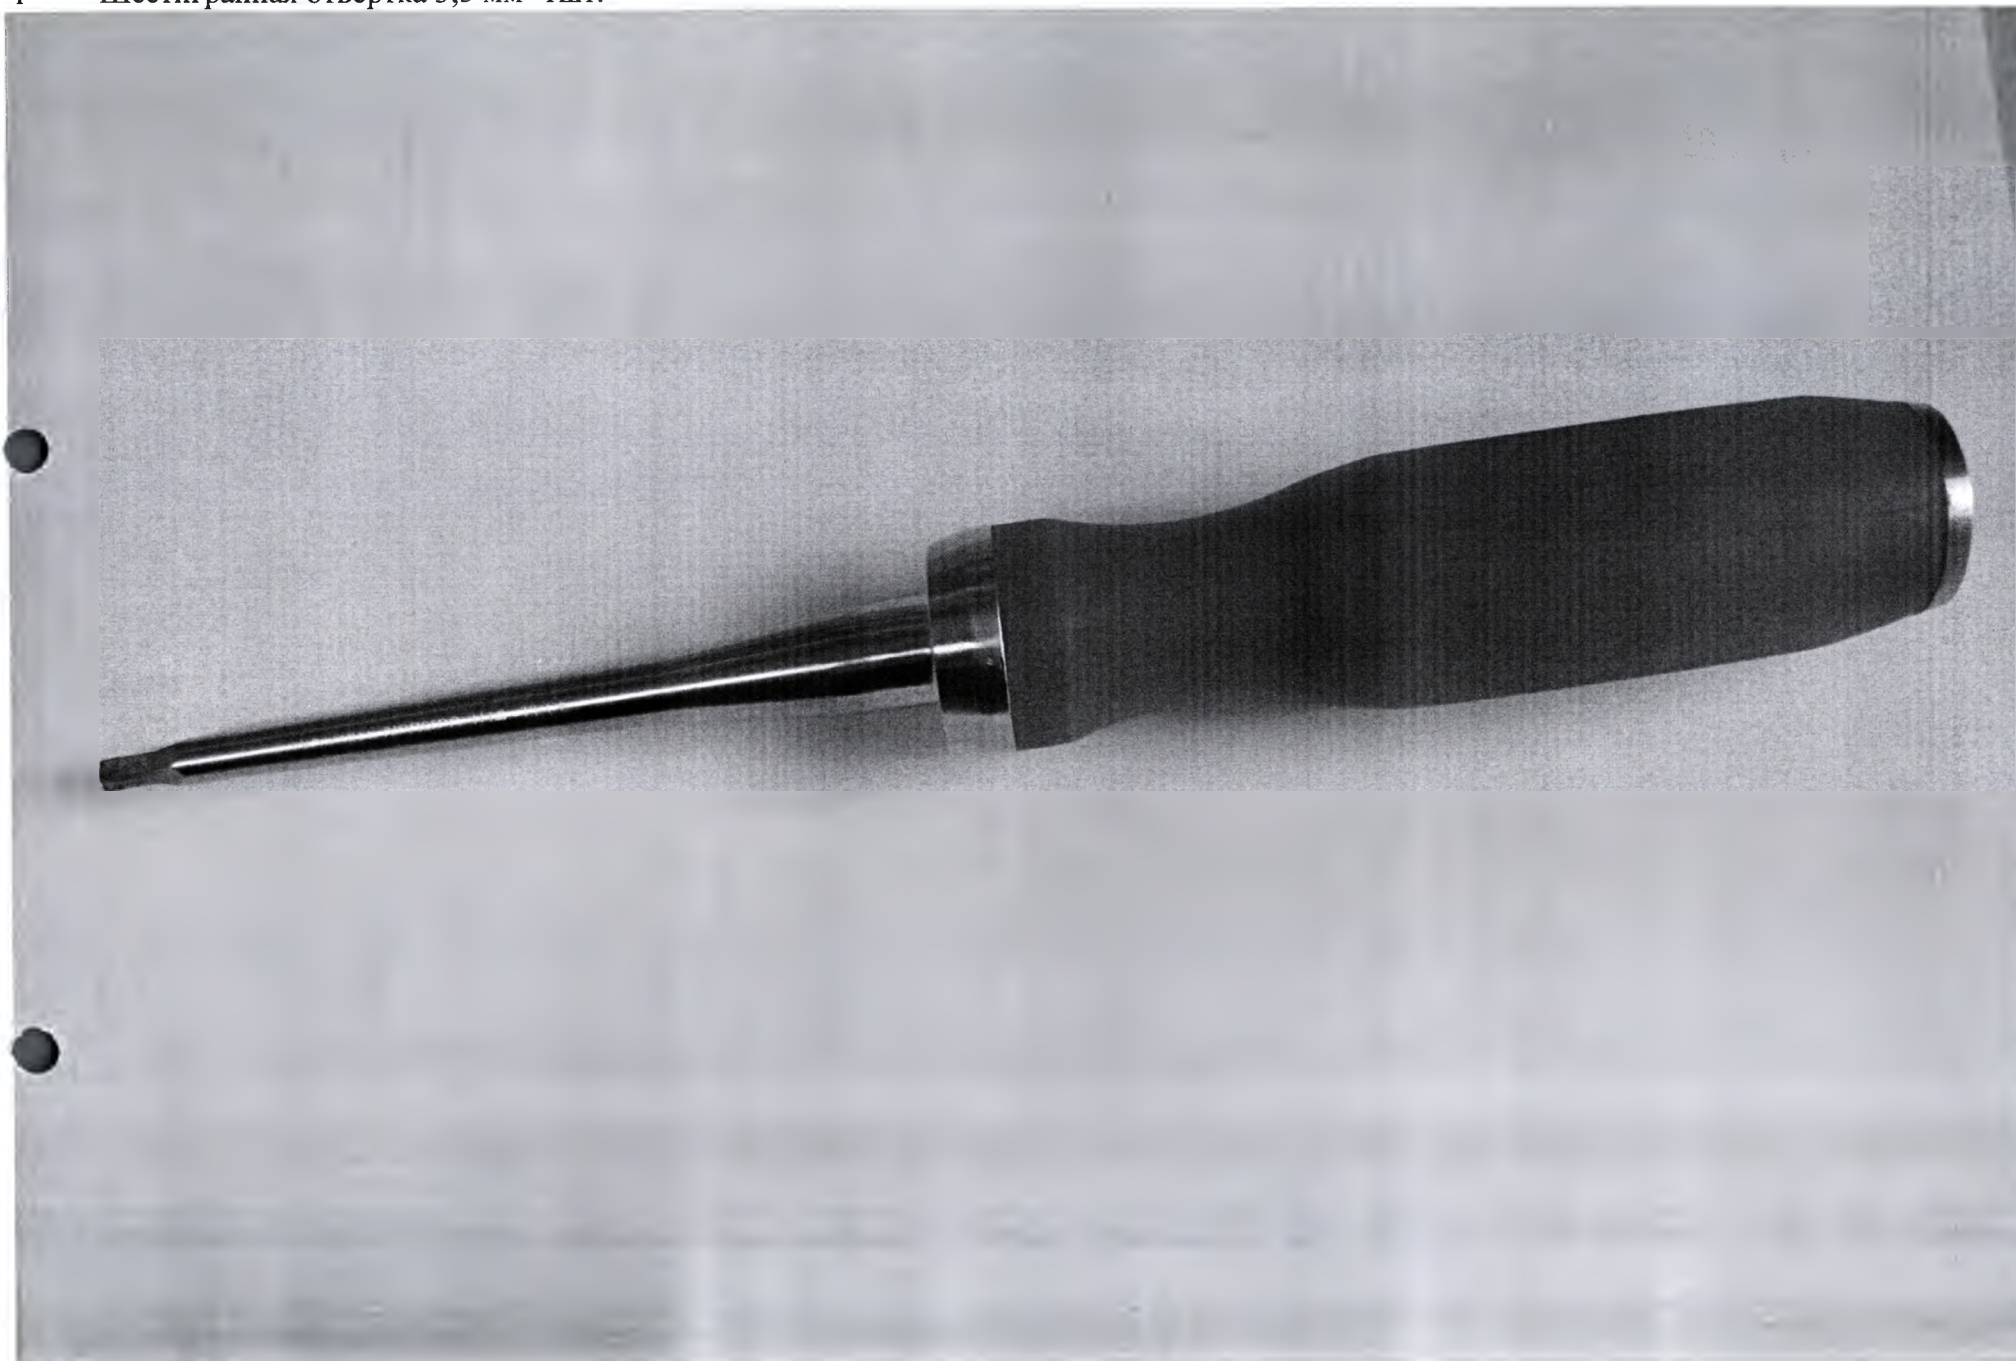













4 Глубиномер- 1шт.


5

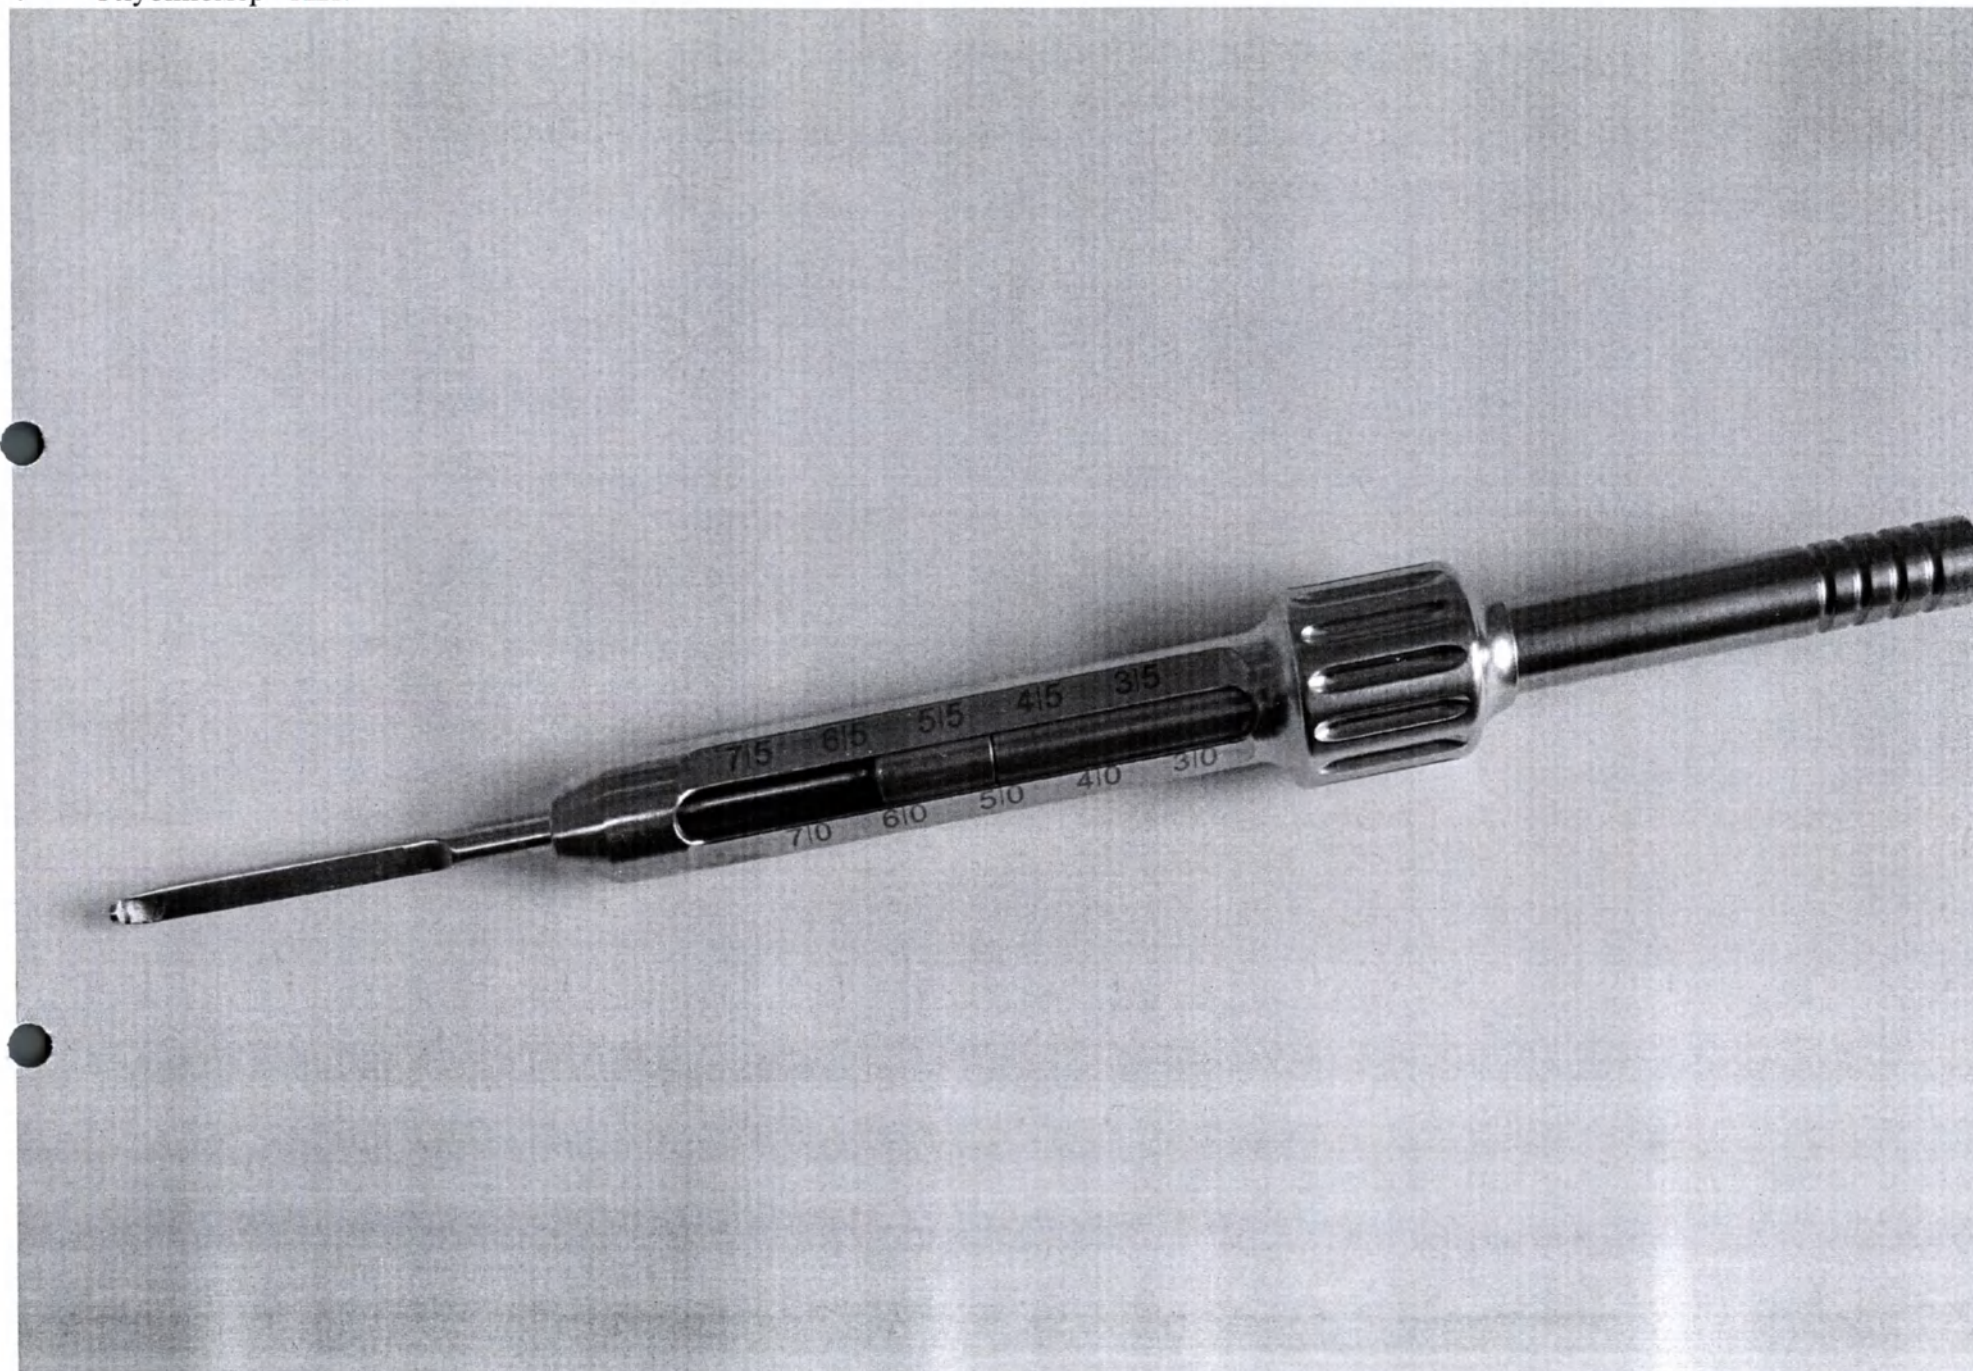




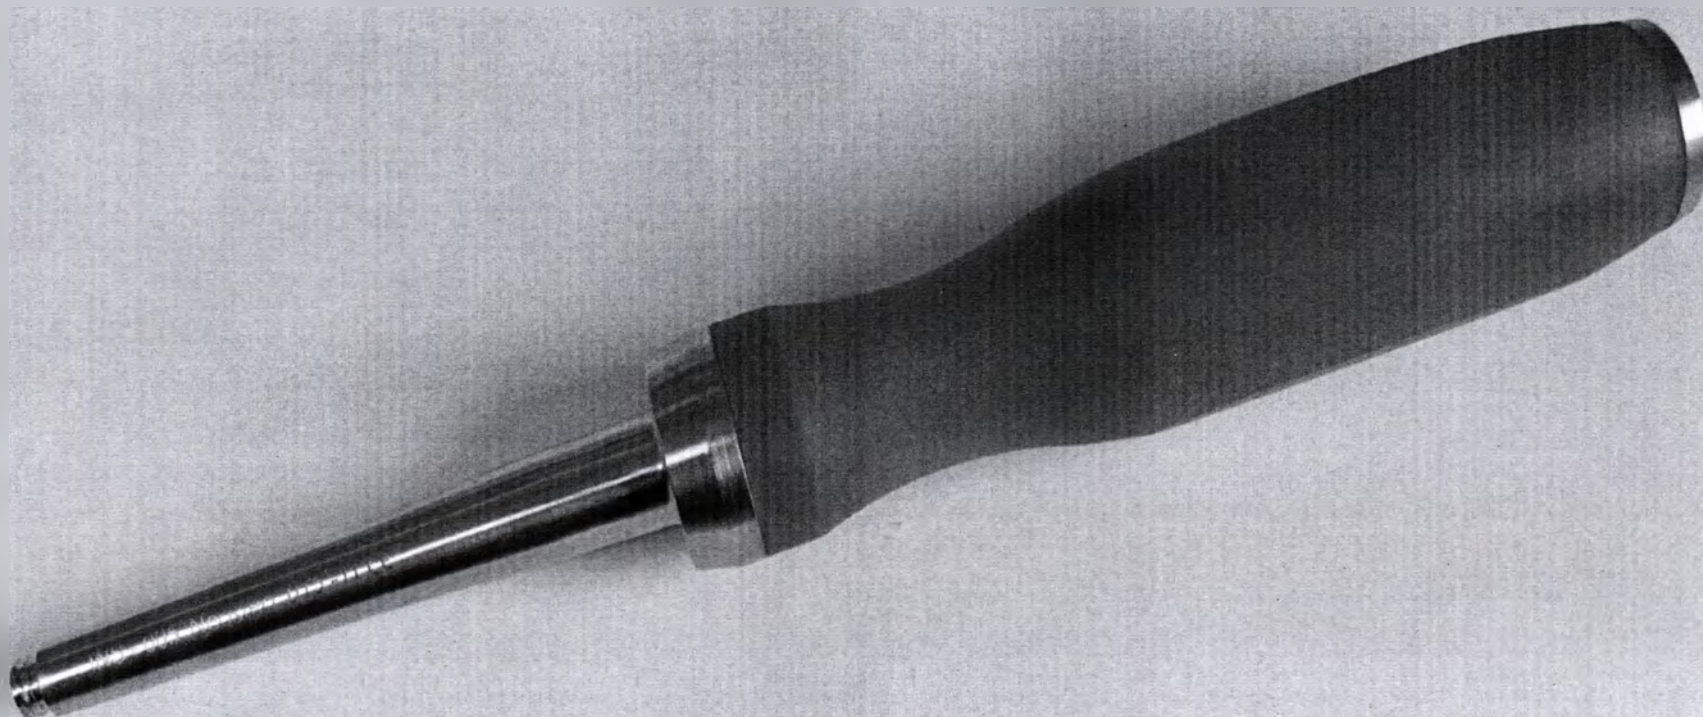




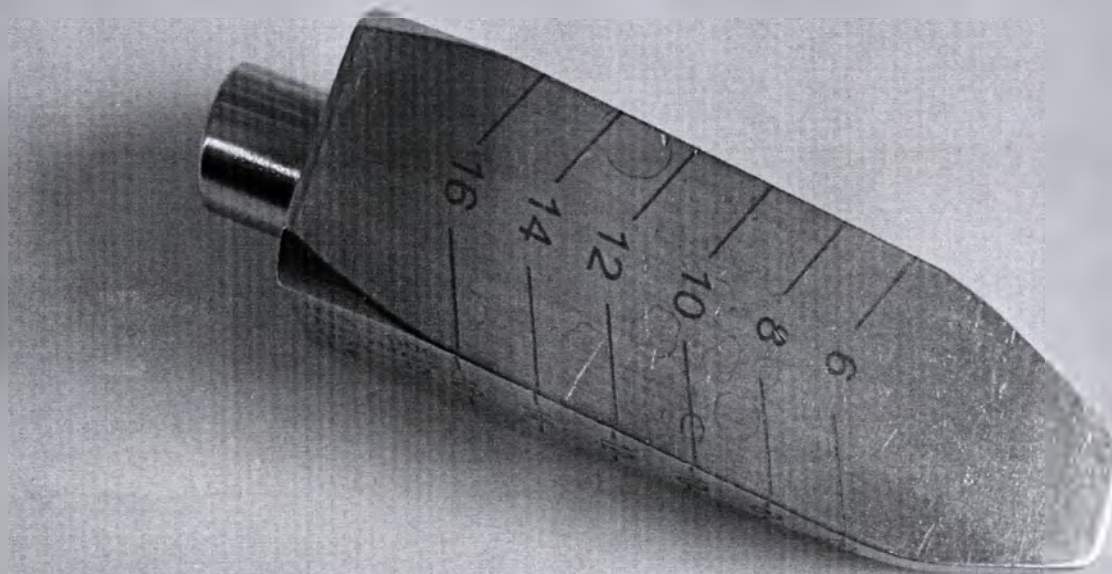



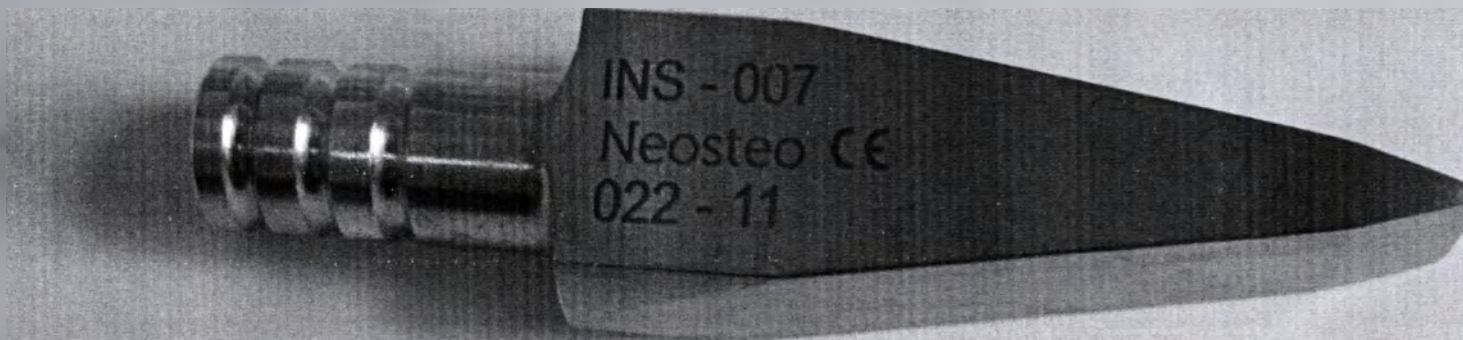



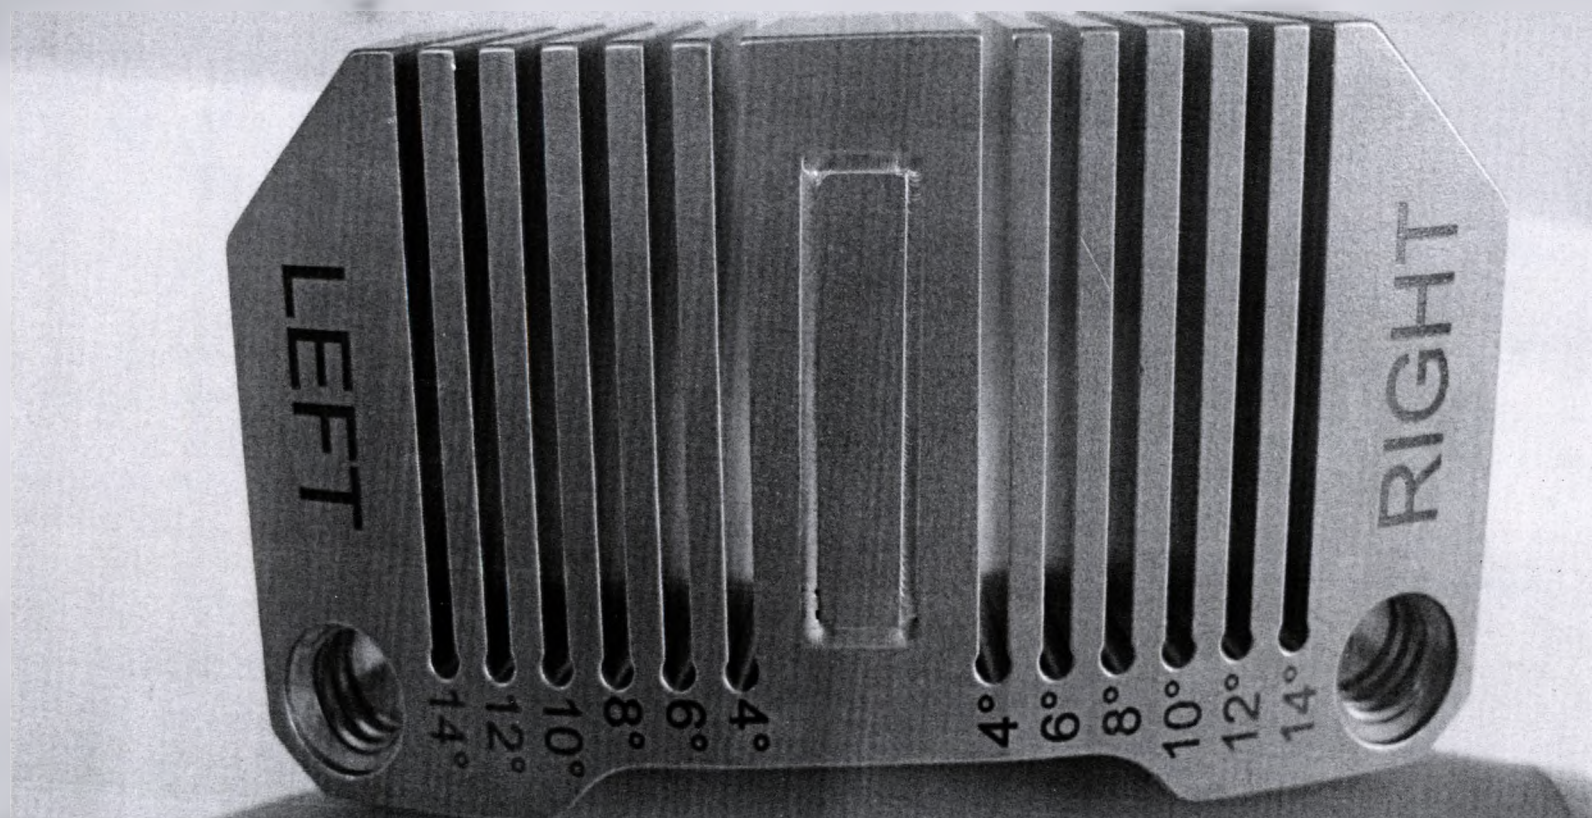



9  
11

ВТО шаблон пластины, размер открытия 1-1 шт.  
ВТО шаблон головки пластины -1шт.


10 ВТО шаблон пластины, размер открытия 2-1шт.  
12 ВТО шаблон пластины, минимальное открытие -1шт.

10






13 ВТО направляющая – 1 шт.

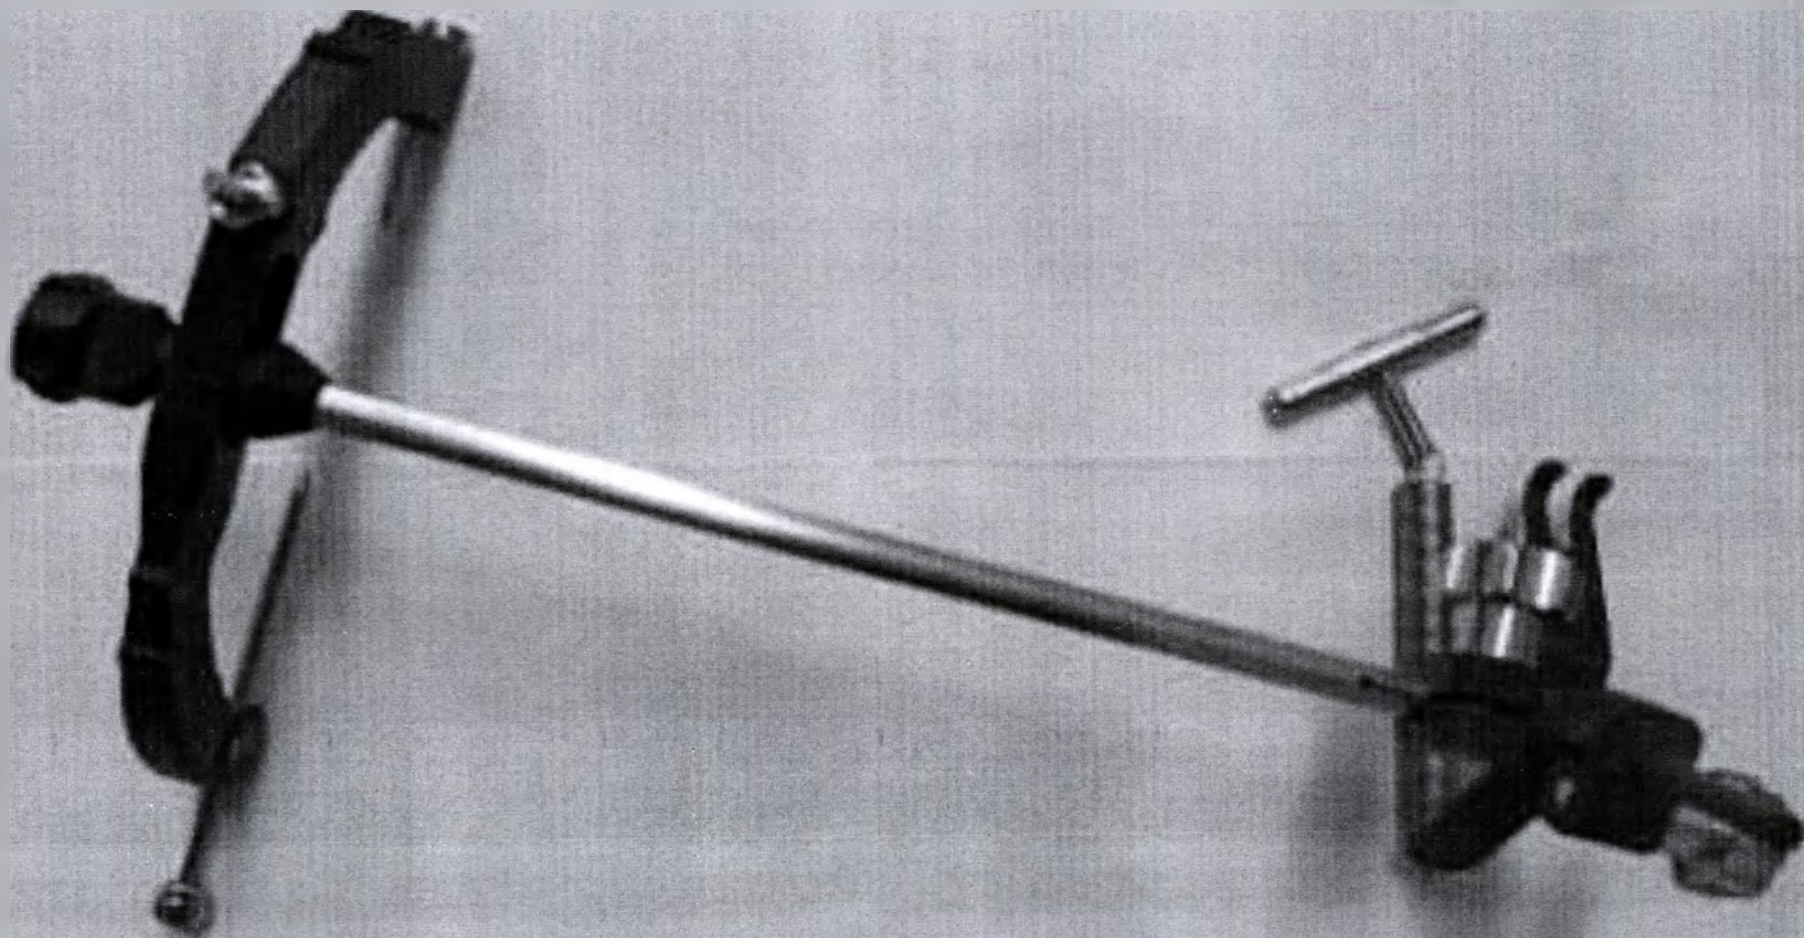



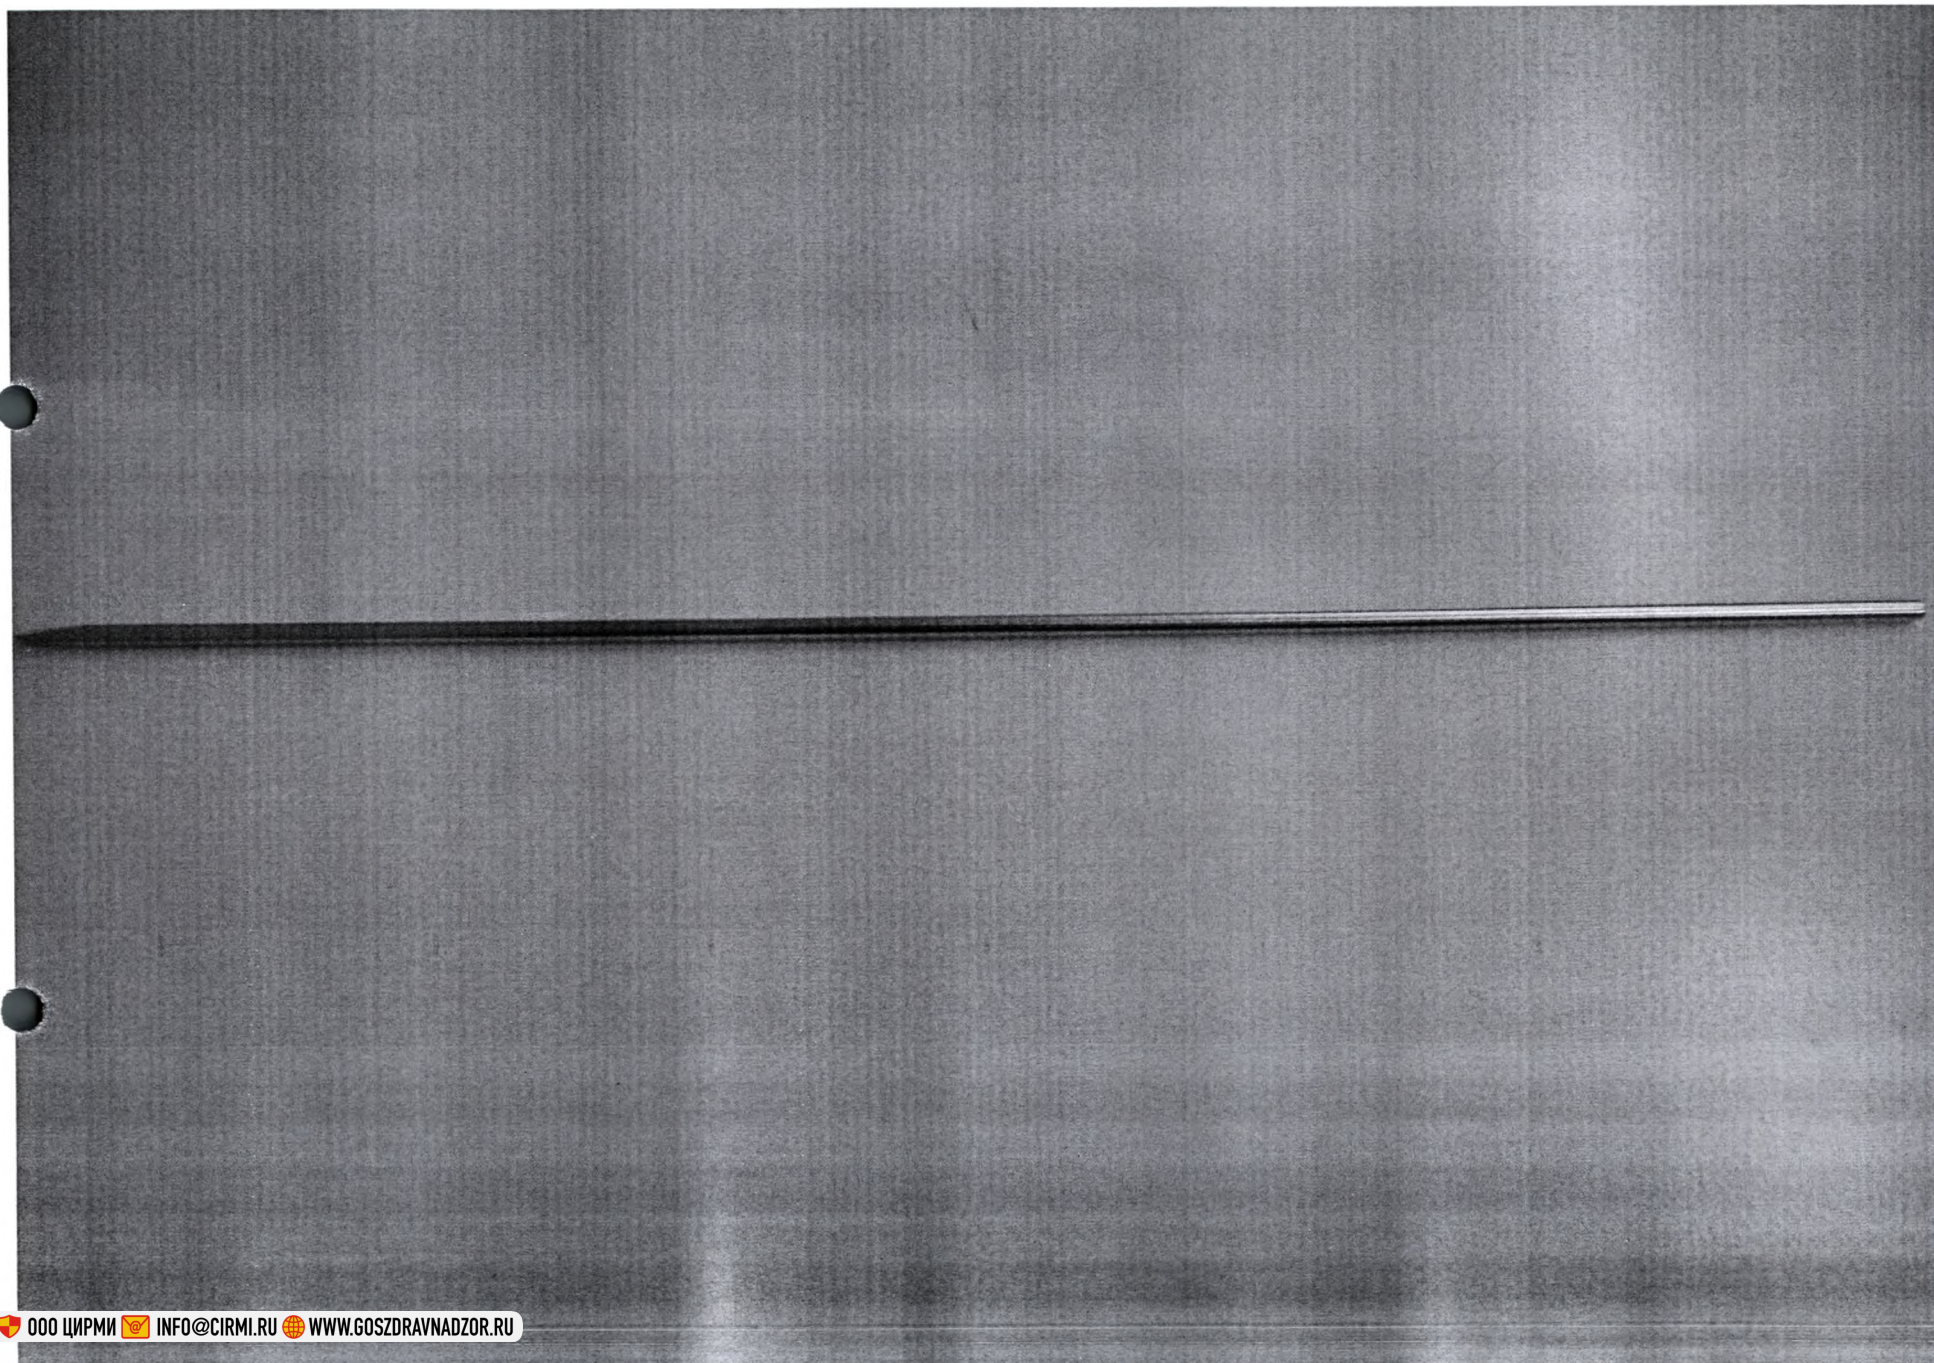




Макет маркировки на русском языке:

|                                                                 |                                                          |    |                                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|--------------------------------------|
|                                                                 | <b>NEOSTEO</b>                                           |    | <b>neosteo</b><br>EFFICIENT MOBILITY |
| Mallève 2a – 1 Boulevard Jean<br>Moulin 44100 NANTES<br>Франция |                                                          |    |                                      |
| <b>Инструменты для установки имплантатов в наборах:</b>         |                                                          |    |                                      |
| <b>Набор 1:</b>                                                 |                                                          |    |                                      |
| 1                                                               | Шестигранная отвертка 3,5 мм- 1шт.                       |    |                                      |
| 2                                                               | Направляющая Ø 4,5 мм – 3шт.                             |    |                                      |
| 3                                                               | Сверло с делениями Ø 4,5 с системой крепления АО - 3 шт. |    |                                      |
| 4                                                               | Глубиномер- 1шт.                                         |    |                                      |
| 5                                                               | Ручка (для открытого клина) – 1 шт.                      |    |                                      |
| 6                                                               | Пробный открытый клин – 1 шт.                            |    |                                      |
| 7                                                               | Расширительный клин – 1шт.                               |    |                                      |
| 8                                                               | Направляющая для закрытой ВТО – 1шт.                     |    |                                      |
| 9                                                               | ВТО шаблон пластины, размер открытия 1-1 шт.             |    |                                      |
| 10                                                              | ВТО шаблон пластины, размер открытия 2-1шт.              |    |                                      |
| 11                                                              | ВТО шаблон головки пластины -1шт.                        |    |                                      |
| 12                                                              | ВТО шаблон пластины, минимальное открытие -1шт.          |    |                                      |
| 13                                                              | ВТО направляющая – 1шт.                                  |    |                                      |
| 14                                                              | Спица Киршнера Ø2,5мм - Длина 200мм - 4 шт.              |    |                                      |
| <b>REF</b>                                                      | <b>LOT</b>                                               |    |                                      |
| 05267                                                           | 196-13                                                   |    | 2016/02                              |
|                                                                 |                                                          | CE |                                      |
| 2013/02                                                         | 0499                                                     |    |                                      |
| 100 мм                                                          |                                                          |    |                                      |
| 150 мм                                                          |                                                          |    |                                      |



**Набор 2:**


1 Компрессионная деталь, длина 55 мм - 1шт.

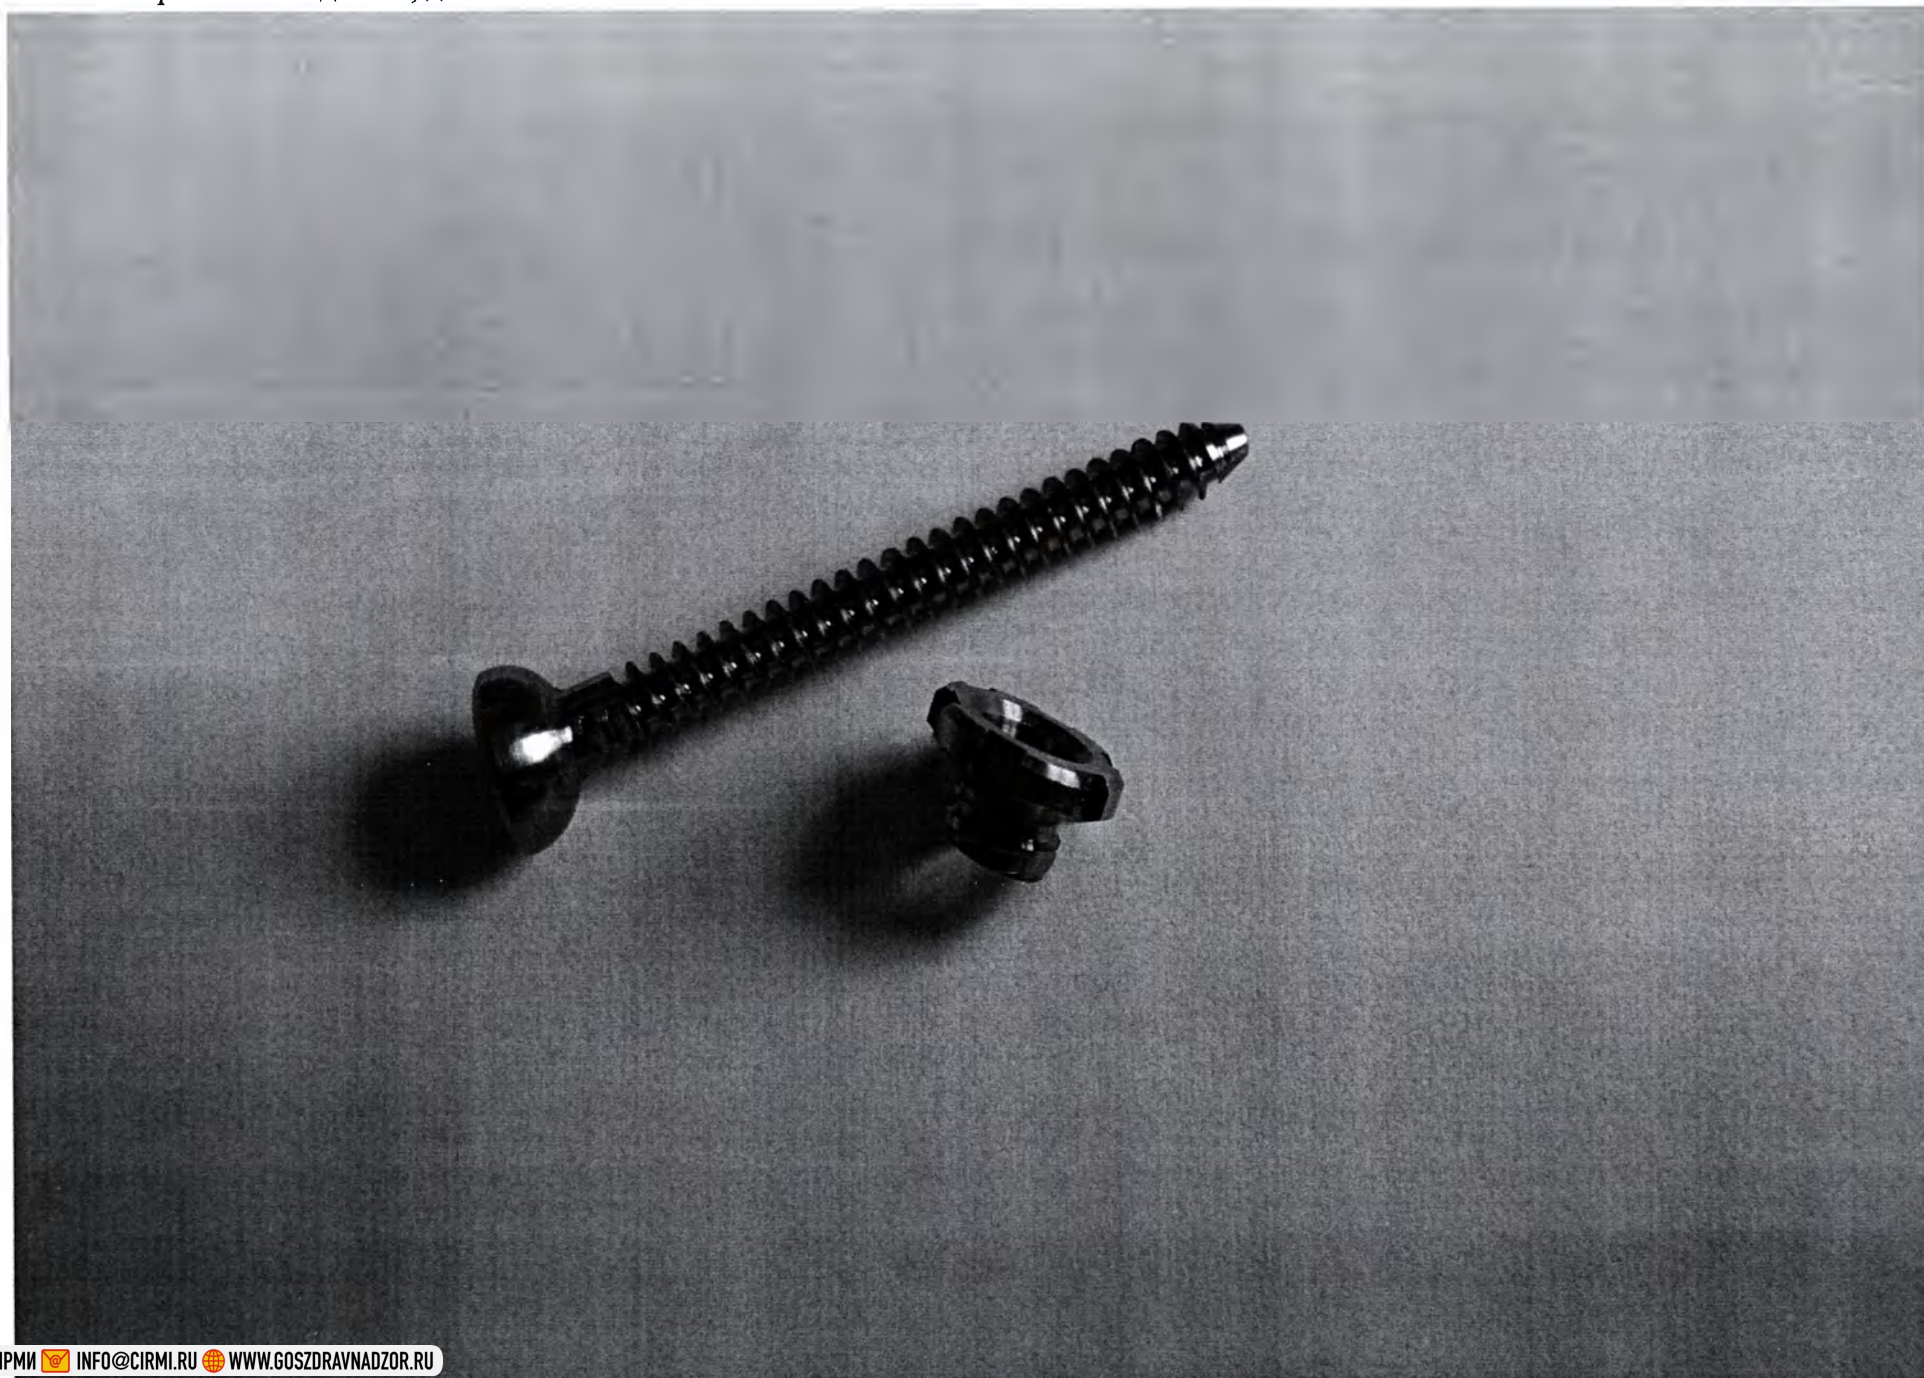







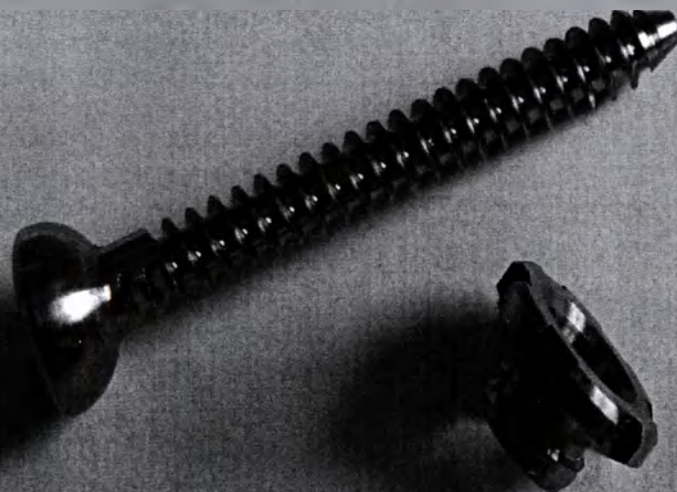
















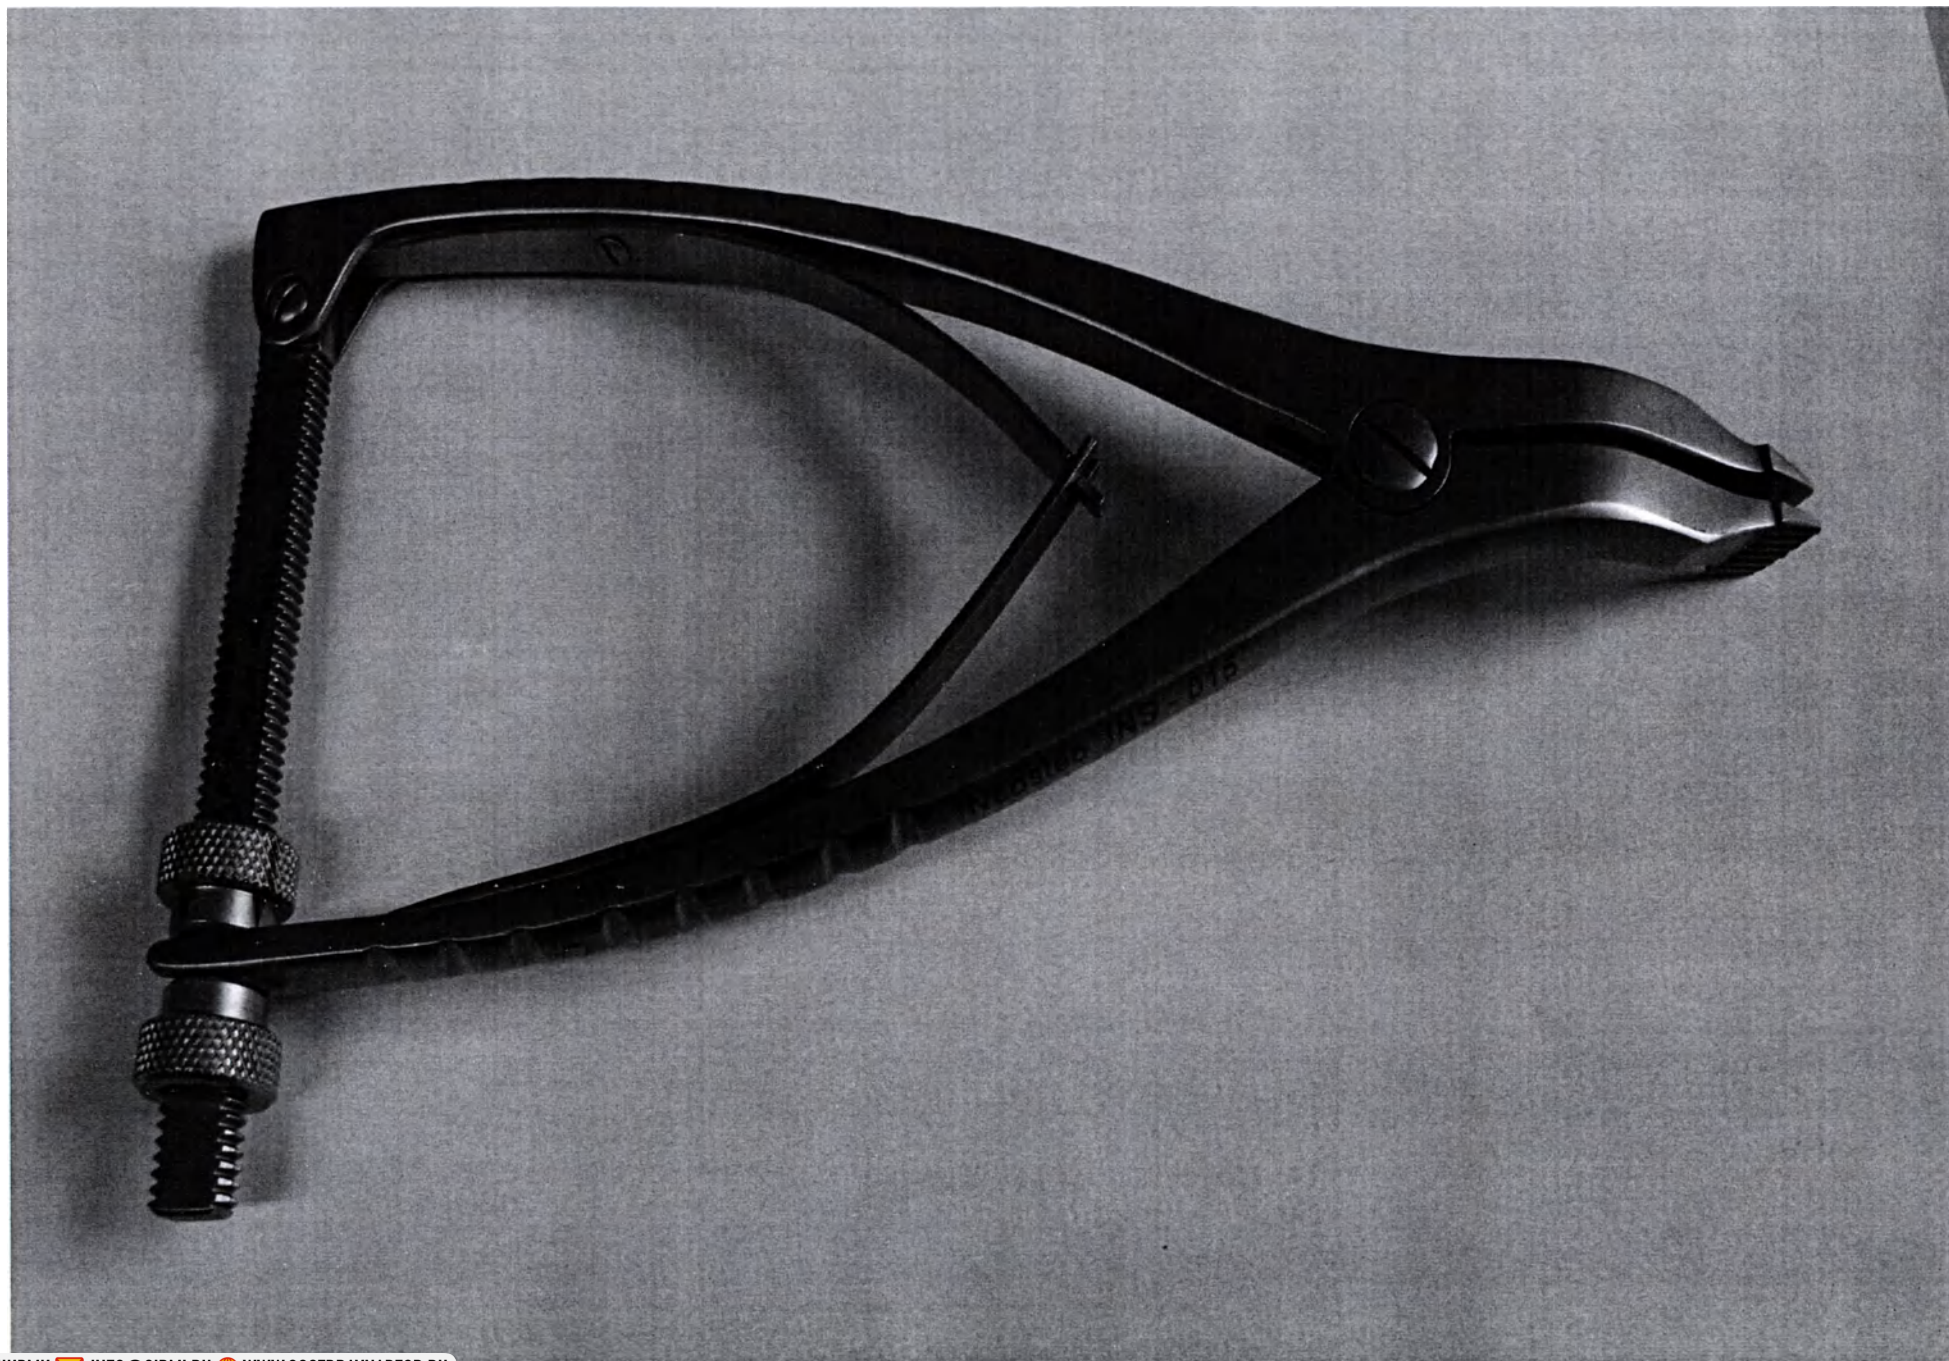








|                                                                                                                                                                        |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>NEOSTEO</b><br>Mallève 2a – 1 Boulevard<br>Jean Moulin 44100 NANTES<br>Франция |          |
| <b>Инструменты для установки имплантатов в наборах:</b>                                                                                                                |                                                                                           |
| <b>Набор 2:</b>                                                                                                                                                        |                                                                                           |
| 1                                                                                                                                                                      | Компрессионная деталь, длина 35 мм - 1 шт.                                                |
| 2                                                                                                                                                                      | Компрессионная деталь, длина 40 мм – 1 шт.                                                |
| 3                                                                                                                                                                      | Компрессионная деталь, длина 45 мм – 1 шт.                                                |
| 4                                                                                                                                                                      | Компрессионная деталь, длина 50 мм – 1 шт.                                                |
| 5                                                                                                                                                                      | Компрессионная деталь, длина 55 мм - 1 шт.                                                |
| 6                                                                                                                                                                      | Сверло с делениями Ø3,5 мм с системой крепления АО - 1 шт.                                |
| 7                                                                                                                                                                      | Костный дистрактор - 1 шт.                                                                |
| 8                                                                                                                                                                      | Направляющая для компрессионной детали – 1 шт.                                            |
| <b>REF</b><br>05268                                                                                                                                                    | <b>LOT</b><br>199-13                                                                      |
|                                                                                       |  2016/02 |
| <br>2013/02                                                                         |  0499  |
|                                                                                     |       |
| 100 мм                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
| 150 мм                                                                                                                                                                 |                                                                                           |



**Набор 3:**


1 Шестигранная отвертка 1,5 мм с системой крепления АО -1 шт.

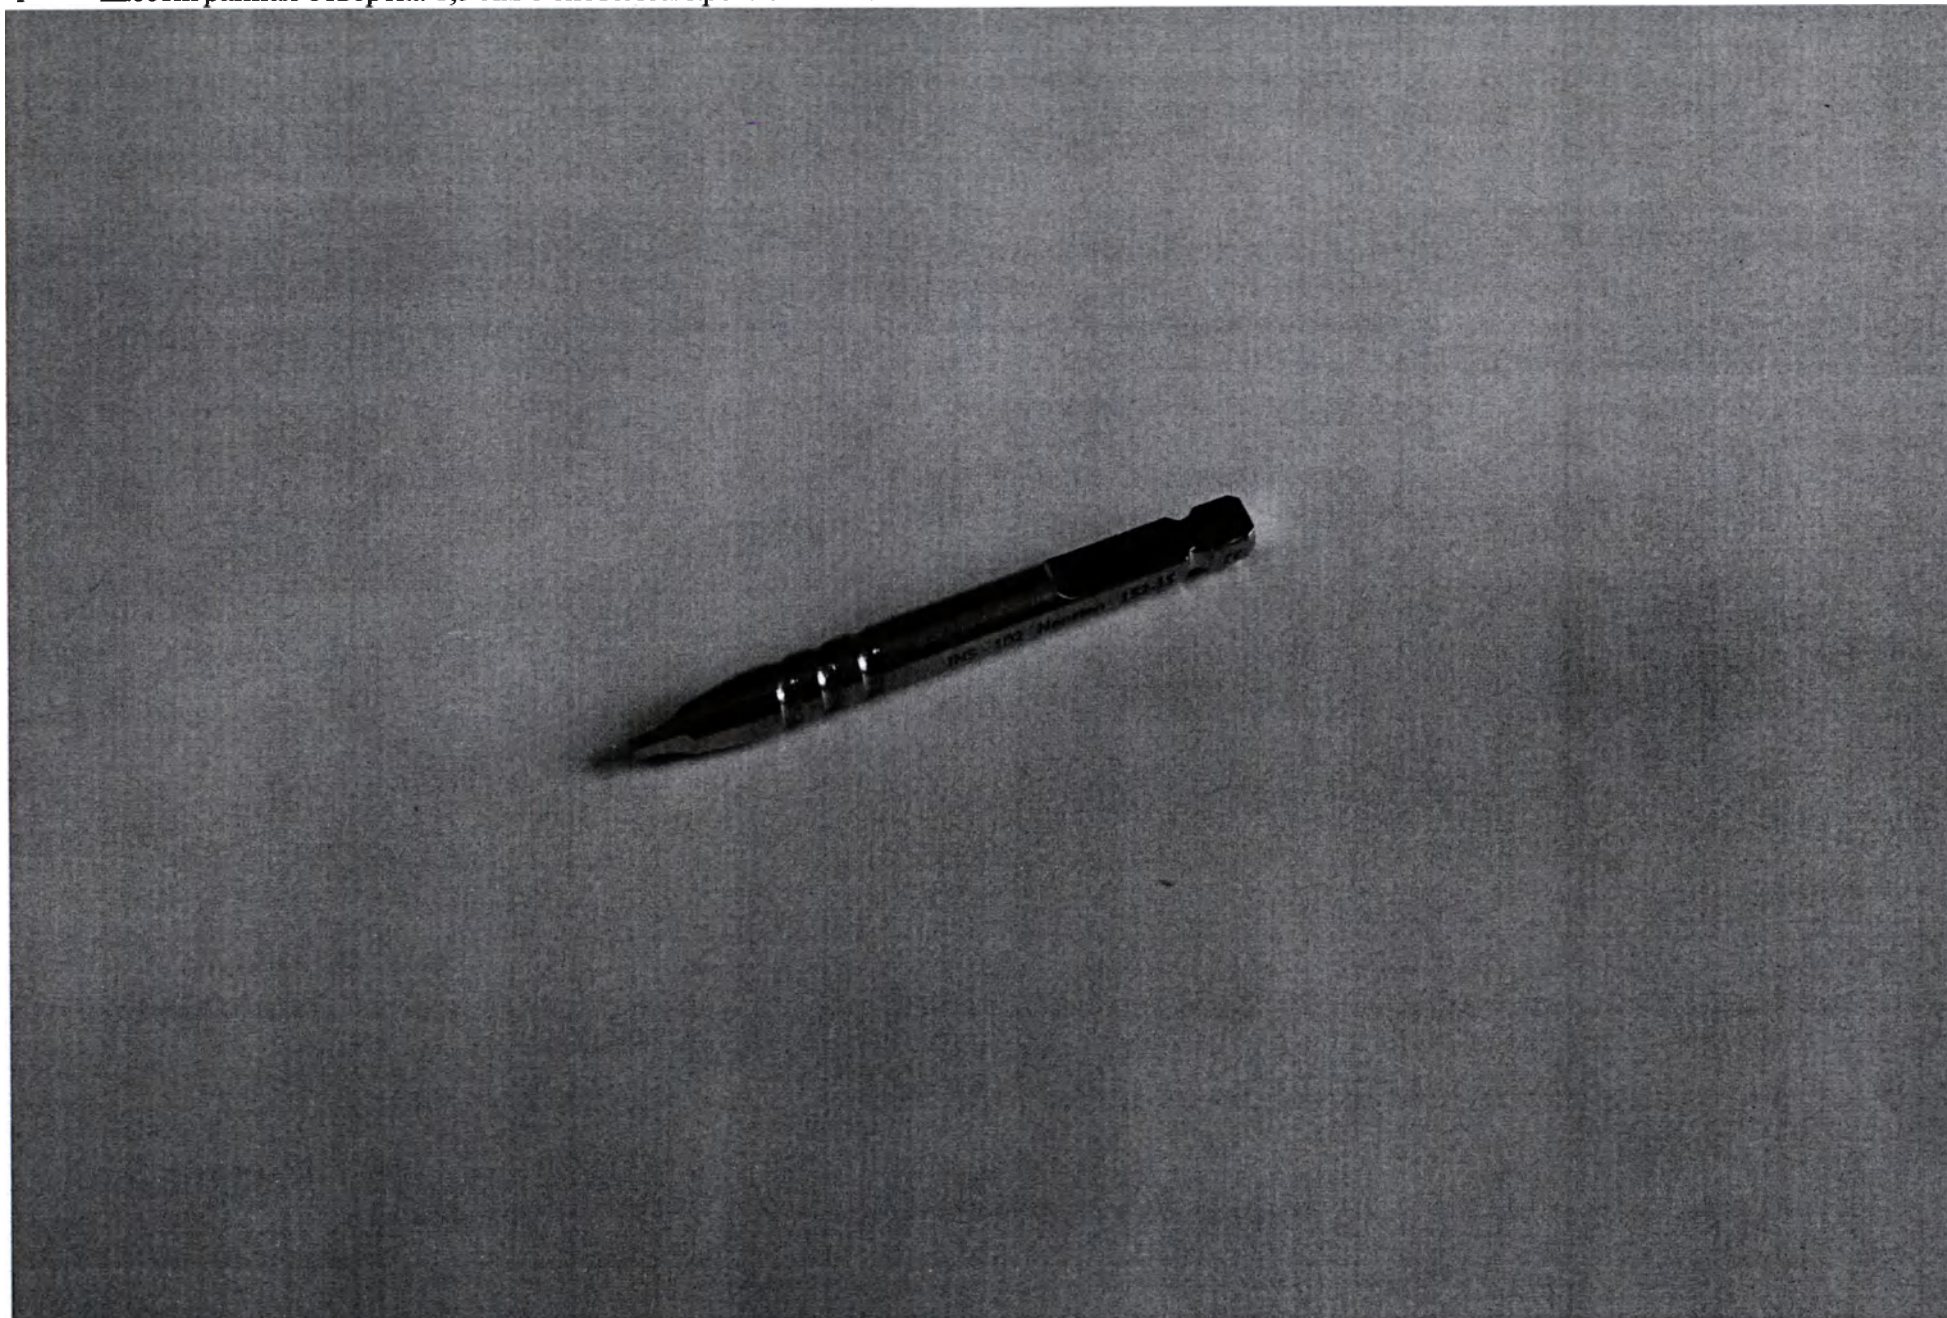







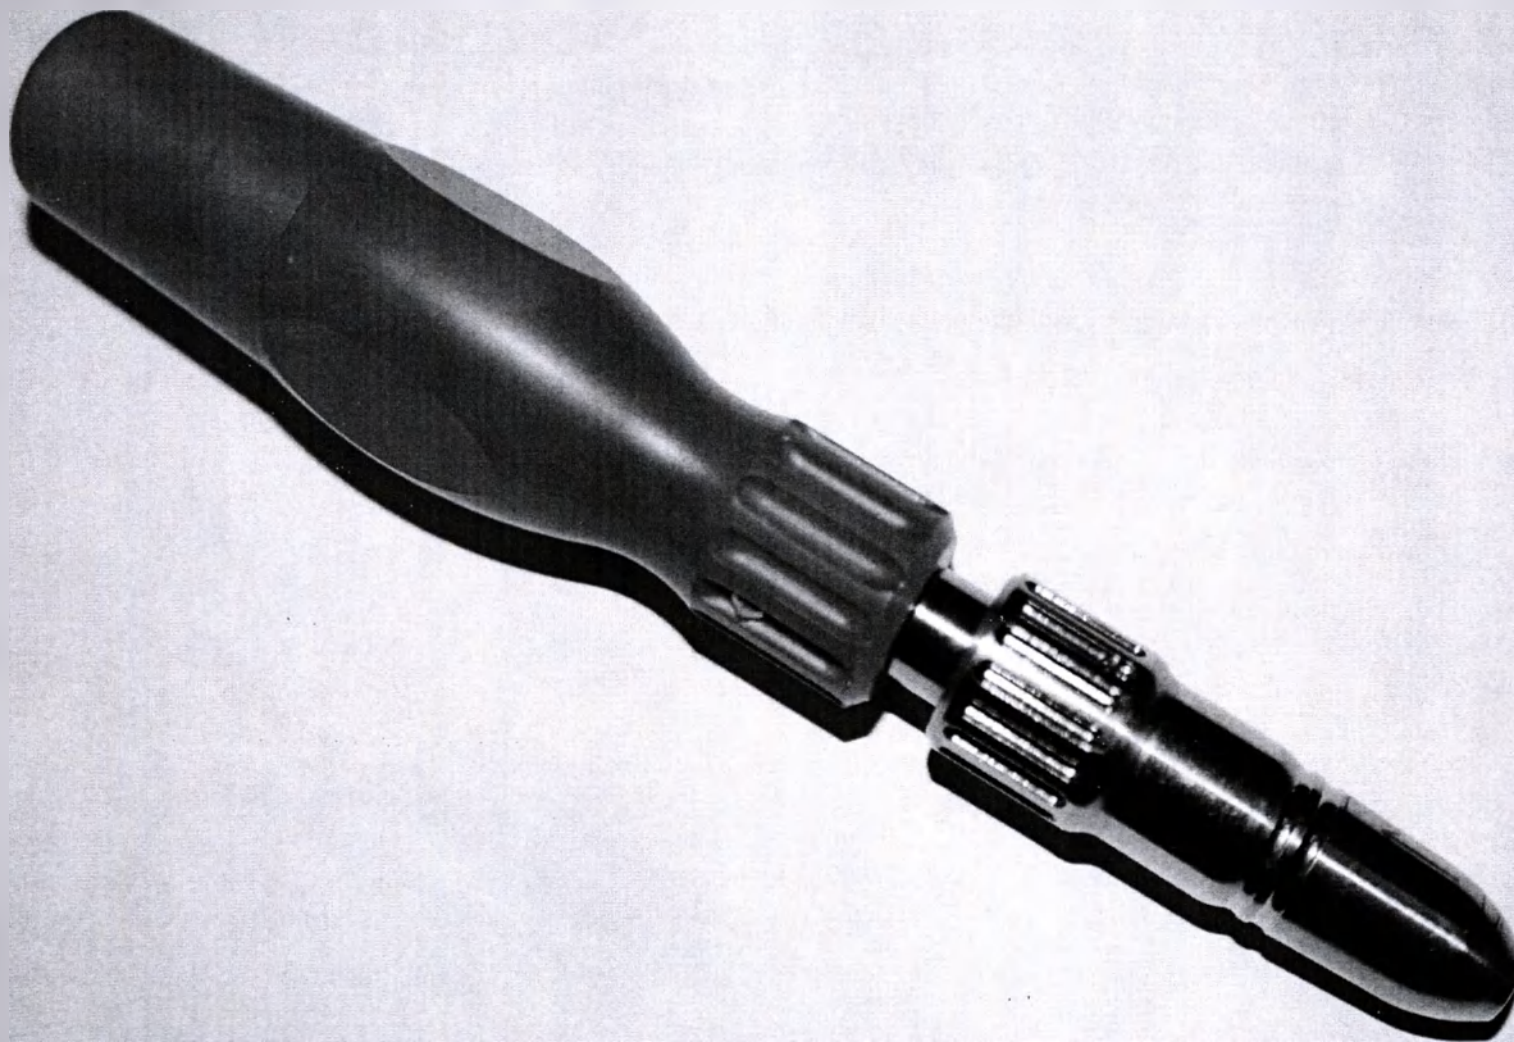














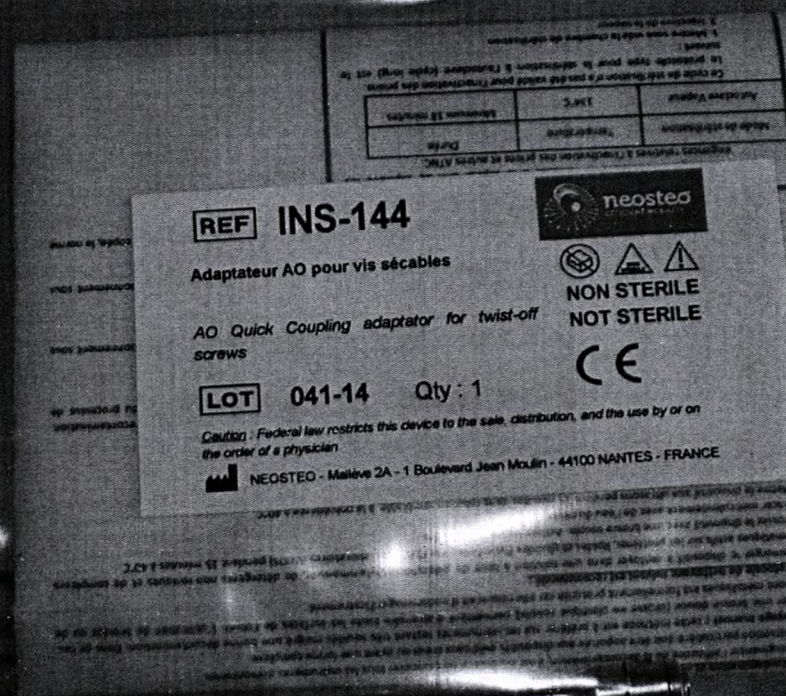




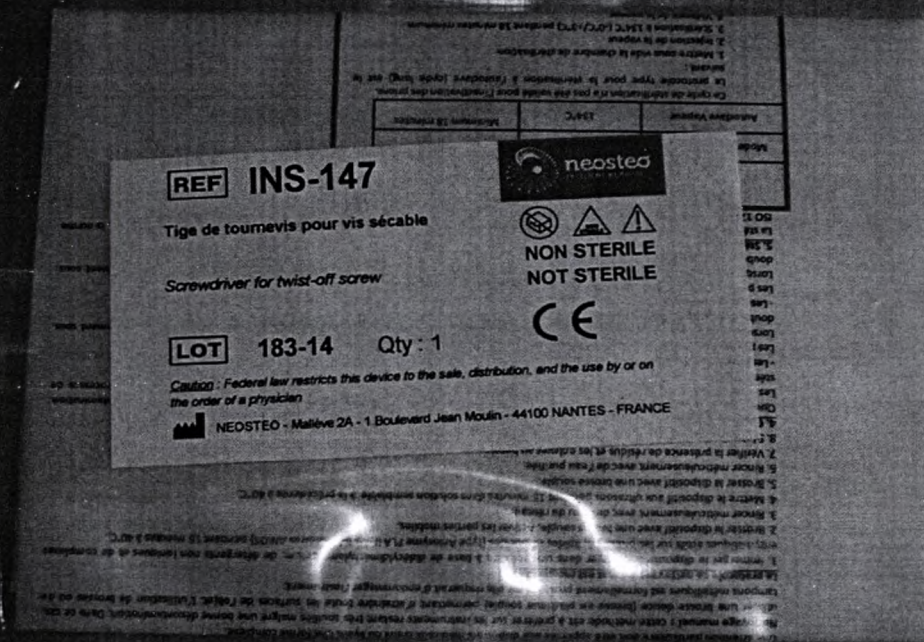





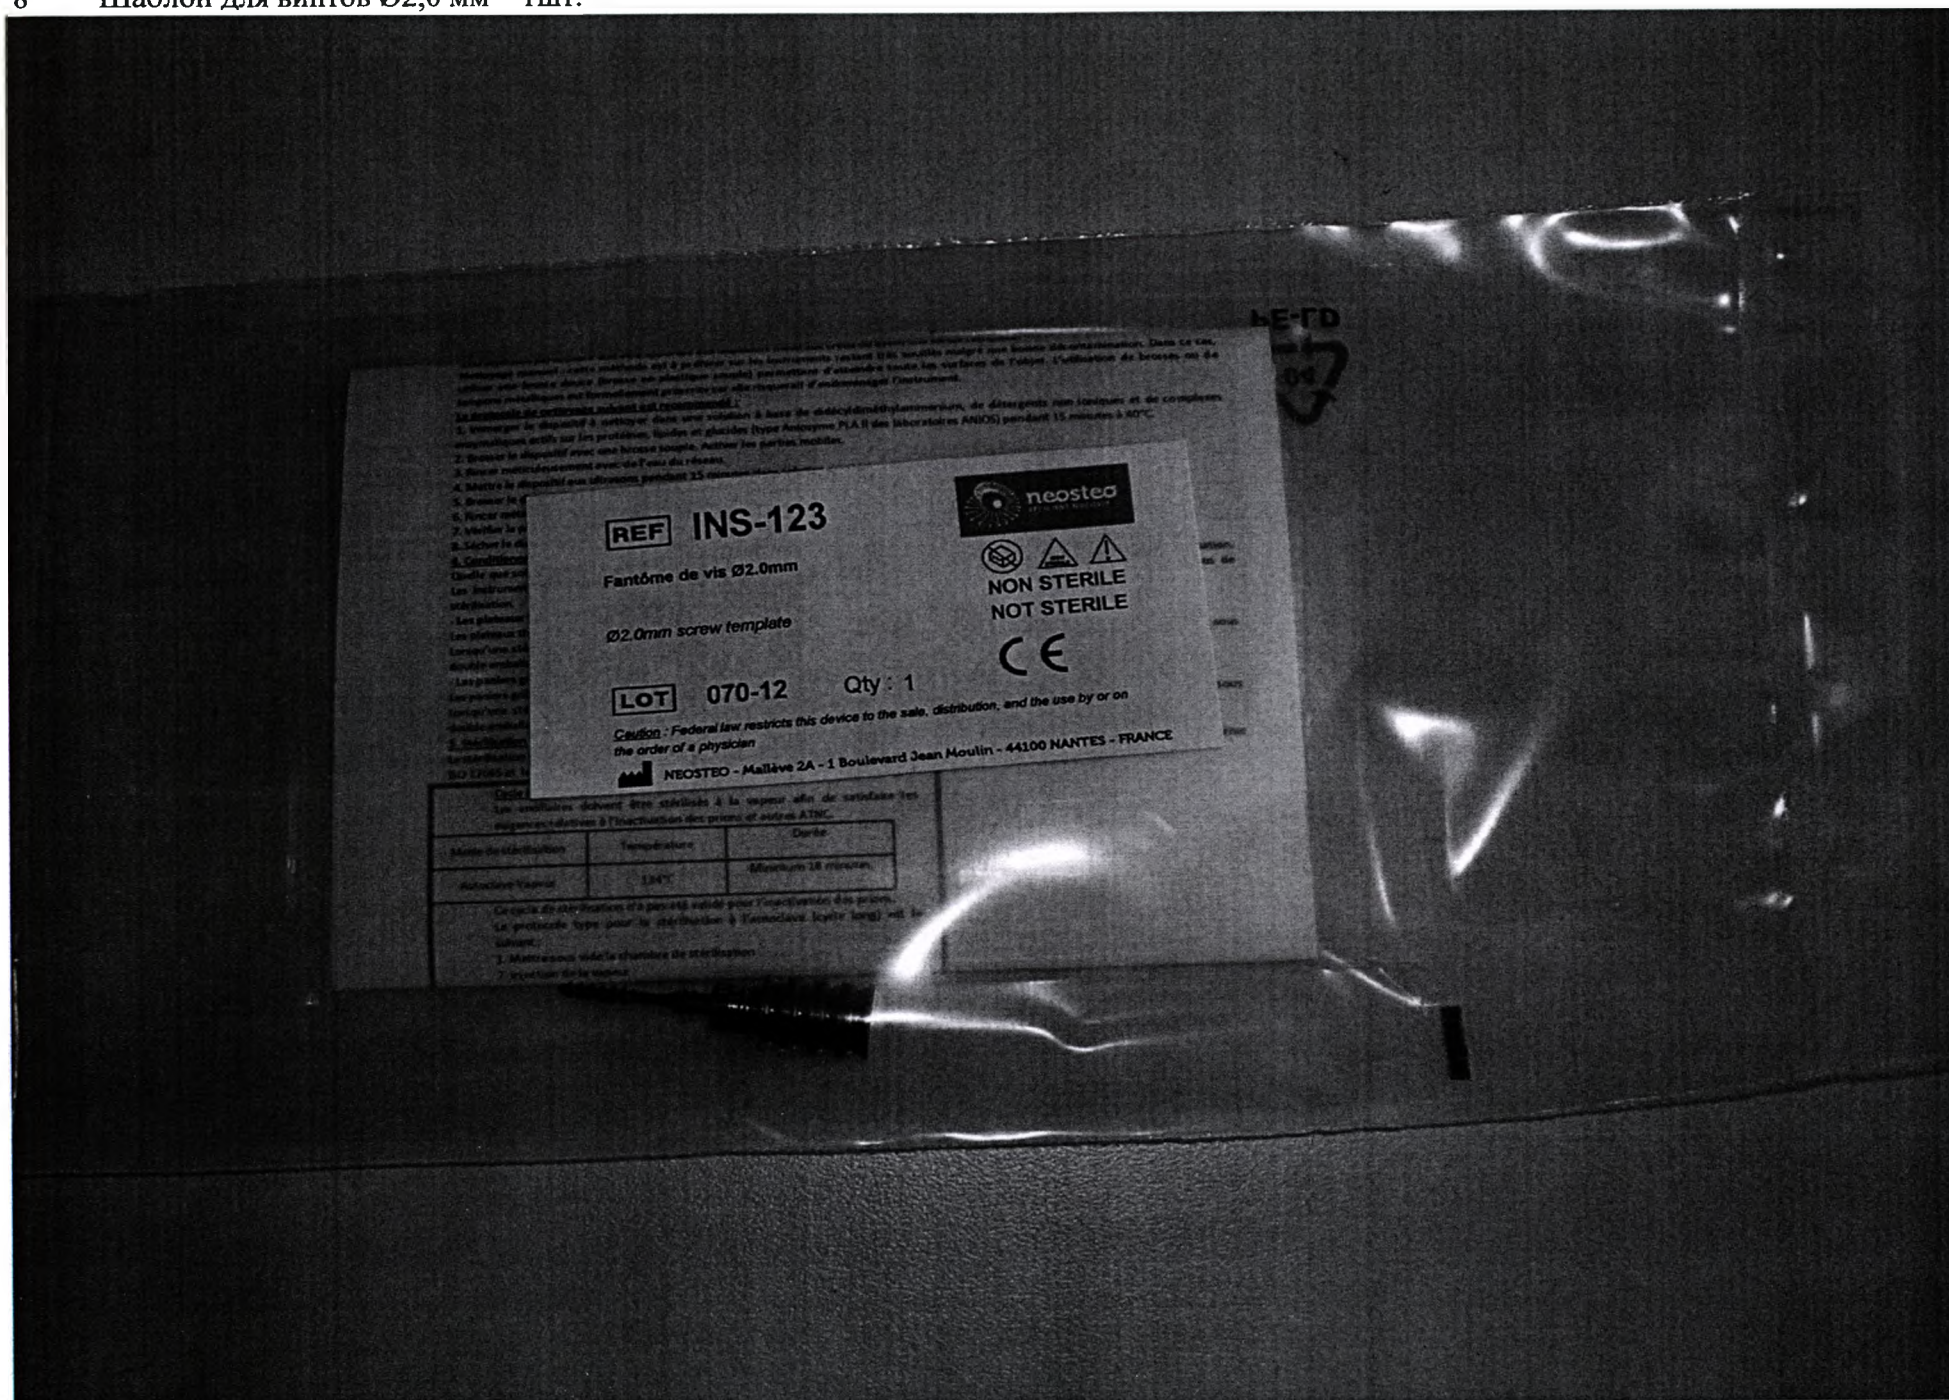



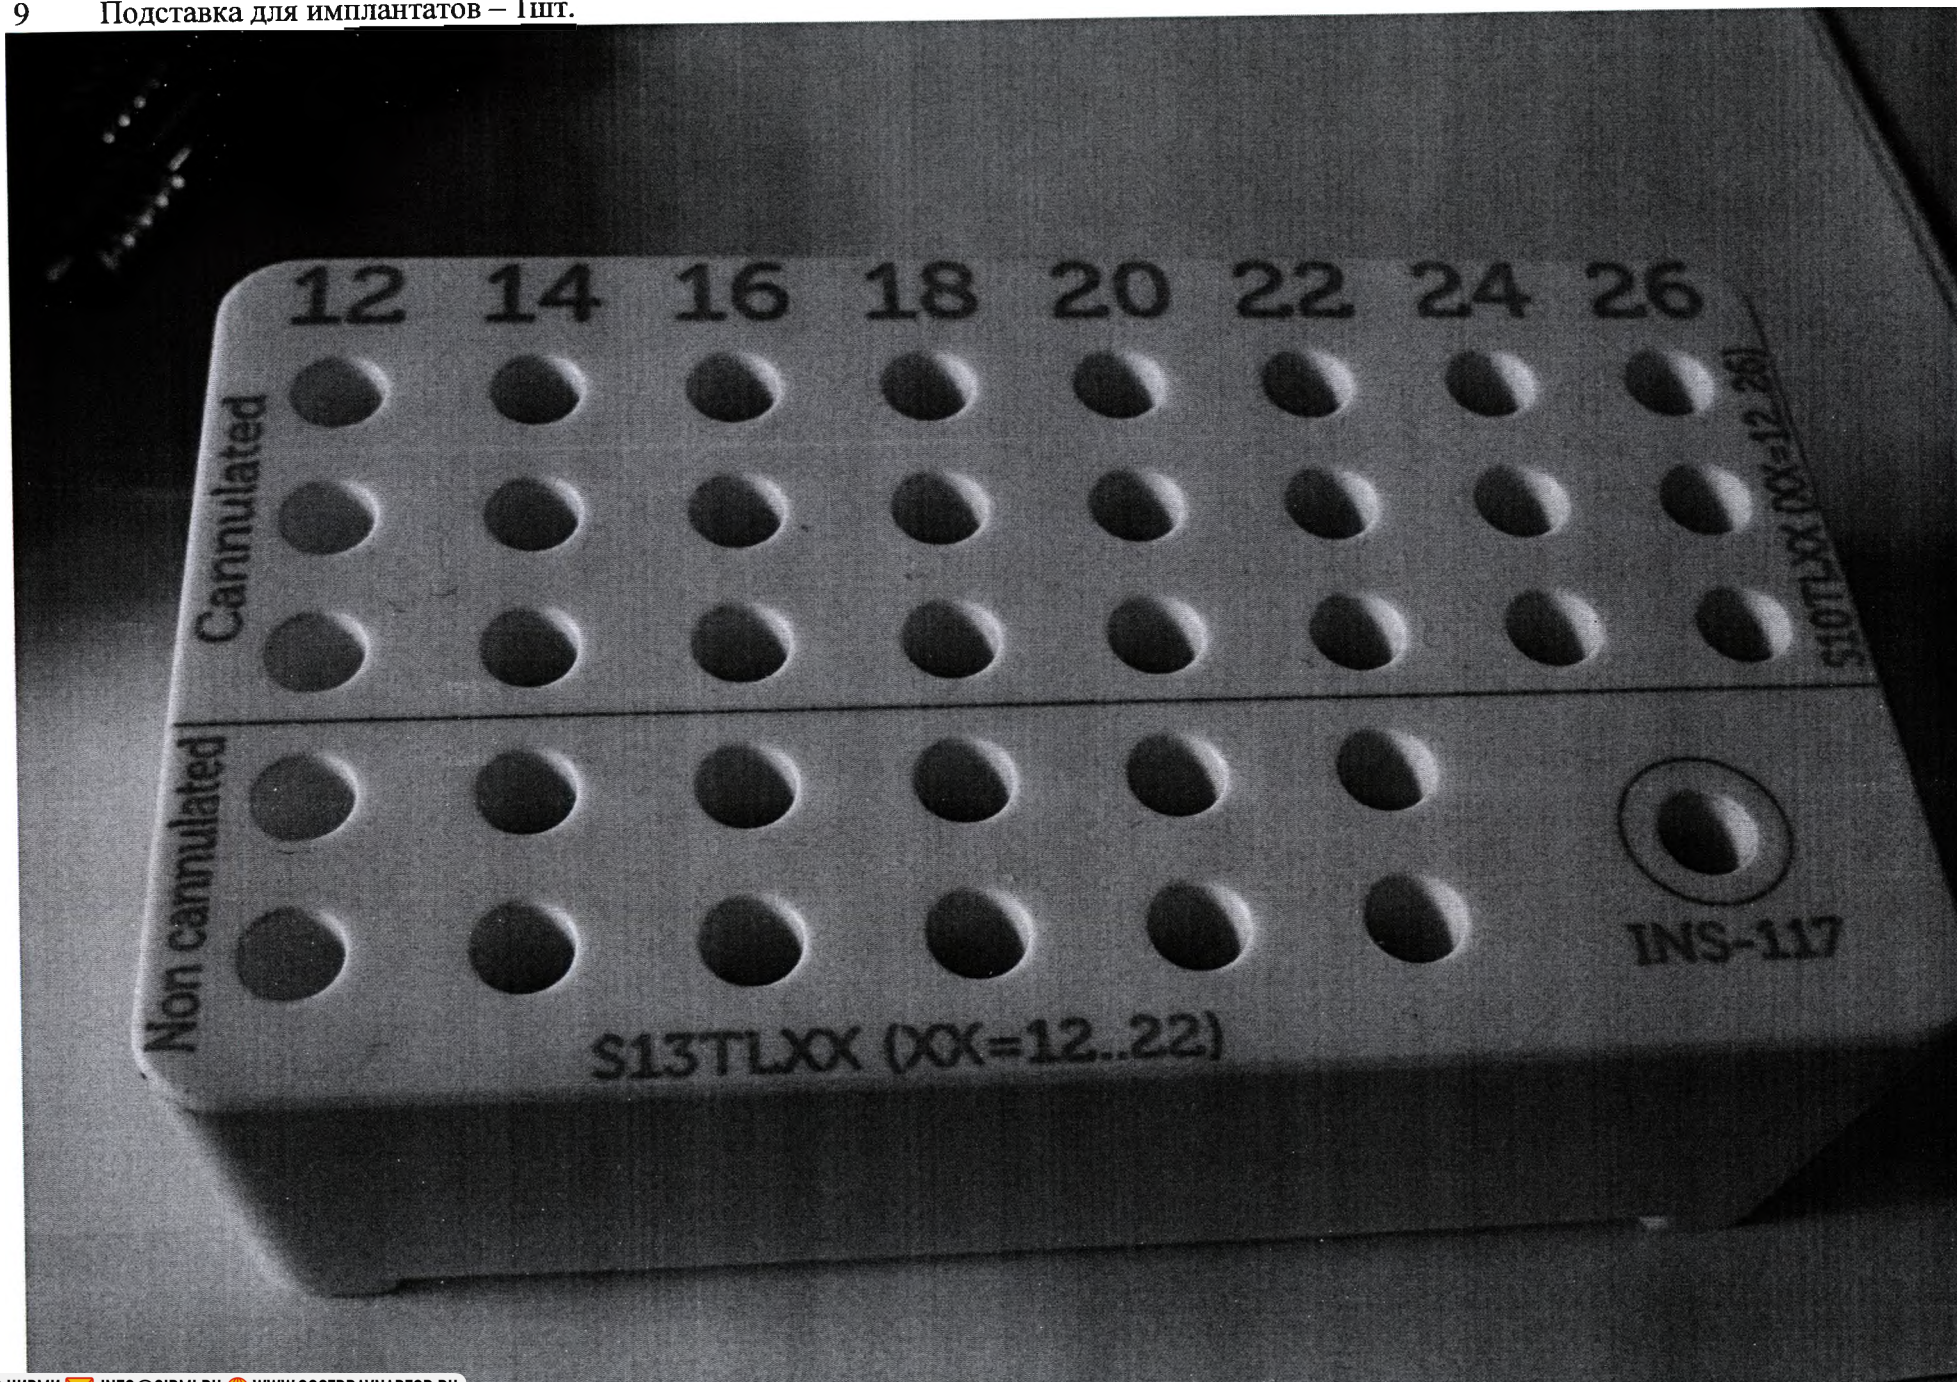




|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>NEOSTEO</b><br>Mallève 2a – 1 Boulevard Jean<br>Moulin 44100 NANTES<br>Франция | <br><b>neosteo</b><br>EFFICIENT MOBILITY |
| <b>Инструменты для установки имплантатов в наборах:</b>                                                                                                                |                                                                                                                          |
| <b>Набор 3:</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |
| 1 Шестигранная отвертка 1,5 мм с системой крепления АО -1 шт.                                                                                                          |                                                                                                                          |
| 2 Лоток для инструментов и винтов Ø2,0 мм- 1 шт.                                                                                                                       |                                                                                                                          |
| 3 Рукоятка для быстроразъемного соединения АО Ø4,5 мм- 1 шт.                                                                                                           |                                                                                                                          |
| 4 Костный рычаг Weil -1шт.                                                                                                                                             |                                                                                                                          |
| 5 Приспособление для проведения винтов Ø 2.0 мм – 1 шт.                                                                                                                |                                                                                                                          |
| 6 Аналоговый быстроразъемный АО адаптер для извлечения винтов – 1шт.                                                                                                   |                                                                                                                          |
| 7 Отвертка для извлечения винтов – 1 шт.                                                                                                                               |                                                                                                                          |
| 8 Шаблон для винтов Ø2,0 мм – 1шт.                                                                                                                                     |                                                                                                                          |
| 9 Подставка для имплантатов – 1шт.                                                                                                                                     |                                                                                                                          |
| <br>05268                                                                             | <br>198-13                              |
|                                                                                       | <br>2016/02                             |
| <br>2013/02                                                                         | <br>0499                              |
|                                                                                     |                                       |
|                                                                                    |                                                                                                                          |
| :                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |
| 100 мм                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |
| 150 мм                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |



**Набор 4:**


1 Сверло-зенкер с системой крепления АО - 1шт.

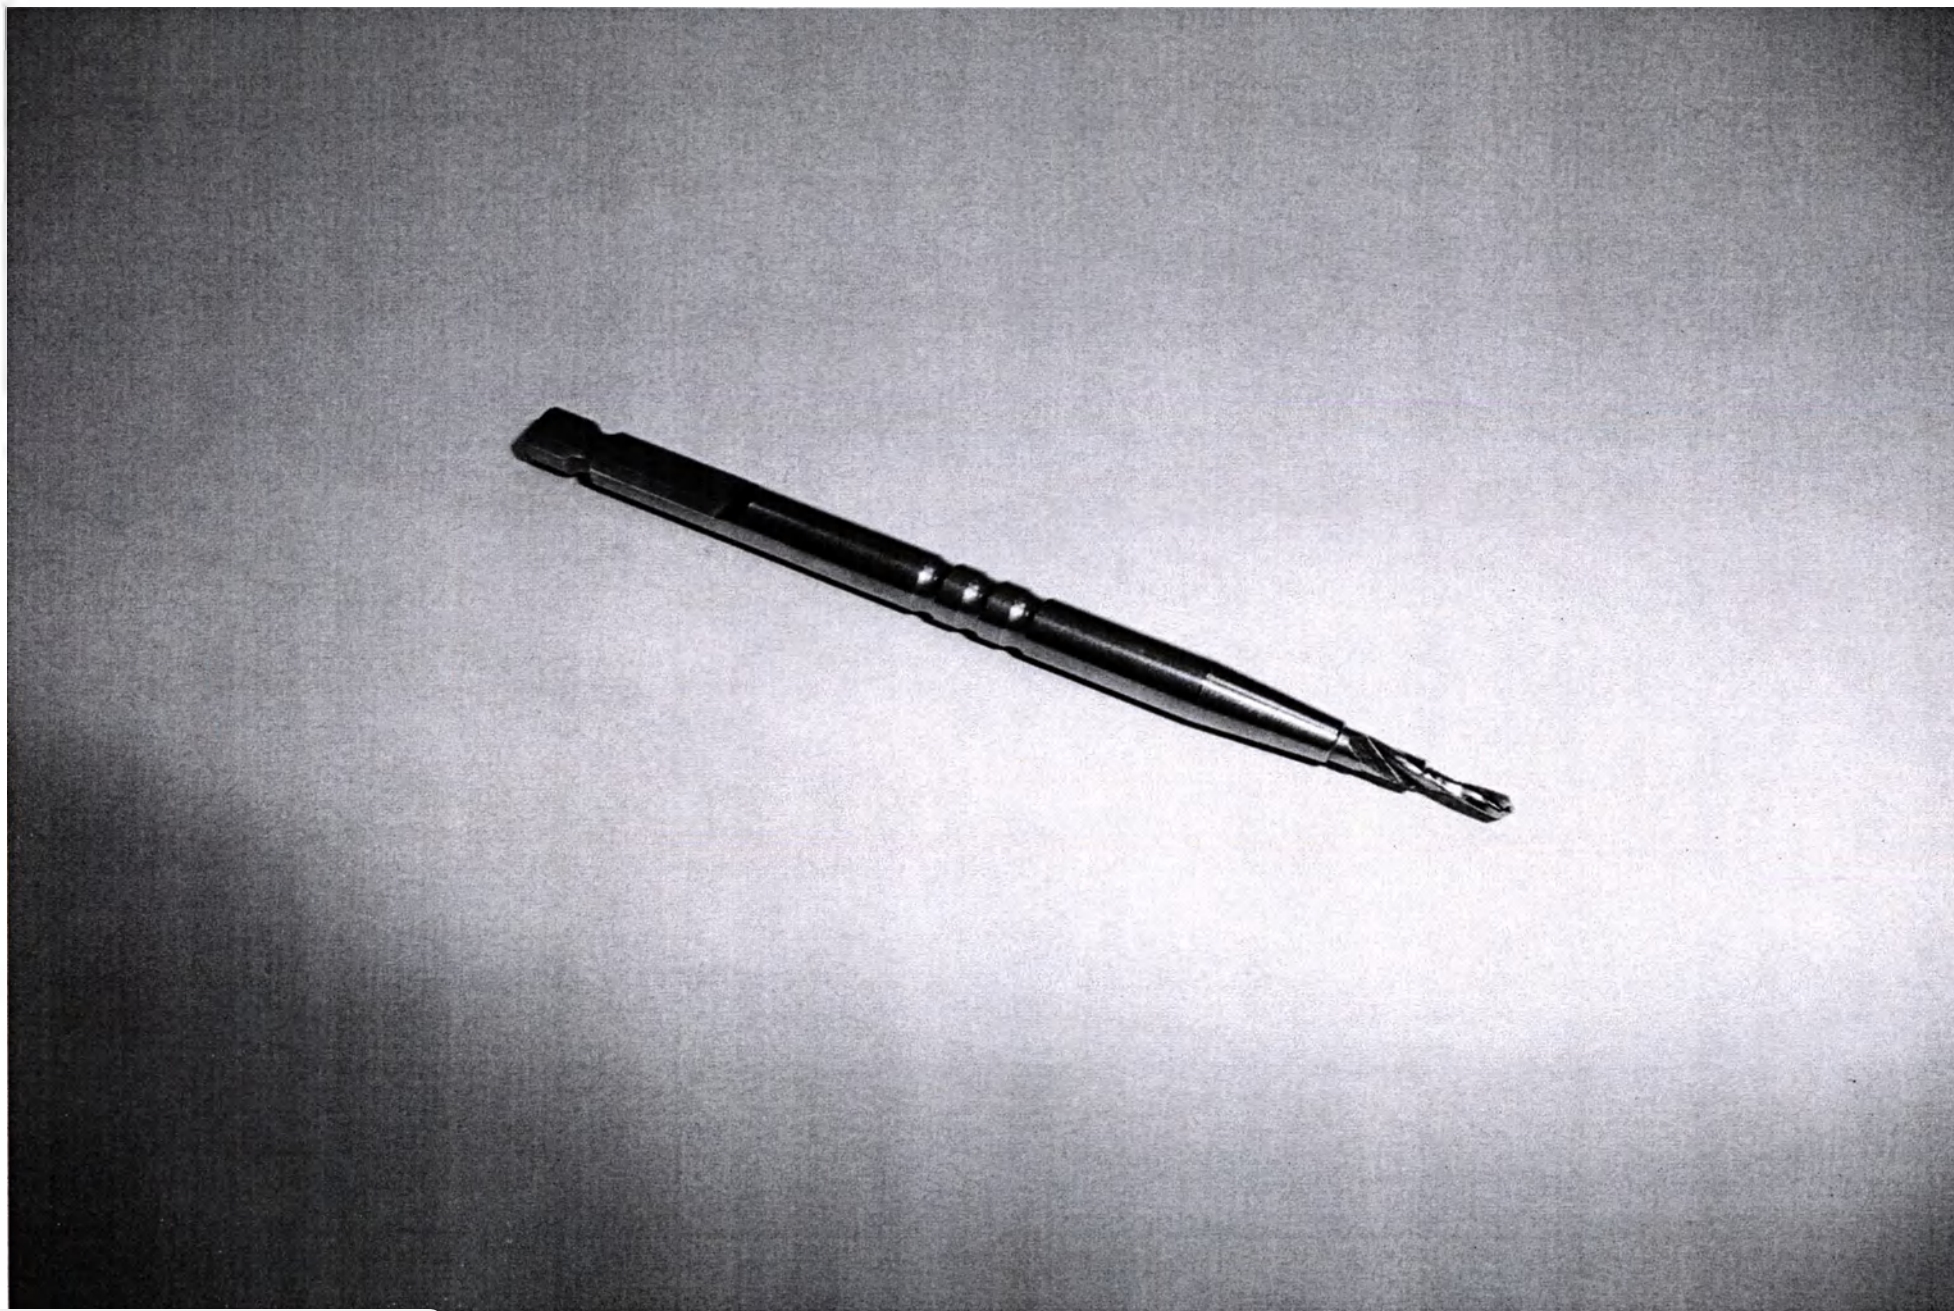









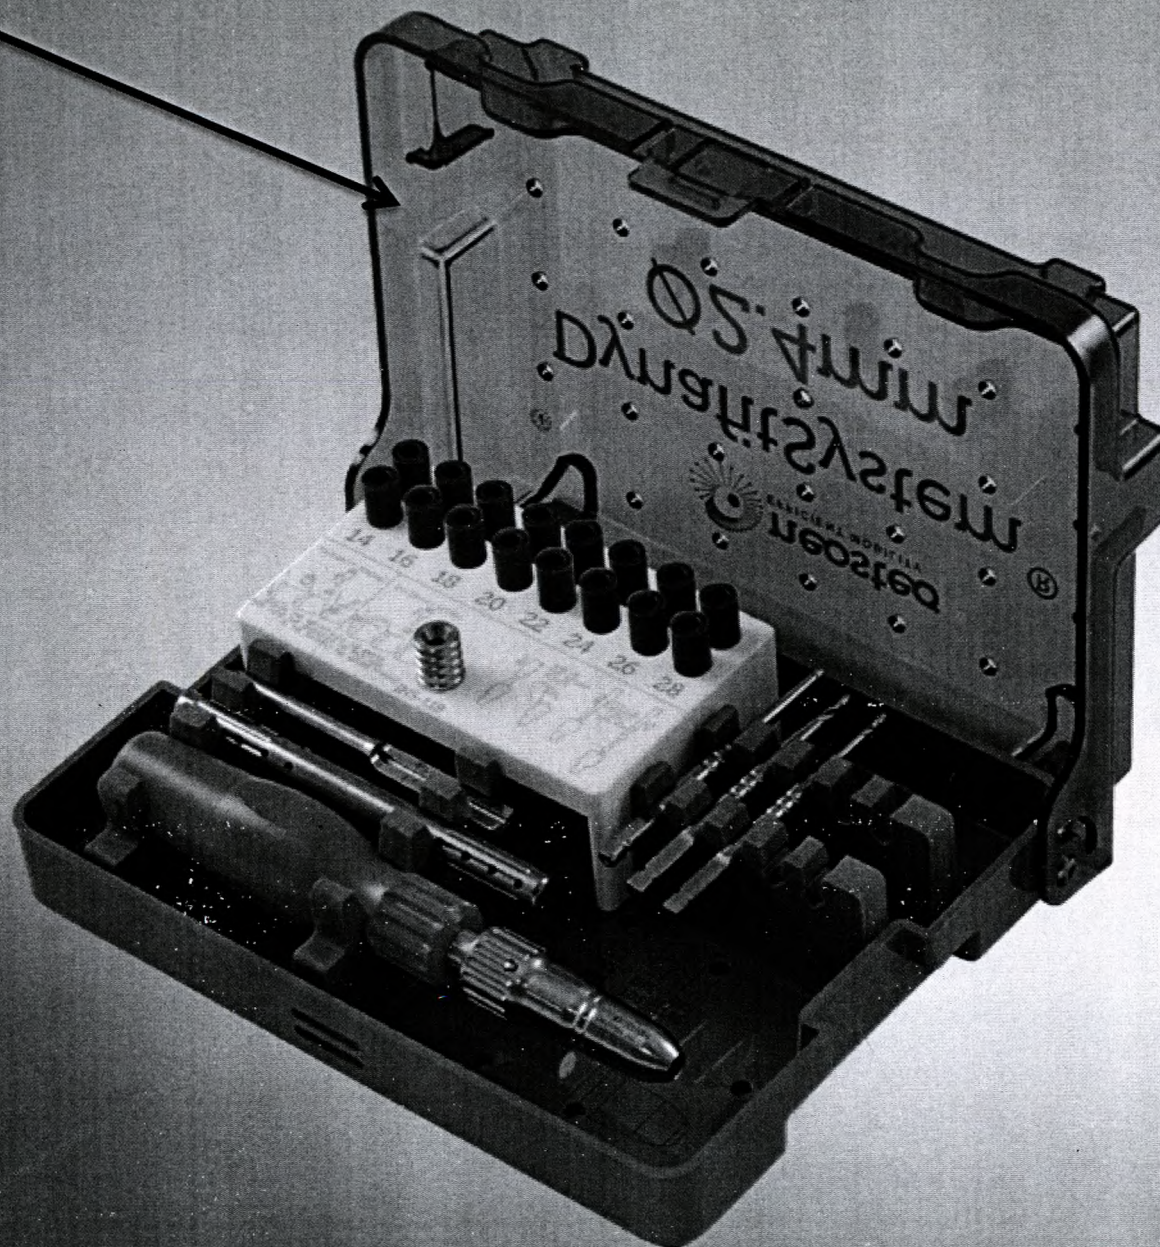




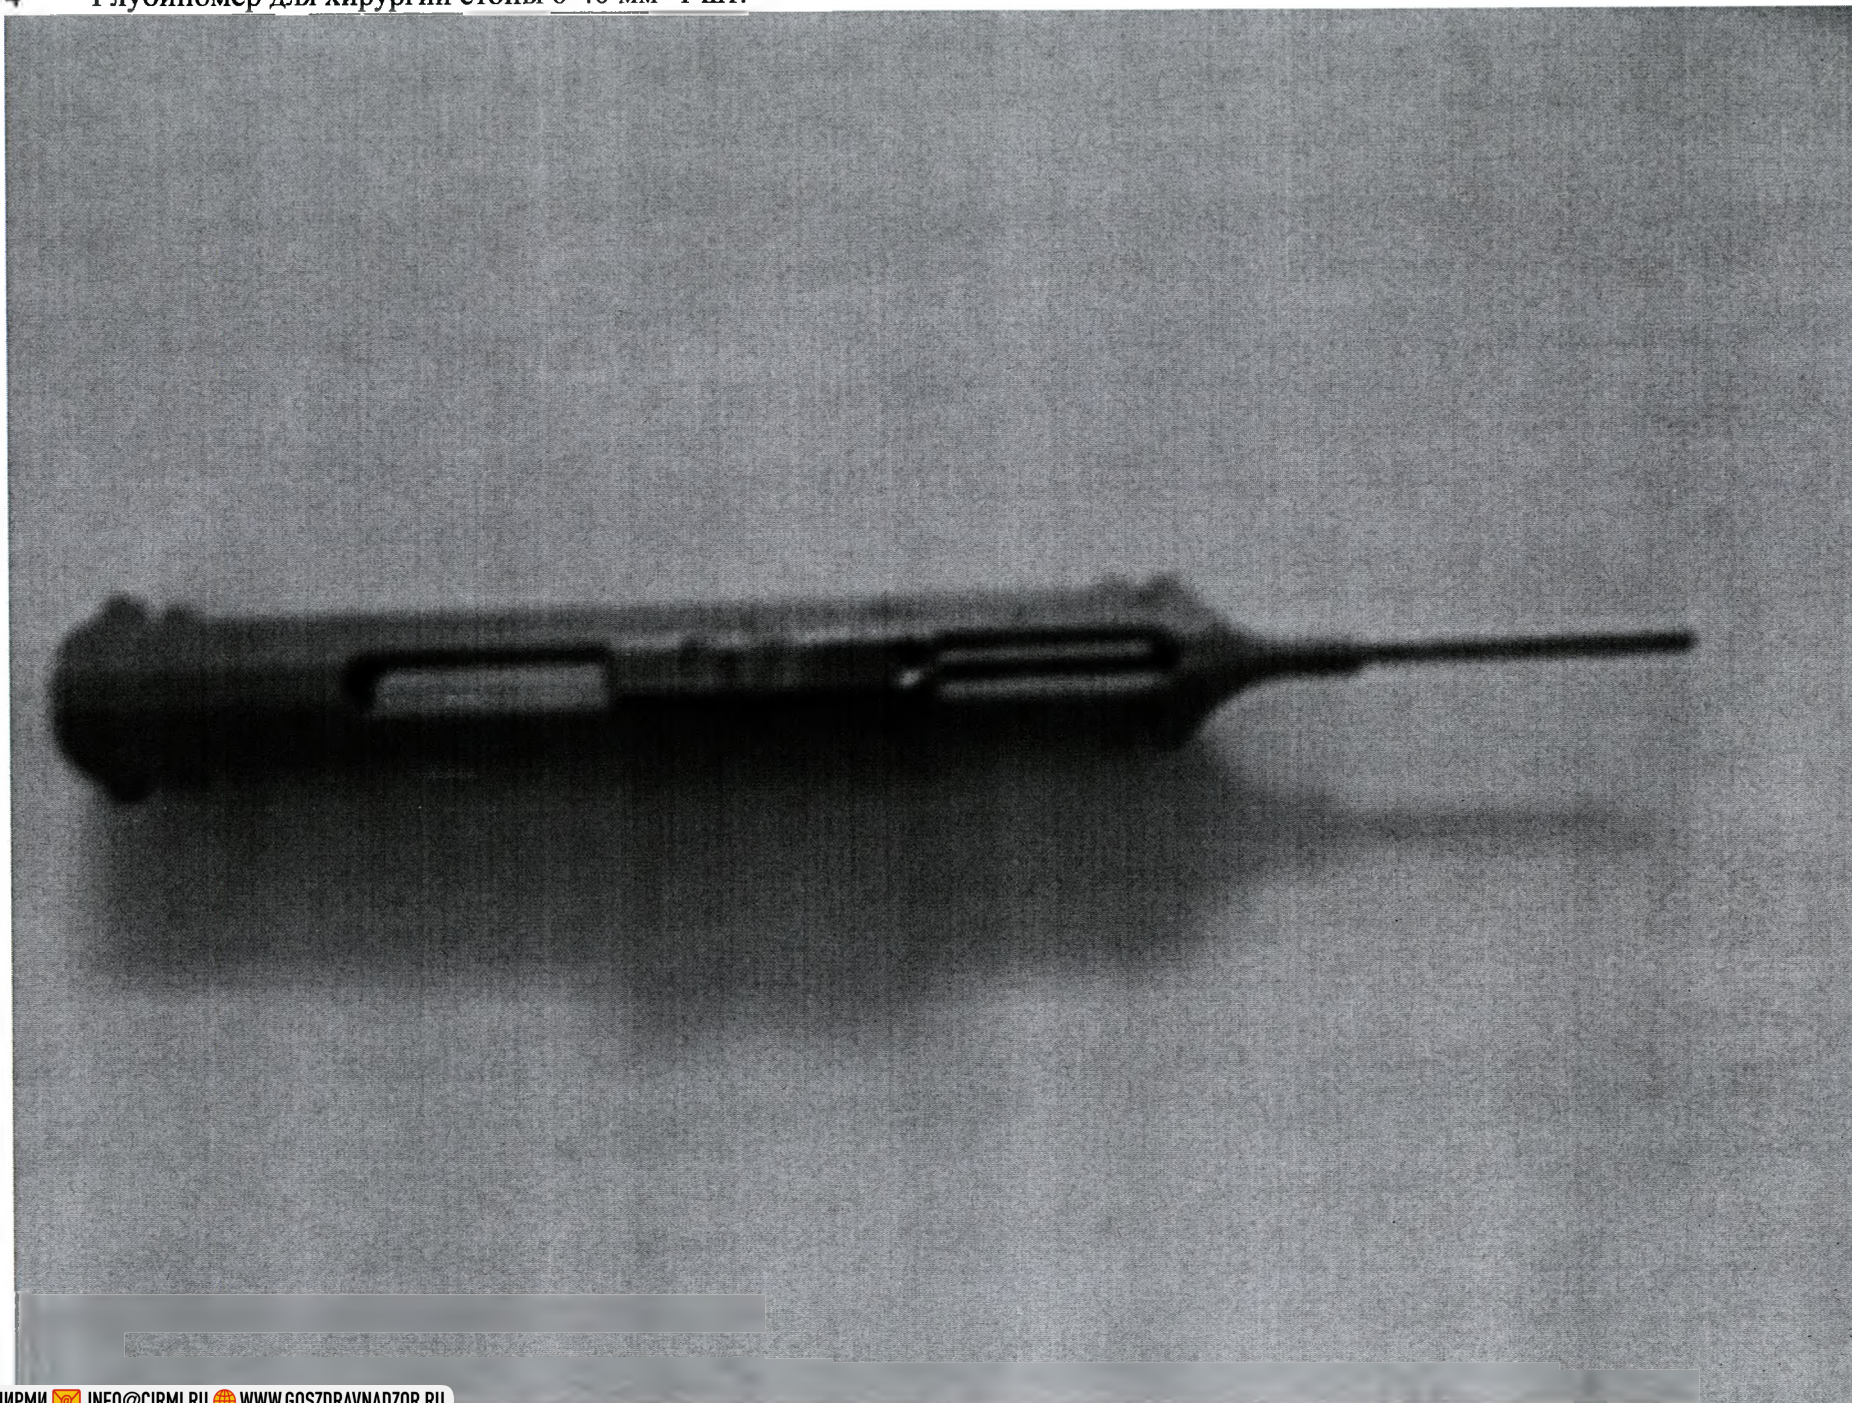




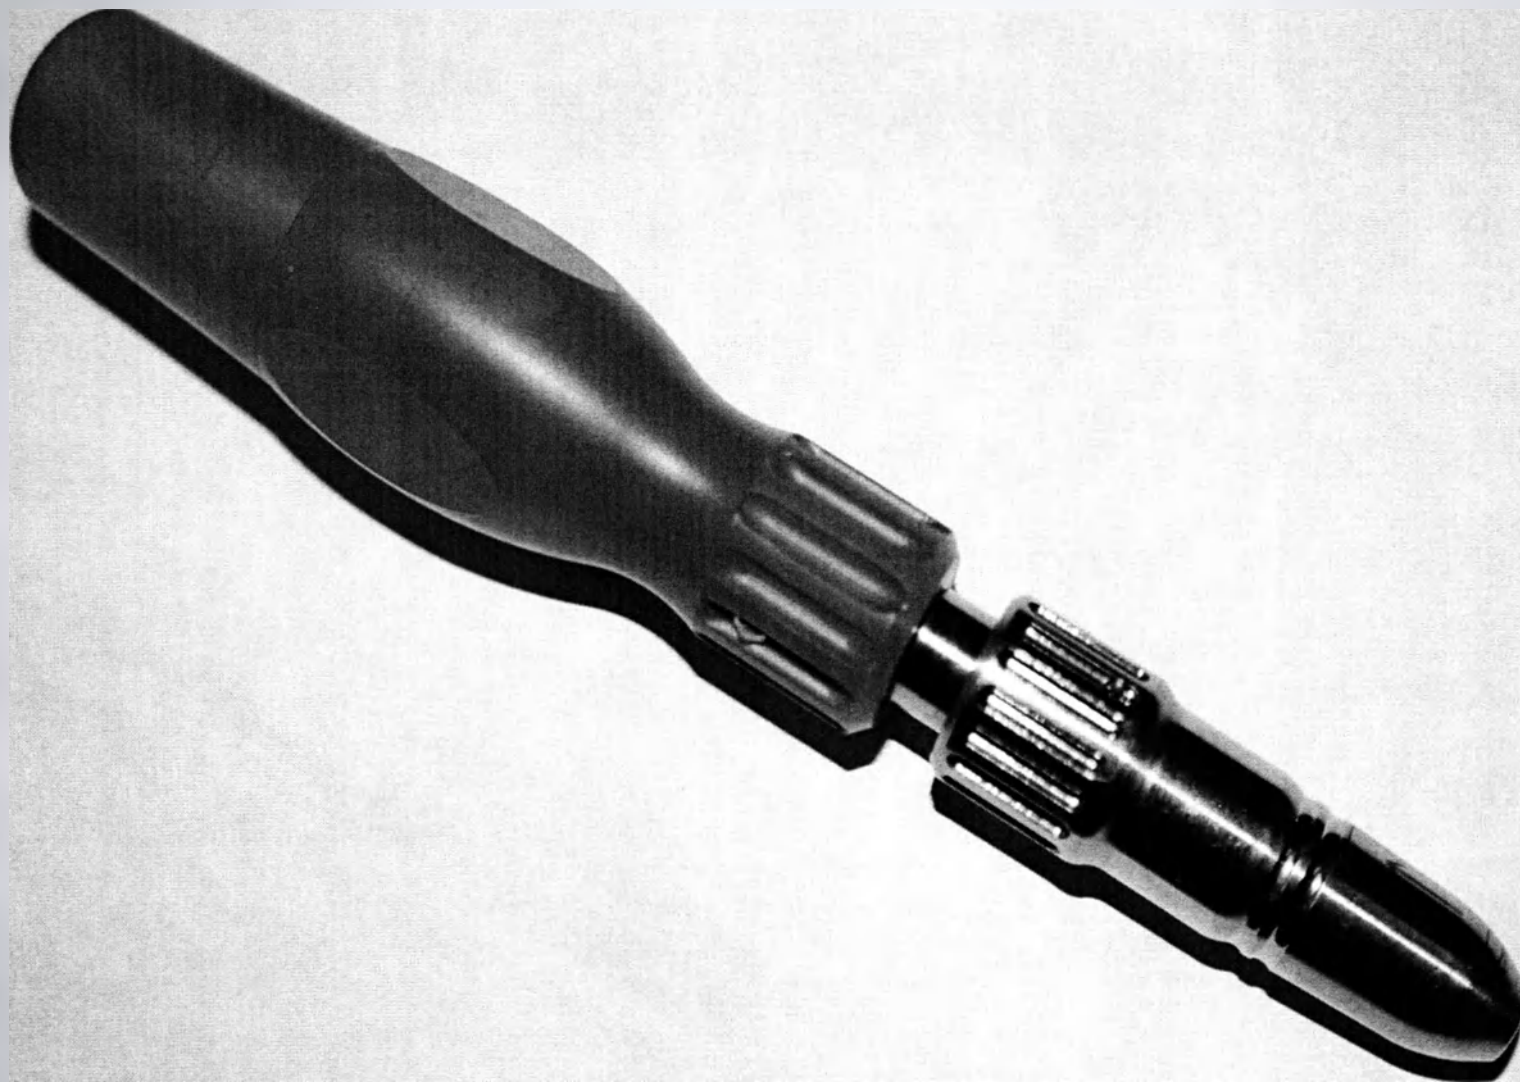




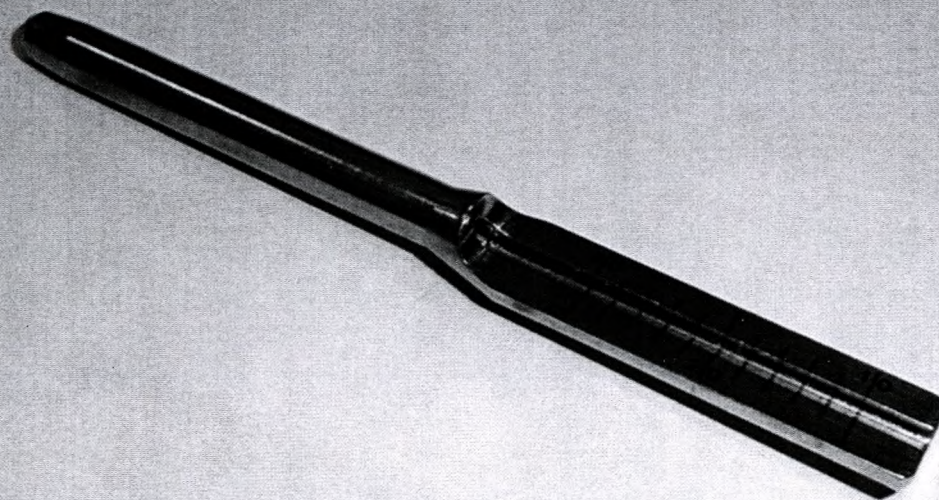




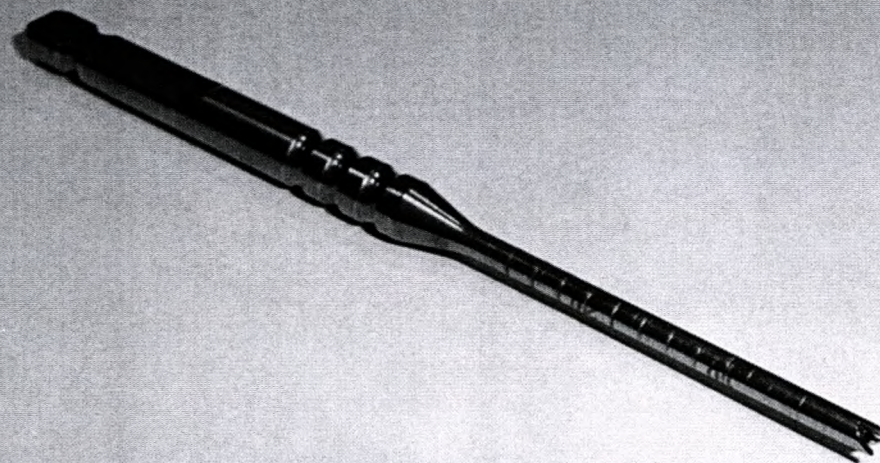




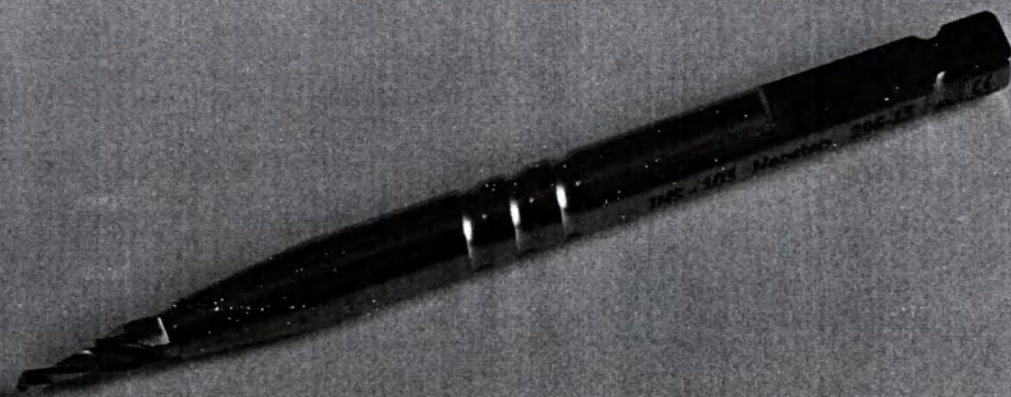




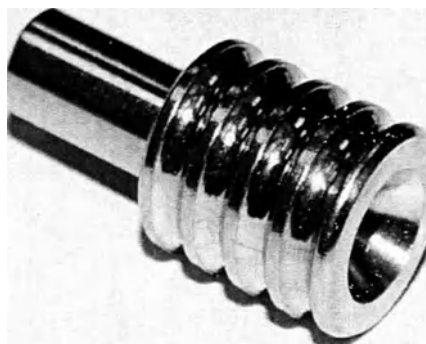



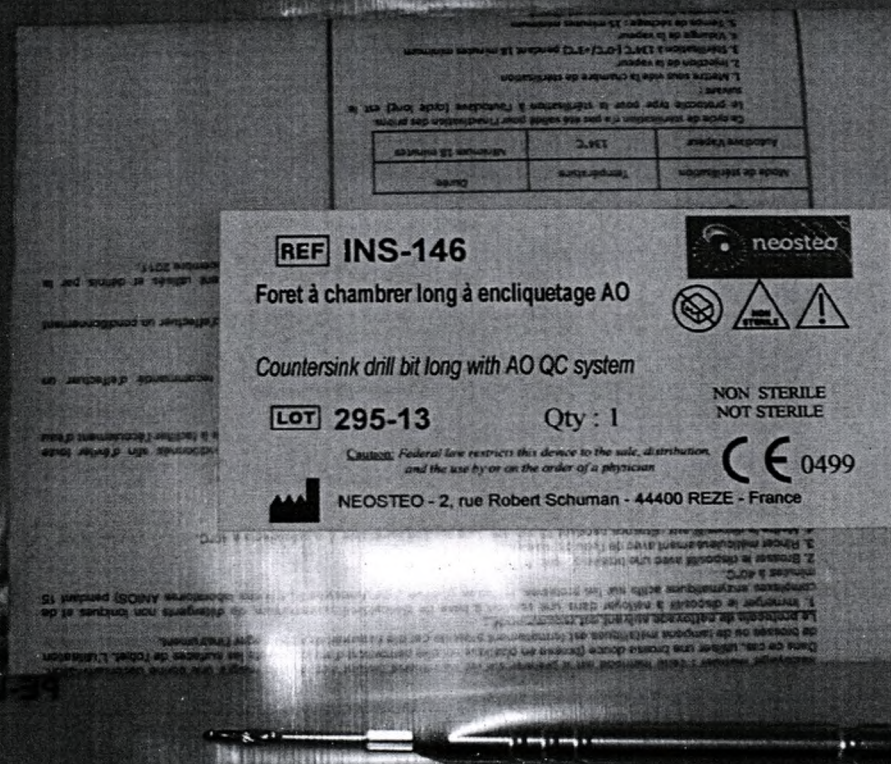




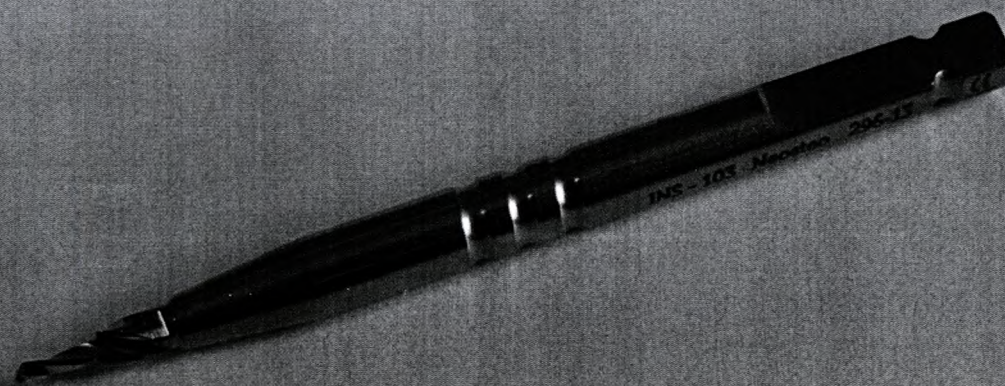







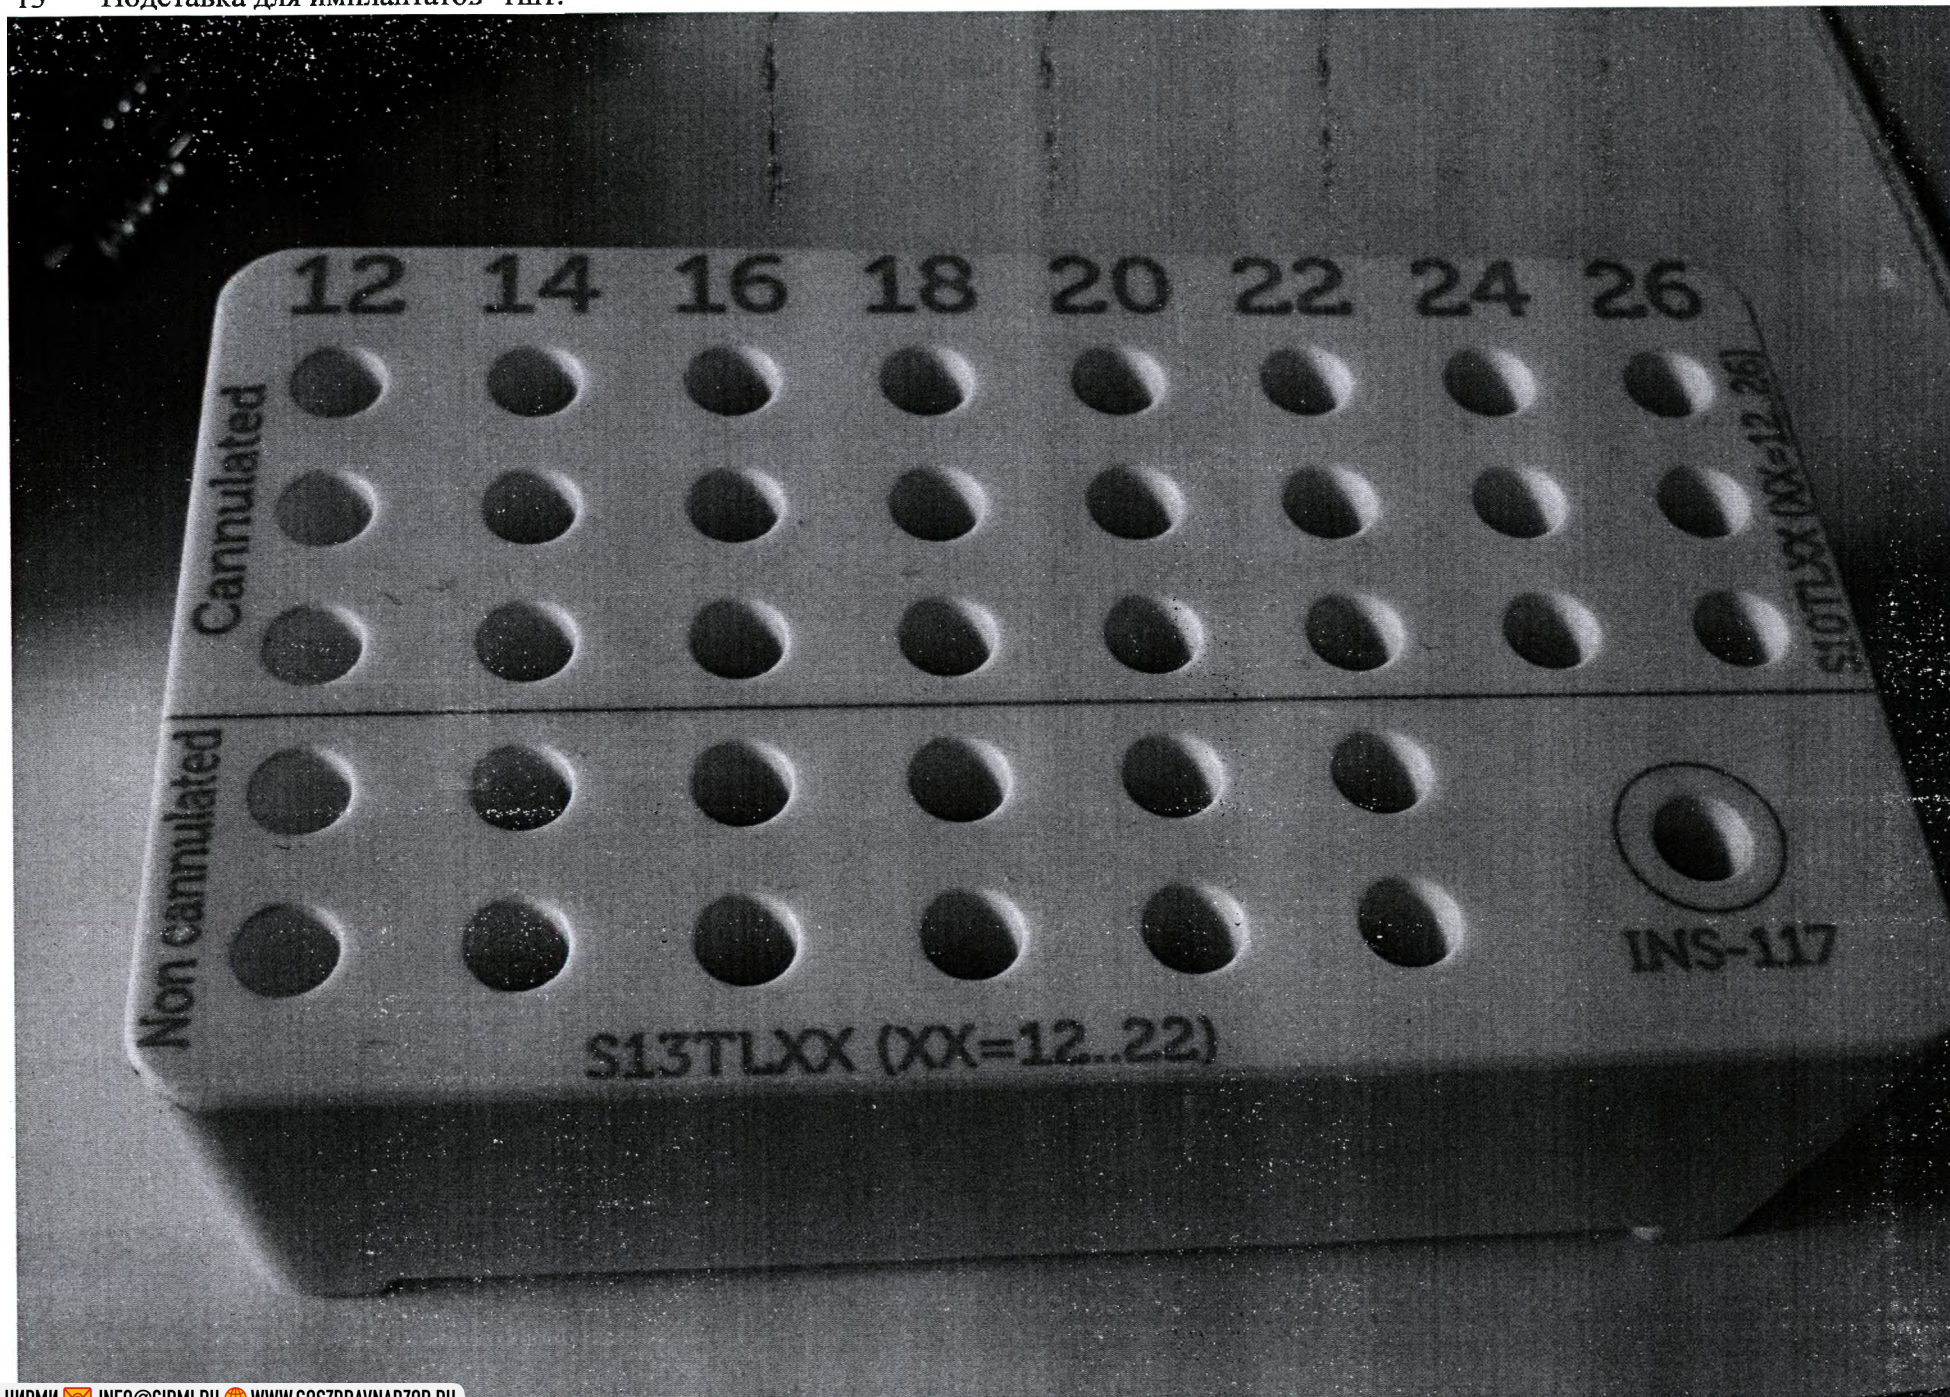





NEOSTEO

Mallève 2a – 1 Boulevard  
Jean Moulin 44100 NANTES  
Франция



**Инструменты для установки имплантатов в наборах:  
Набор 4:**

- 1 Сверло-зенкер с системой крепления АО - 1шт.
- 2 Зенкер канюлированный с системой крепления АО -1шт.
- 3 Лоток для инструментов и винтов Ø2,4 мм – 1шт.
- 4 Глубиномер для хирургии стопы 6-40 мм -1 шт.
- 5 Рукоятка для быстроразъемного соединения АО Ø4,5 мм -1 шт.
- 6 Измеритель погружения спиц Киршнера Ø 1,0 мм, длина 80 мм -1шт.
- 7 Канюлированное сверло Ø1,9 мм с делениями с системой крепления АО – 1шт.
- 8 Длинное сверло с системой крепления АО- 1шт.
- 9 Приспособление для проведения винтов Ø2,4 мм-1 шт.
- 10 Длинное канюлированное сверло с системой крепления АО- 1 шт.
- 11 Длинное сверло с системой крепления АО-1 шт.
- 12 Шаблон для винтов Ø2,4 мм- 1 шт.
- 13 Подставка для имплантатов- 1шт.



05270



201-13



2016/02



2013/02



0499




150 mm

100 mm




Набор 5:


1 Спица Киршнера Ø1.0мм - Длина 80мм-6 шт.

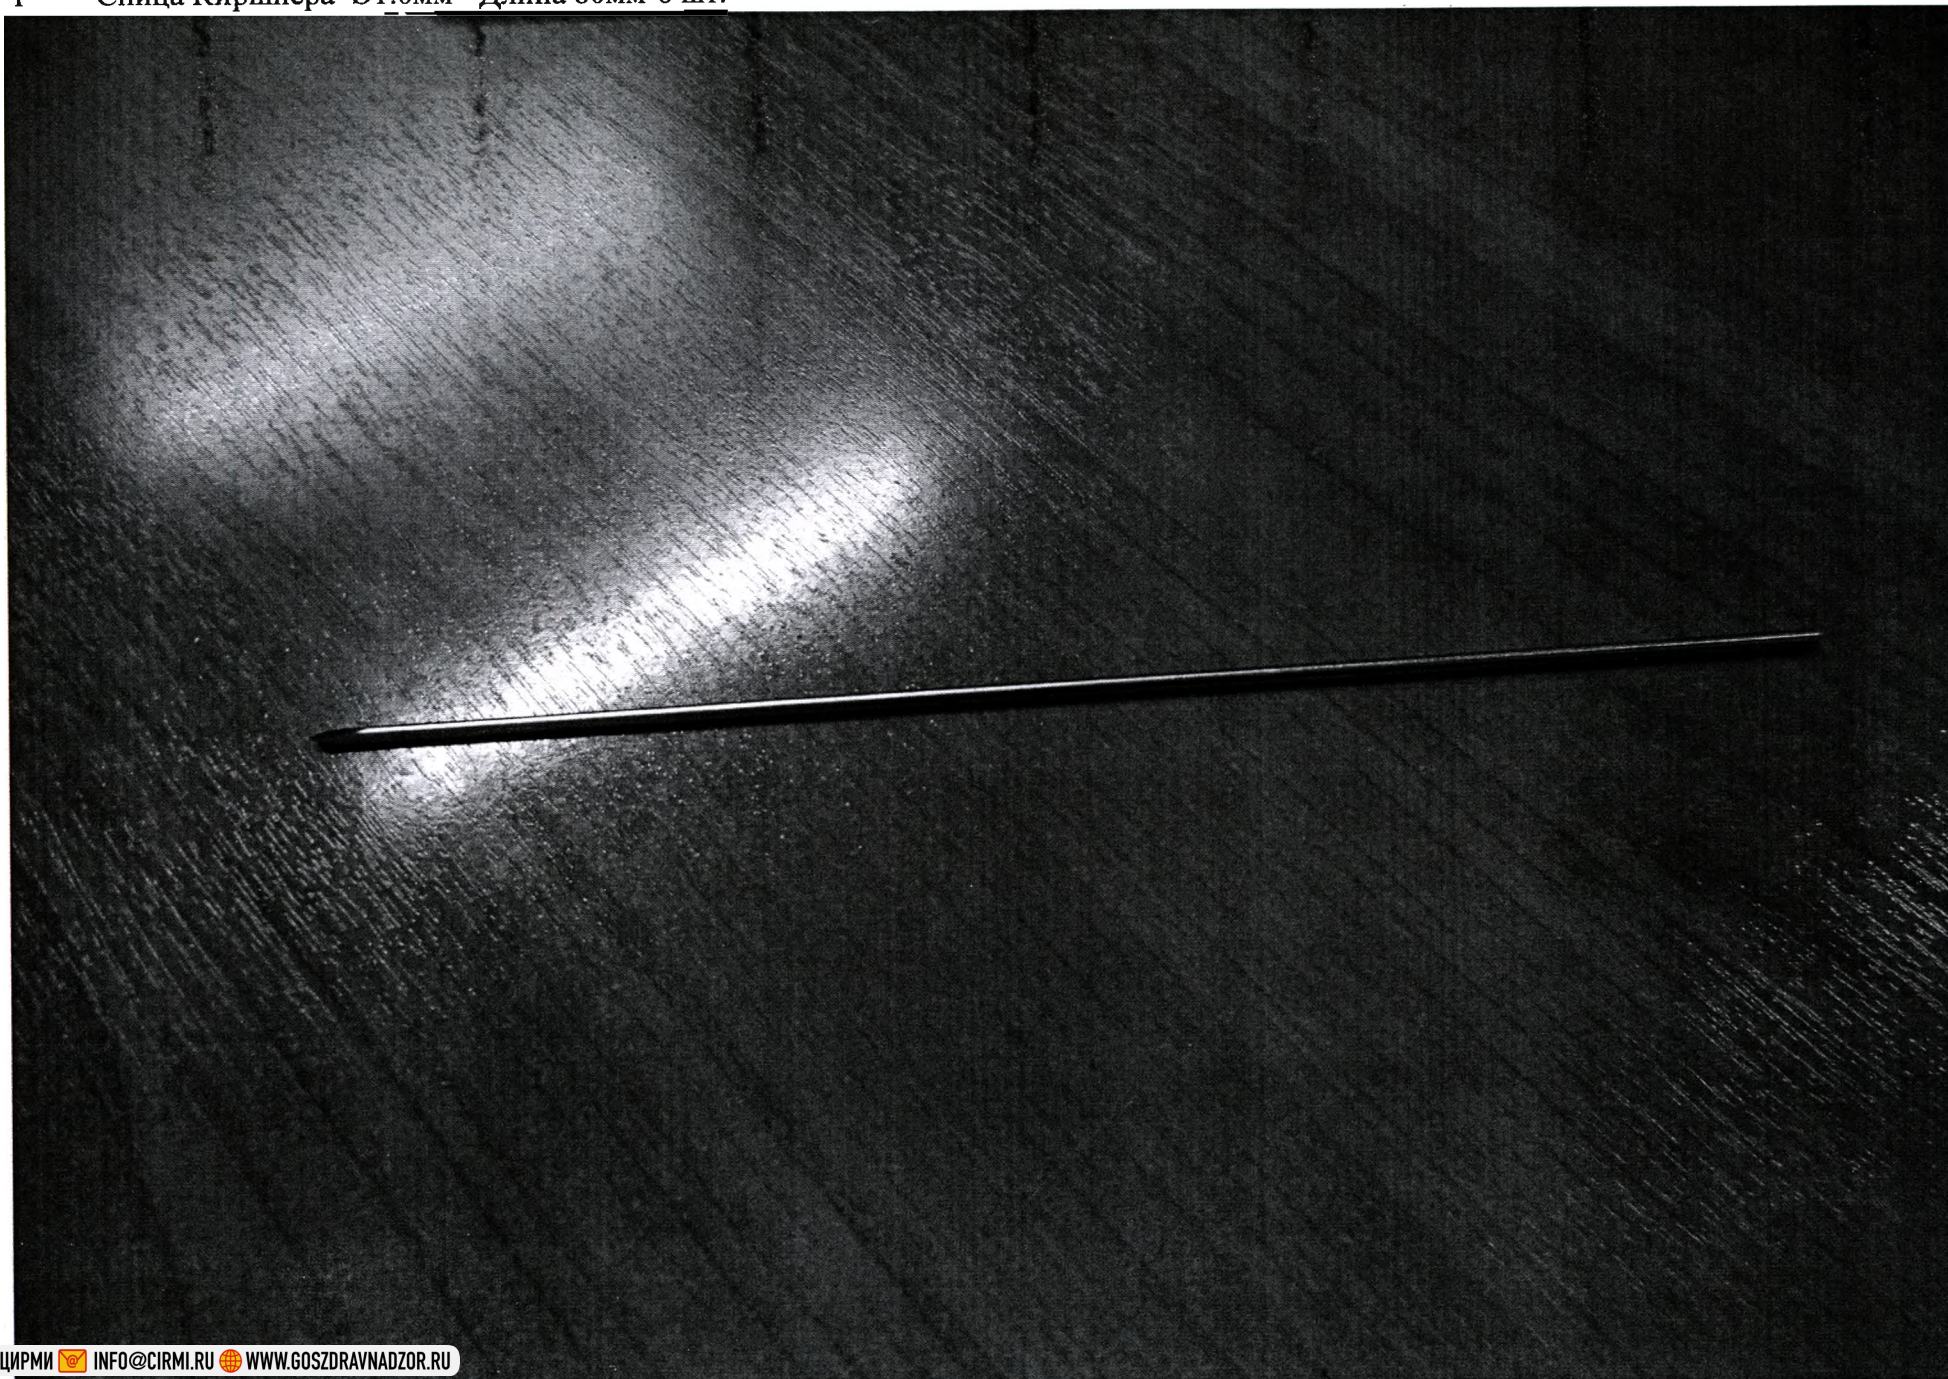



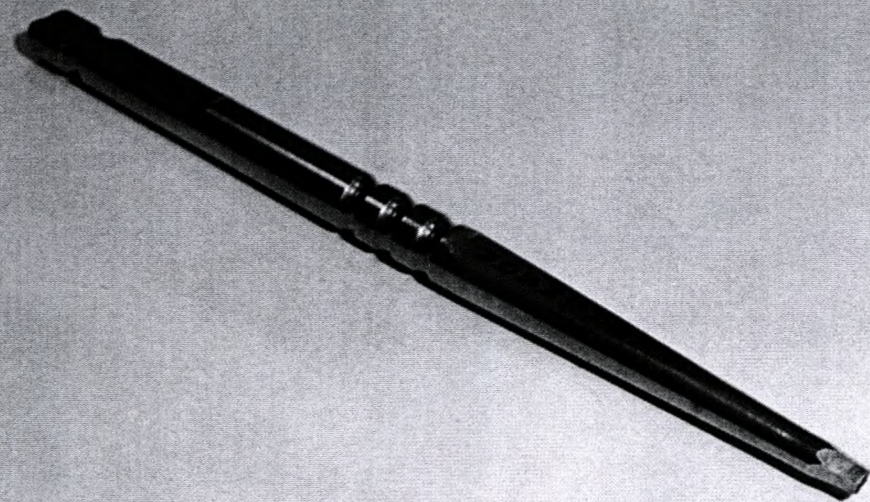




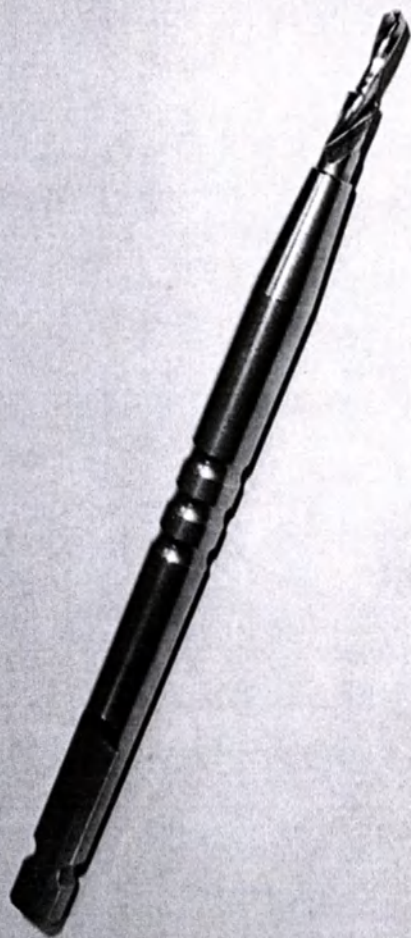







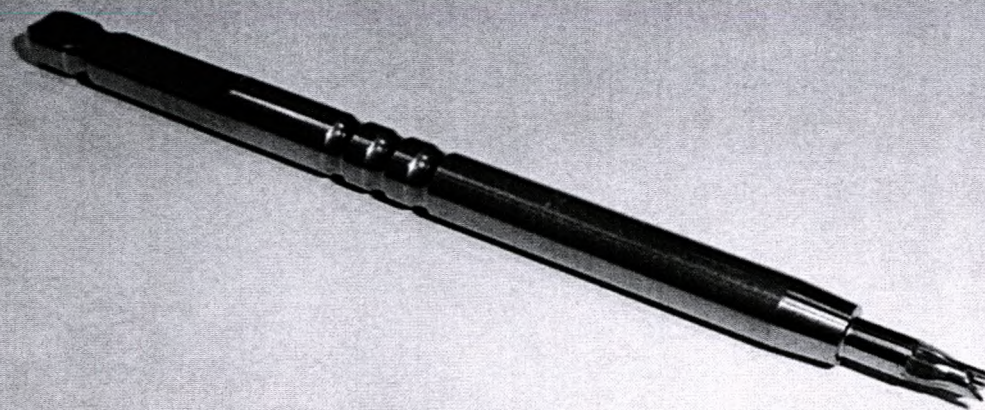


















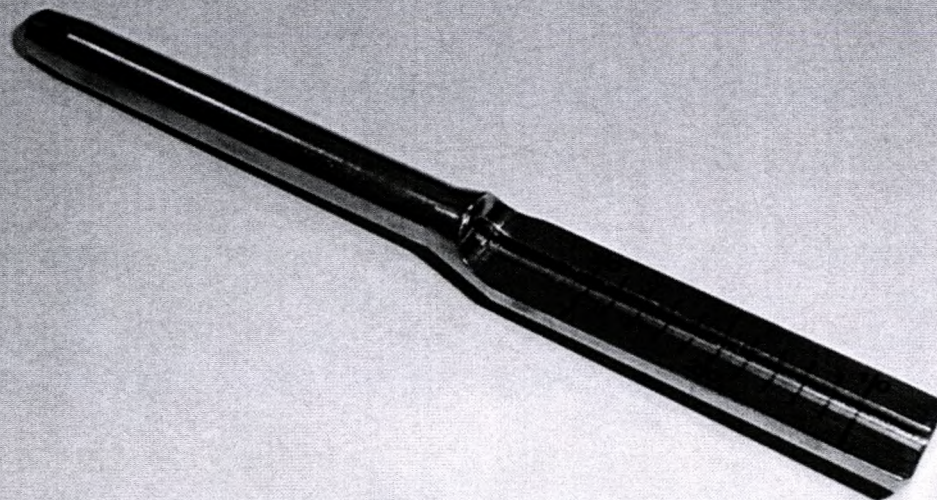



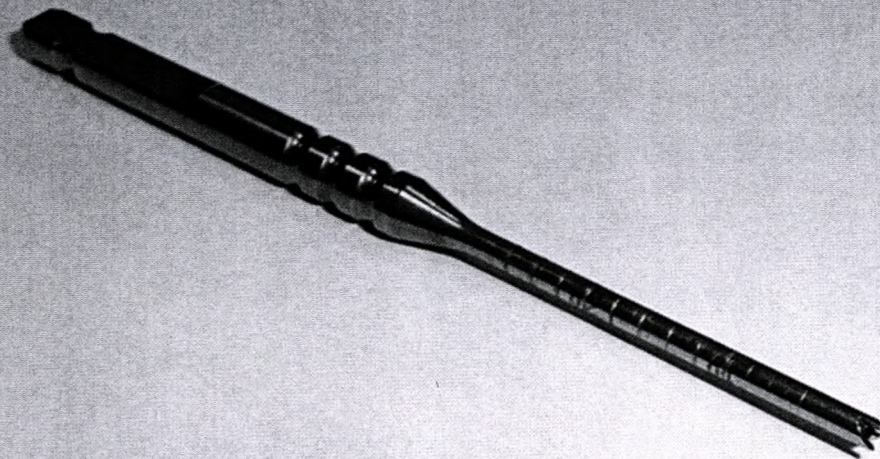




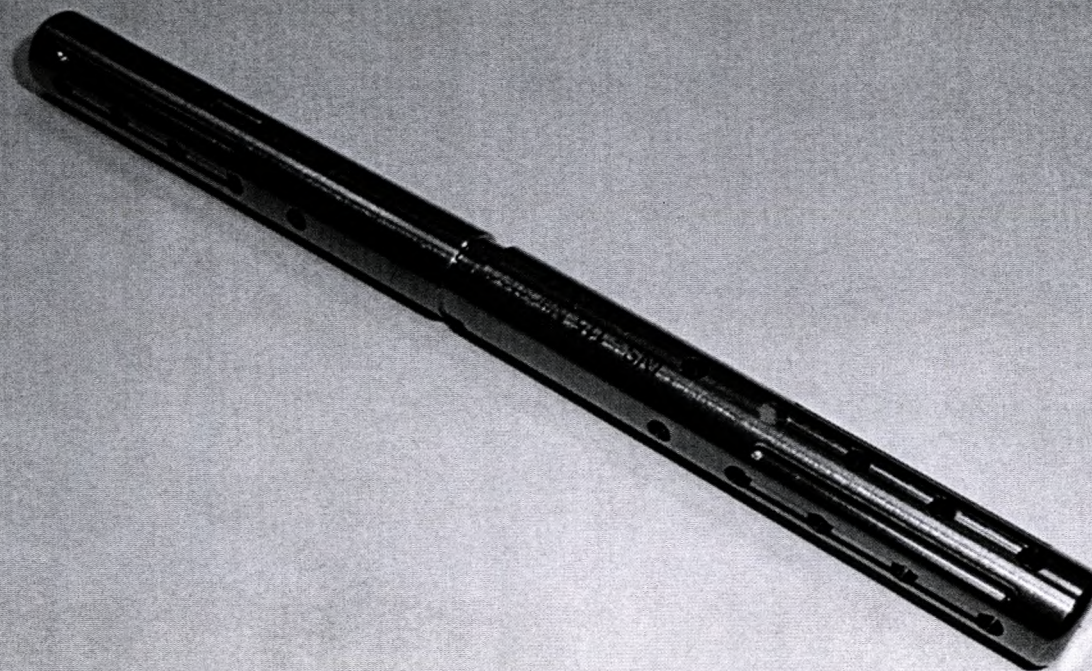








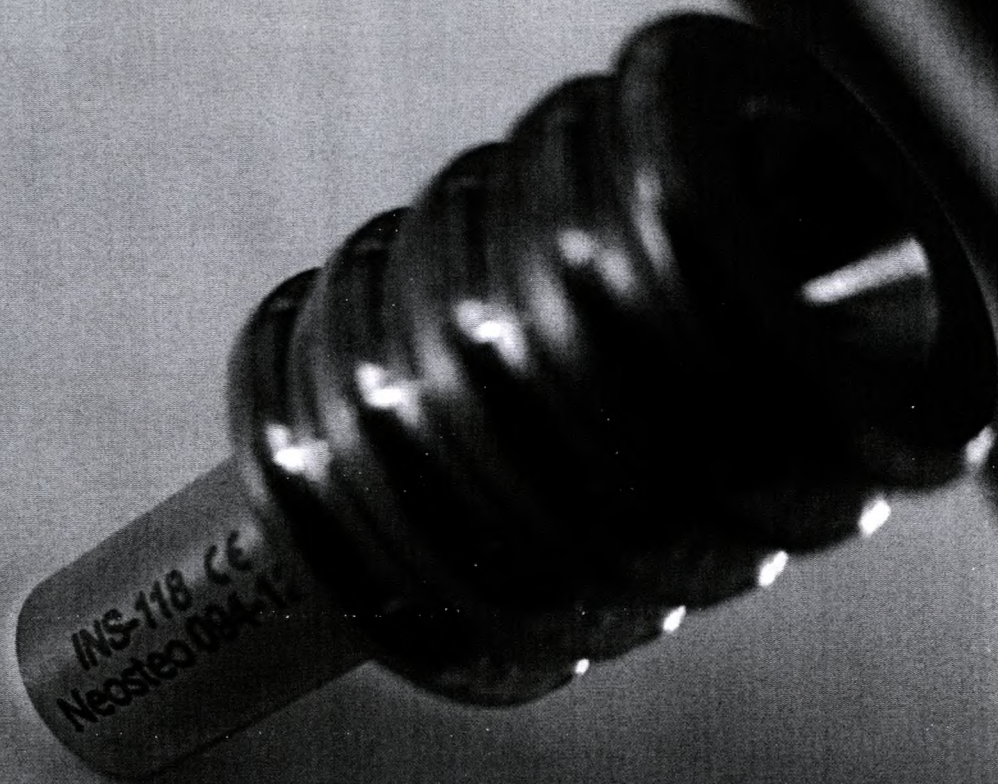


INS-118 CC  
Neosteel 104-1



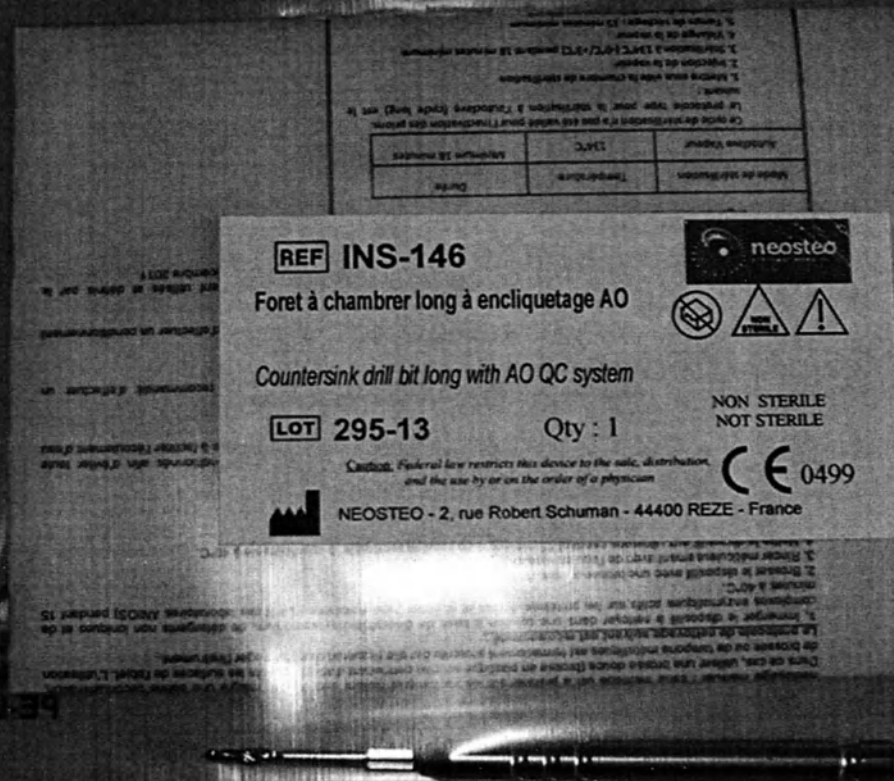



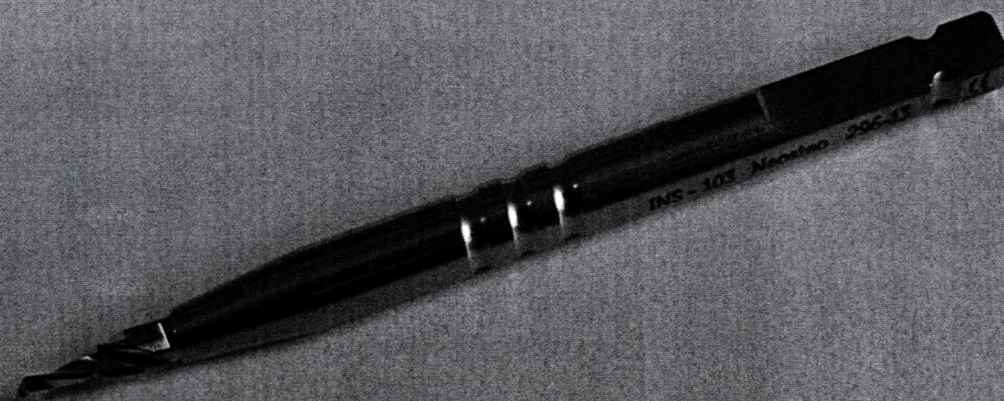



**REF** INS-122


**Fantôme de vis Ø2.6mm**

Ø2.6mm screw template

**LOT** 069-12 Qty: 1

**Caution:** Federal law restricts this device to the sale, distribution, and the use by or on the order of a physician.

NEOSTEO - Mailève 2A - 1 Boulevard Jean Moulin - 44100 NANTES - FRANCE



la stérilisation par autoclave est une stérilisation par chaleur humide.

920-17465 et les applications de l'Association (925-811-202) pour plus d'informations.

**Cycle long**  
Les autoclaves doivent être calibrés à la vapeur afin de satisfaire les exigences relatives à l'association des pressions et autres ATCC.


| Méthode de stérilisation | Température | Durée              |
|--------------------------|-------------|--------------------|
| Autoclave Vapour         | 121°C       | Minimum 15 minutes |

Ce cycle de stérilisation n'est pas valide pour l'association des pressions et autres ATCC.

Le protocole type pour la stérilisation à l'autoclave longue est le suivant :

1. Mettre sous vide la chambre de stérilisation
2. Injection de la vapeur
3. Maintenir à 121°C (250°F) pendant 15 minutes minimum



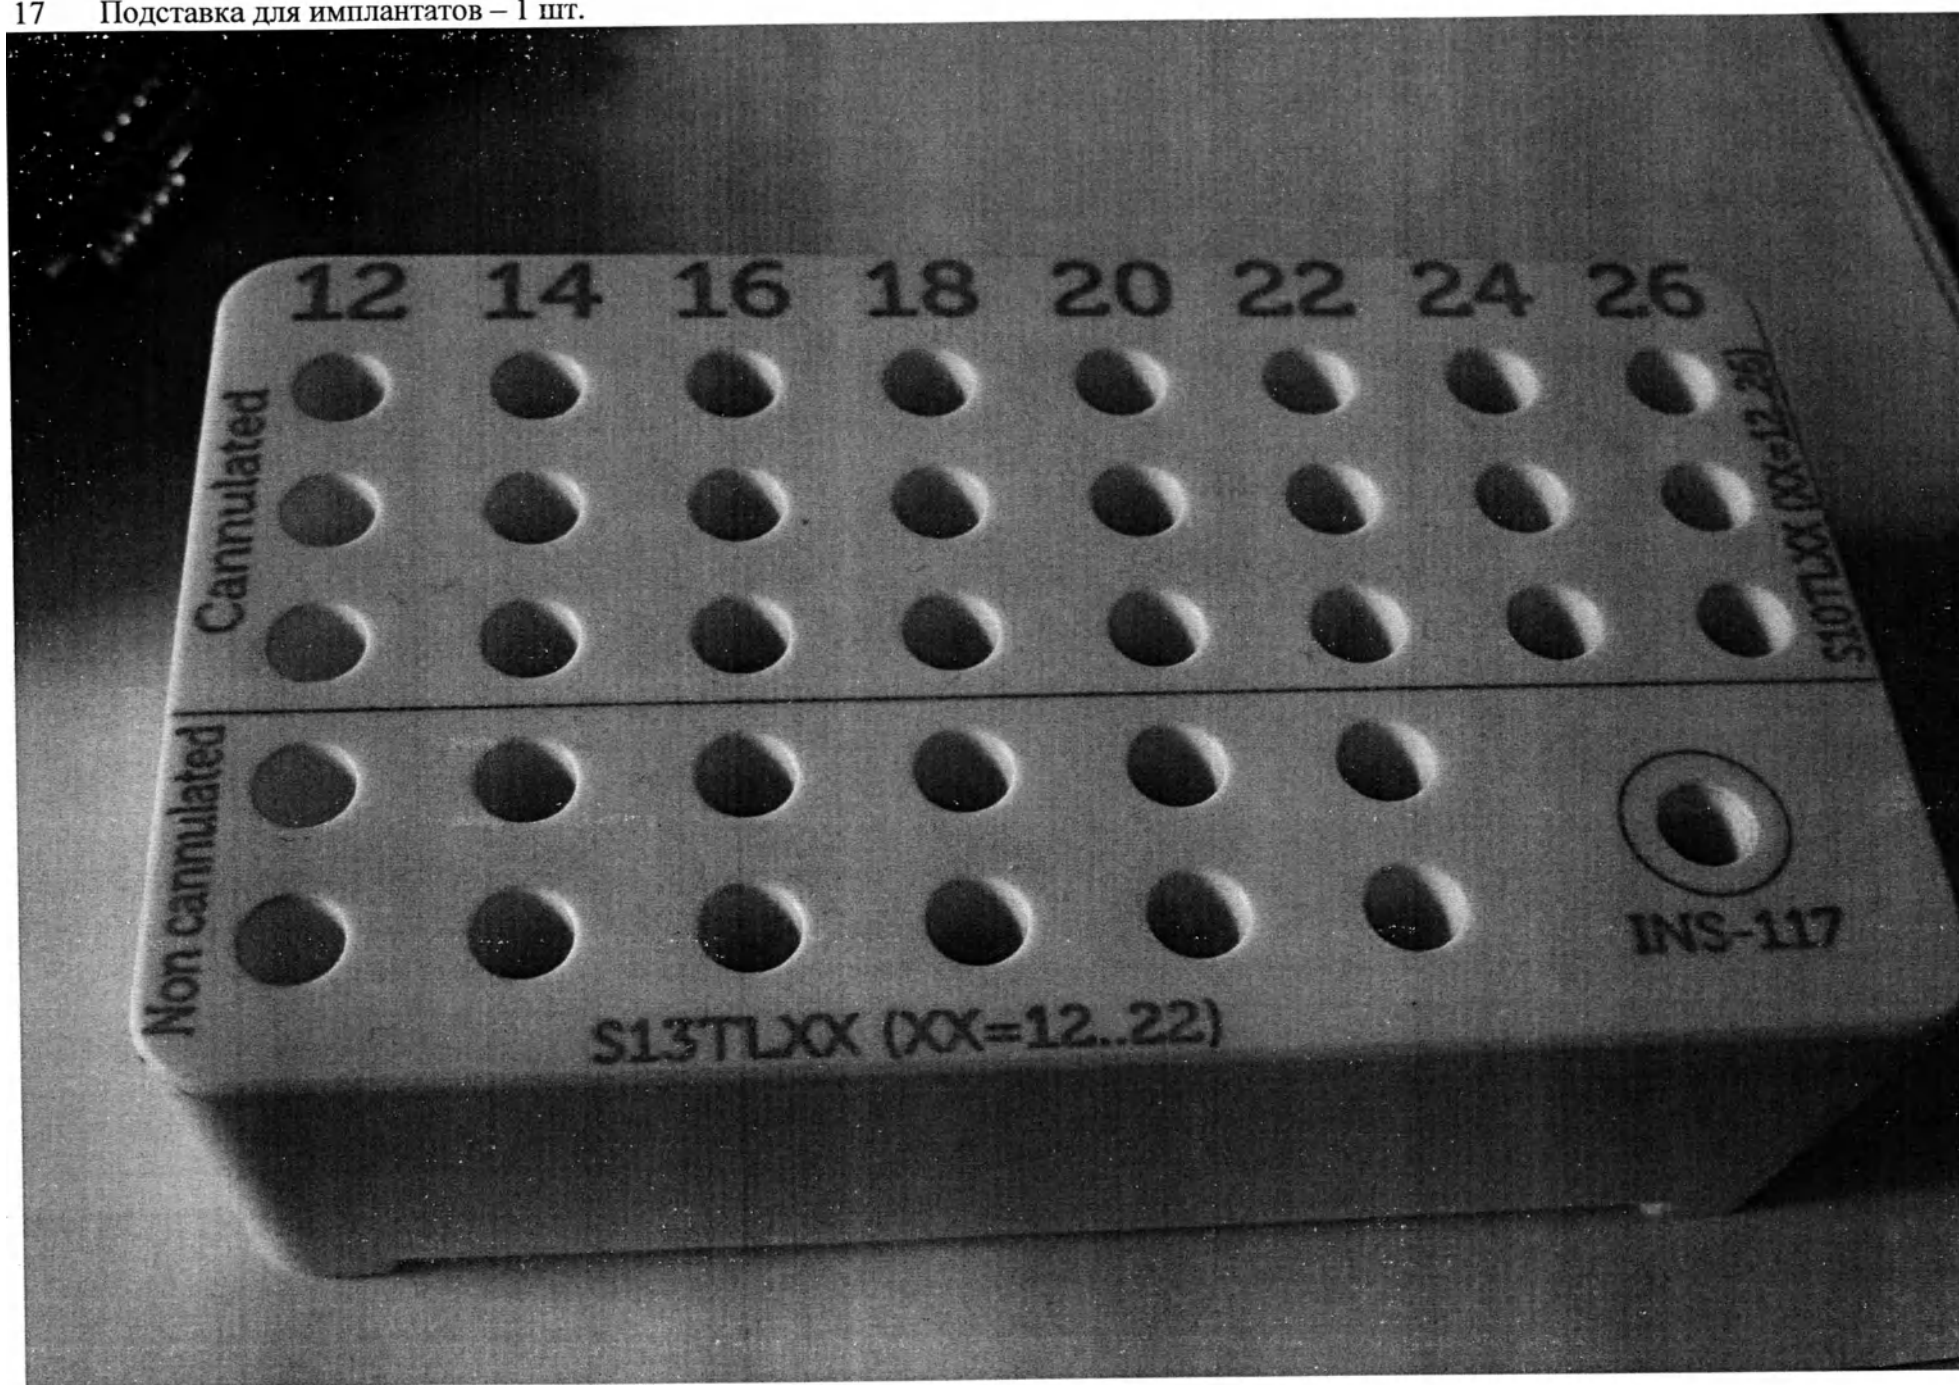





NEOSTEO

Mallève 2a – 1 Boulevard Jean

Moulin 44100 NANTES

Франция



neosteo  
EFFICIENT MOBILITY

## Инструменты для установки имплантатов в наборах:

### Набор 5:

- 1 Спирца Киршнера Ø1.0мм - Длина 80мм-6 шт.
- 2 Канюлированная шестигранная отвертка 1,8 мм с системой крепления АО -1 шт.
- 3 Сверло-зенкер с системой крепления АО-1шт.
- 4 Канюлированная шестигранная отвертка 1.8мм с функцией самоблокировки и системой крепления АО-1 шт.
- 5 Зенкер канюлированный Ø2.5мм с системой крепления АО -1 шт.
- 6 Лоток для инструментов и винтов Ø2,6 мм-1 шт.
- 7 Глубиномер для хирургии стопы 6-40 мм-1 шт.
- 8 Рукоятка для быстросъемного соединения АО Ø4,5 мм-1шт.
- 9 Измеритель погружения спиц Киршнера Ø 1,0 мм, длина 80 мм -1 шт.
- 10 Канюлированное сверло Ø1,9 мм с делениями с системой крепления АО -1 шт.
- 11 Контейнер для спиц Киршнера Ø1.0мм - Длина 80мм - 1 шт.
- 12 Сверло Ø1,9 мм с делениями с системой крепления АО - 1шт.
- 13 Приспособление для проведения винтов Ø2,6 мм- 1шт.
- 14 Длинное канюлированное сверло с системой крепления АО -1шт.
- 15 Длинное сверло с системой крепления АО – 1шт.
- 16 Шаблон для винтов Ø2,6 мм – 1 шт.
- 17 Подставка для имплантатов – 1 шт.

REF


05272

LOT

202-13



2016/02



2013/02



CE  
0499




100 мм

150 мм




**Набор 6:**

1 Спiца Киршнера Ø1.0мм - Длина 80мм- 6 шт.

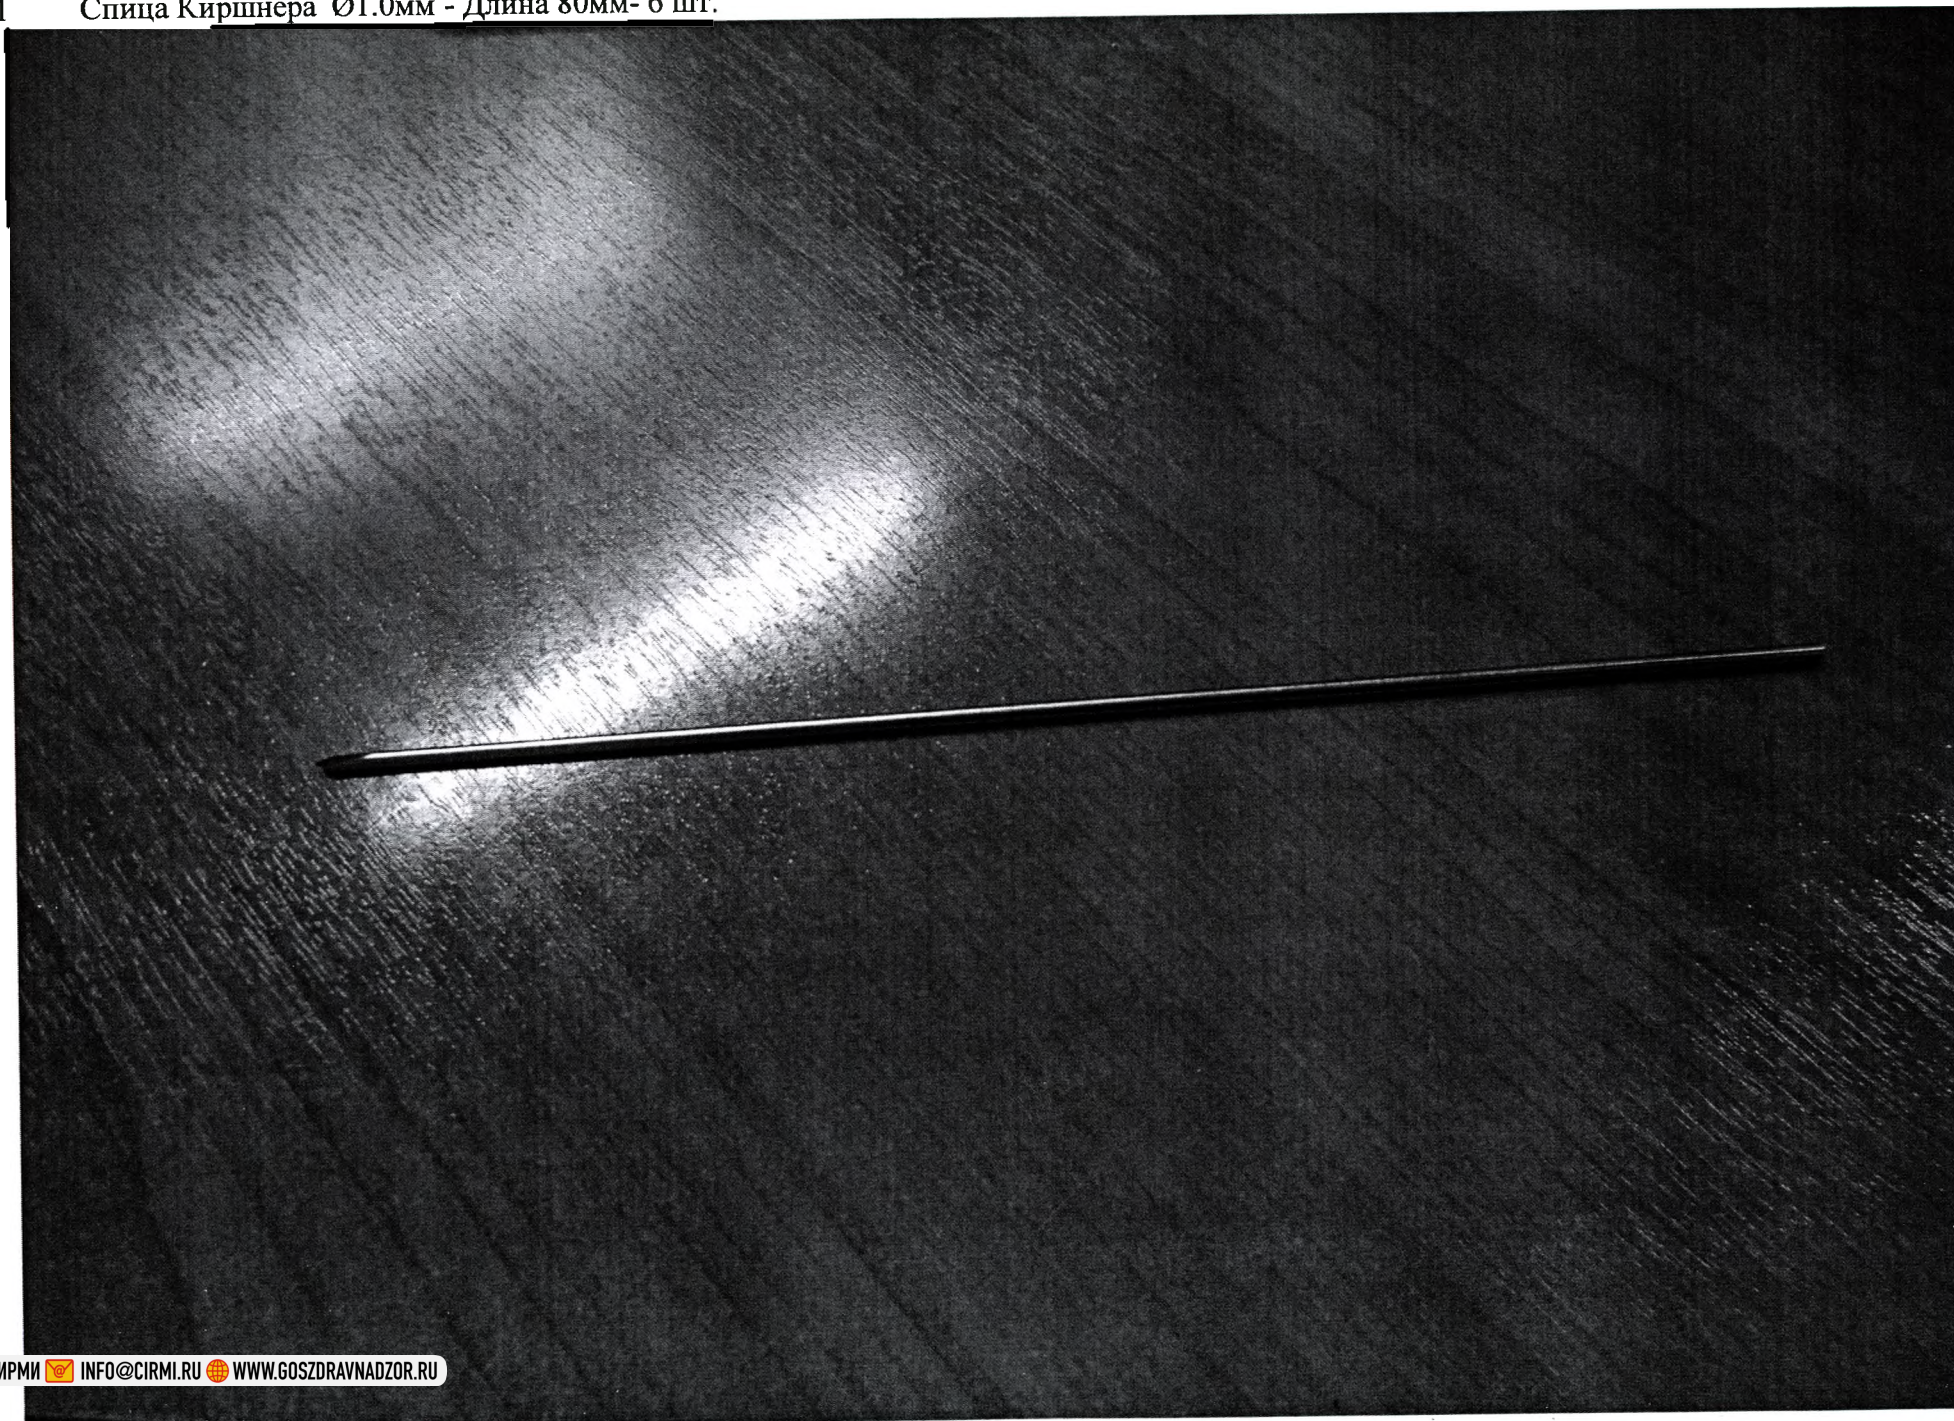




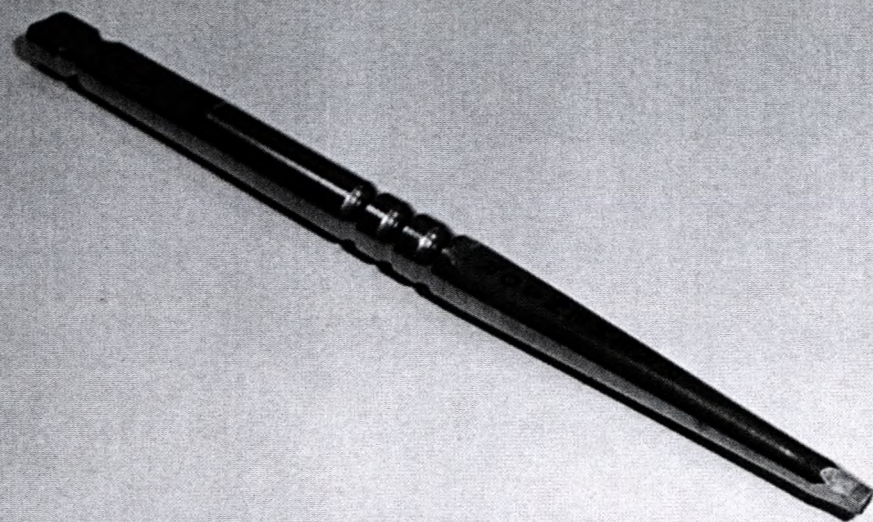




3. Сверло-зенкер с системой крепления АО - 1 шт.

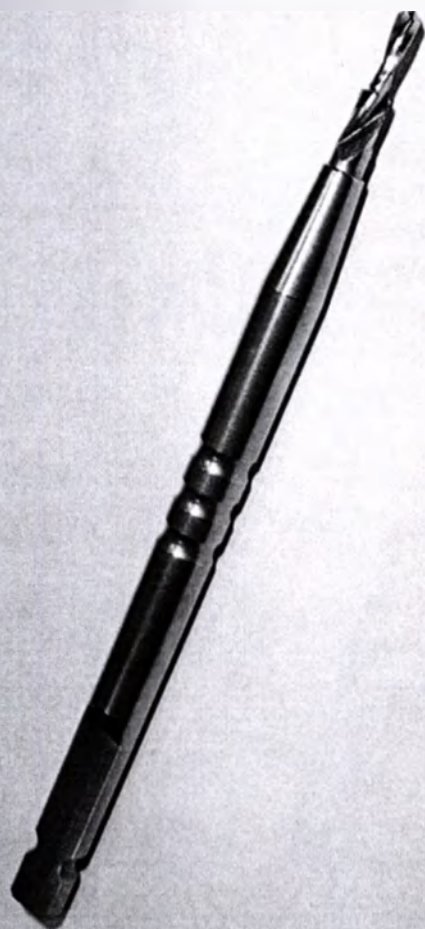







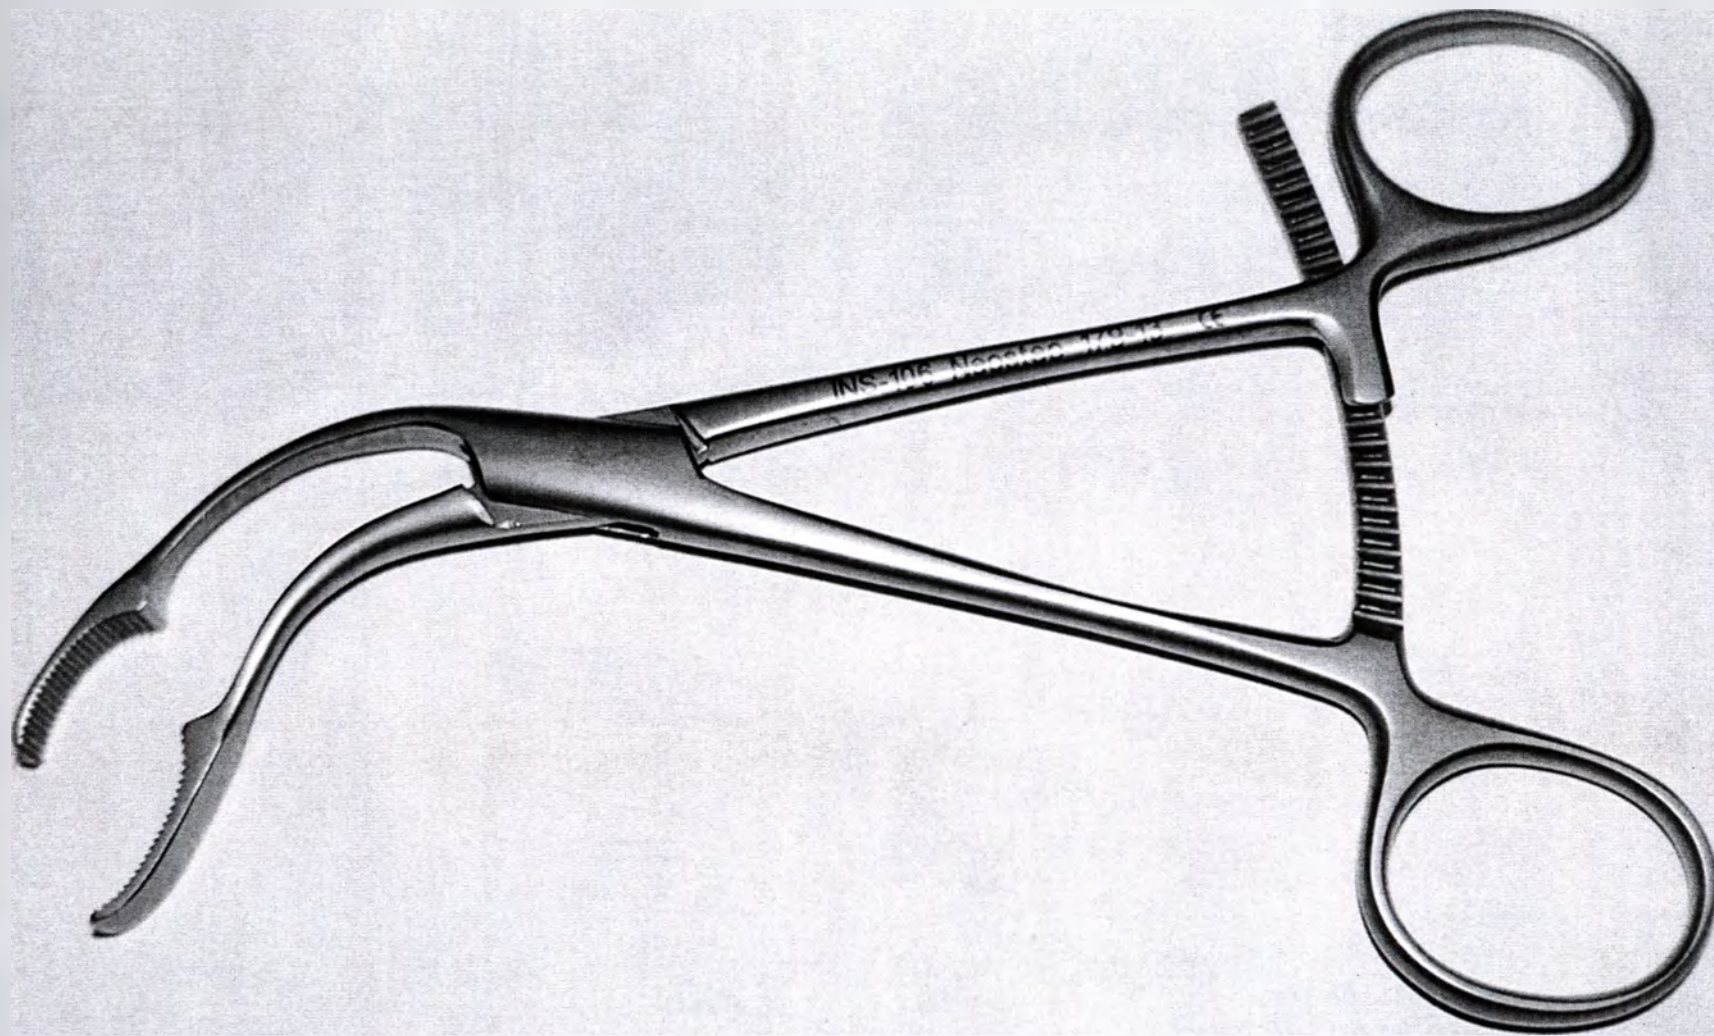


















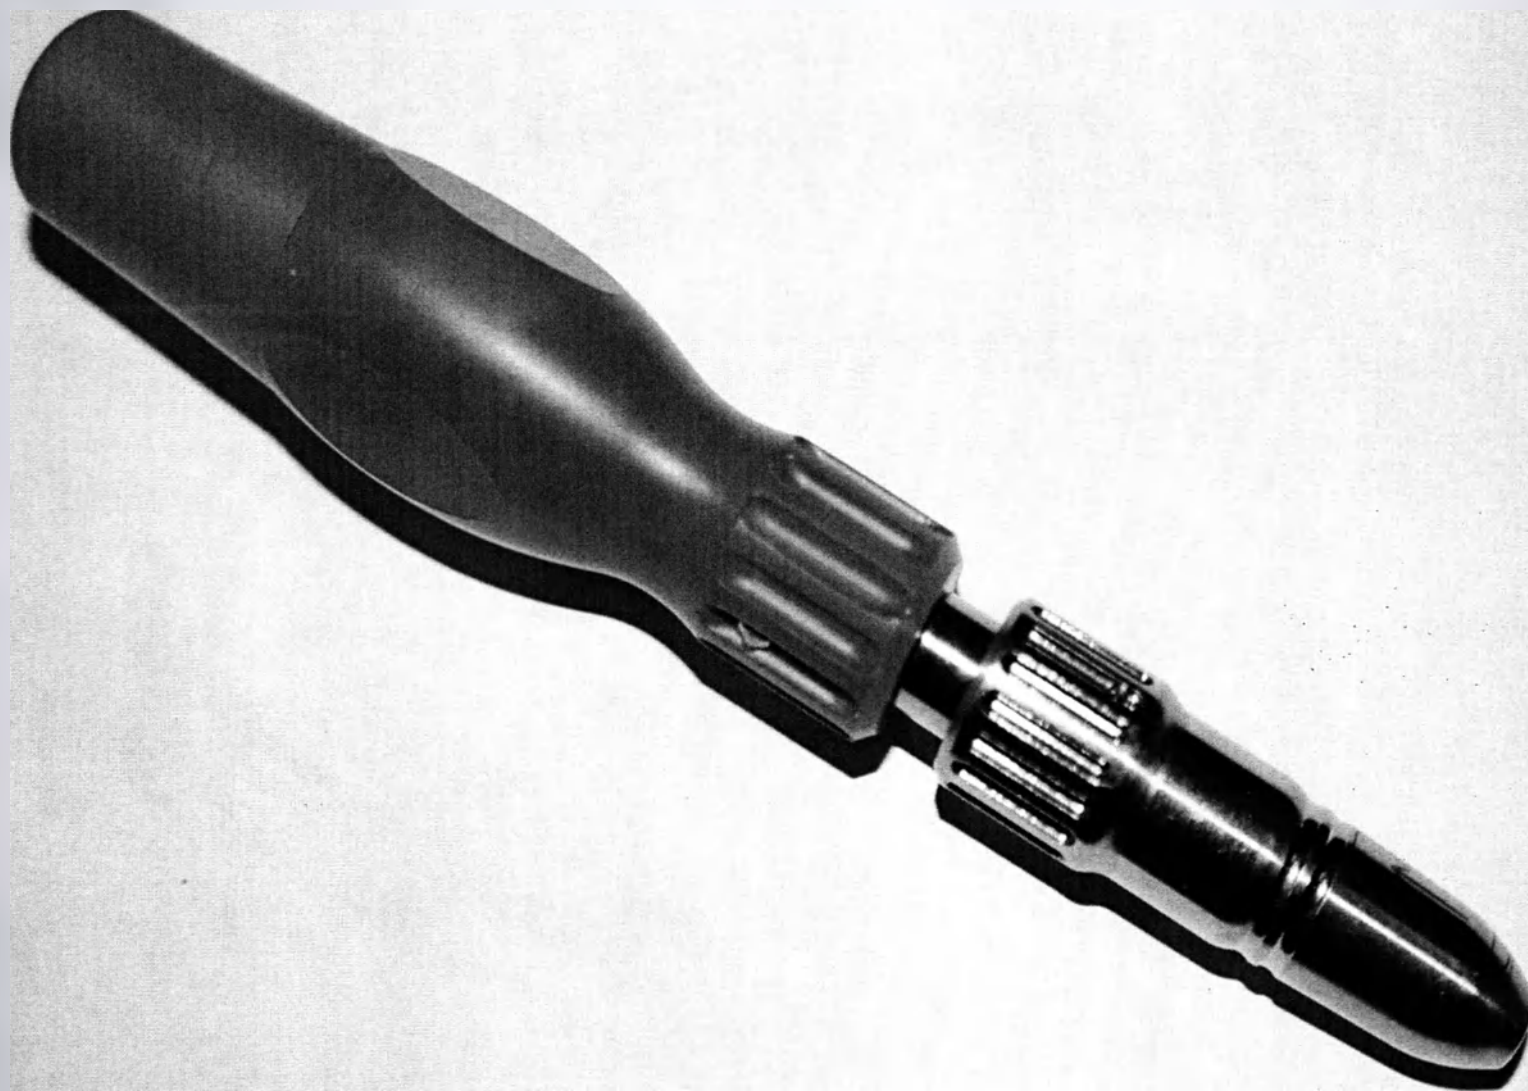




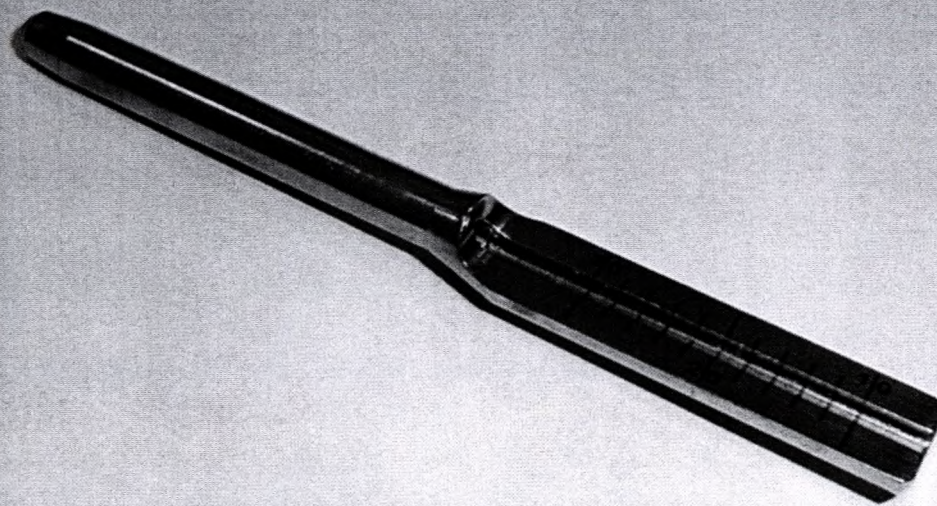



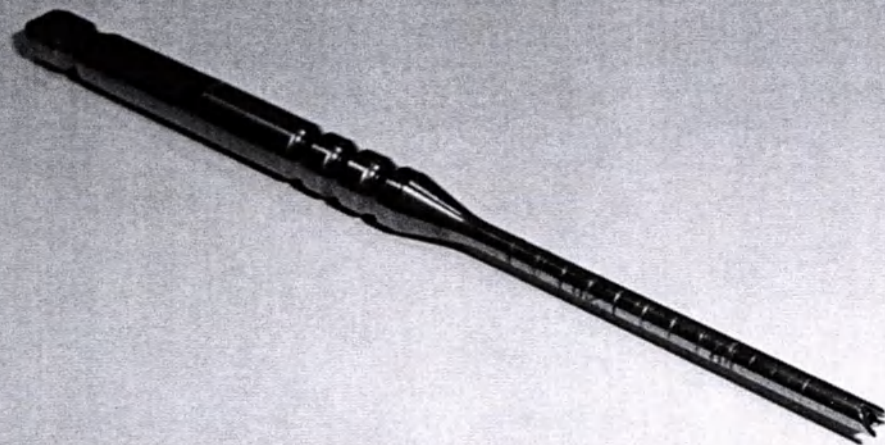



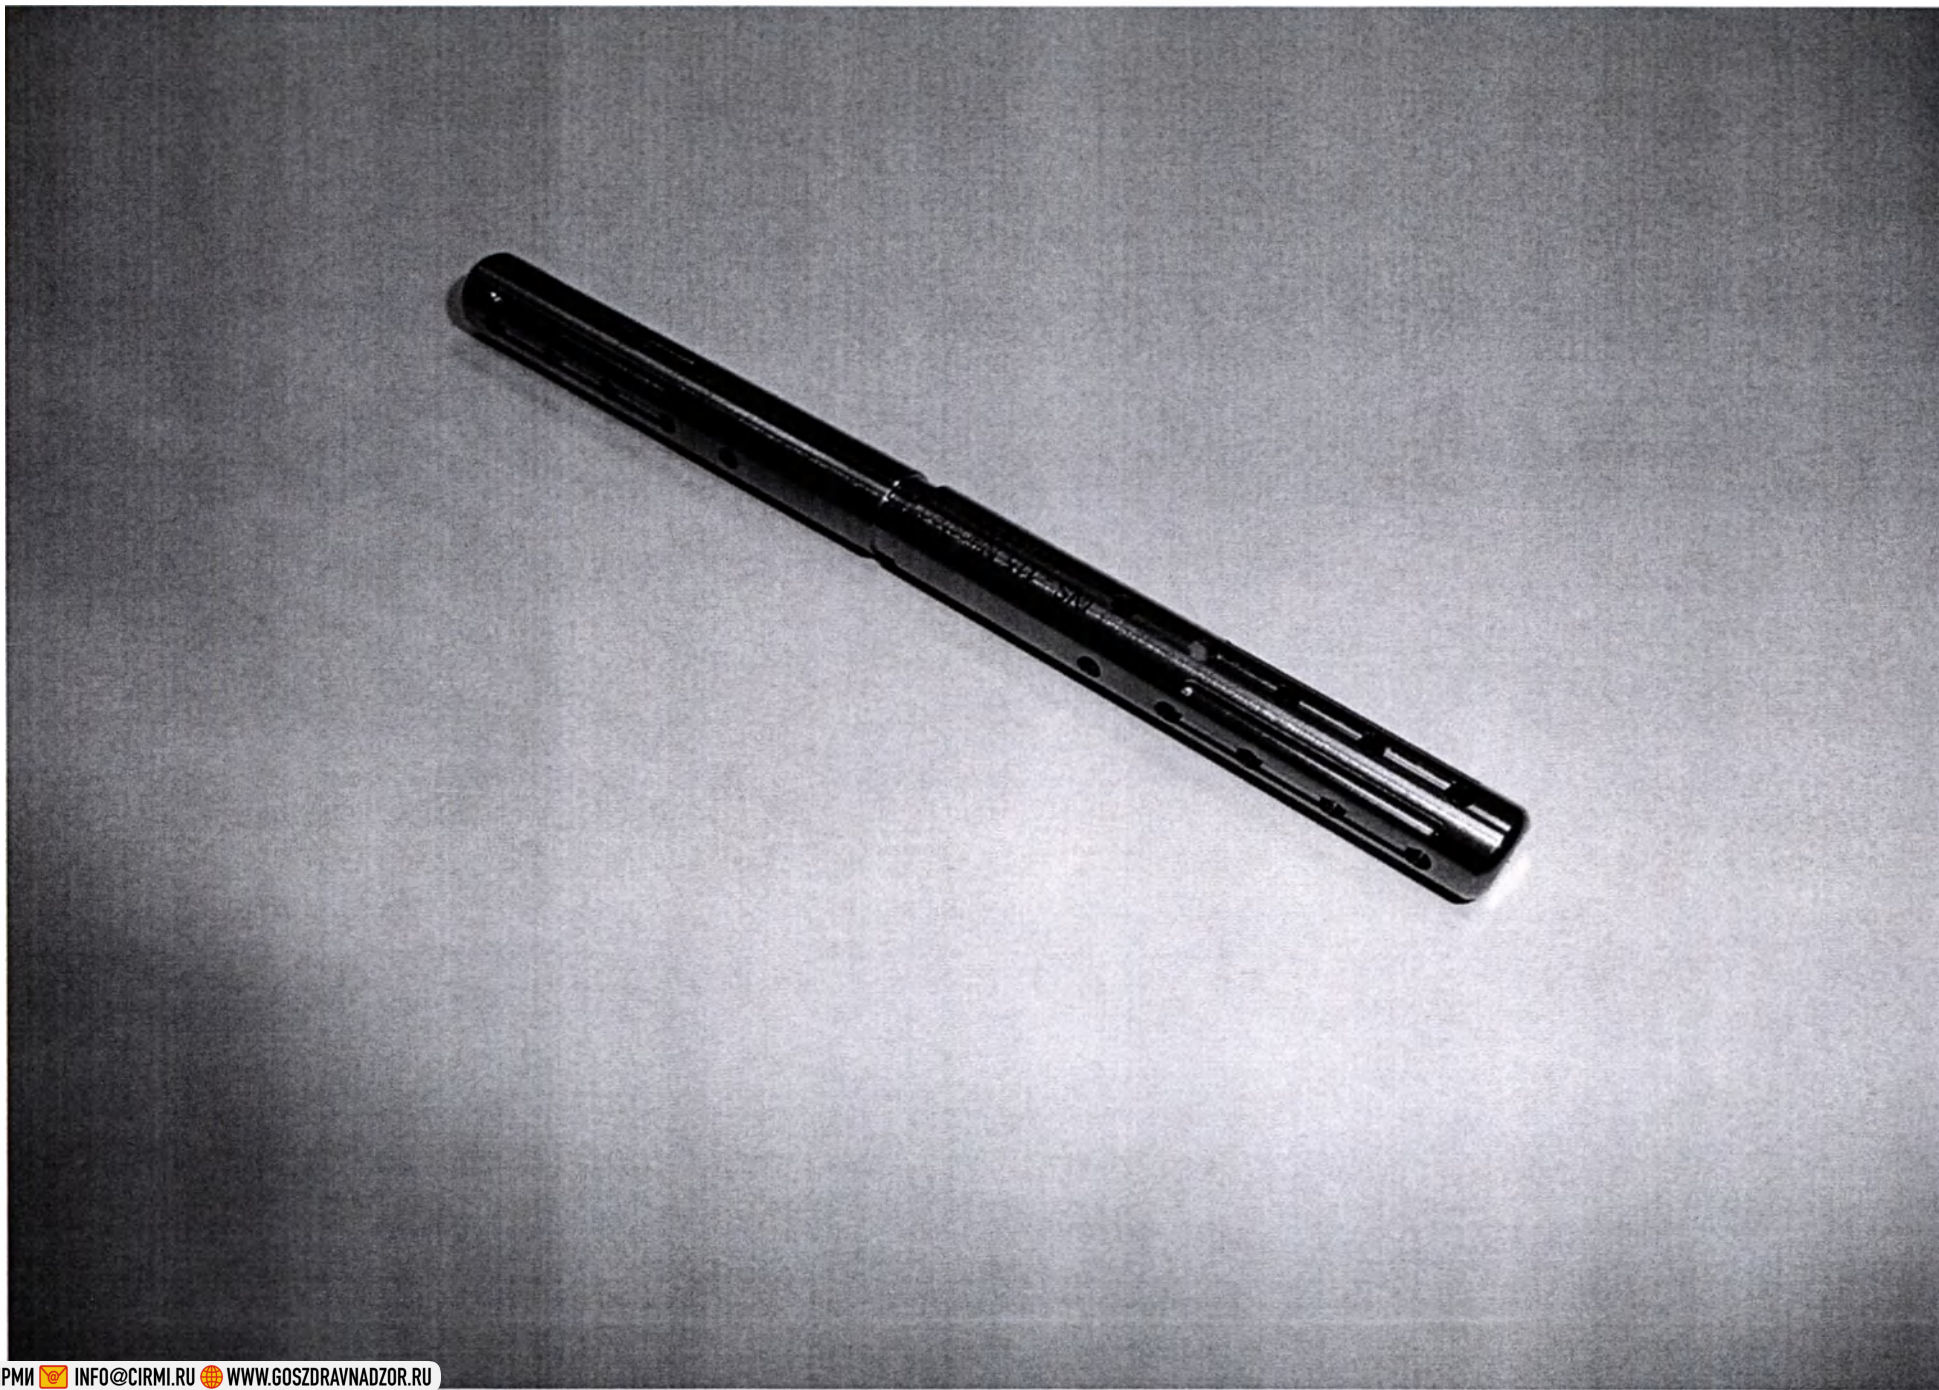
















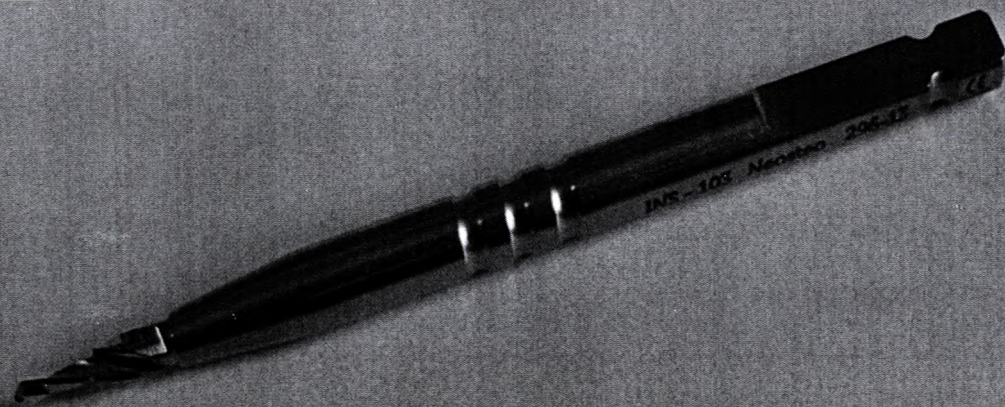



neosteo

**REF INS-121**

Fastène de vis Ø3,2mm

Ø3,2mm screw template

**LOT 068-12** Qty : 1


**CE**

Caution : Factual law restricts this device to the sale, distribution, and the use by or on the order of a physician

NEOSTEO - Médium ZA - 1 Boulevard Jean Moulin - 44100 NANTES - FRANCE

| Mode de distribution | Température | Stock              |
|----------------------|-------------|--------------------|
| Autoclave            | 121°C       | Minimum 10 minutes |



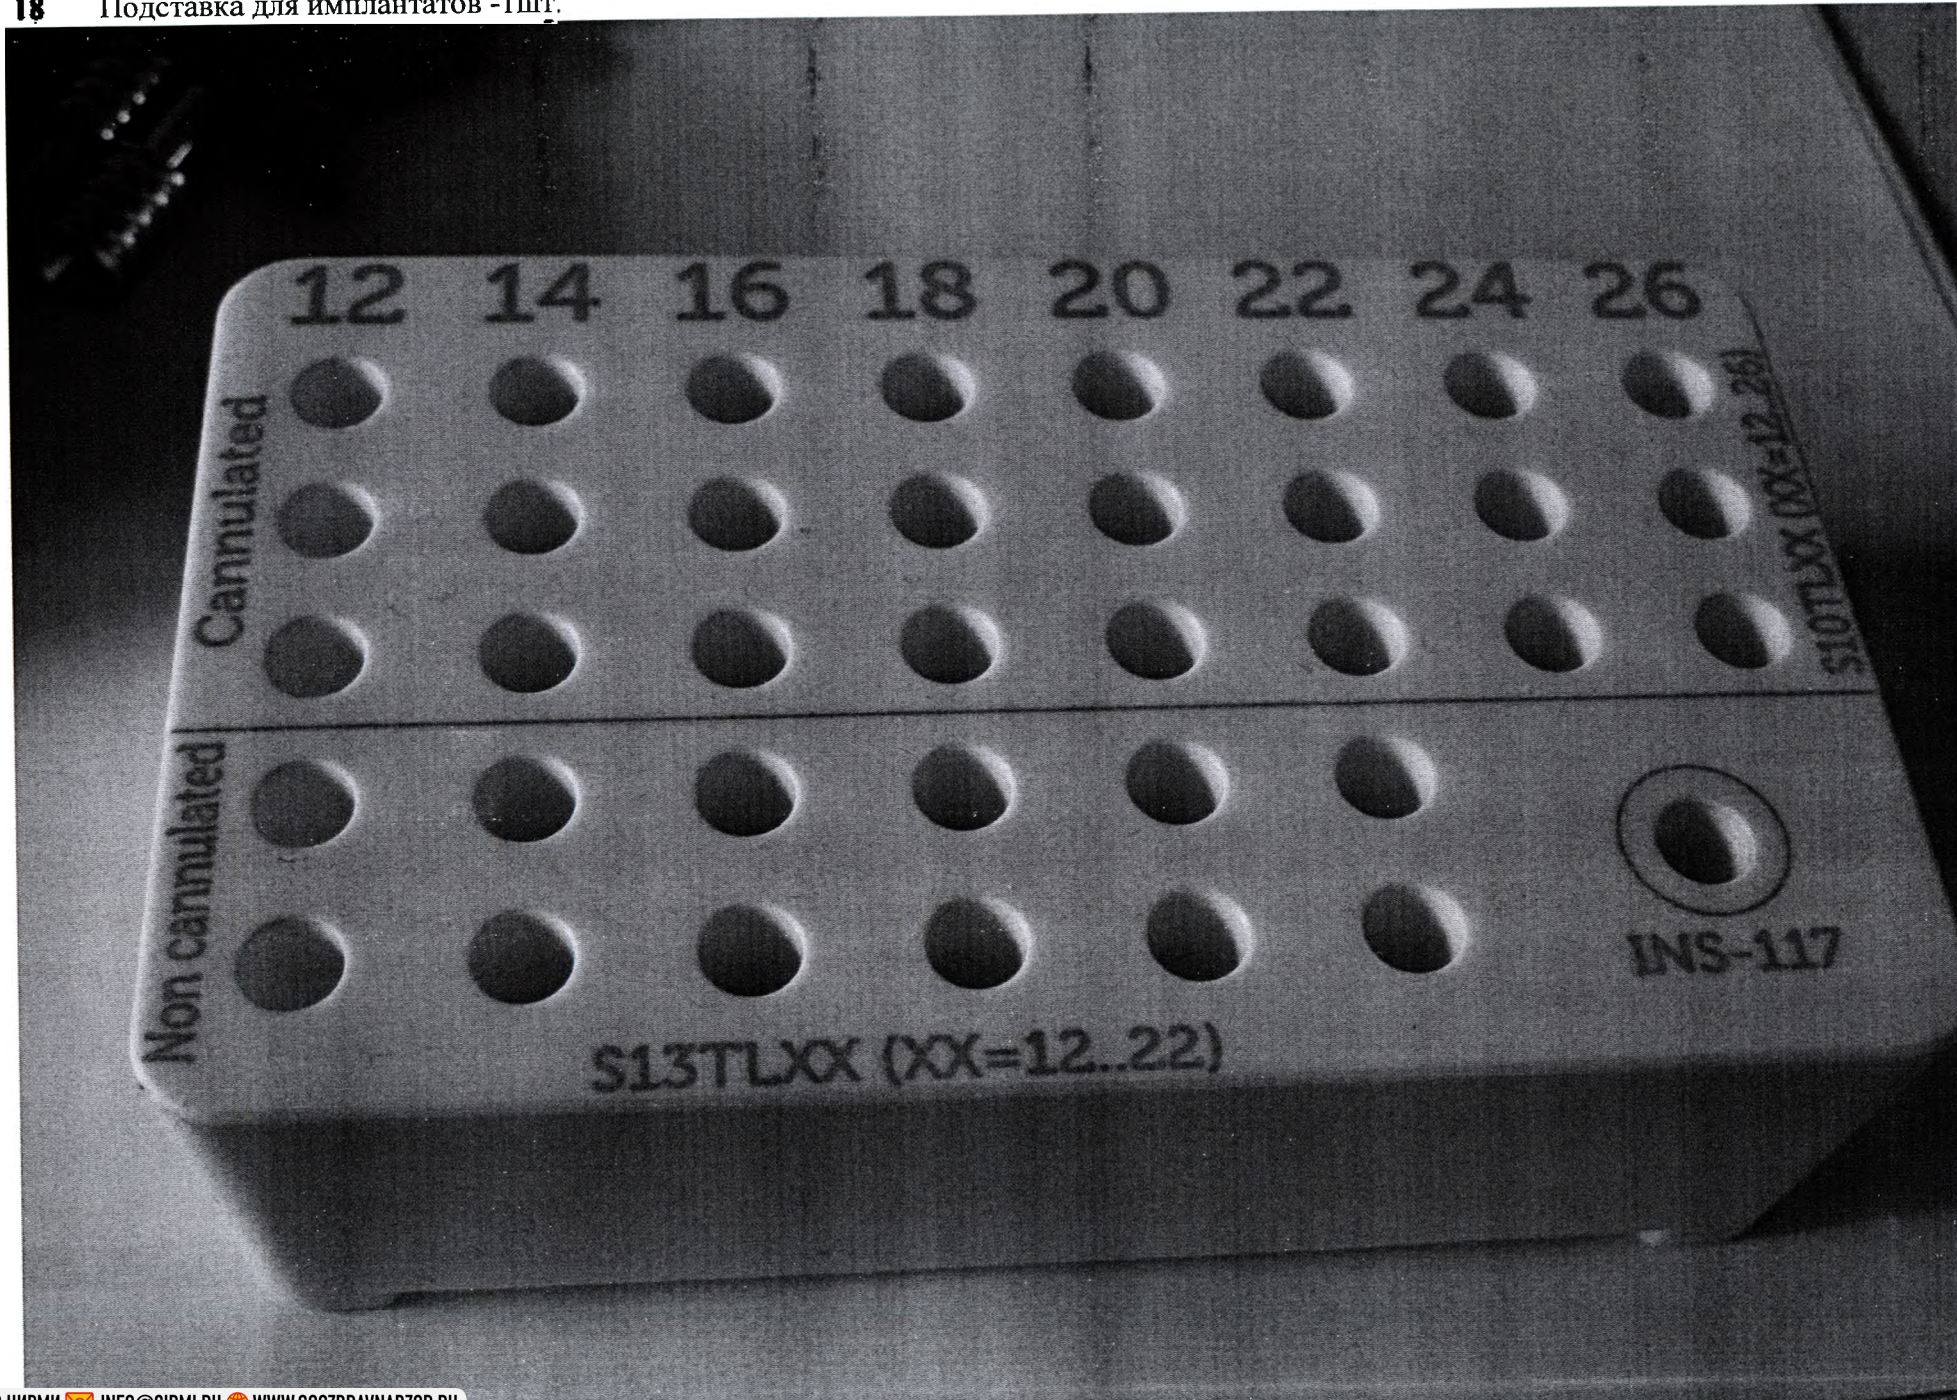



|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>NEOSTEO</b><br>Mallève 2a – 1 Boulevard<br>Jean Moulin 44100 NANTES<br>Франция | <br><b>neosteo</b><br>EFFICIENT MOBILITY |
| <b>Инструменты для установки имплантатов в наборах:</b>                                                                                                                |                                                                                                                           |
| <b>Набор 6:</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |
| 1 Спица Киршнера Ø1.0мм - Длина 80мм- 6 шт.                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 2 Канюлированная шестигранная отвертка 1,8 мм с системой крепления АО-1шт.                                                                                             |                                                                                                                           |
| 3 Сверло-зенкер с системой крепления АО - 1 шт.                                                                                                                        |                                                                                                                           |
| 4 Канюлированная шестигранная отвертка 1.8мм с функцией самоблокировки и системой крепления АО - 1 шт.                                                                 |                                                                                                                           |
| 5 Зажим для скрепления отломков- 1 шт.                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
| 6 Зенкер канюлированный Ø3.2мм с системой крепления АО-1 шт.                                                                                                           |                                                                                                                           |
| 7 Лоток для инструментов и винтов Ø3,2 мм – 1 шт.                                                                                                                      |                                                                                                                           |
| 8 Глубиномер для хирургии стопы 6-40 мм -1шт.                                                                                                                          |                                                                                                                           |
| 9 Рукоятка для быстроразъемного соединения АО Ø4,5 мм – 1шт.                                                                                                           |                                                                                                                           |
| 10 Измеритель погружения спиц Киршнера Ø 1,0 мм, длина 80 мм -1 шт.                                                                                                    |                                                                                                                           |
| 11 Канюлированное сверло Ø1,9 мм с делениями с системой крепления АО-1 шт.                                                                                             |                                                                                                                           |
| 12 Контейнер для спиц Киршнера Ø1.0мм - Длина 80мм – 1 шт.                                                                                                             |                                                                                                                           |
| 13 Сверло Ø1,9 мм с делениями с системой крепления АО – 1 шт.                                                                                                          |                                                                                                                           |
| 14 Приспособление для проведения винтов Ø3,2 мм -1 шт.                                                                                                                 |                                                                                                                           |
| 15 Длинное канюлированное сверло с системой крепления АО-1шт.                                                                                                          |                                                                                                                           |
| 16 Длинное сверло с системой крепления АО-1шт.                                                                                                                         |                                                                                                                           |
| 17 Шаблон для винтов Ø3,2 мм -1 шт.                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
| 18 Подставка для имплантатов -1шт.                                                                                                                                     |                                                                                                                           |
| <b>REF</b><br>05274                                                                                                                                                    | <b>LOT</b><br>204-13                                                                                                      |
|                                                                                     |  2016/02                               |
|  2013/02                                                                            |  NON STERILE                           |
|  0499                                                                               |                                        |
|  -50 °C                                                                             |                                                                                                                           |


100 мм

150 мм




**Набор 7:**

1      Спица Киршнера Ø1.0мм - Длина 80мм – 6 шт.

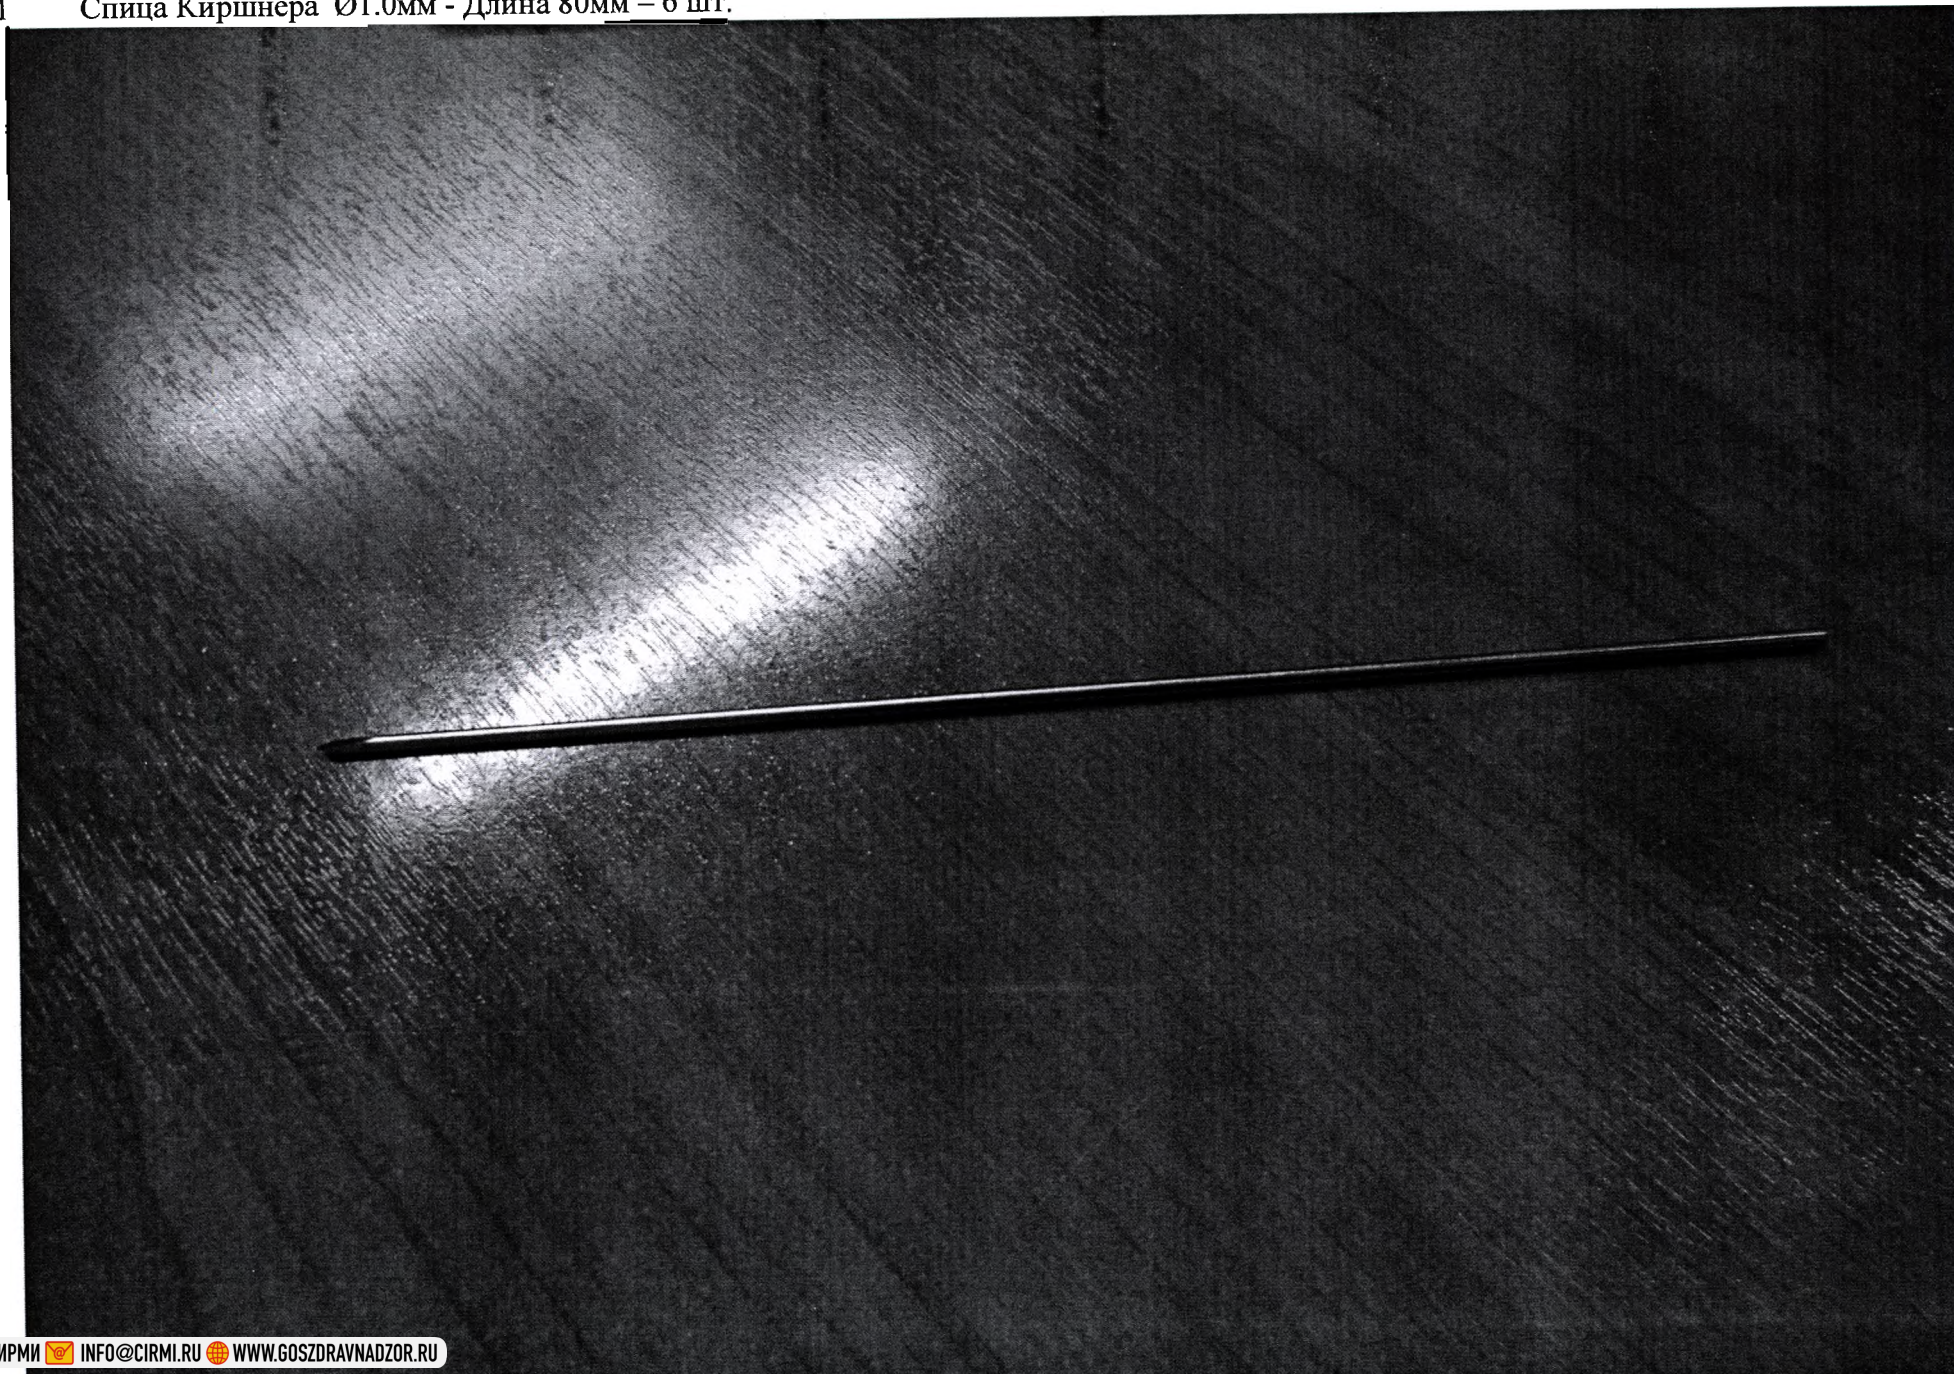



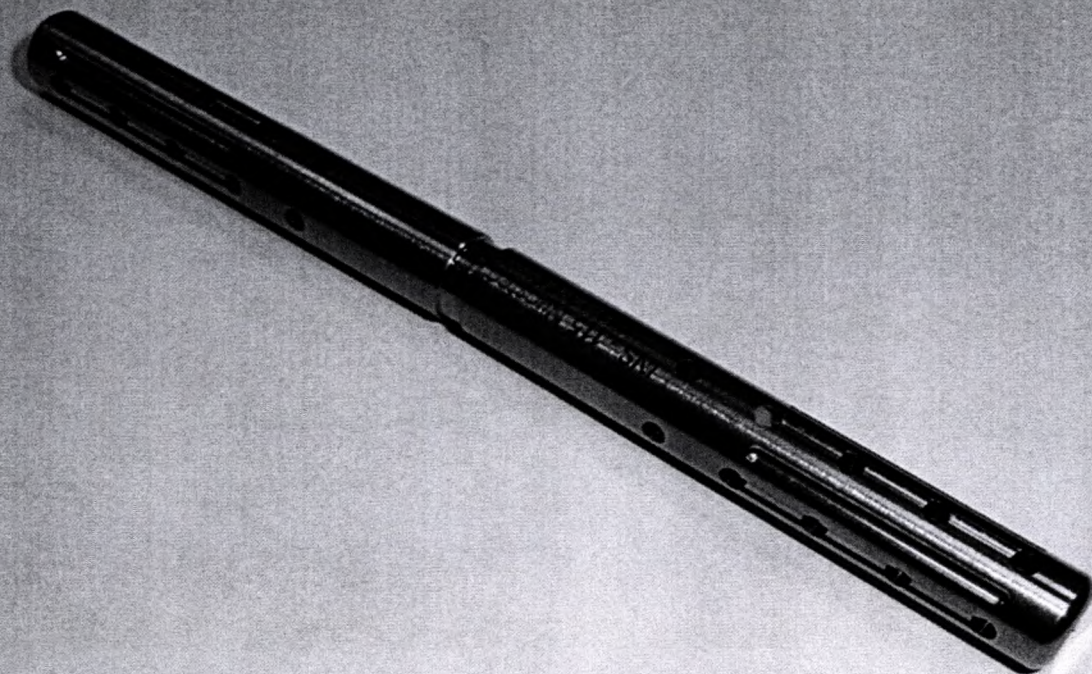























|                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>NEOSTEO</b><br>Mallève 2a – 1 Boulevard Jean<br>Moulin 44100 NANTES<br>Франция |                     |
| <b>Инструменты для установки имплантатов в наборах:</b>                                                                                                                |                                                                                                      |
| <b>Набор 7:</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                      |
| 1                                                                                                                                                                      | Спица Киршнера Ø1.0мм - Длина 80мм – 6 шт.                                                           |
| 2                                                                                                                                                                      | Контейнер для спиц Киршнера Ø1.0мм - Длина 80мм - 1 шт.                                              |
| 3                                                                                                                                                                      | Лоток для инструментов для стягивающих скоб – 1 шт.                                                  |
| 4                                                                                                                                                                      | Инструмент для стягивающих скоб под углом 90° - 1 шт.                                                |
| 5                                                                                                                                                                      | Инструмент для стягивающих скоб под углом 26° - 1 шт.                                                |
| 6                                                                                                                                                                      | Направляющая для стягивающих скоб под углом 90° - 1 шт.                                              |
| 7                                                                                                                                                                      | Направляющая для стягивающих скоб под углом 26° - 1 шт.                                              |
| <br>05276                                                                             | <br>206-13          |
|                                                                                       | <br>2016/02         |
| <br>2013/02                                                                          |                    |
| <br>0499                                                                             |                    |
|                                                                                                                                                                        | <br>-50°C / +50°C |


100 мм

120 мм



**Инструменты для установки имплантатов в отдельных упаковках:**

1. Спика Киршнера Ø2,5мм - Длина 200мм

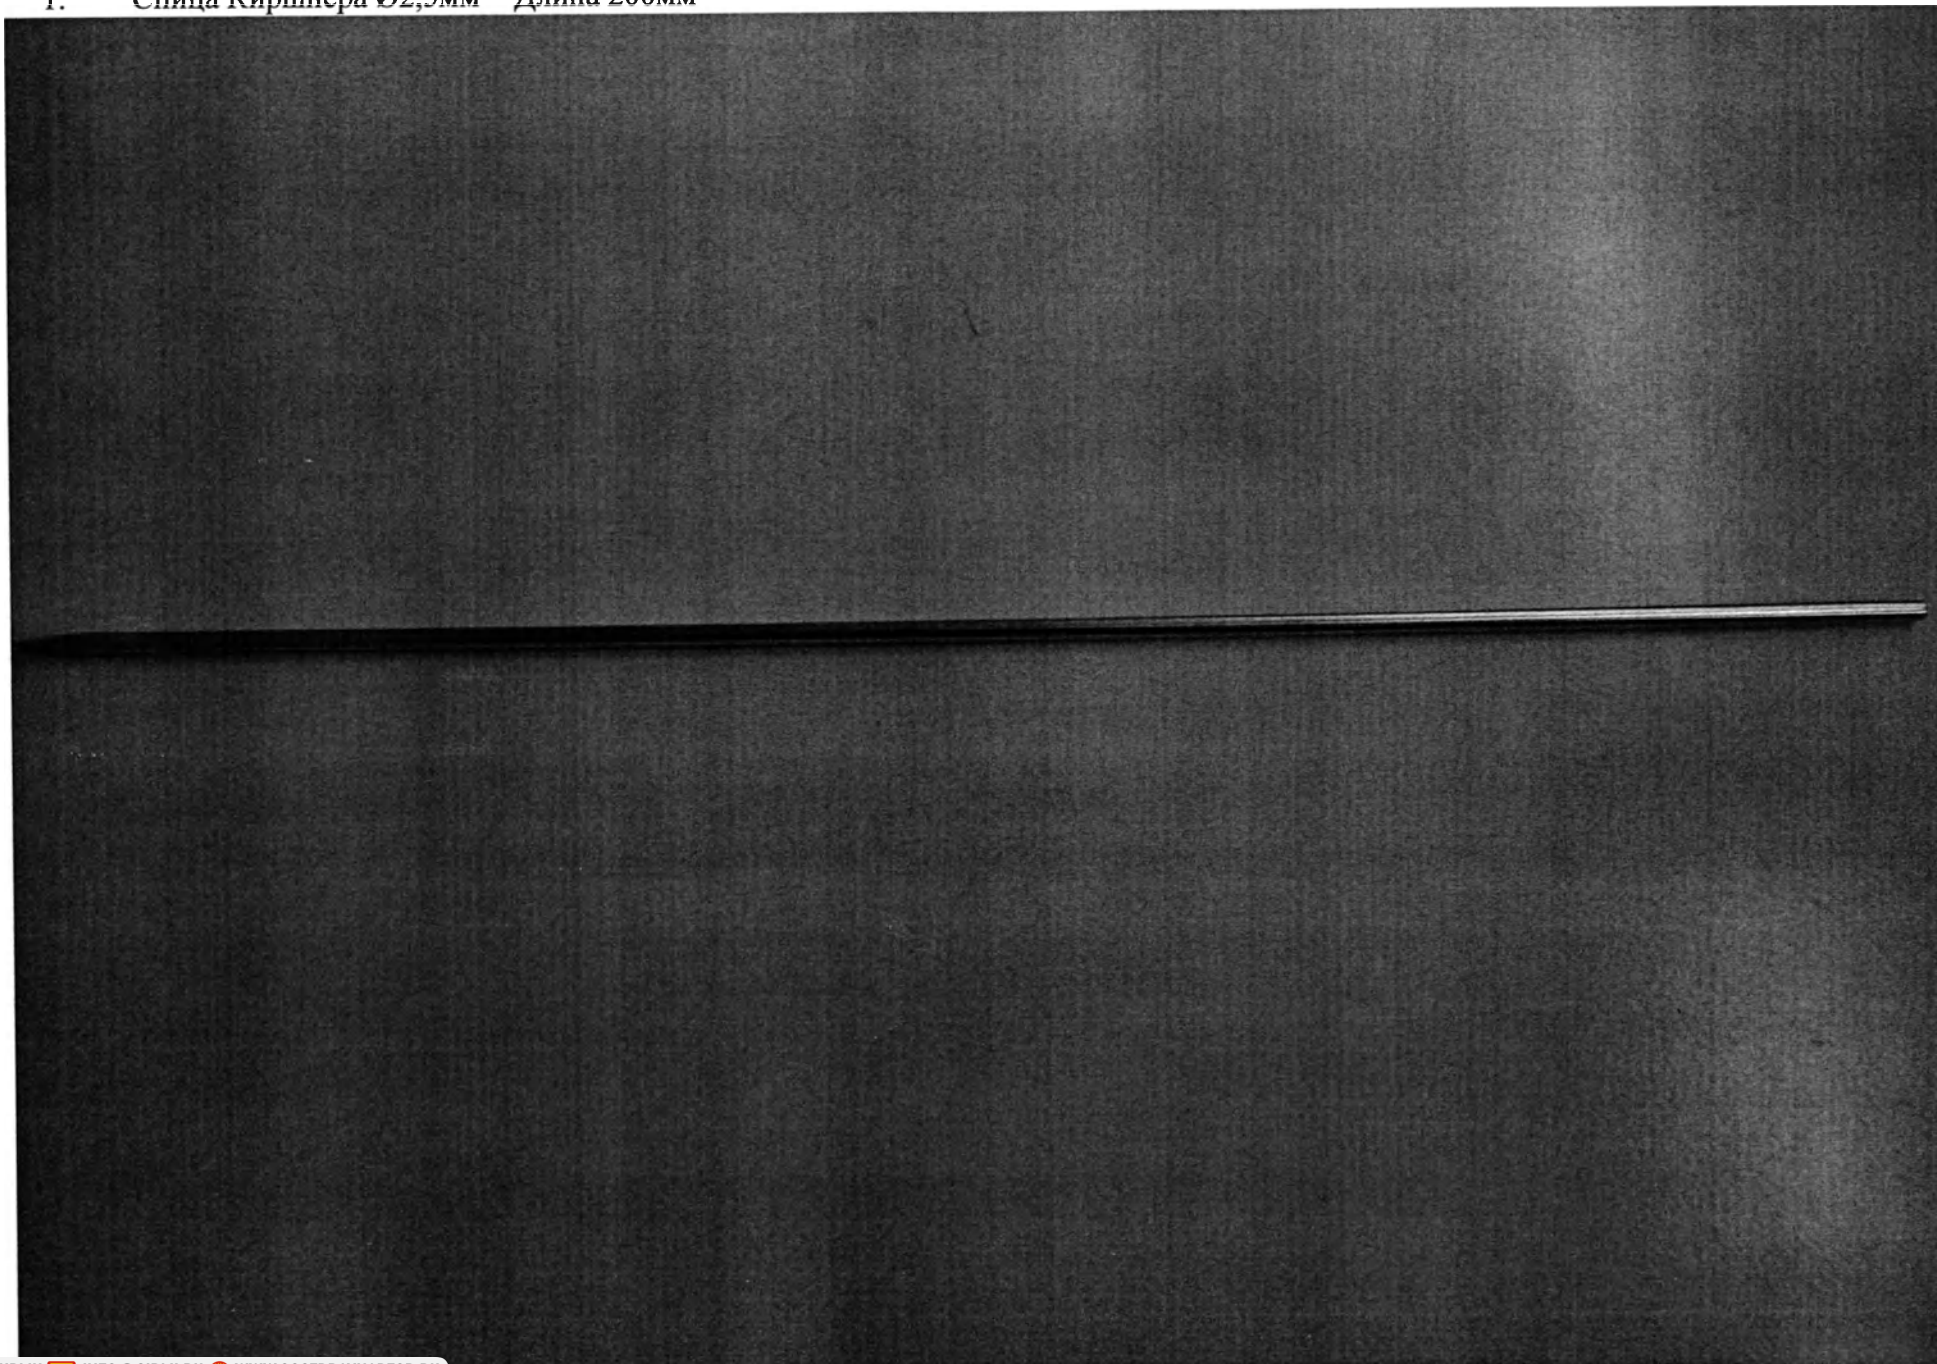



2. Спiца Киршнера Ø1.0мм - Длина 80мм





### 3. Шестигранная отвертка 3,5 мм






4. Направляющая Ø4,5 мм





5. Сверло с делениями Ø 4,5 с системой крепления АО

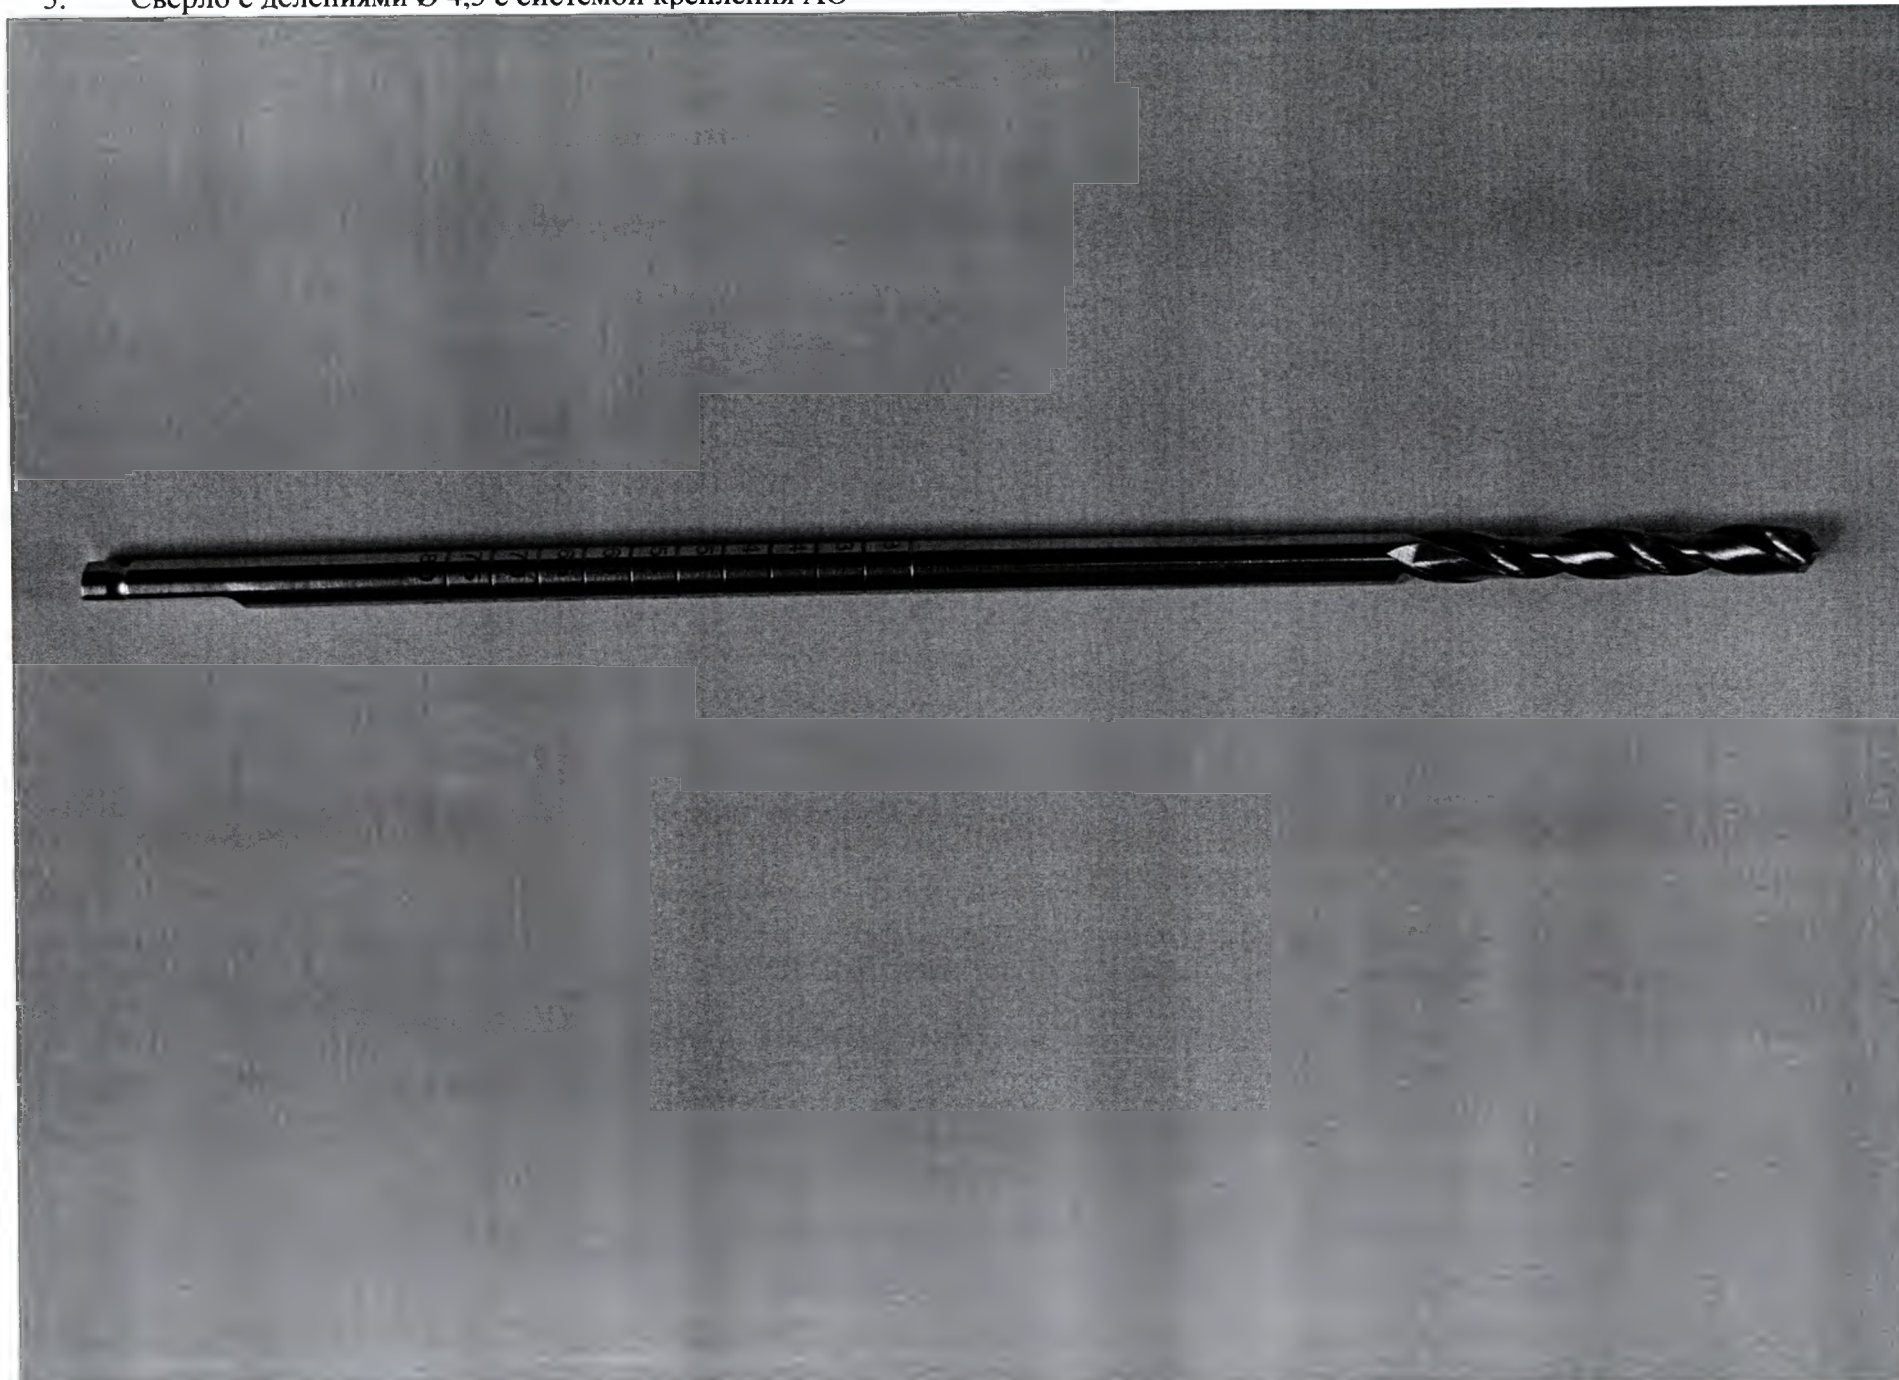









7. Ручка (для открытого клина)





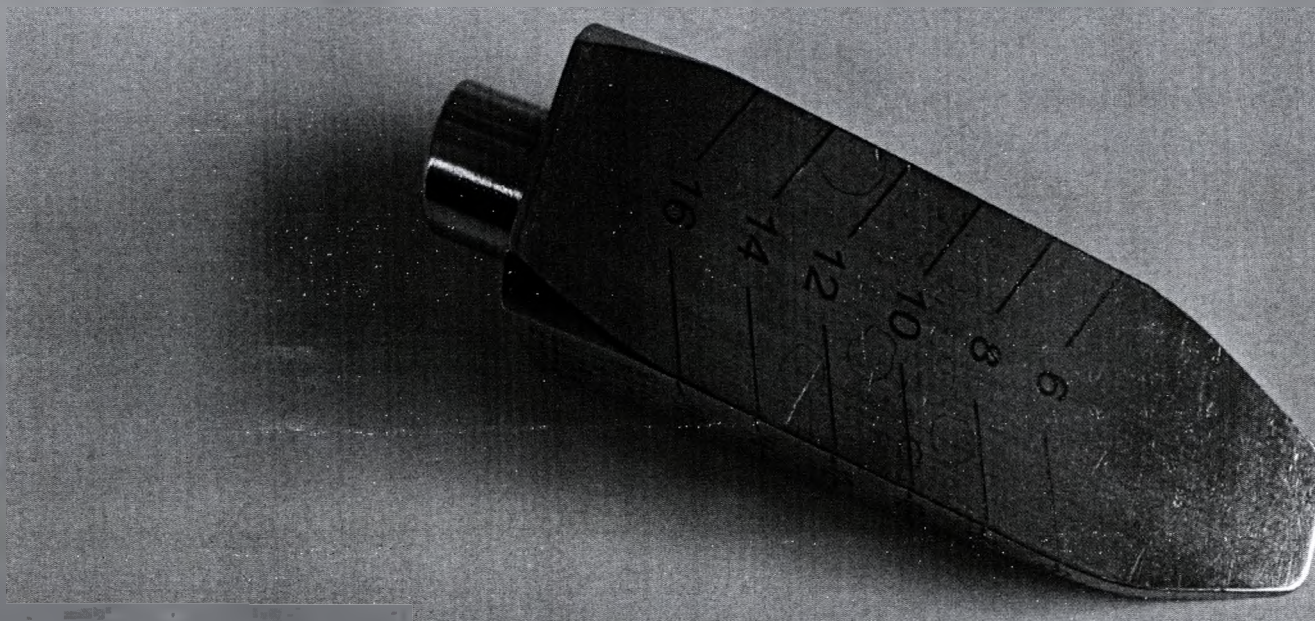




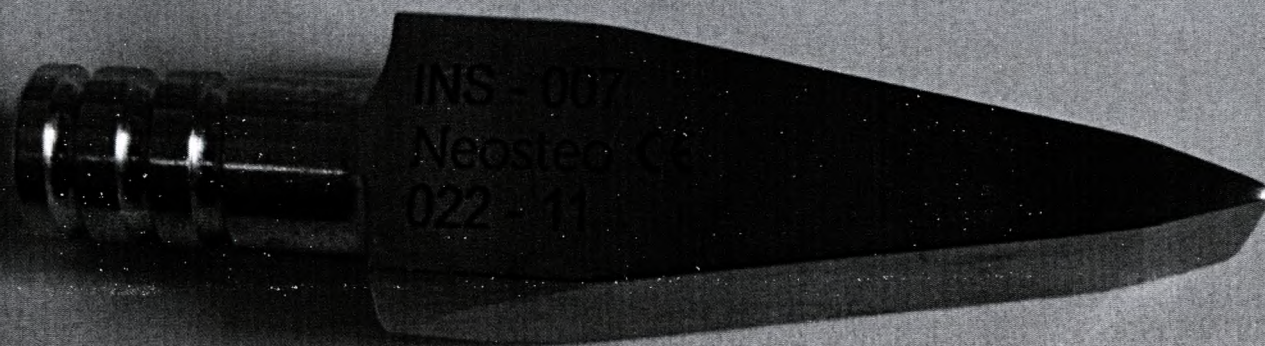



10. Лоток для инструментов при проведении высокой тibiальной остеотомии (ВТО)

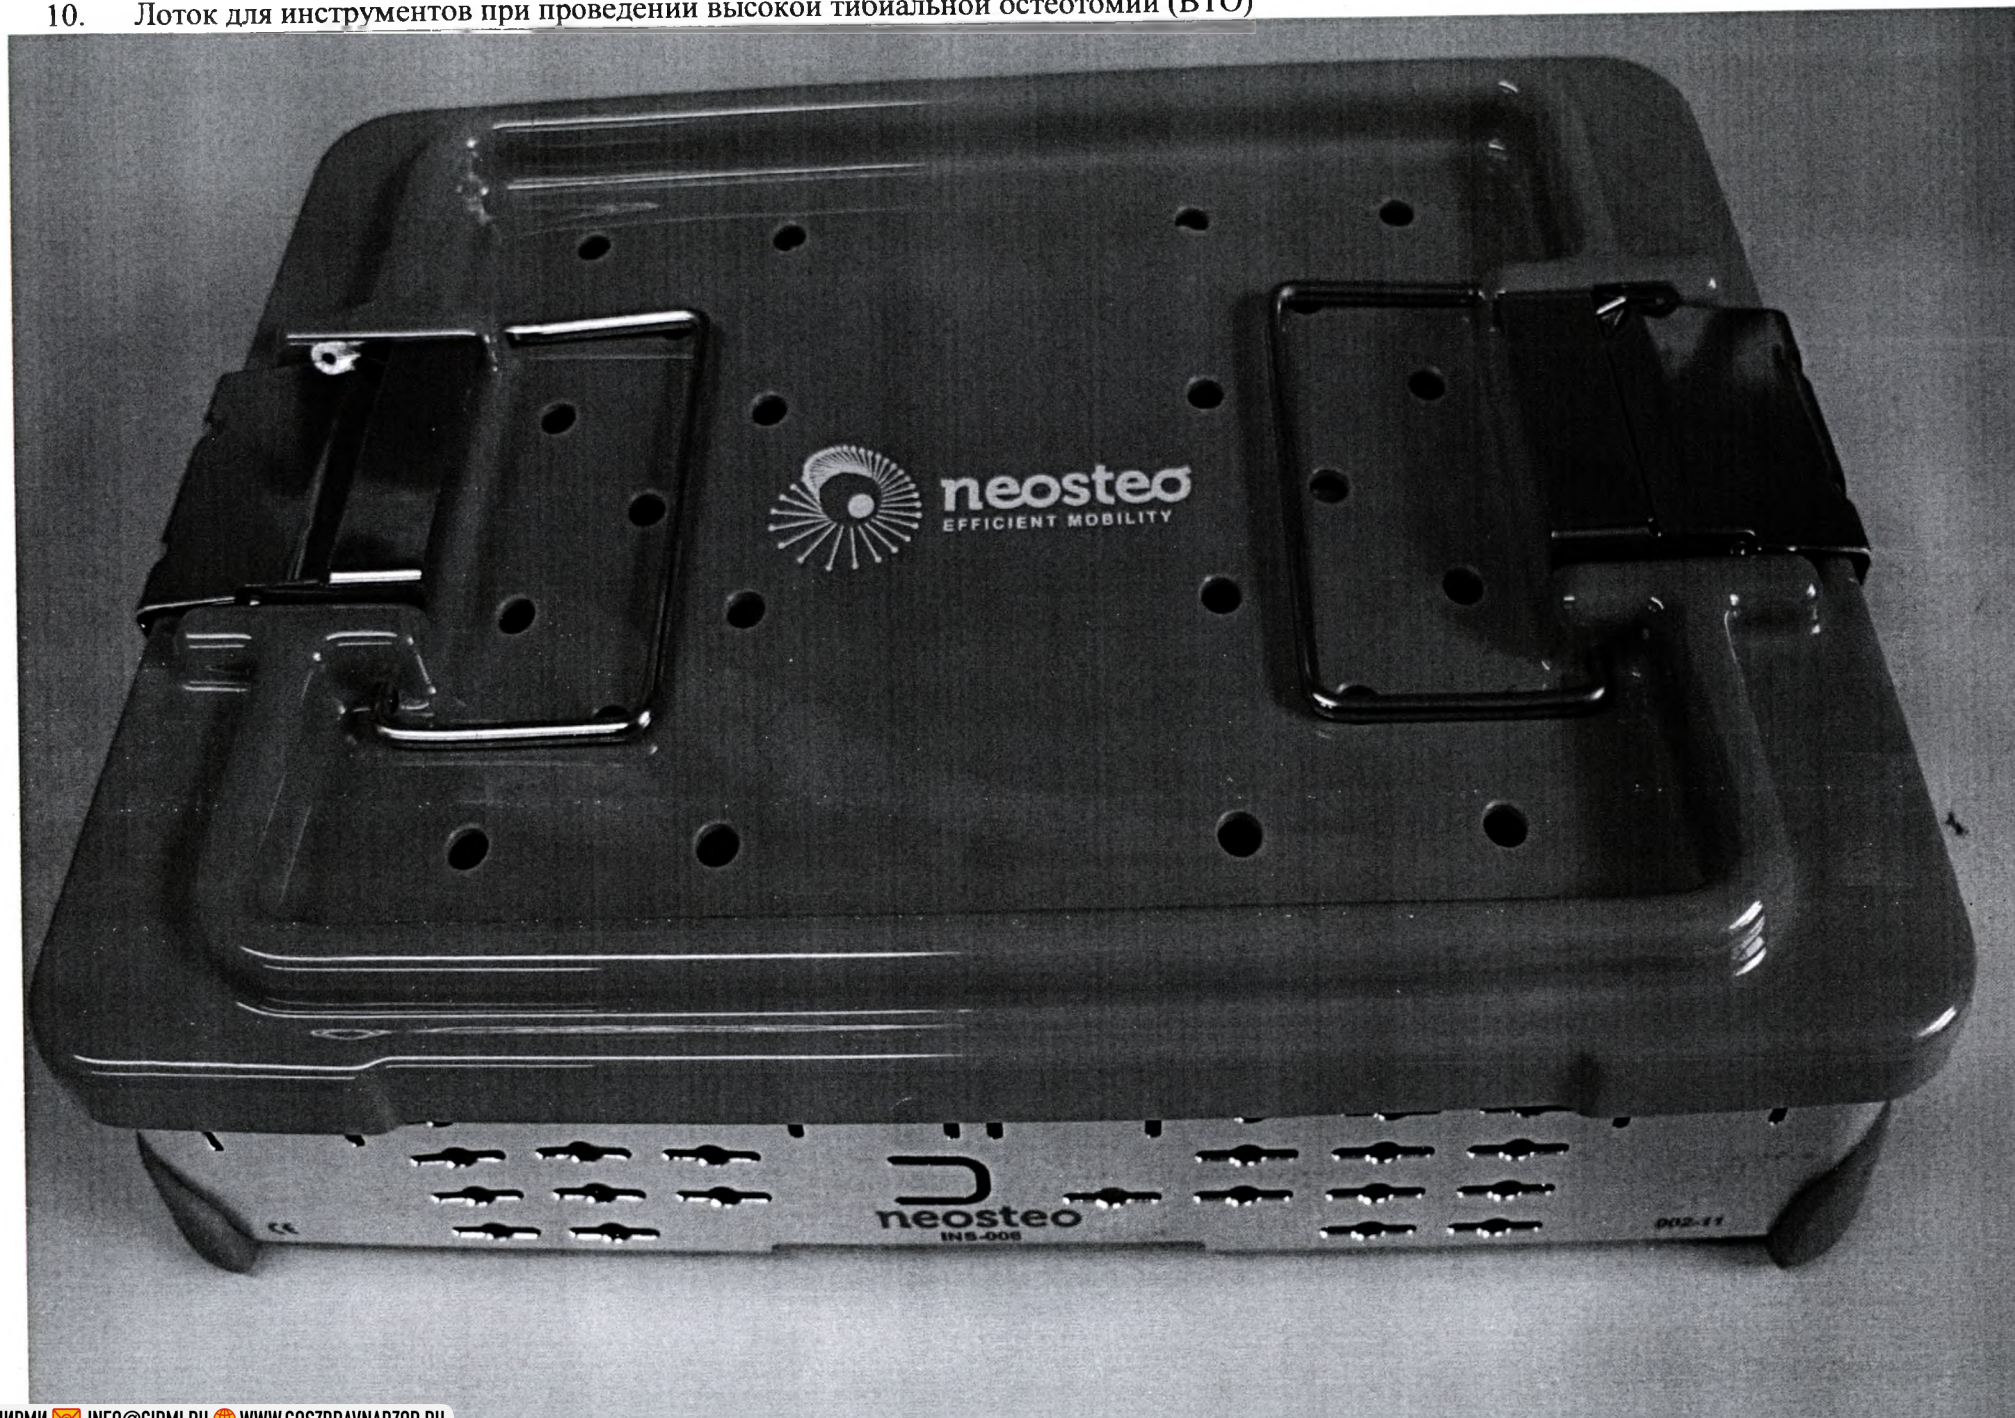




11. Направляющая для закрытой ВТО






12. ВТО шаблон пластины, размер открытия 1 13. ВТО шаблон пластины, размер открытия  
14. ВТО шаблон головки пластины 15. ВТО шаблон пластины, минимальное открытие

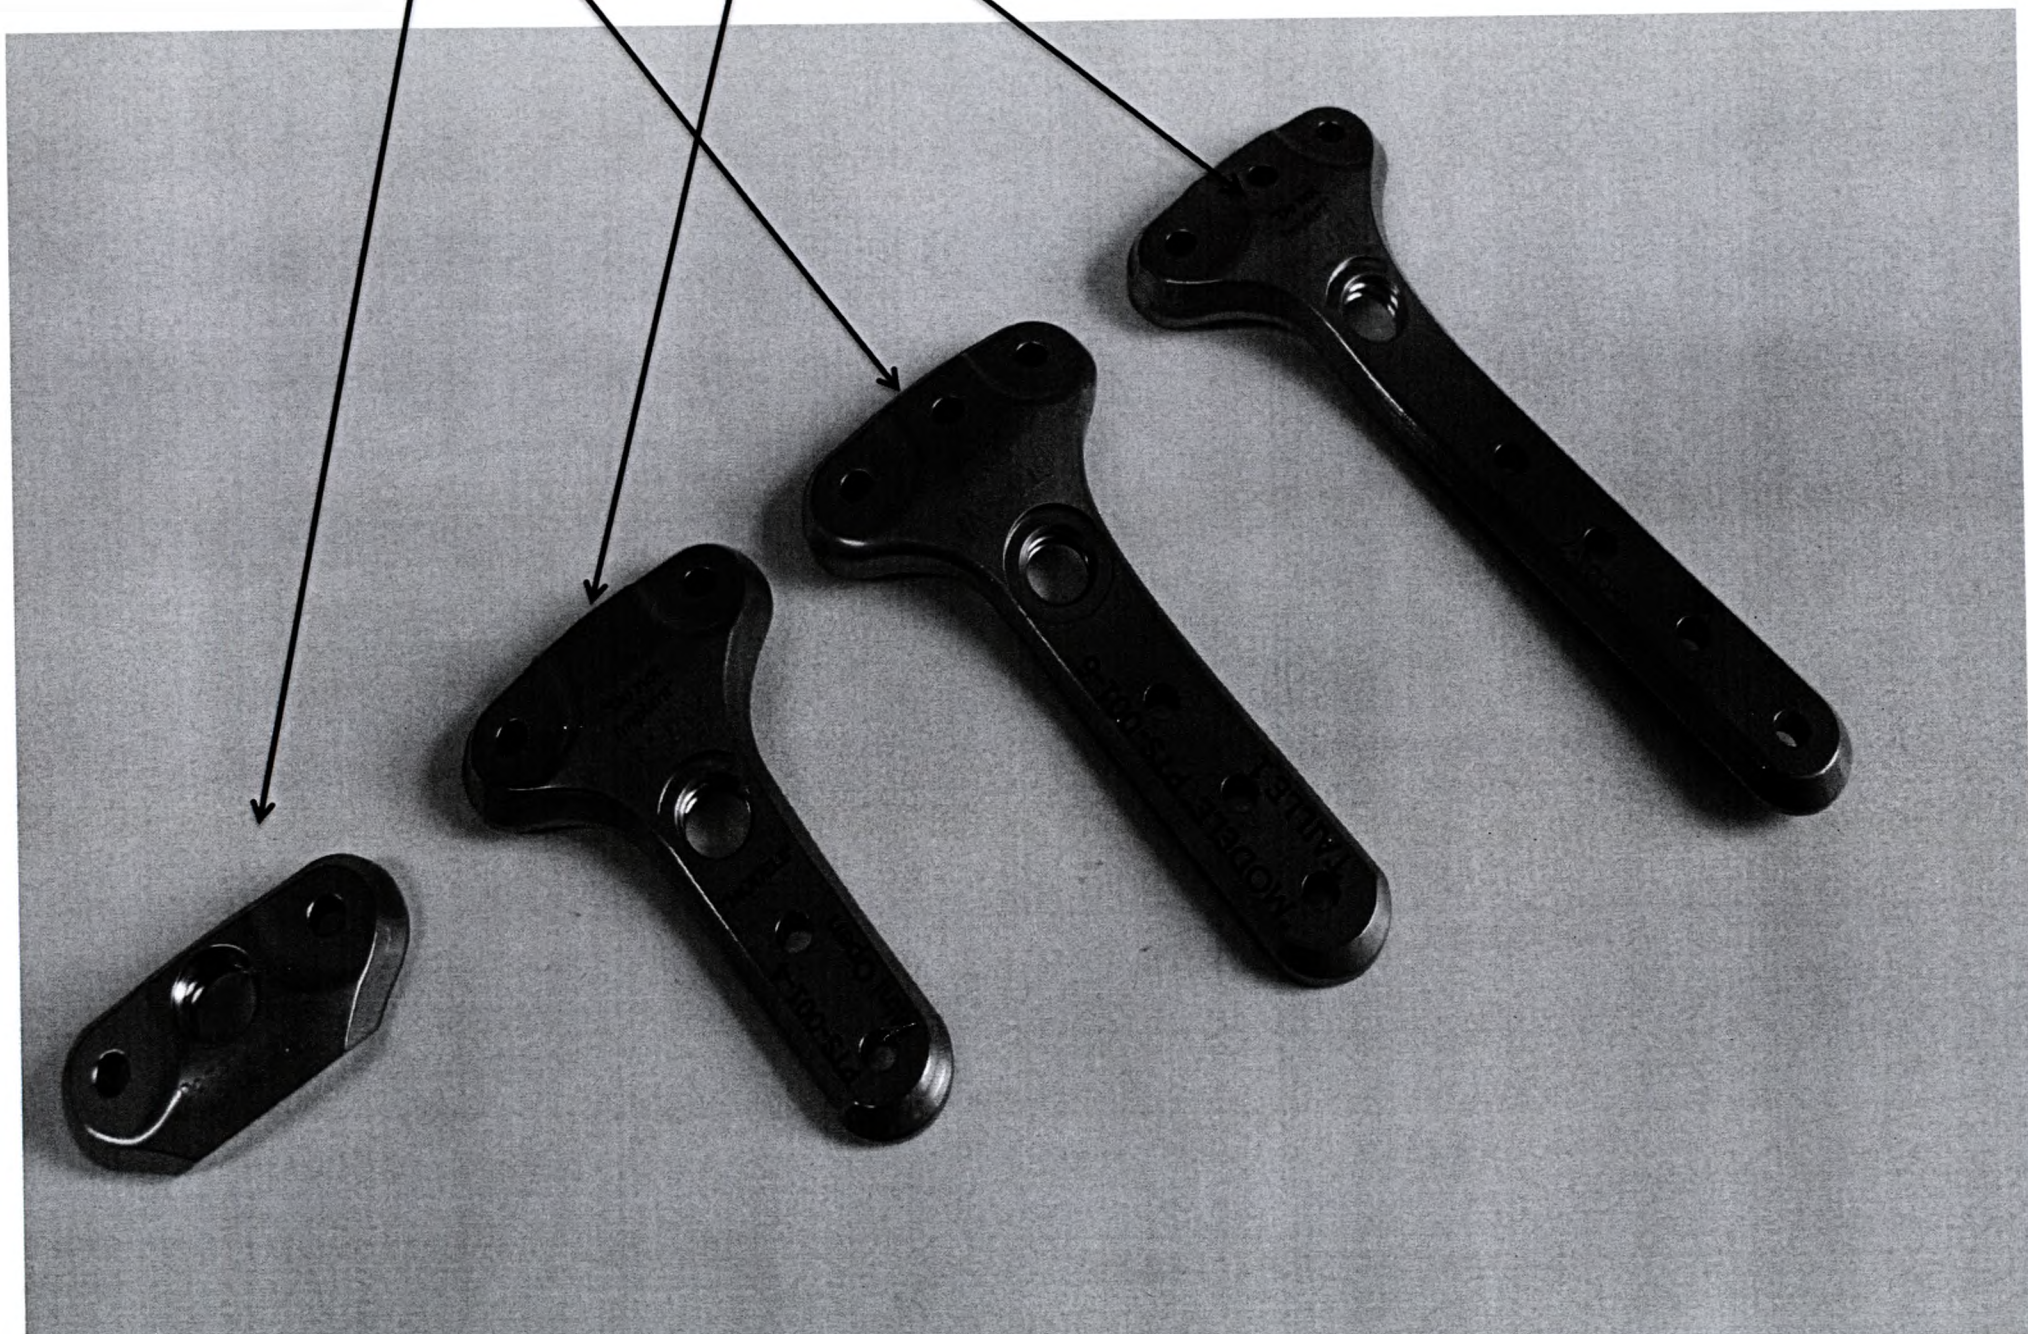




## 16. Костный дистрактор

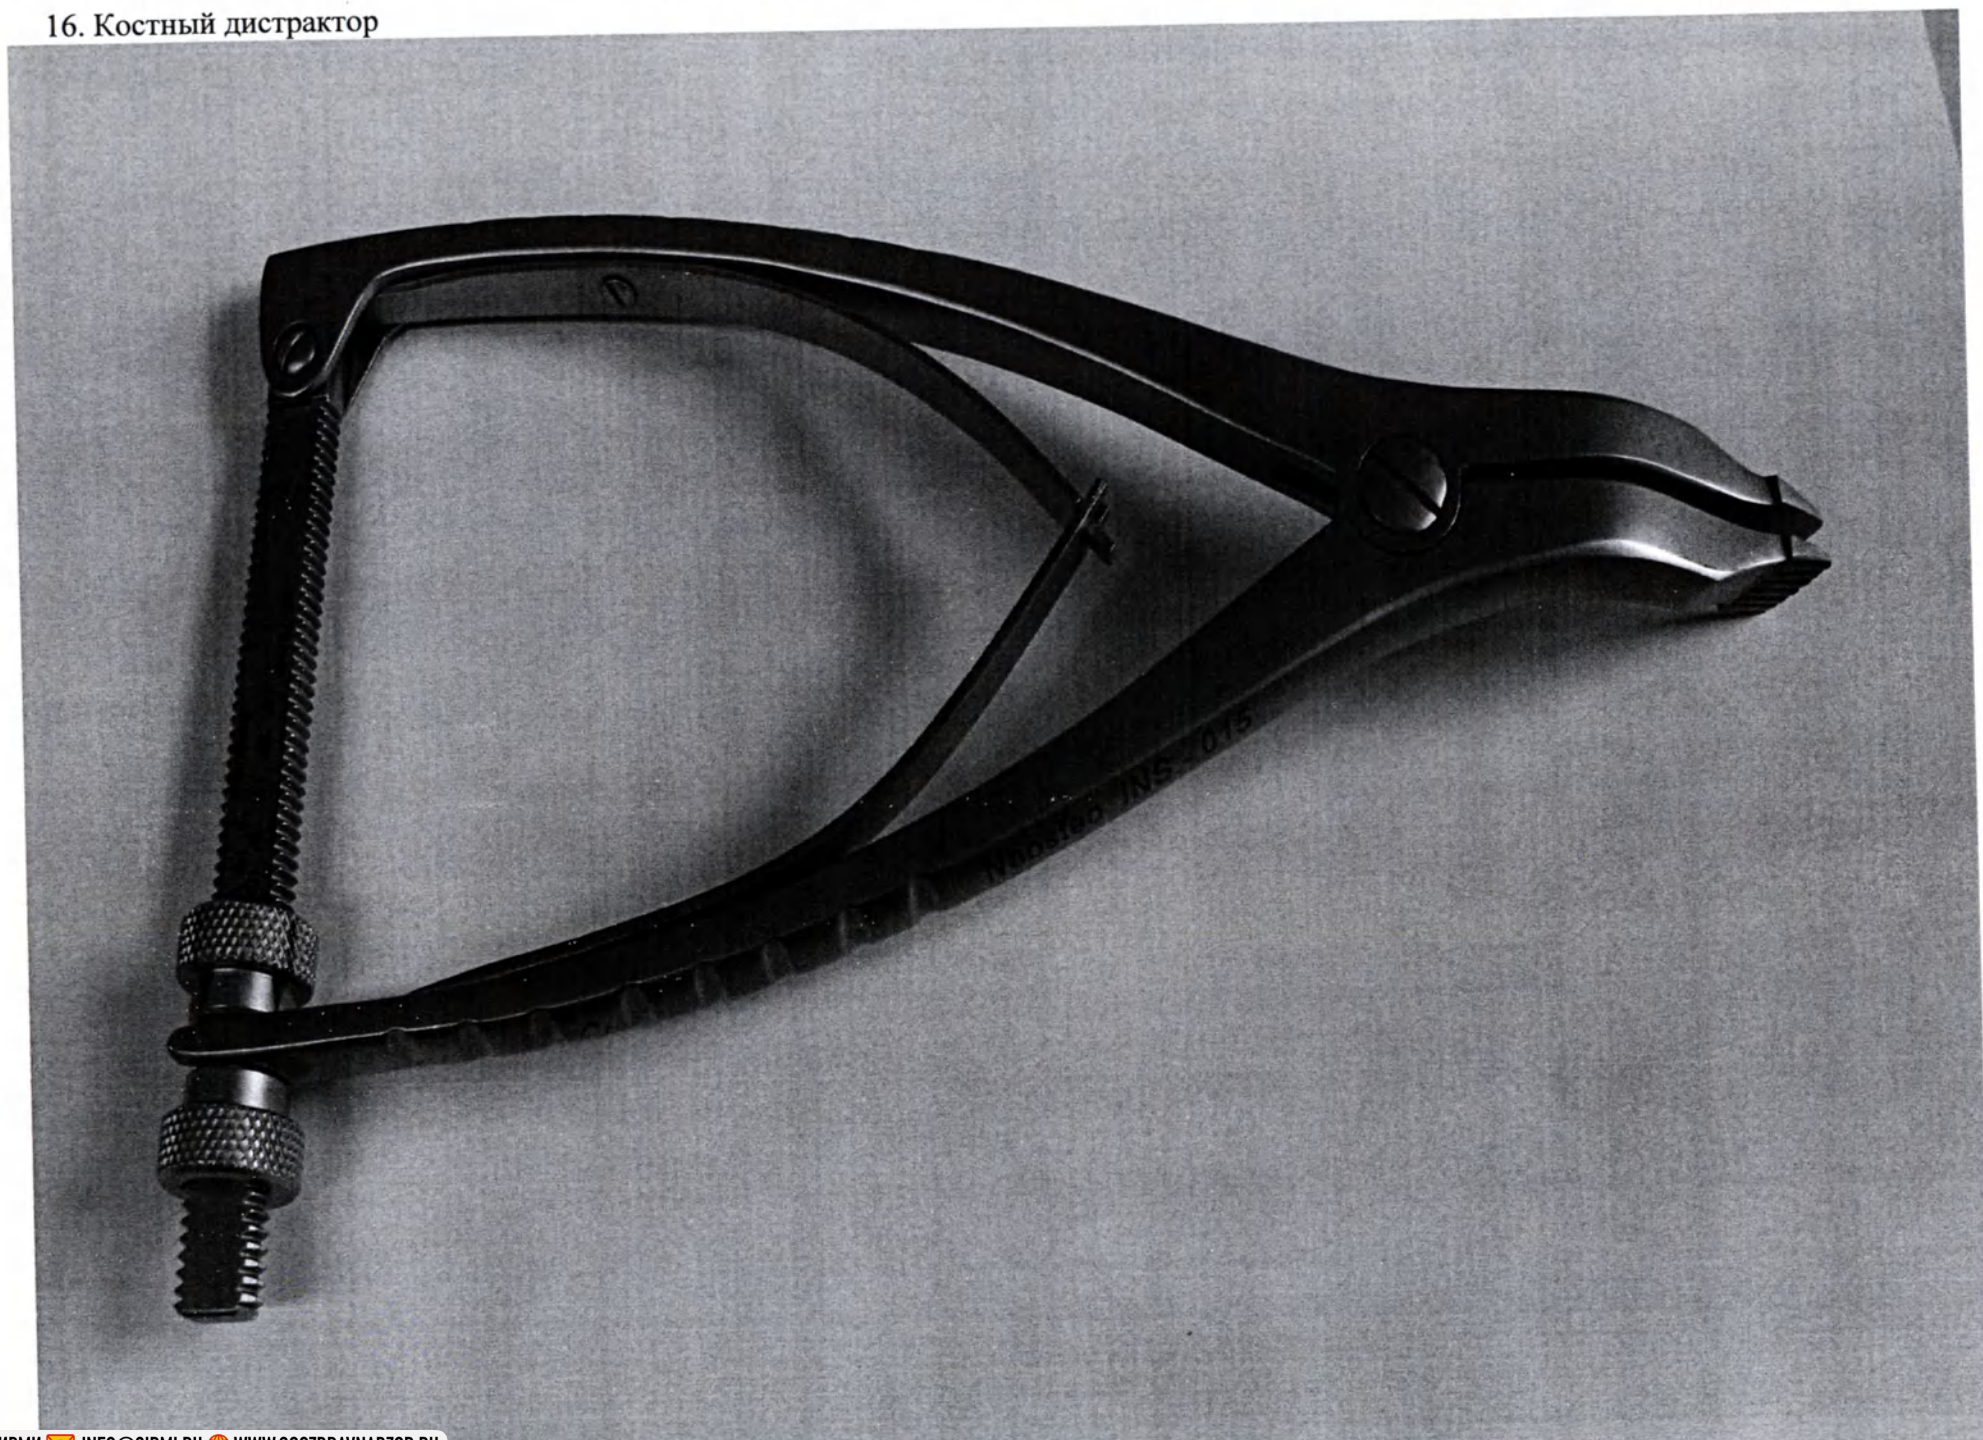




17. ВТО направляющая

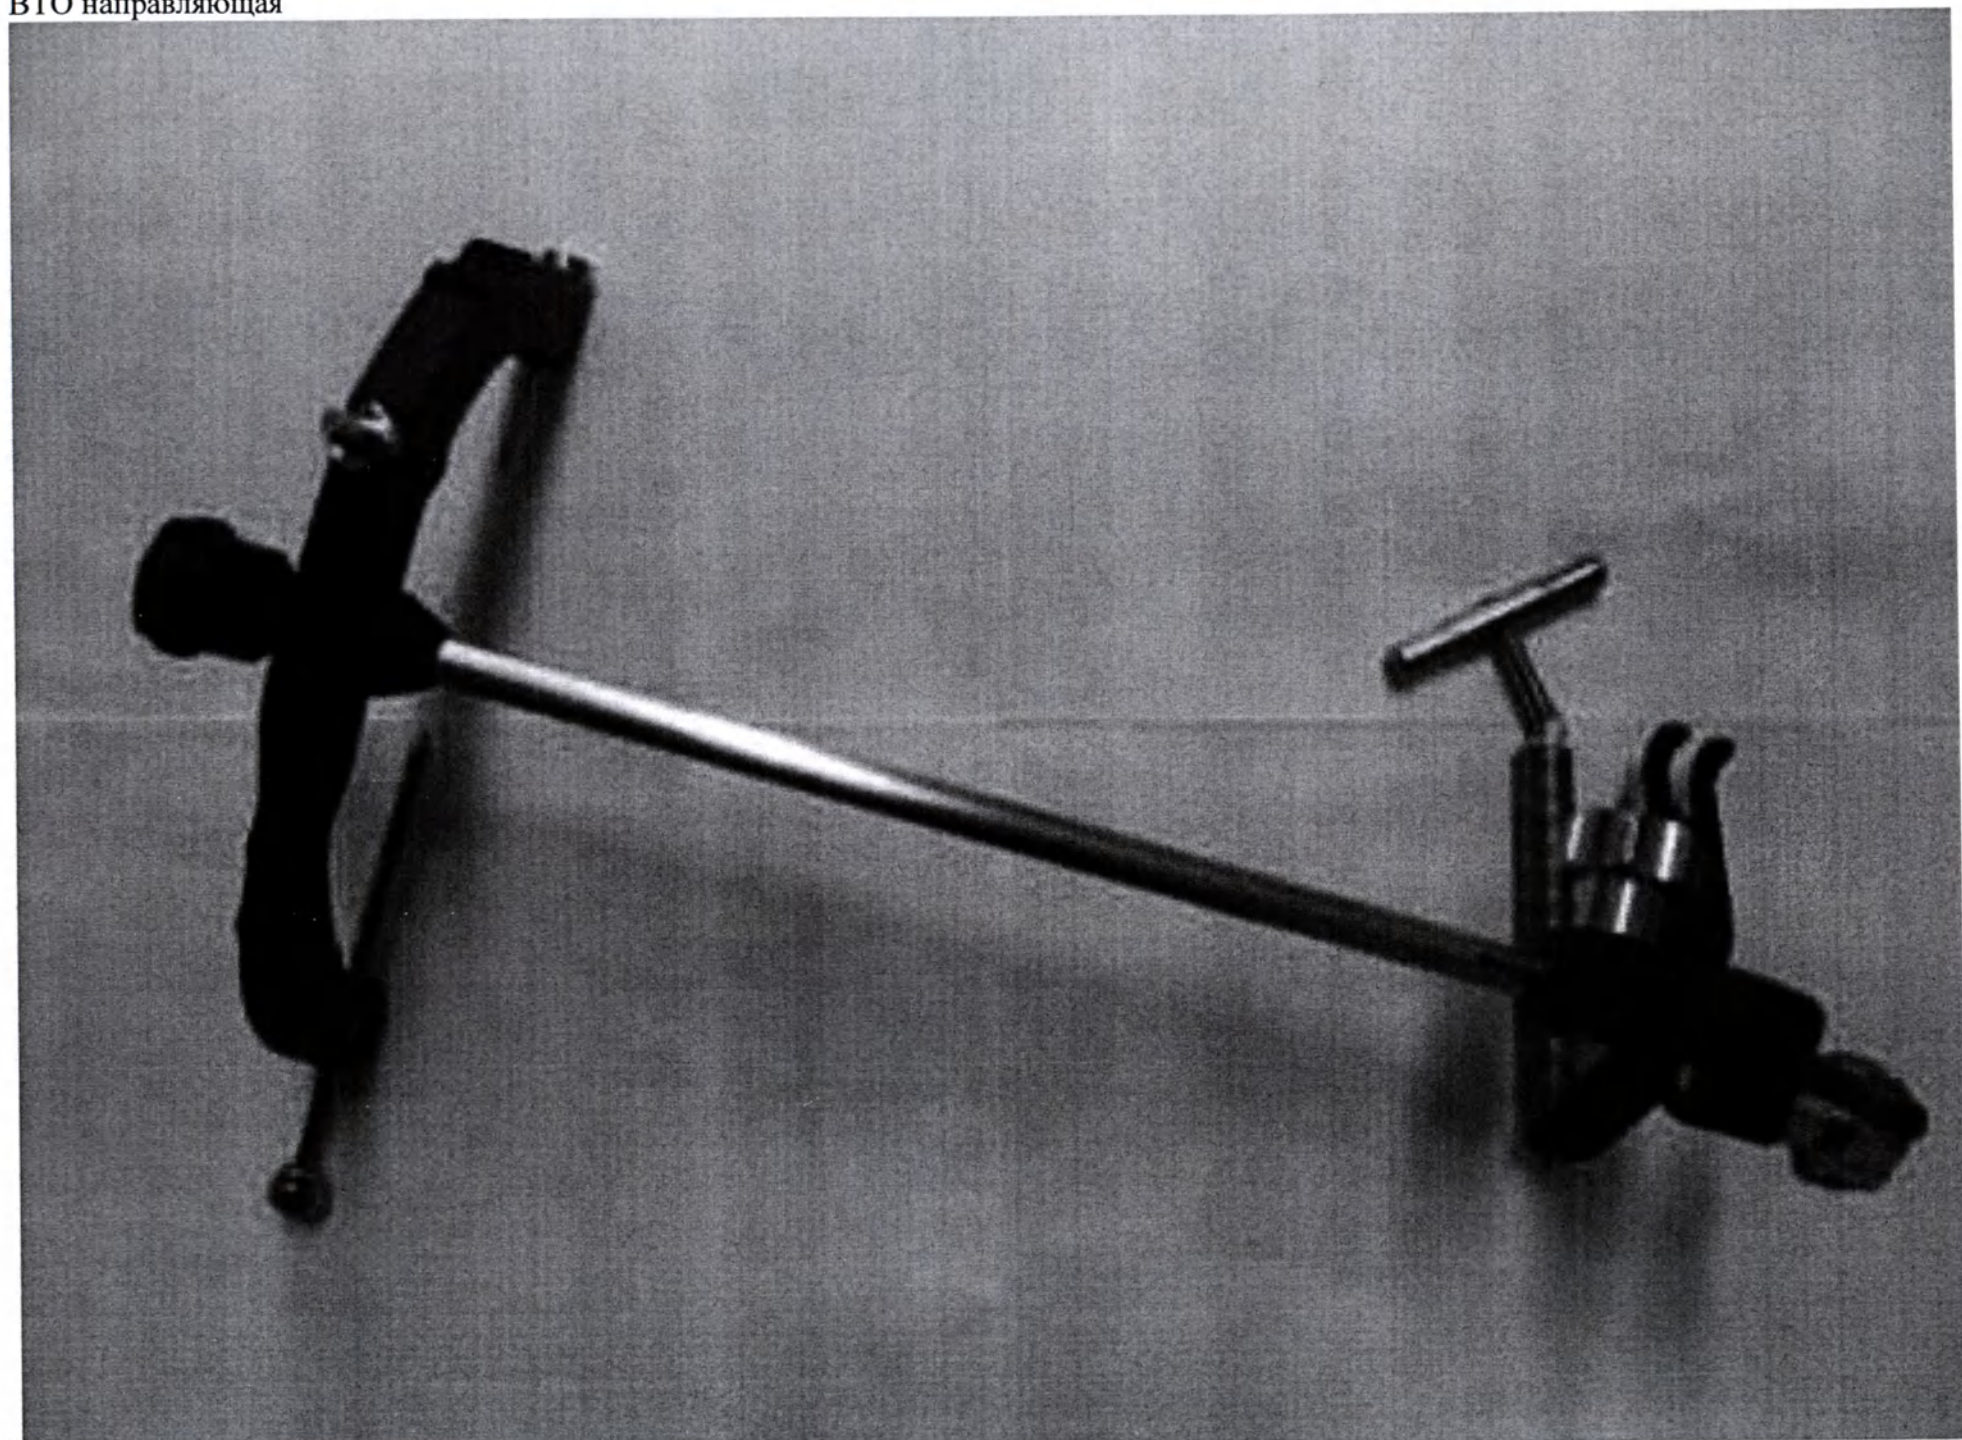




18. Компрессионная деталь, длина 35 мм

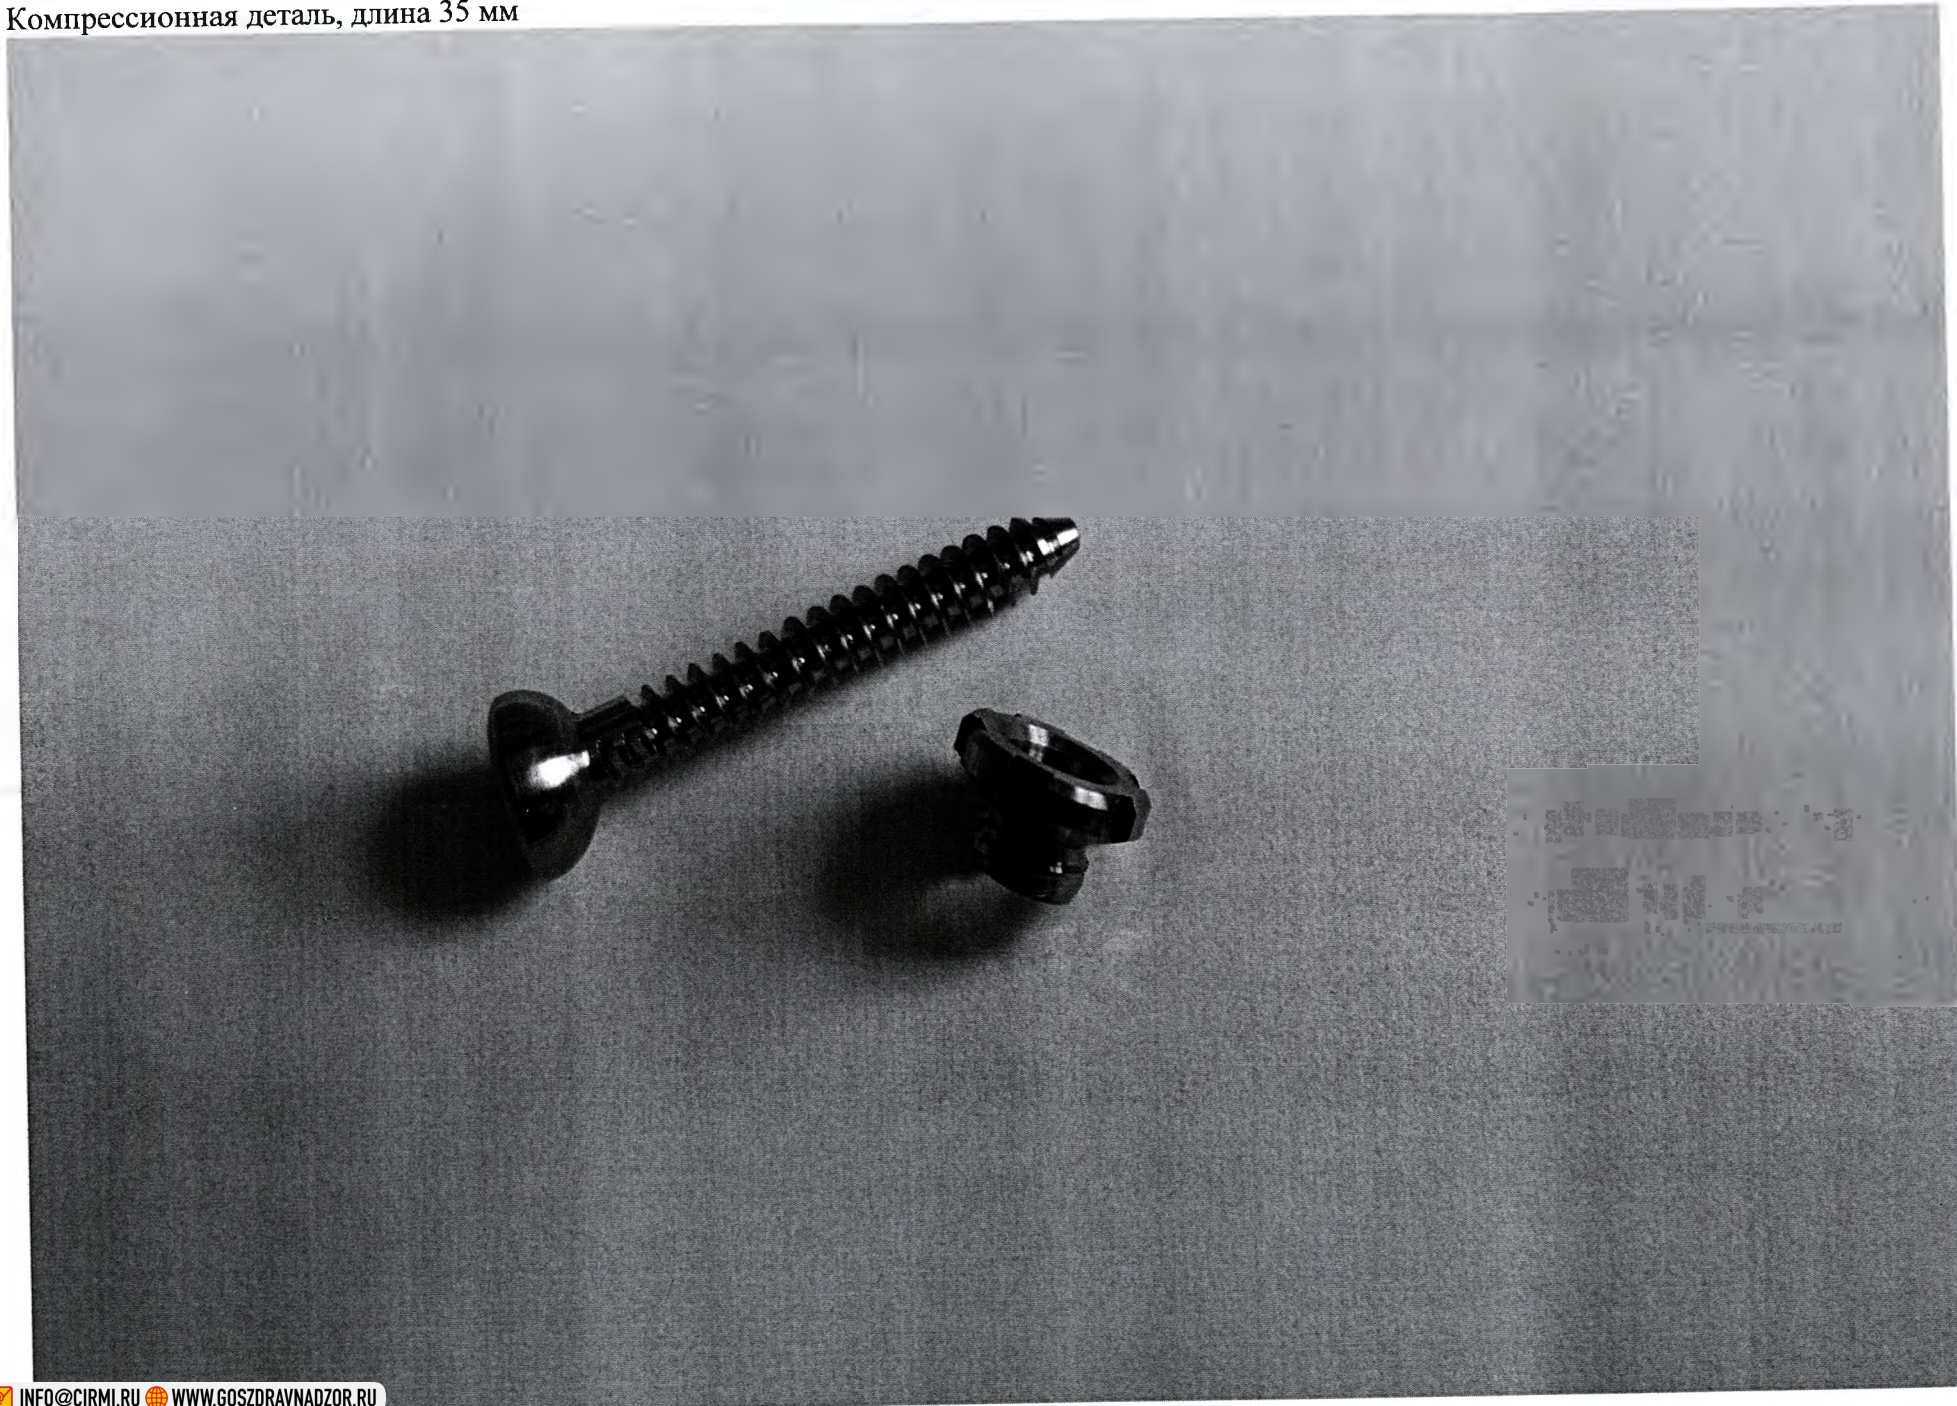




19. Компрессионная деталь, длина 40 мм

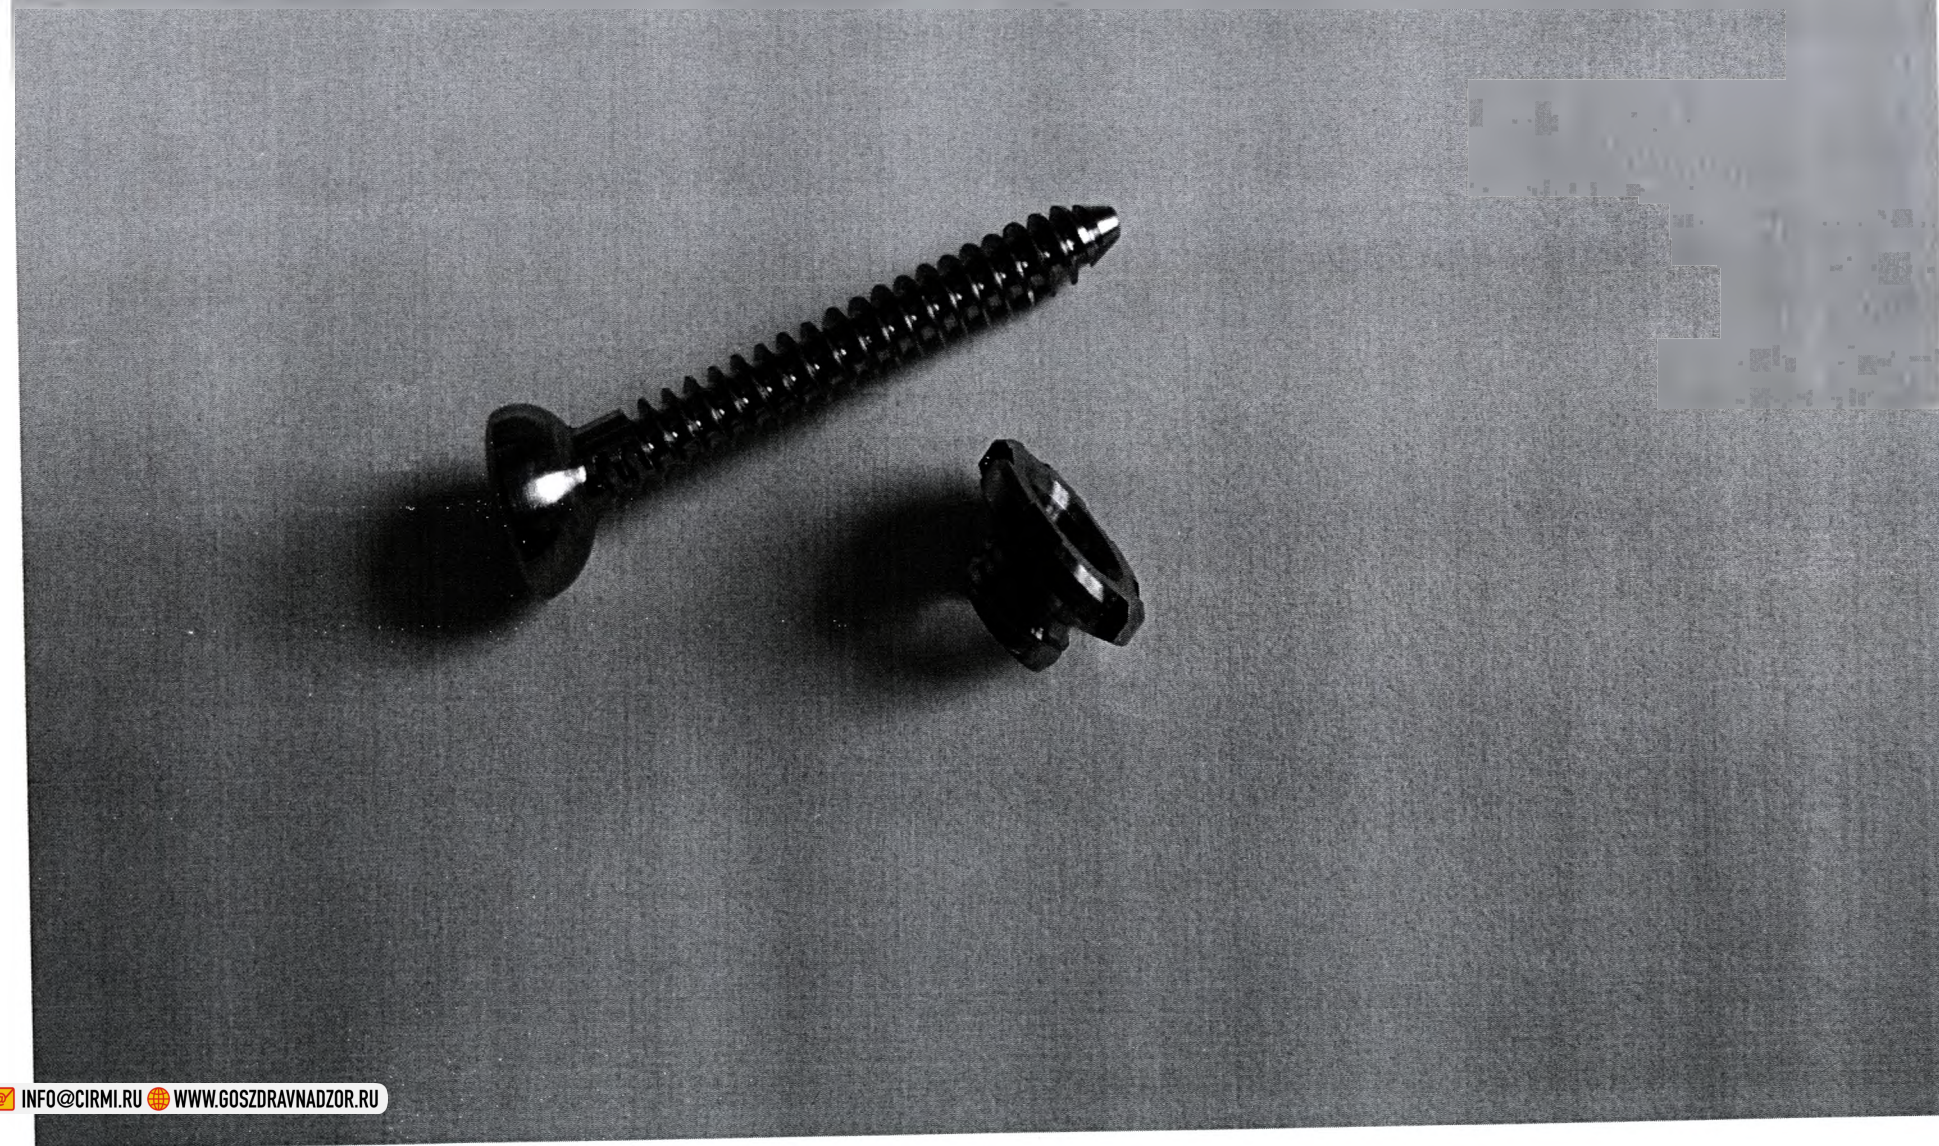




20. Компрессионная деталь, длина 45 мм

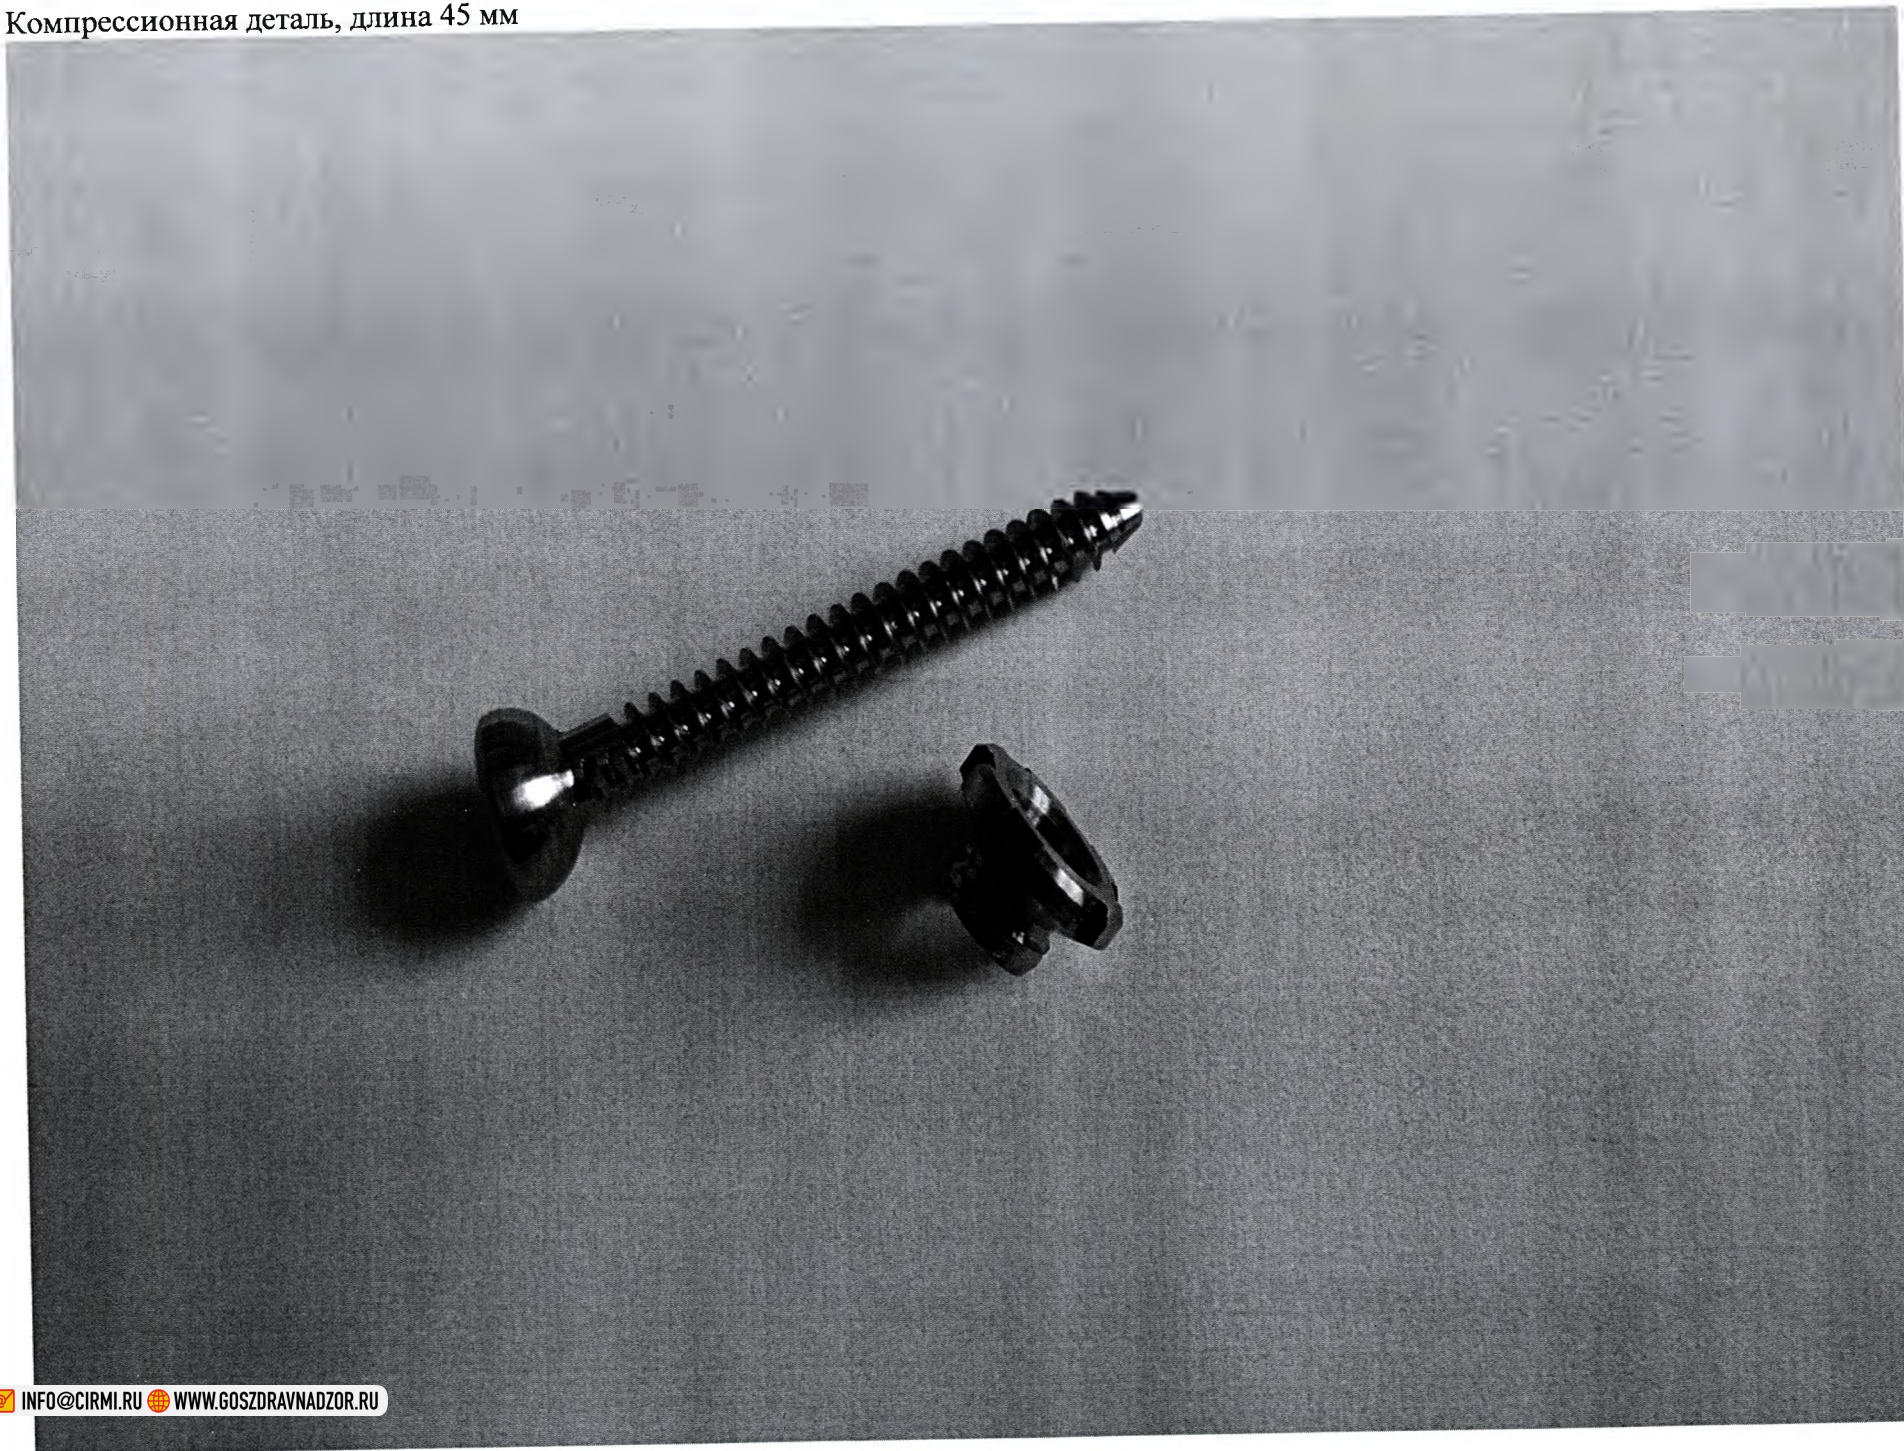




21. Компрессионная деталь, длина 50 мм

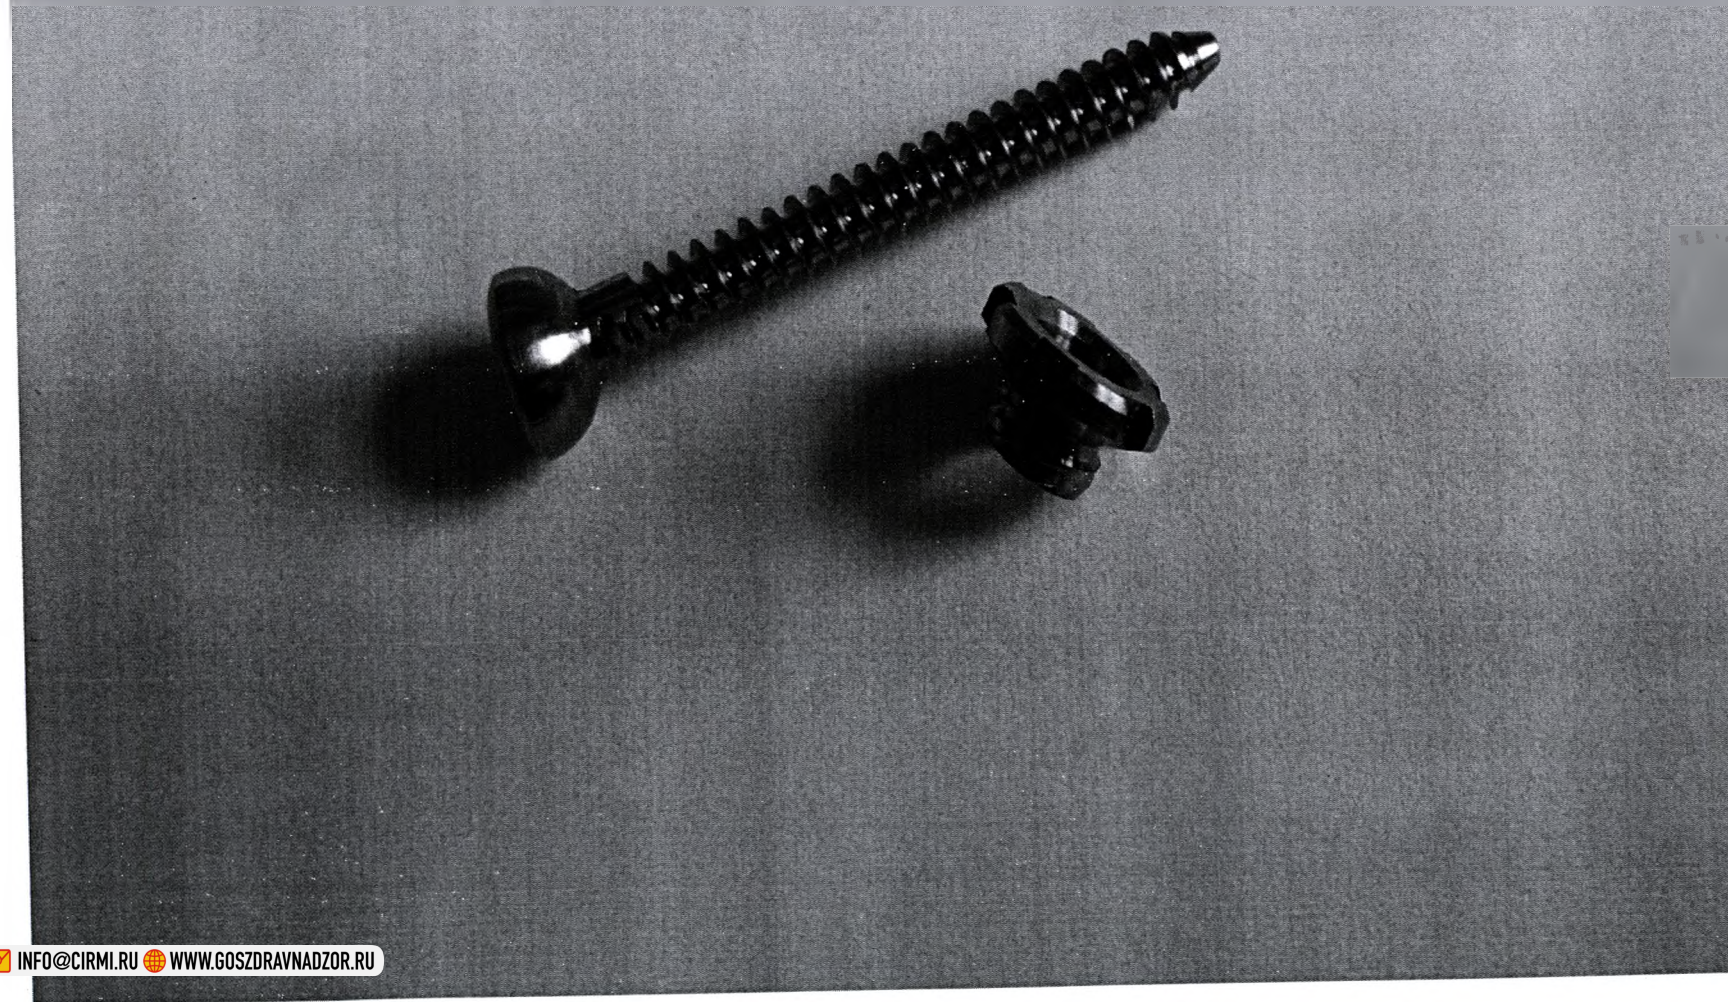




22. Компрессионная деталь, длина 55 мм

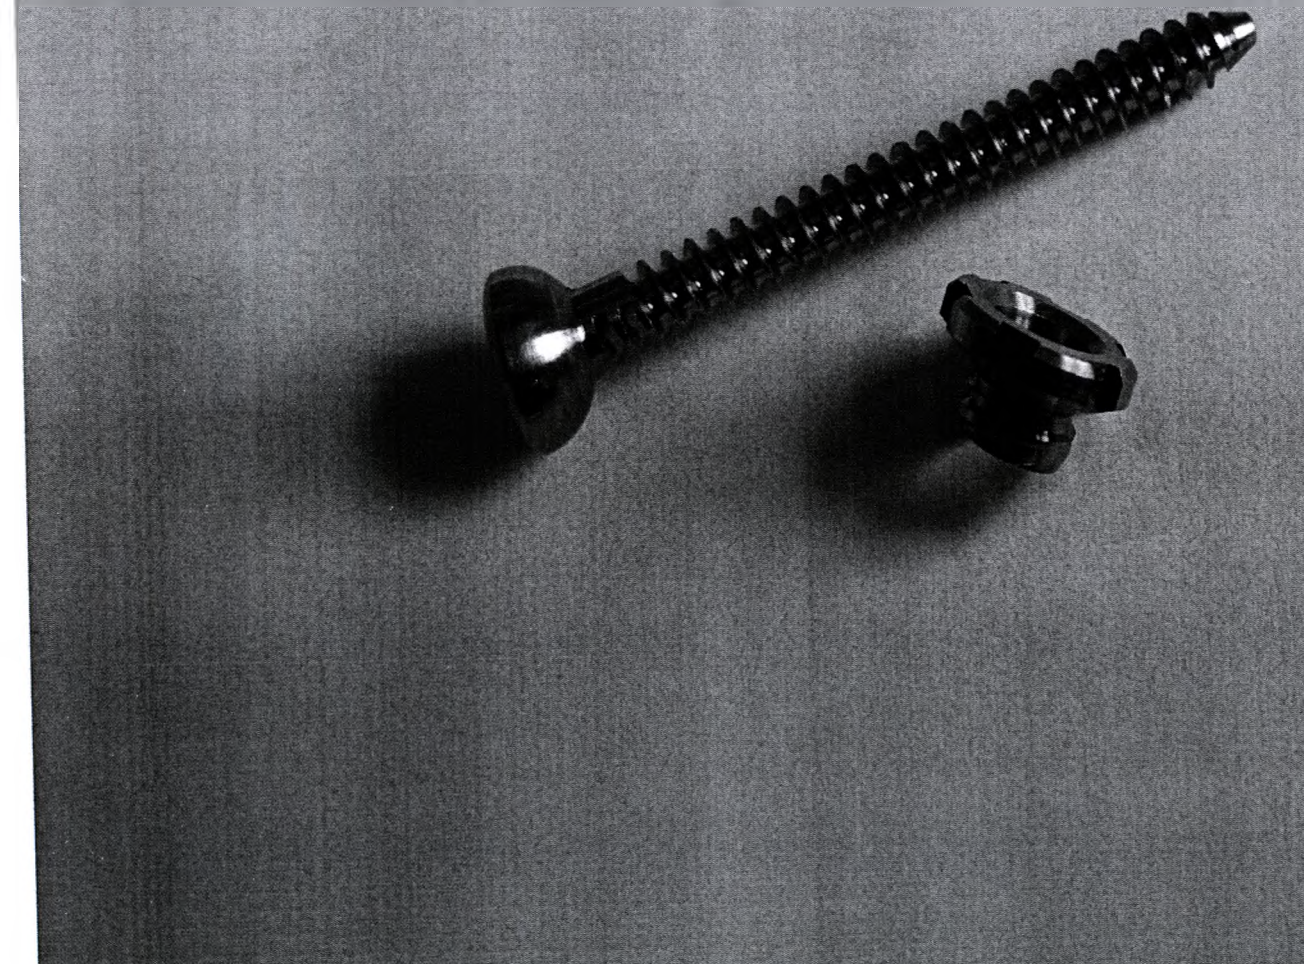



## 23. Направляющая для компрессионной детали

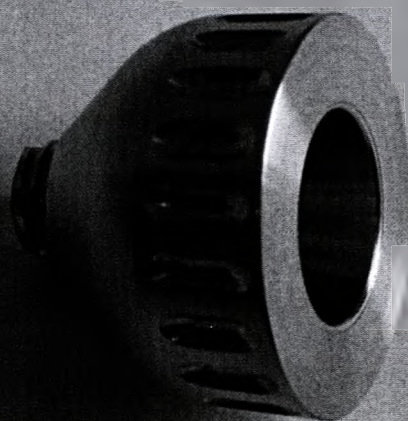



24. Сверло с делениями Ø3,5 мм с системой крепления АО






25. Канюлированная шестигранная отвертка 1,8 мм с системой крепления АО










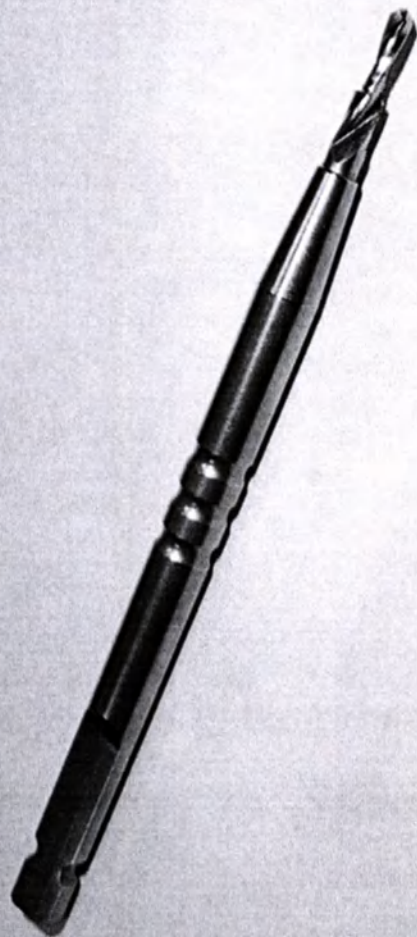



28. Канюлированная шестигранная отвертка 1.8мм с функцией самоблокировки и системой крепления АО

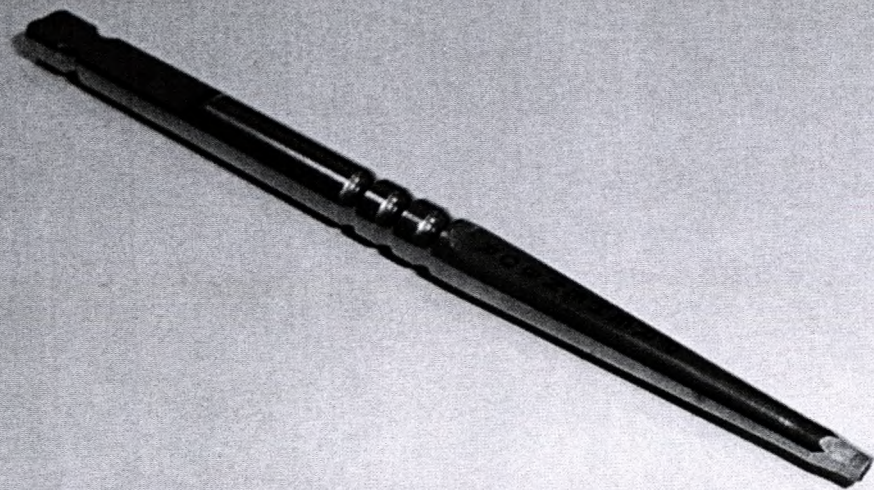




29. Зенкер канюлированный Ø2.5мм с системой крепления АО






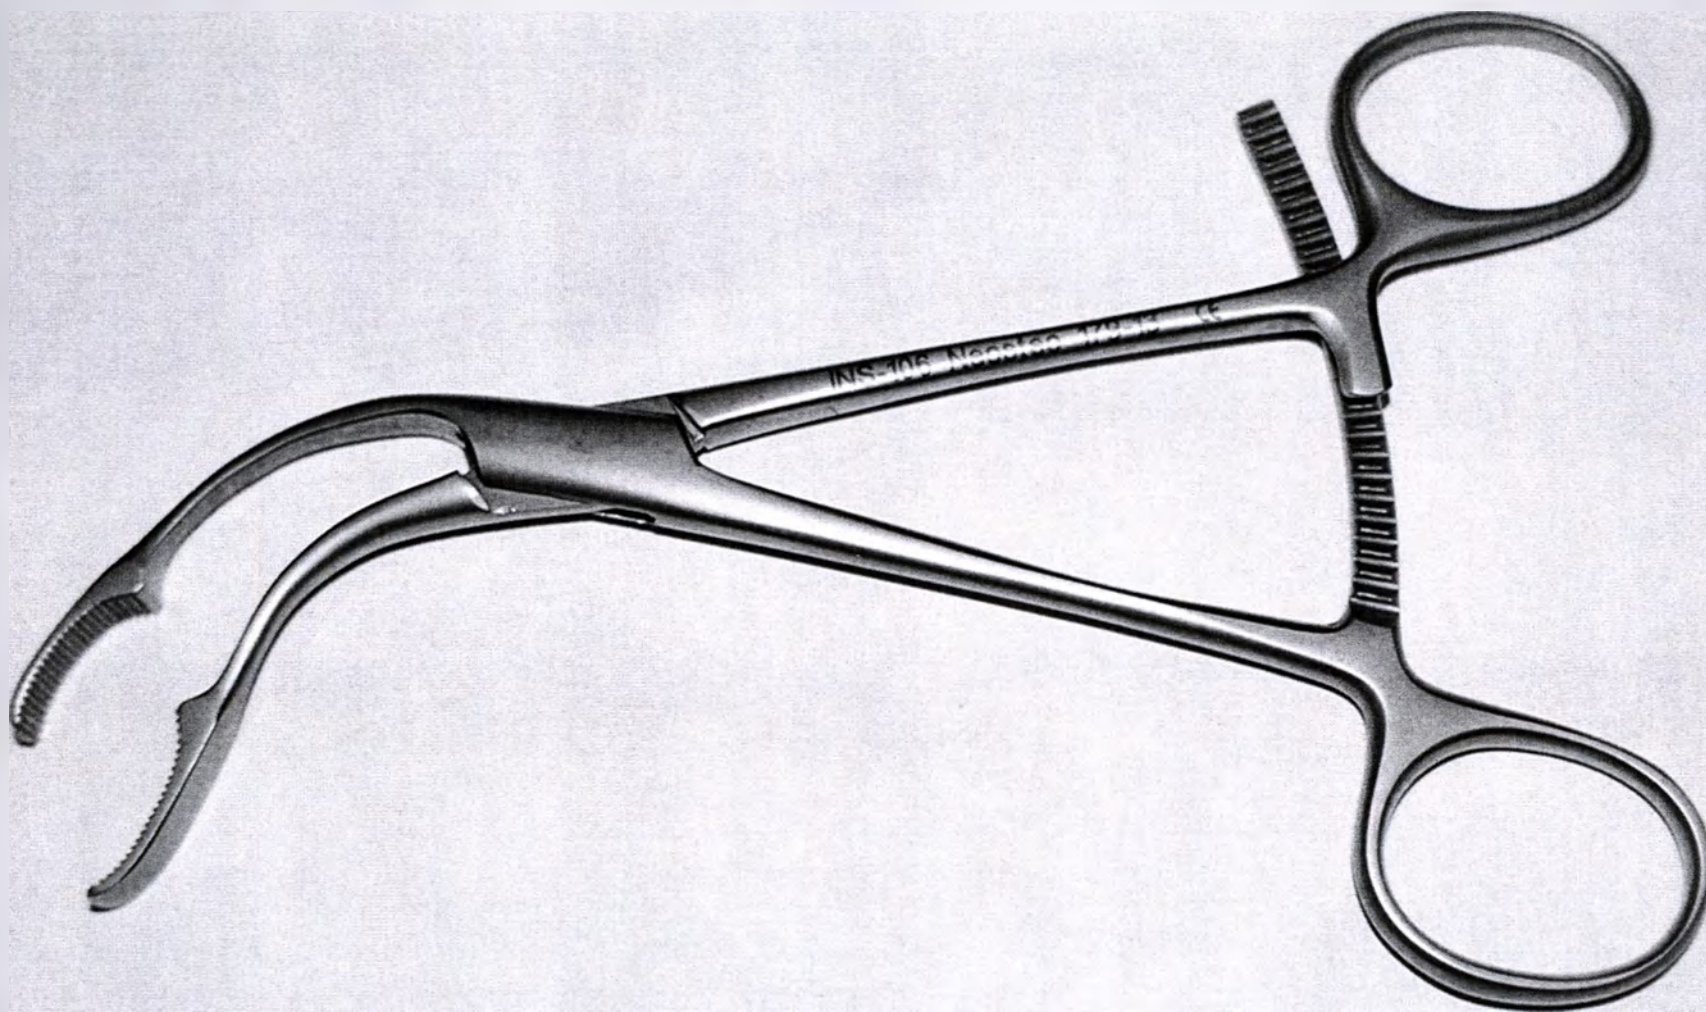




31. Глубиномер для хирургии стопы 6-40 мм

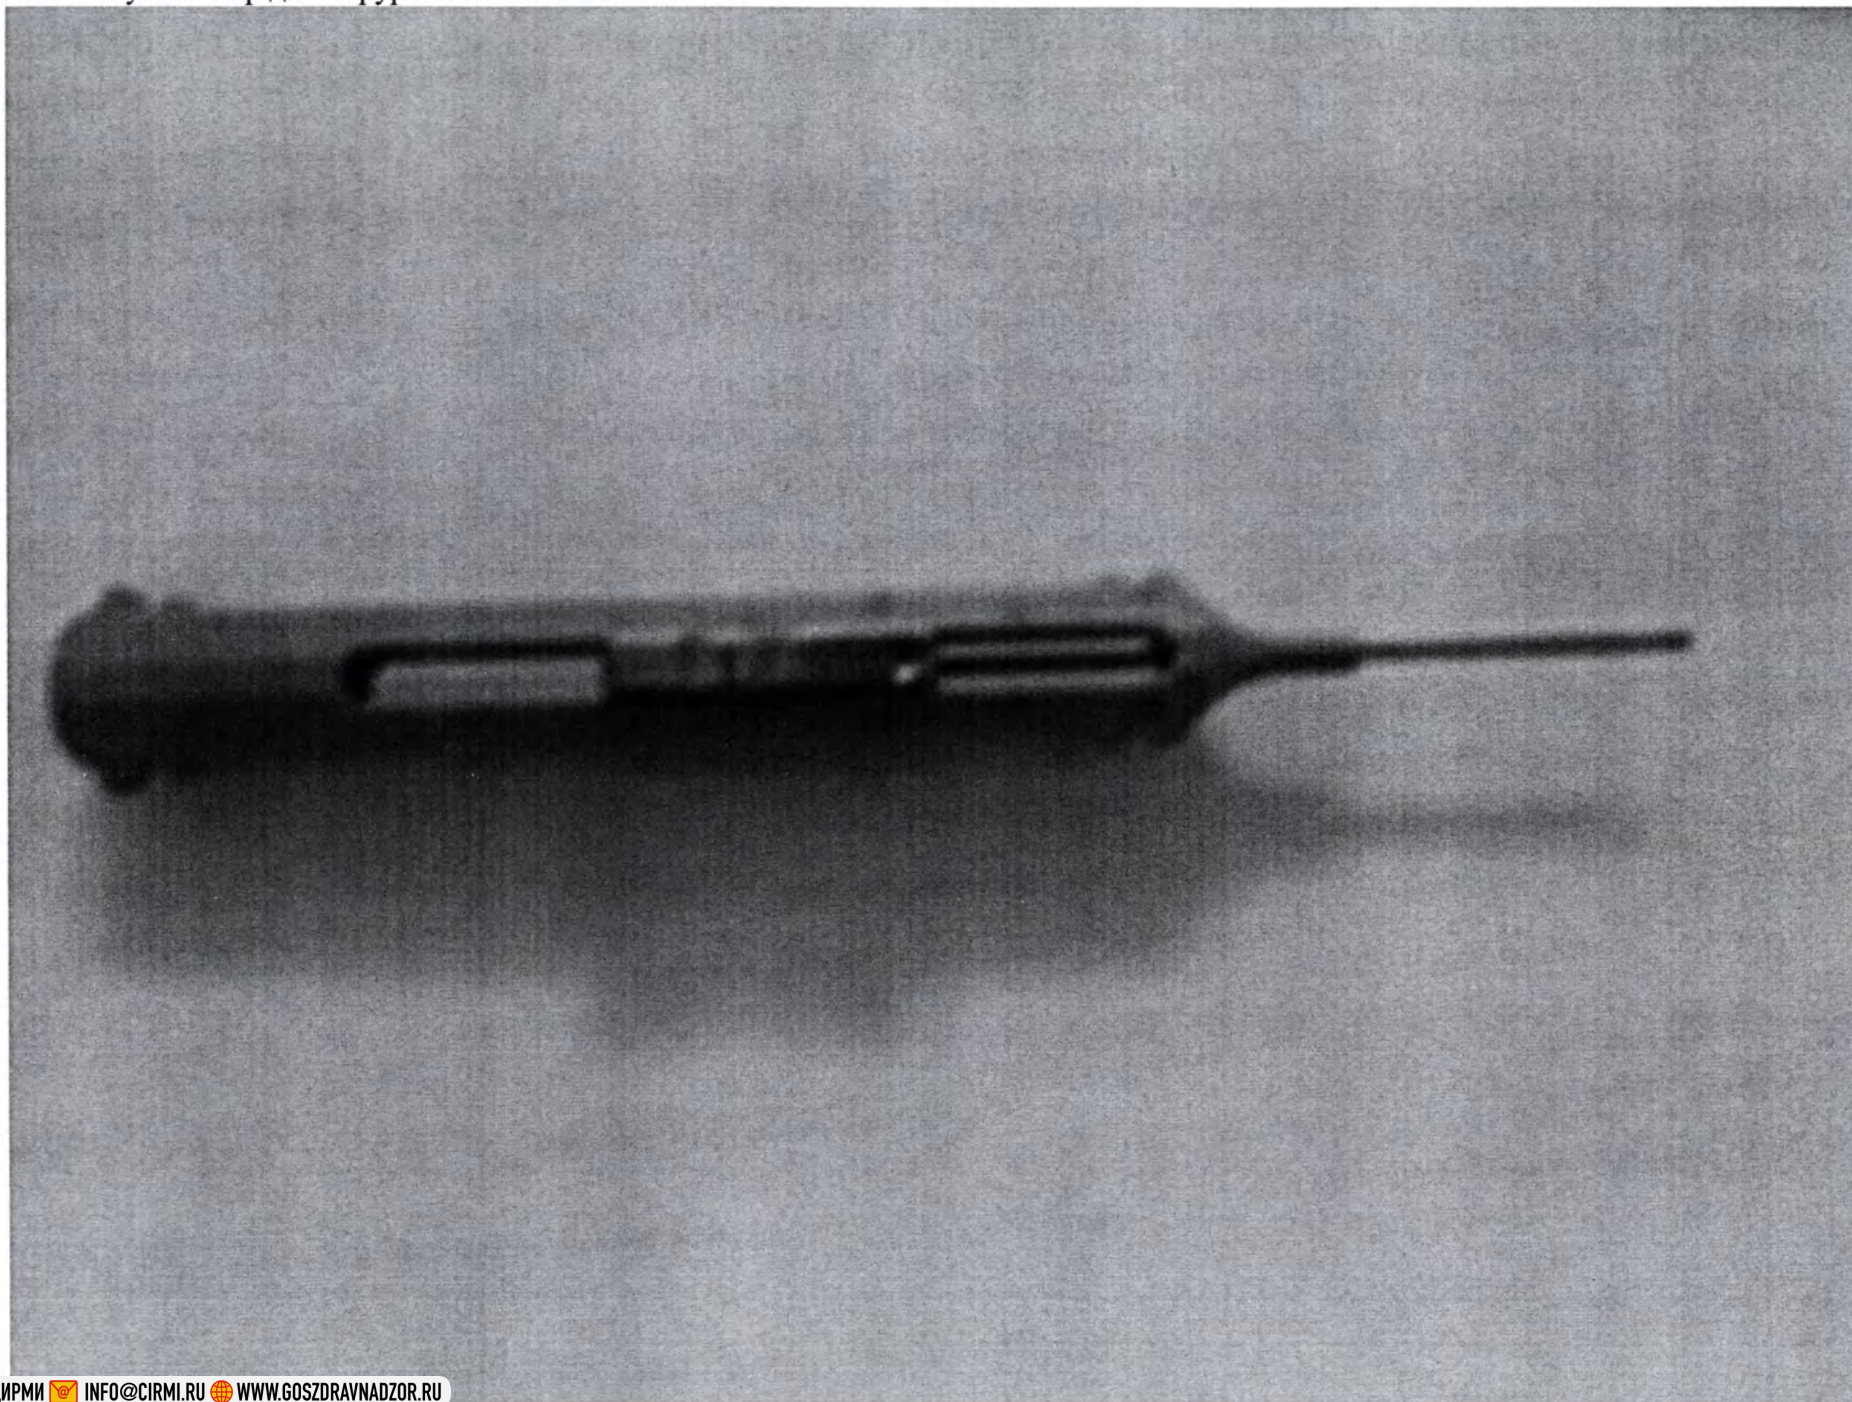




32. Рукоятка для быстроразъемного соединения АО Ø4,5 мм

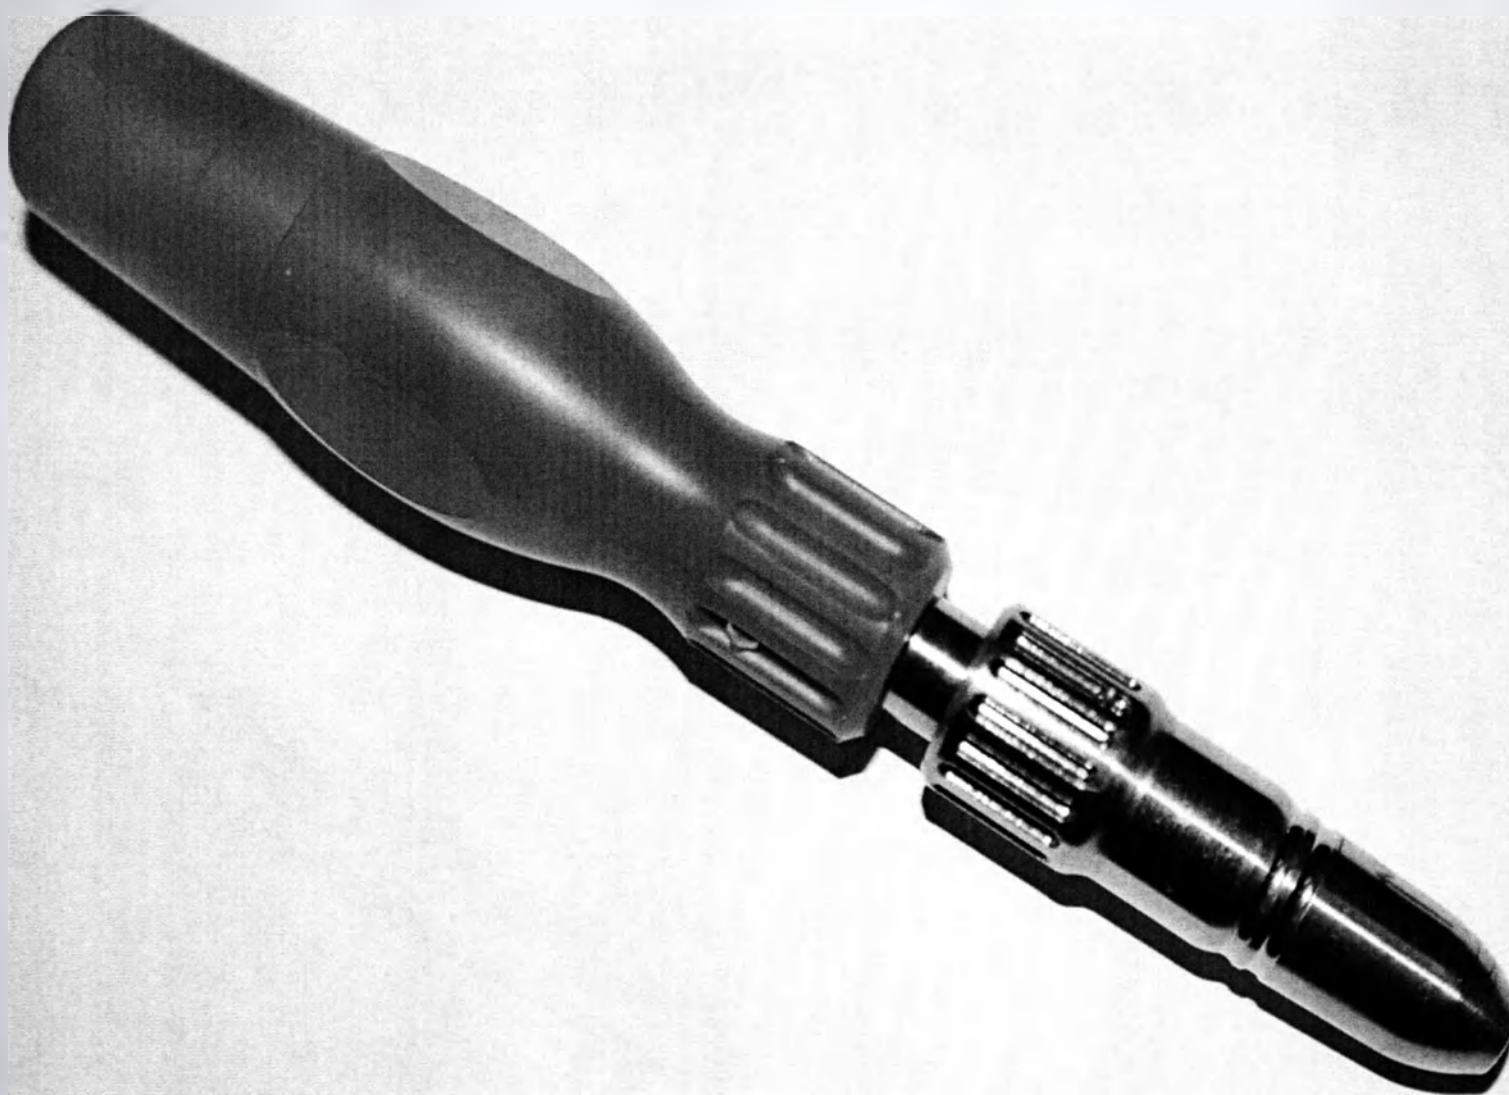



33. Измеритель погружения спиц Киршнера Ø 1,0 мм, длина 80 мм

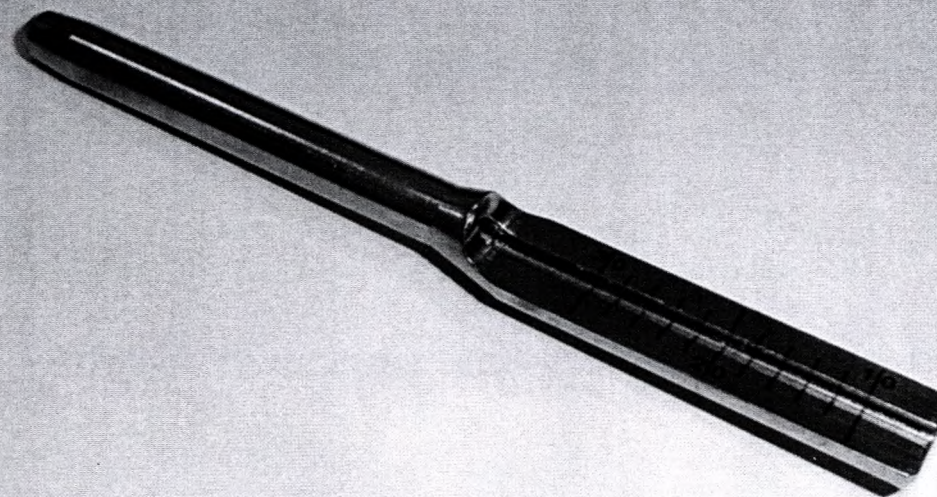




34. Костный рычаг Weil






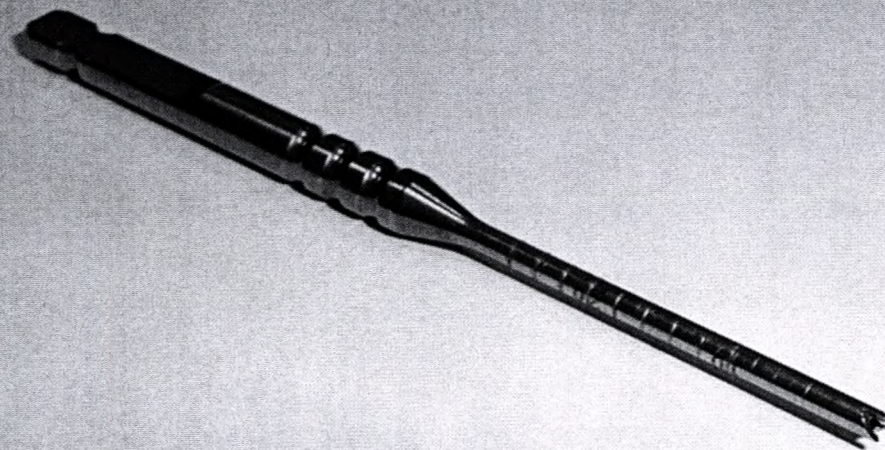



36. Контейнер для спиц Киршнера Ø1.0мм - Длина 80мм

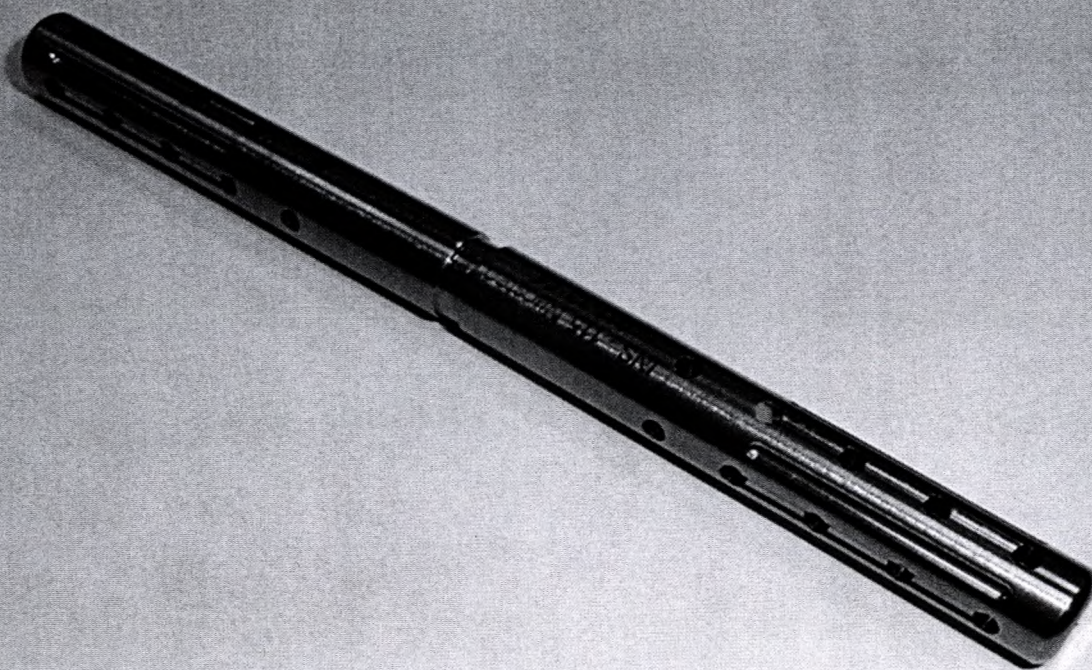



37. Сверло Ø1,9 мм с делениями с системой крепления АО


















#### 41. Приспособление для проведения винтов Ø2,4 мм

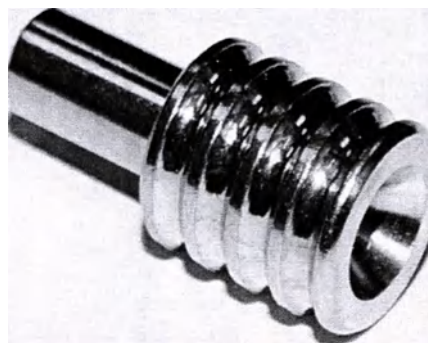



Nettoyage manuel : cette méthode est à réserver aux instruments restant très souvent malgré une bonne désinfection. Dans ce cas, utiliser une brosse douce (brosse en plastique souple) perméable d'eau chaude toute la surface de l'objet. L'utilisation de brosses ou de tampons métalliques est formellement proscrite car elle risquerait d'endommager l'instrument.

Le protocole de nettoyage suivant est recommandé :

1. Immerger le dispositif à nettoyer dans une solution à base de didécylmethylammonium, de détergents non ioniques et de complexes enzymatiques actifs sur les protéines, lipides et glucides (type Antosyme PLA II des laboratoires ANIOS) pendant 15 minutes à 40°C.
2. Brosser le dispositif avec une brosse souple. Activer les parties mobiles.
3. Rincer méticuleusement avec de l'eau du robinet.
4. Mettre le dispositif aux ultrasons pendant 15 minutes dans une solution de nettoyage.
5. Brosser le dispositif.
6. Rincer méticuleusement.
7. Vérifier la prise.
8. Sécher le dispositif.

4. Conditionnement

Quelle que soit la

Les instruments p

stérilisation.

- Les plateaux ther

Les plateaux therm

lorsqu'une stérilis

double emballage

- Les paniers grillag

Les paniers grillag

lorsqu'une stérilis

double emballage

5. Stérilisation

La stérilisation pré

ISO 17665 et les sp

Cycle type

Les ancillaires doivent être stérilisés à la vapeur afin de satisfaire les exigences relatives à l'activation des prismes et autres ATNC.

| Mode de stérilisation | Température | Durée              |
|-----------------------|-------------|--------------------|
| Autoclave Vapeur      | 134°C       | Minimum 18 minutes |

Ce cycle de stérilisation n'a pas été validé pour l'inactivation des virus.

Le protocole type pour la stérilisation à l'autoclave est le suivant :

1. Mettre sous vide la chambre de stérilisation.
2. Injection de la vapeur.

REF INS-121

Fantôme de vis Ø3.2mm

Ø3.2mm screw template

LOT 068-12 Qty : 1

Caution : Federal law restricts this device to the sale, distribution, and the use by or on the order of a physician

NEOSTEO - Mailève 2A - 1 Boulevard Jean Moulin - 44100 NANTES - FRANCE



NON STERILE  
NOT STERILE





REF INS-122

Fantôme de vis Ø2.6mm

Ø2.6mm screw template

LOT 069-12 Qty : 1

Caution : Federal law restricts this device to the sale, distribution, and the use by or on the order of a physician

NEOSTEO - Mairie 2A - 1 Boulevard Jean Moulin - 44100 NANTES - FRANCE

neosteo

NON STERILE  
NOT STERILE

CE

**Cycle long**  
Les instruments doivent être stérilisés à la vapeur afin de satisfaire les exigences relatives à l'inactivation des prions et autres ATNC.

| Mode de stérilisation | Température | Durée              |
|-----------------------|-------------|--------------------|
| Autoclave Vapeur      | 134°C       | Minimum 20 minutes |

Le cycle de stérilisation n'a pas été validé pour l'inactivation des prions et autres ATNC.  
Le procédé type pour la stérilisation à l'autoclave (cycle long) est le suivant :

1. Mettre sous vide la chambre de stérilisation
2. Injection de la vapeur
3. Stérilisation à 134°C (+0°C/-1°C) pendant 18 minutes (minimum)



Les utilisateurs doivent lire attentivement les instructions d'utilisation et de maintenance avant d'utiliser ce dispositif. Dans ce cas, l'utilisateur doit lire attentivement les instructions d'utilisation et de maintenance avant d'utiliser ce dispositif. Dans ce cas, l'utilisateur doit lire attentivement les instructions d'utilisation et de maintenance avant d'utiliser ce dispositif.

**REF INS-123**

Fantôme de vis Ø2.0mm

Ø2.0mm screw template

**LOT 070-12** Qty : 1

**neosteo**

**NON STERILE**  
**NOT STERILE**

**CE**

Caution: Federal law restricts this device to the sale, distribution, and the use by or on the order of a physician

NEOSTEO - Malleve 2A - 1 Boulevard Jean Moulin - 44100 NANTES - FRANCE

| Méthode de stérilisation | Température | Durée              |
|--------------------------|-------------|--------------------|
| Autoclave Vapeur         | 134°C       | Minimum 15 minutes |


Ce cycle de stérilisation n'est pas valide pour l'inactivation des prions.

Le protocole type pour la stérilisation à l'autoclave (cycle long) est le suivant:

1. Mettre sous vide la chambre de stérilisation
2. Introduire le dispositif




45. Шаблон для винтов Ø2,4 мм

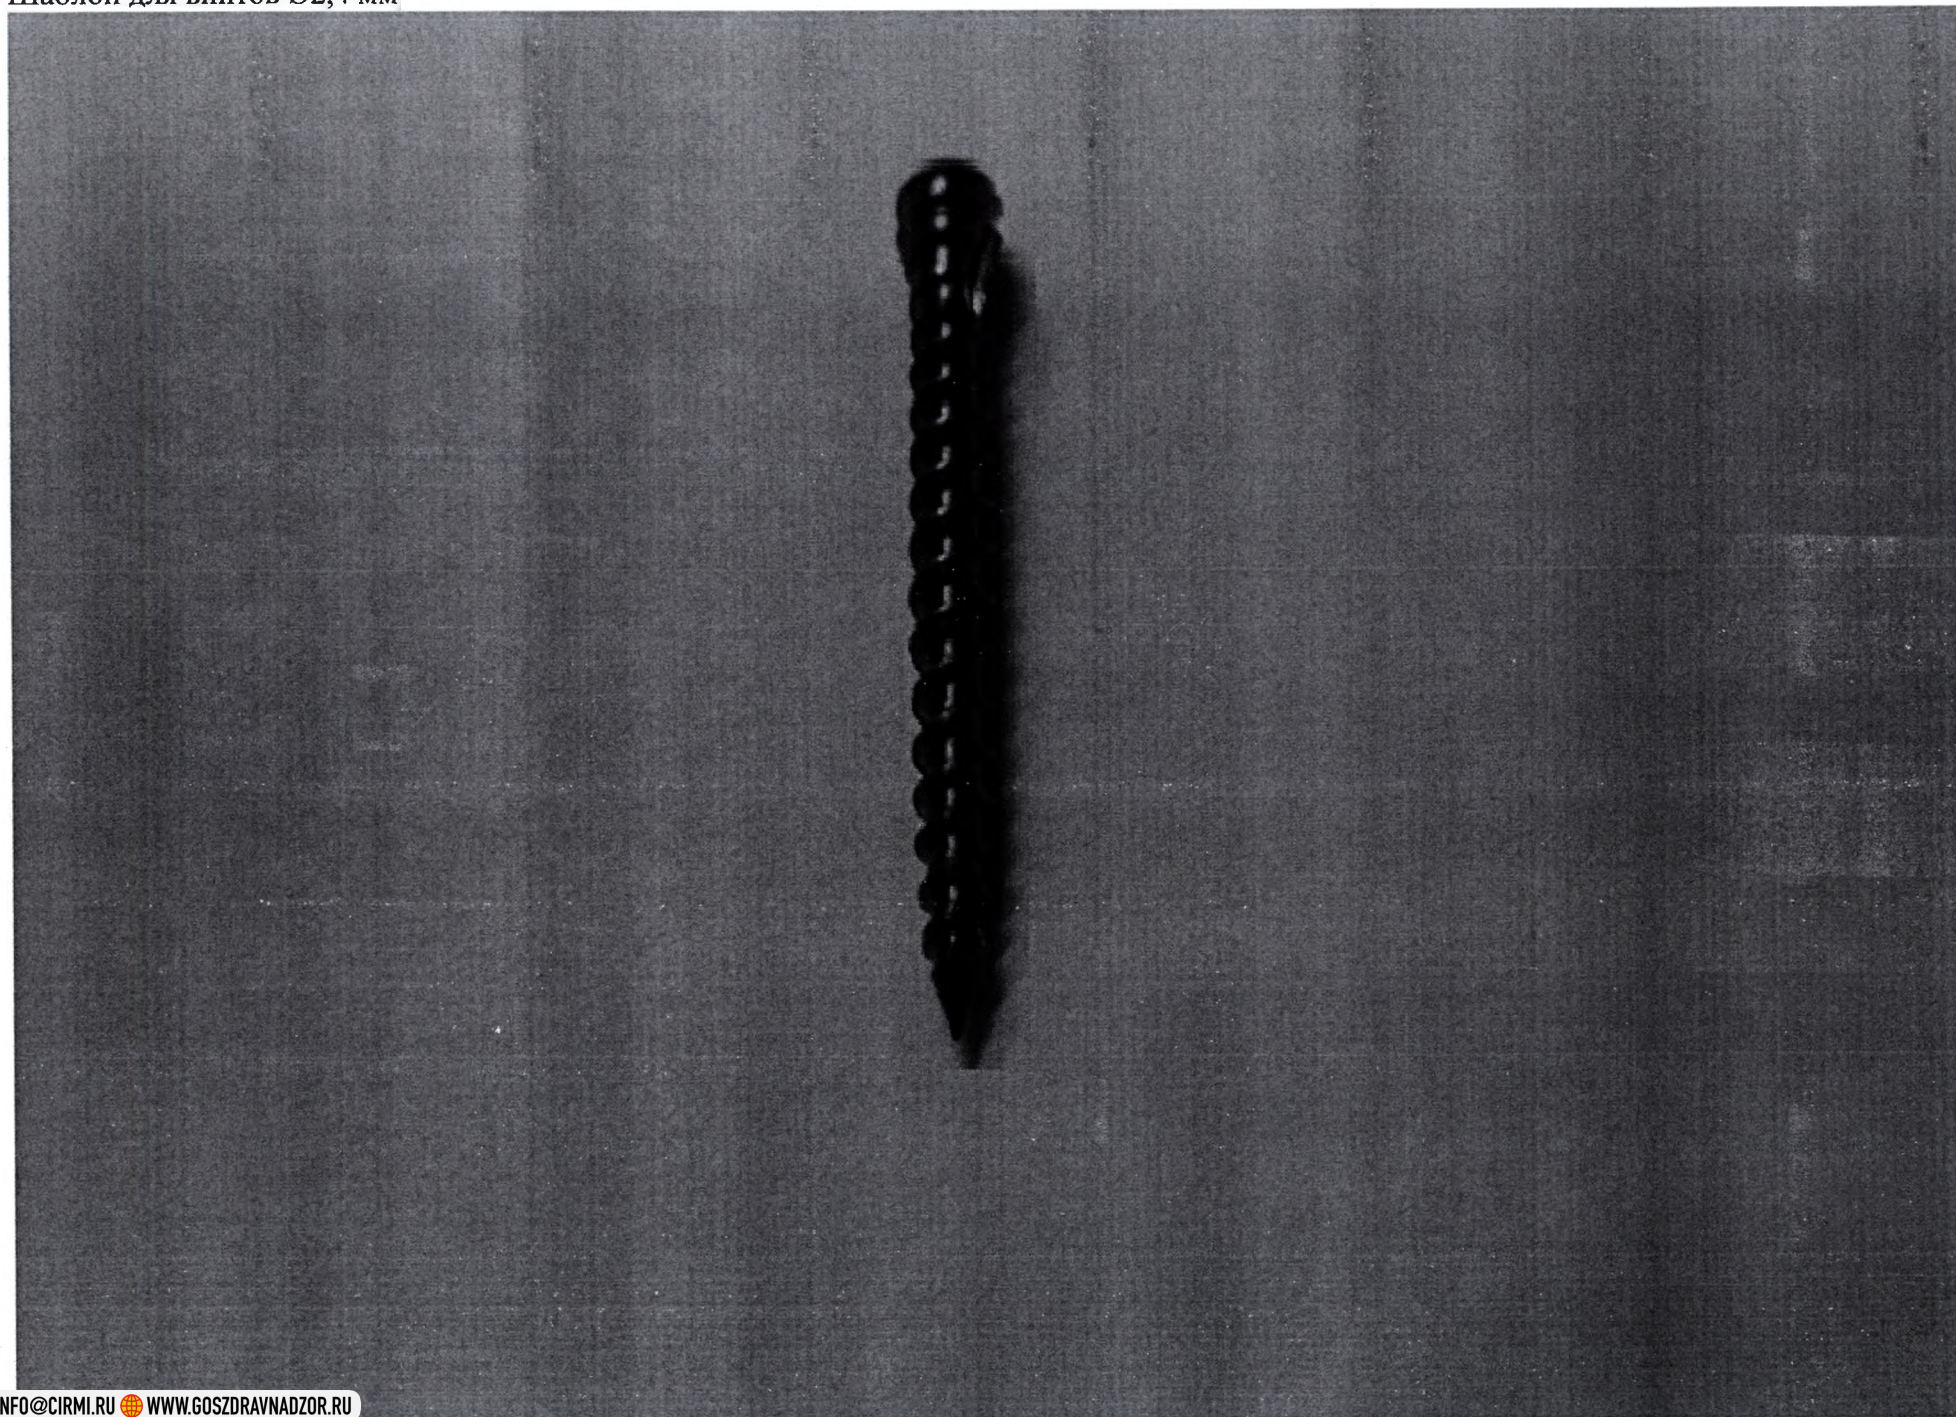




#### 46. Инструмент для стягивающих скоб под углом 90°

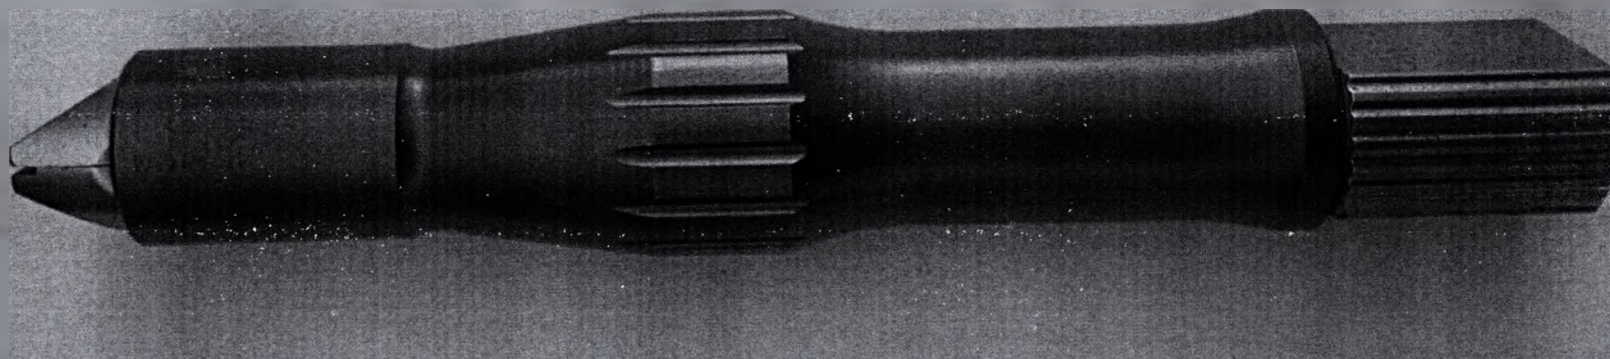



47. Инструмент для стягивающих скоб под углом  $26^{\circ}$

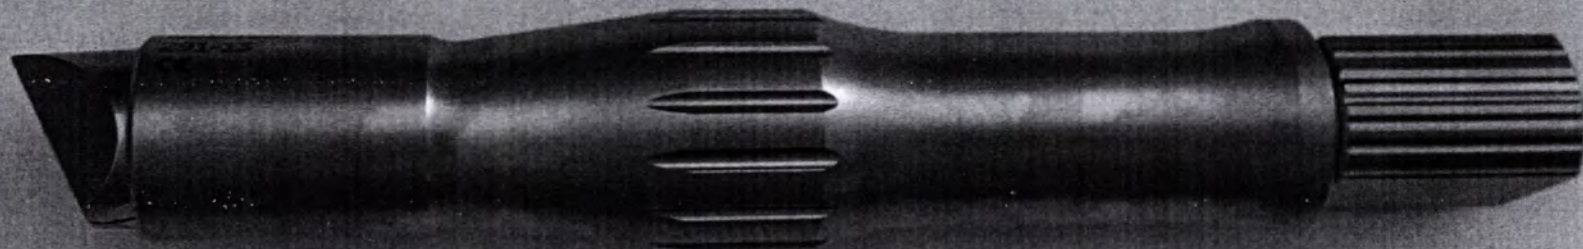








49. Направляющая для стягивающих скоб под углом 26°






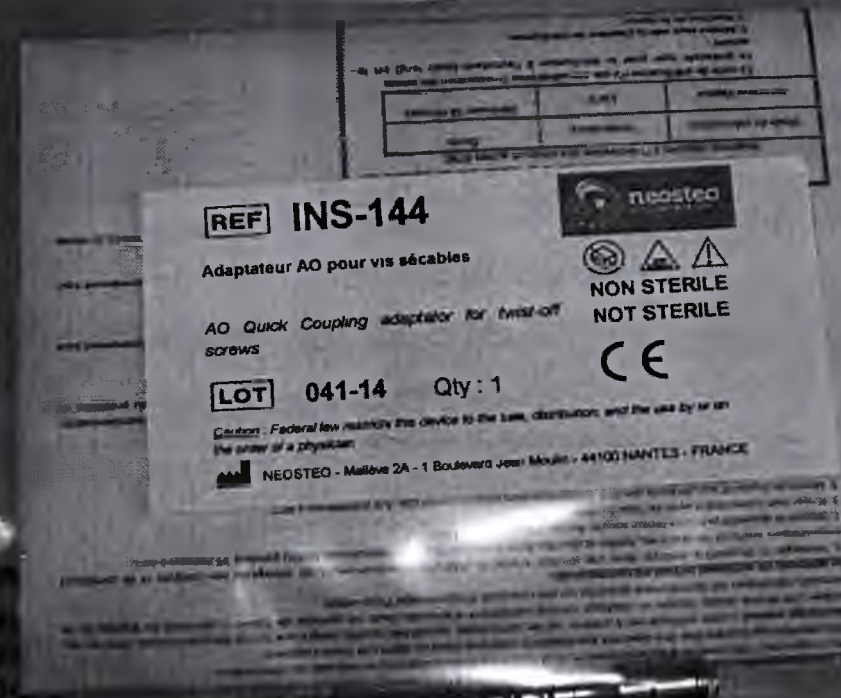




# 51. Длинное канюлированное сверло с системой крепления АО

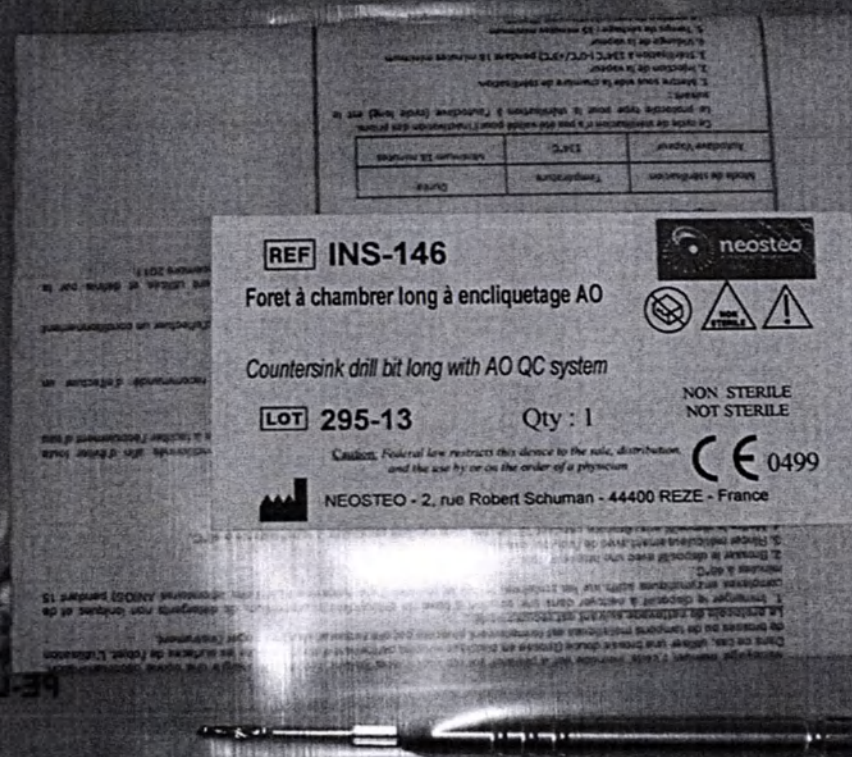




## 52. Длинное сверло с системой крепления АО

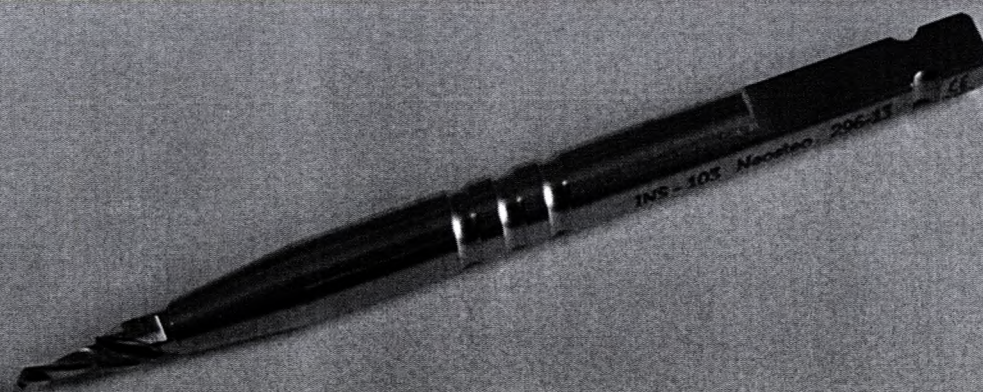



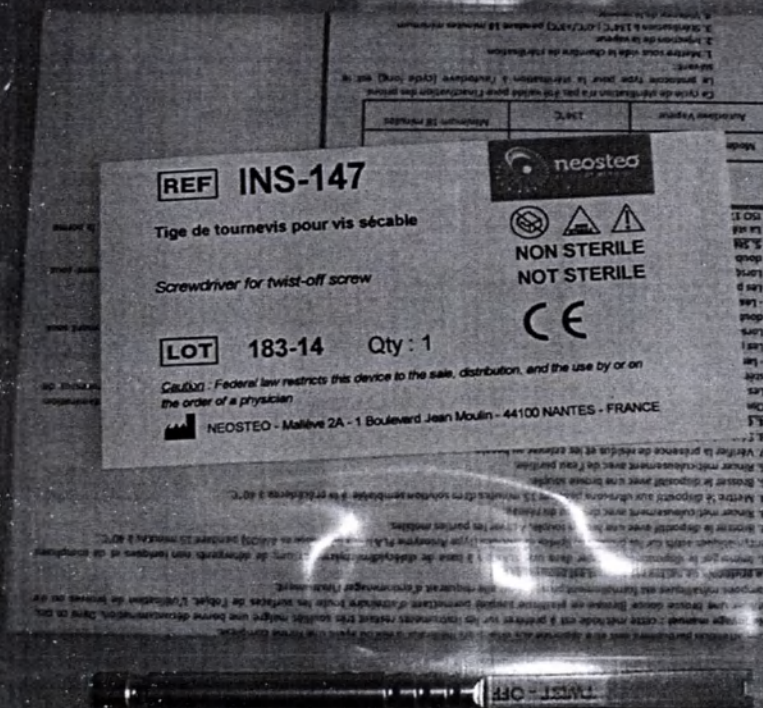




|                                                                                                                                                                                                        |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <p>Caution: Federal law restricts this device to the sale, acquisition, and the use by or on the order of a physician</p> <p>NEOSTEO - Mairie 2A - 1 Boulevard Jean Moulin - 44100 NANTES - FRANCE</p> |                                                      |
| <p><b>REF</b> INS-150</p> <p>Foret à chambrer Ø3.2mm à encliquetage AO</p> <p>Ø3.2mm countersink drill bit with AO QC system</p>                                                                       | <p><b>LOT</b> 036-14      Qty : 1</p> <p>CE 0499</p> |
| <p><b>neosteo</b></p> <p>NON STERILE<br/>NOT STERILE</p>                                                                                                                                               |                                                      |







55. Канюлированное сверло Ø3,2 мм с системой крепления АО

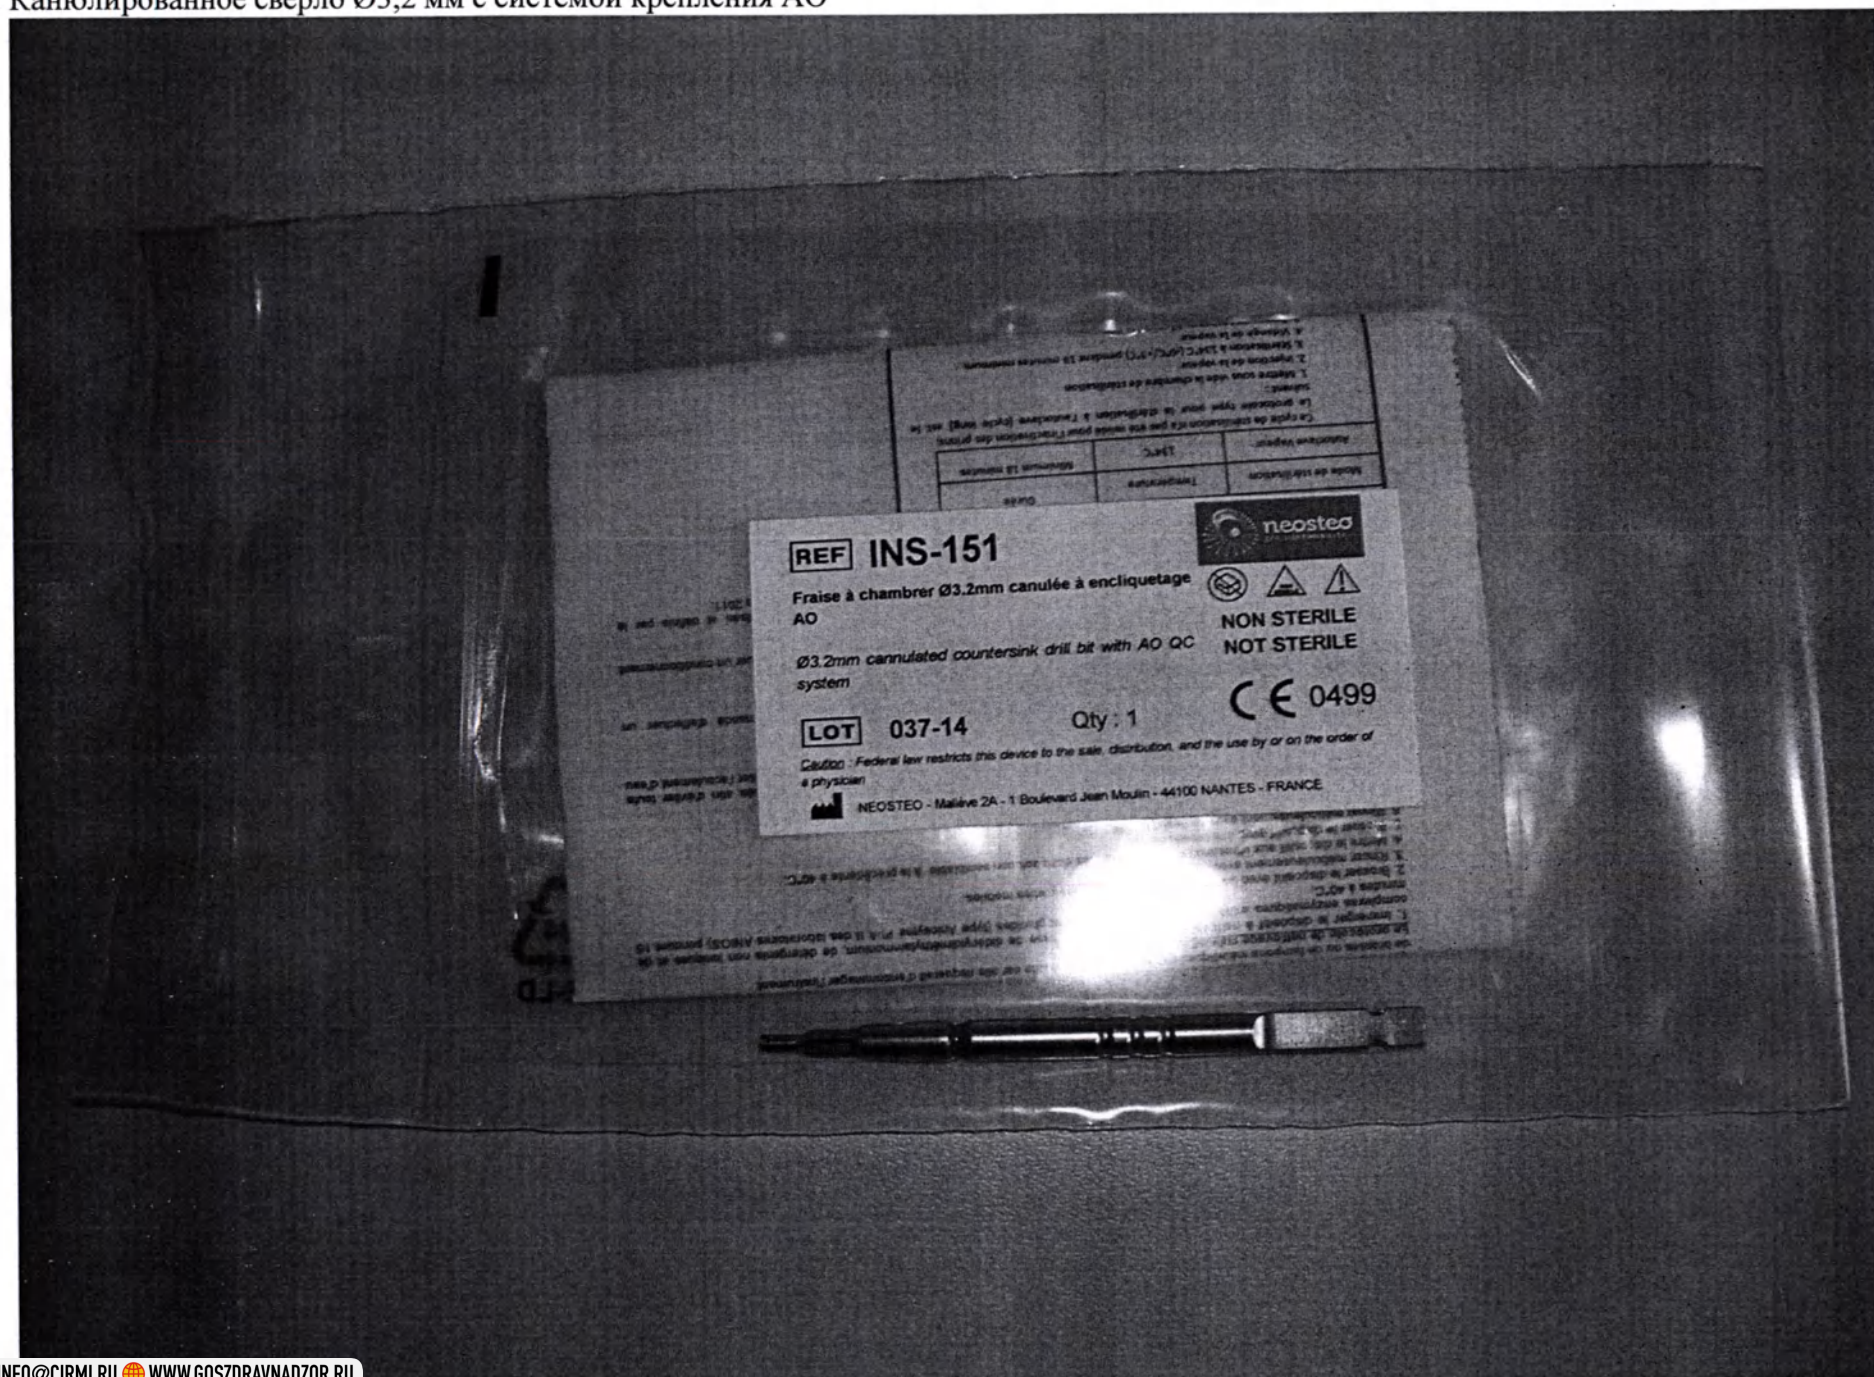




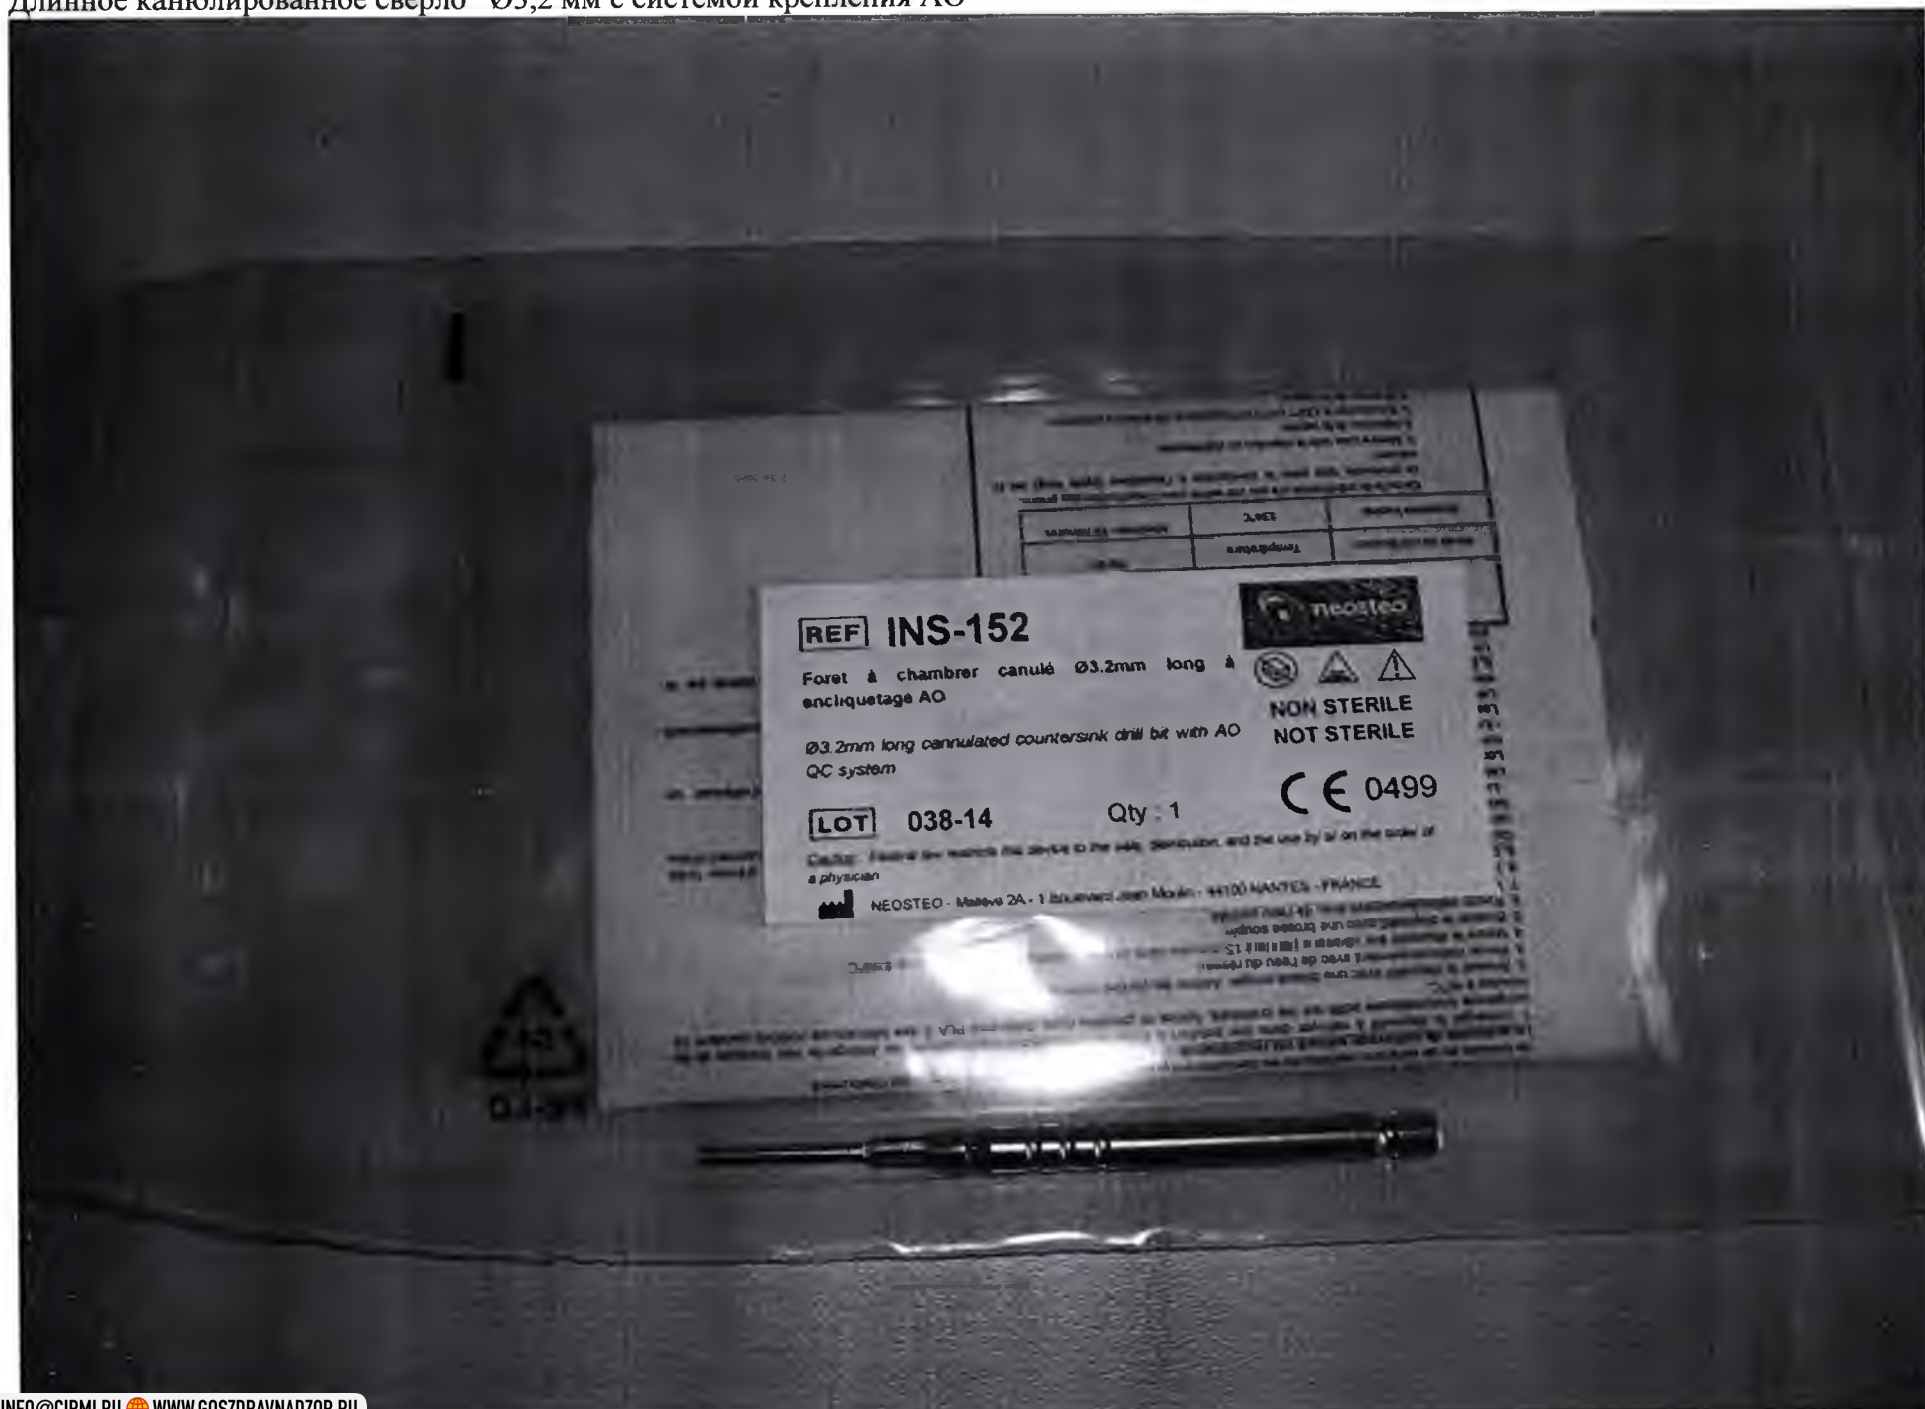




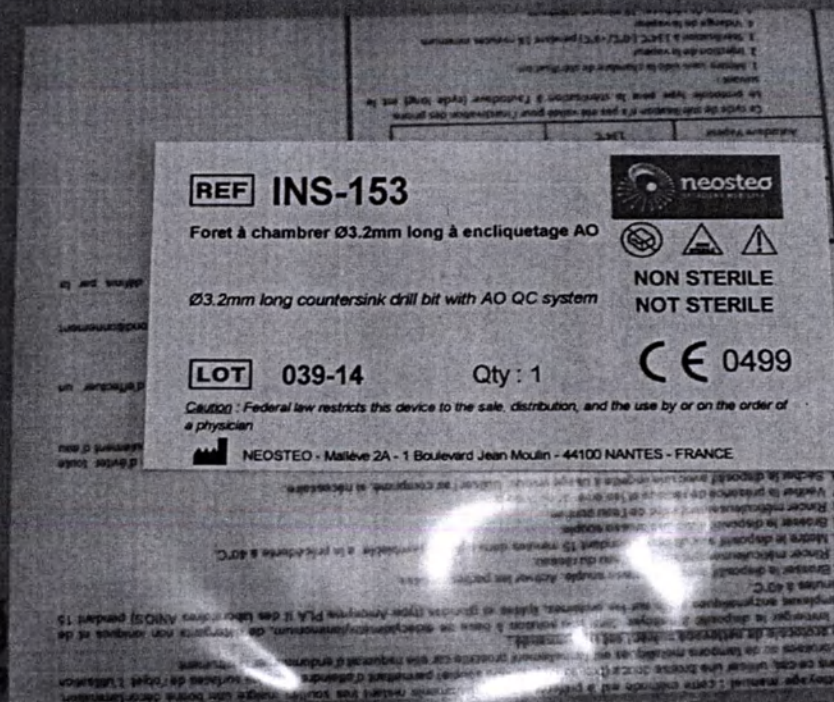



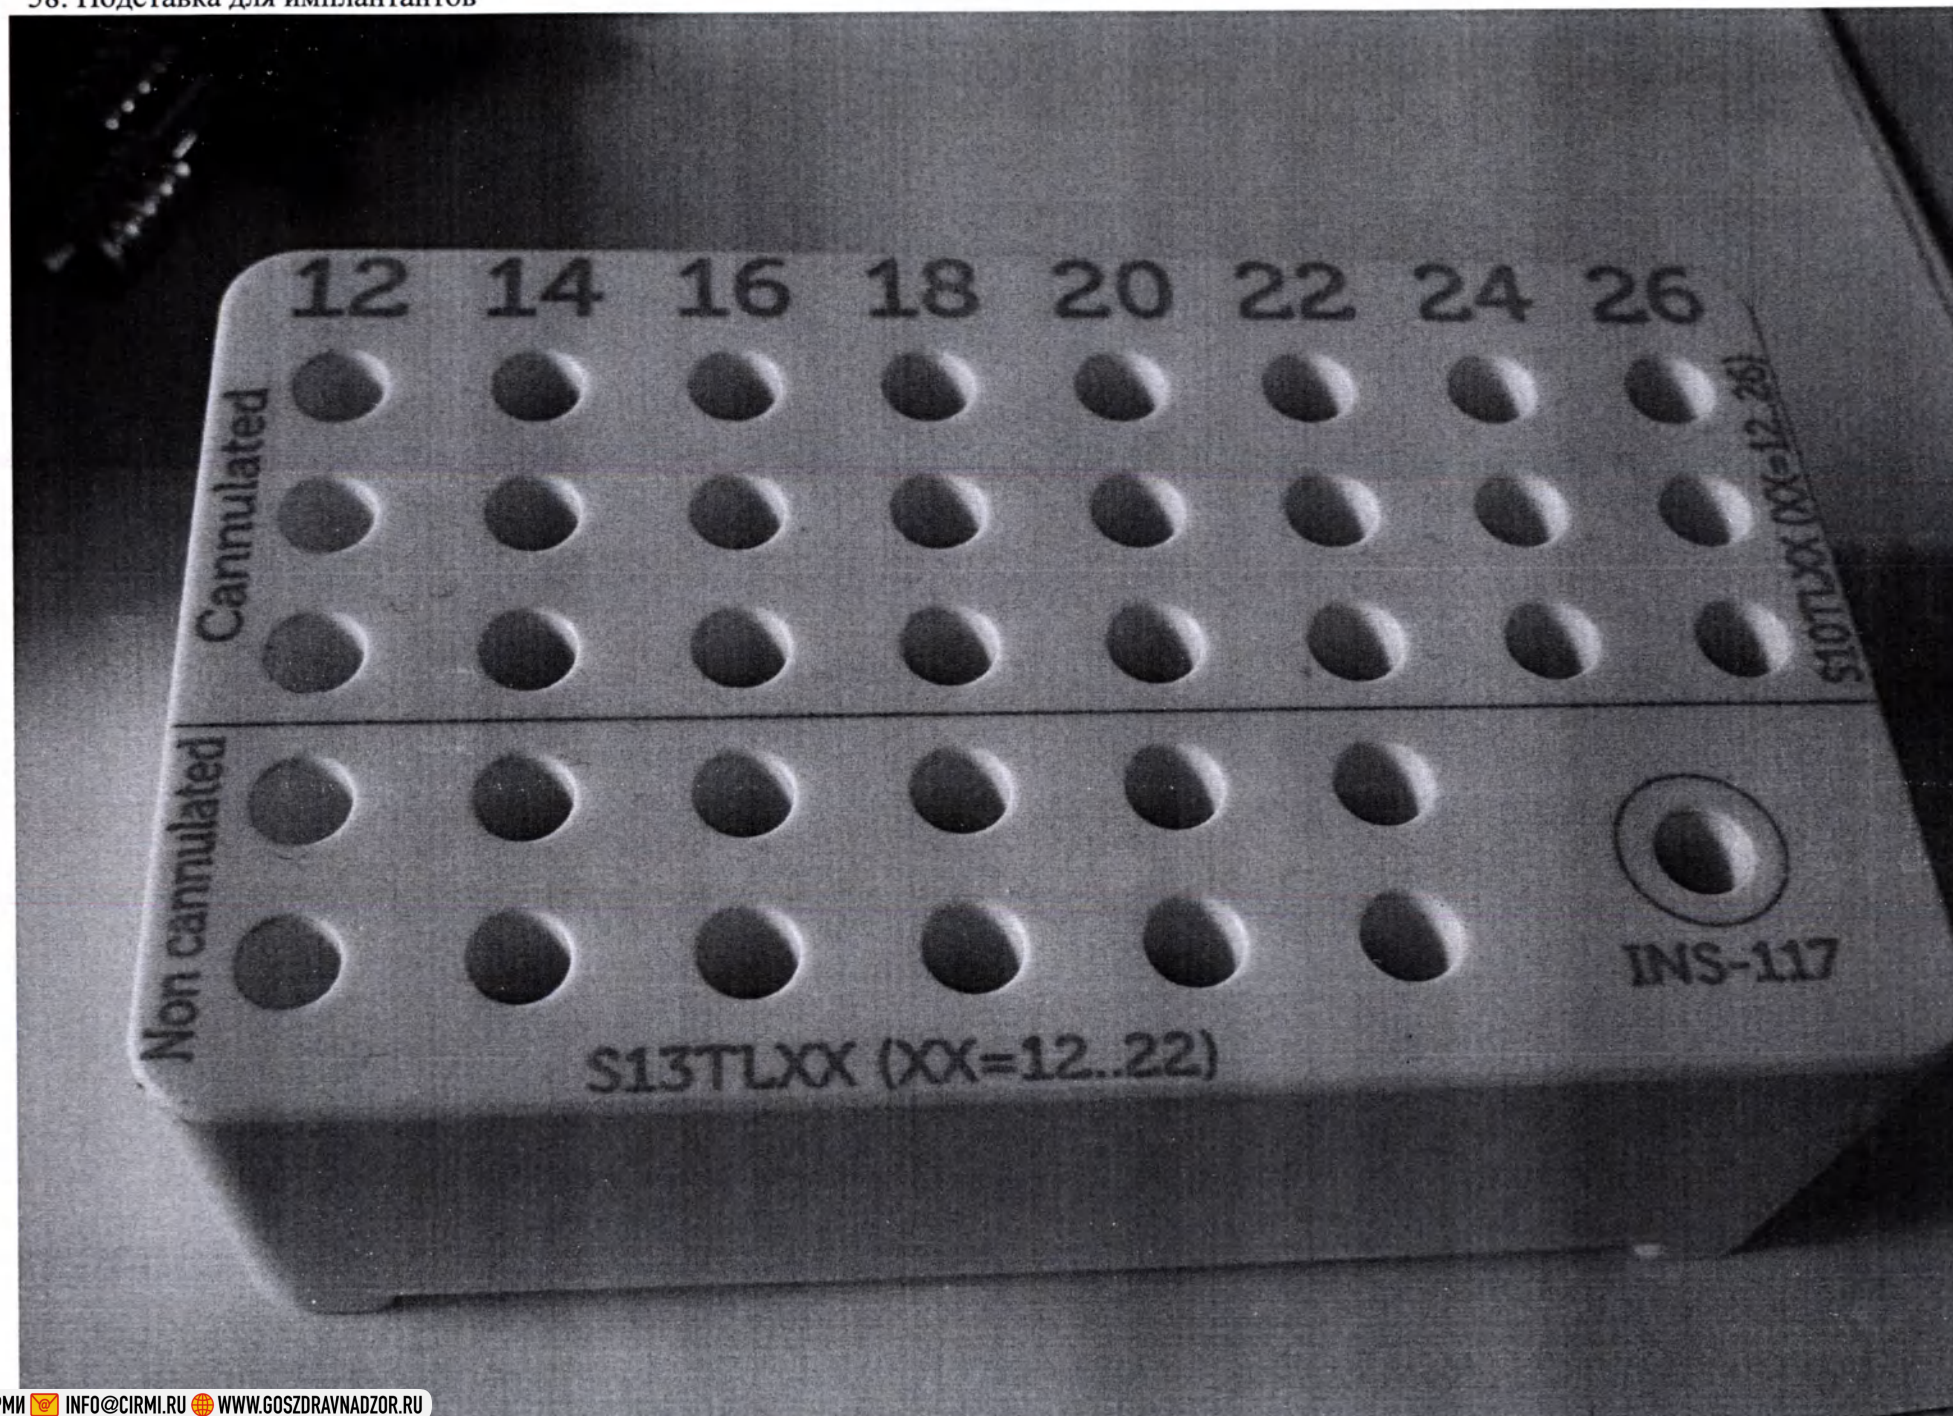



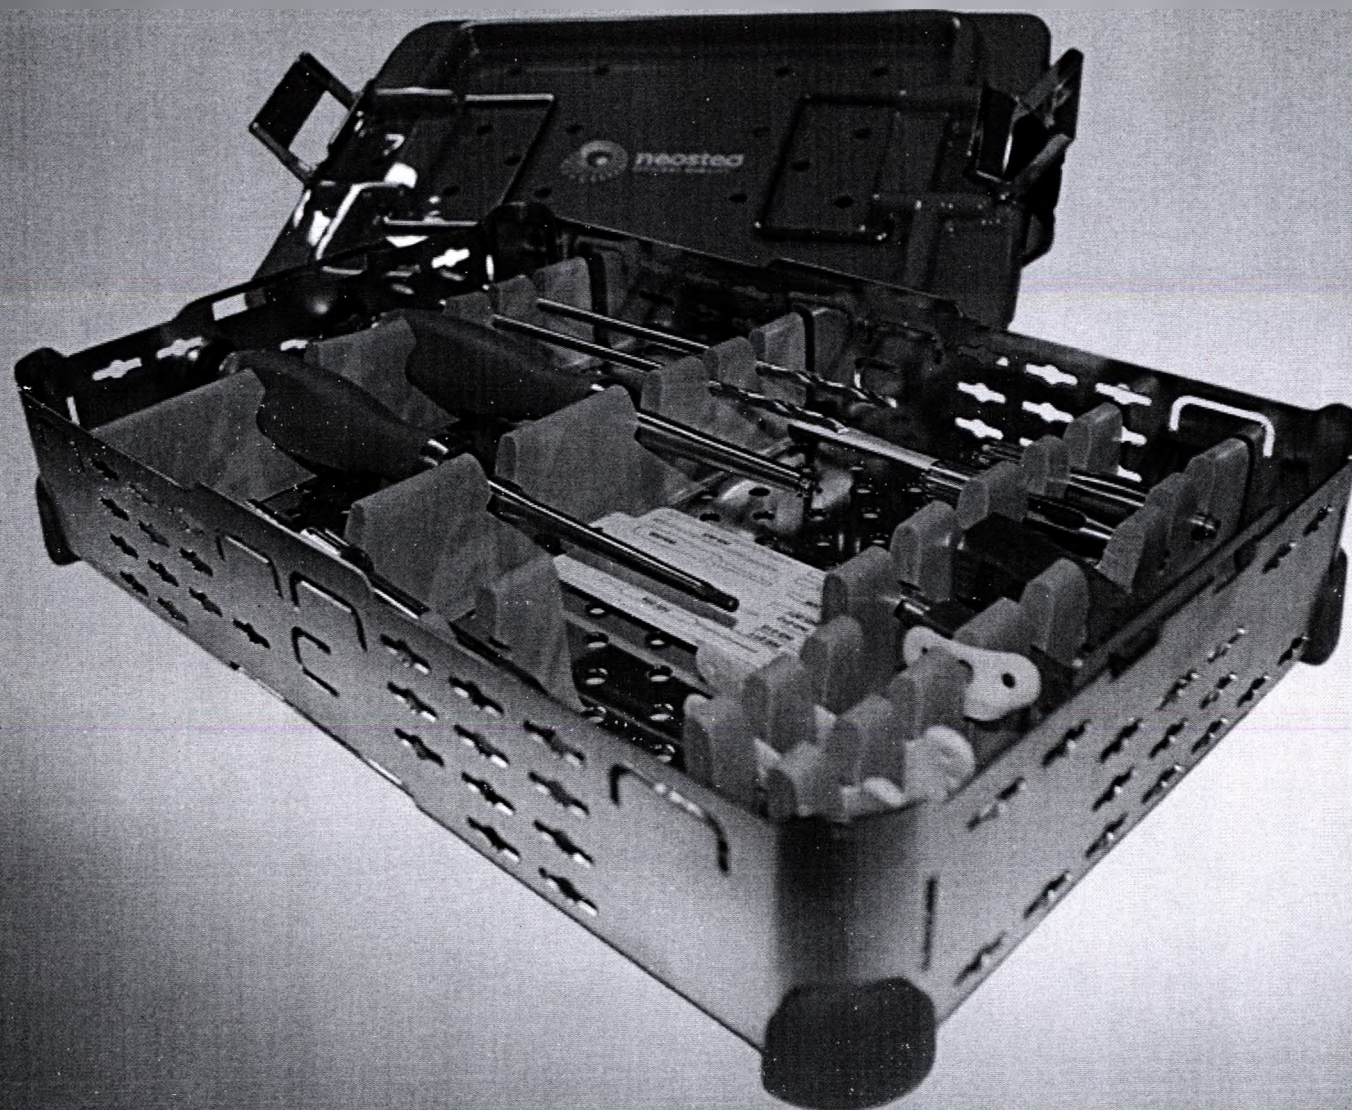
















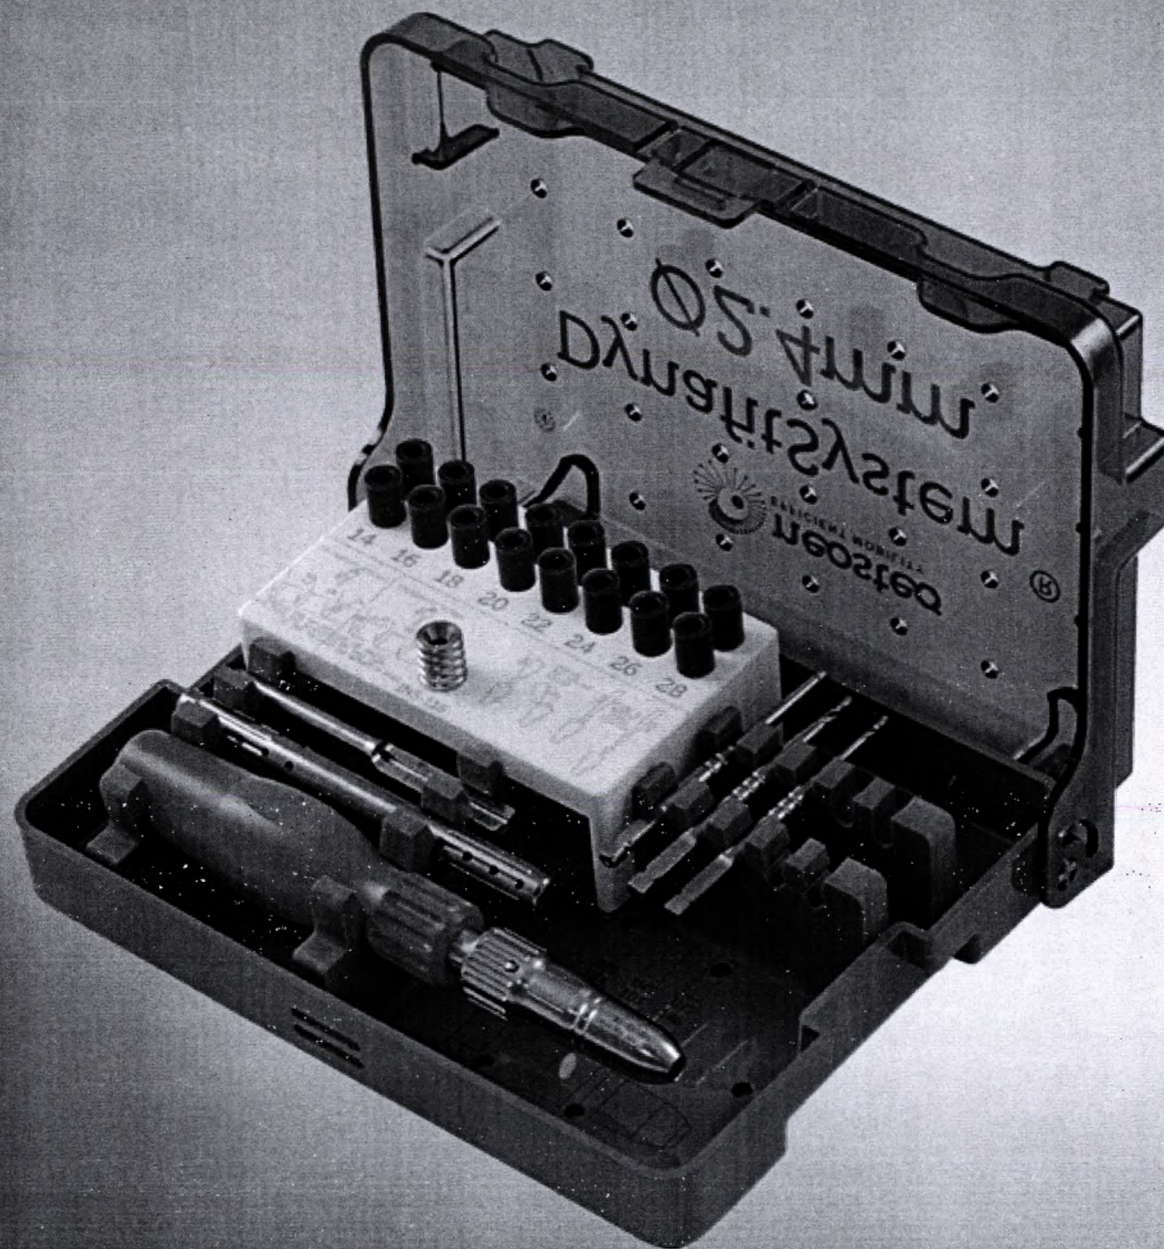









Agrafes de varisation  
Varisation staples



Всего пронумеровано, прошнуровано и  
скреплено печатью 153 листа

А.А. Ушаков

