


Набора реагентов для количественного определения содержания мочевины уреазным методом по конечной точке в сыворотке крови и моче (МОЧЕВИНА КТ ДДС)




Внешний вид

Набора реагентов для количественного определения содержания мочевины уреазным методом по конечной точке в сыворотке крови и моче (МОЧЕВИНА КТ ДДС)

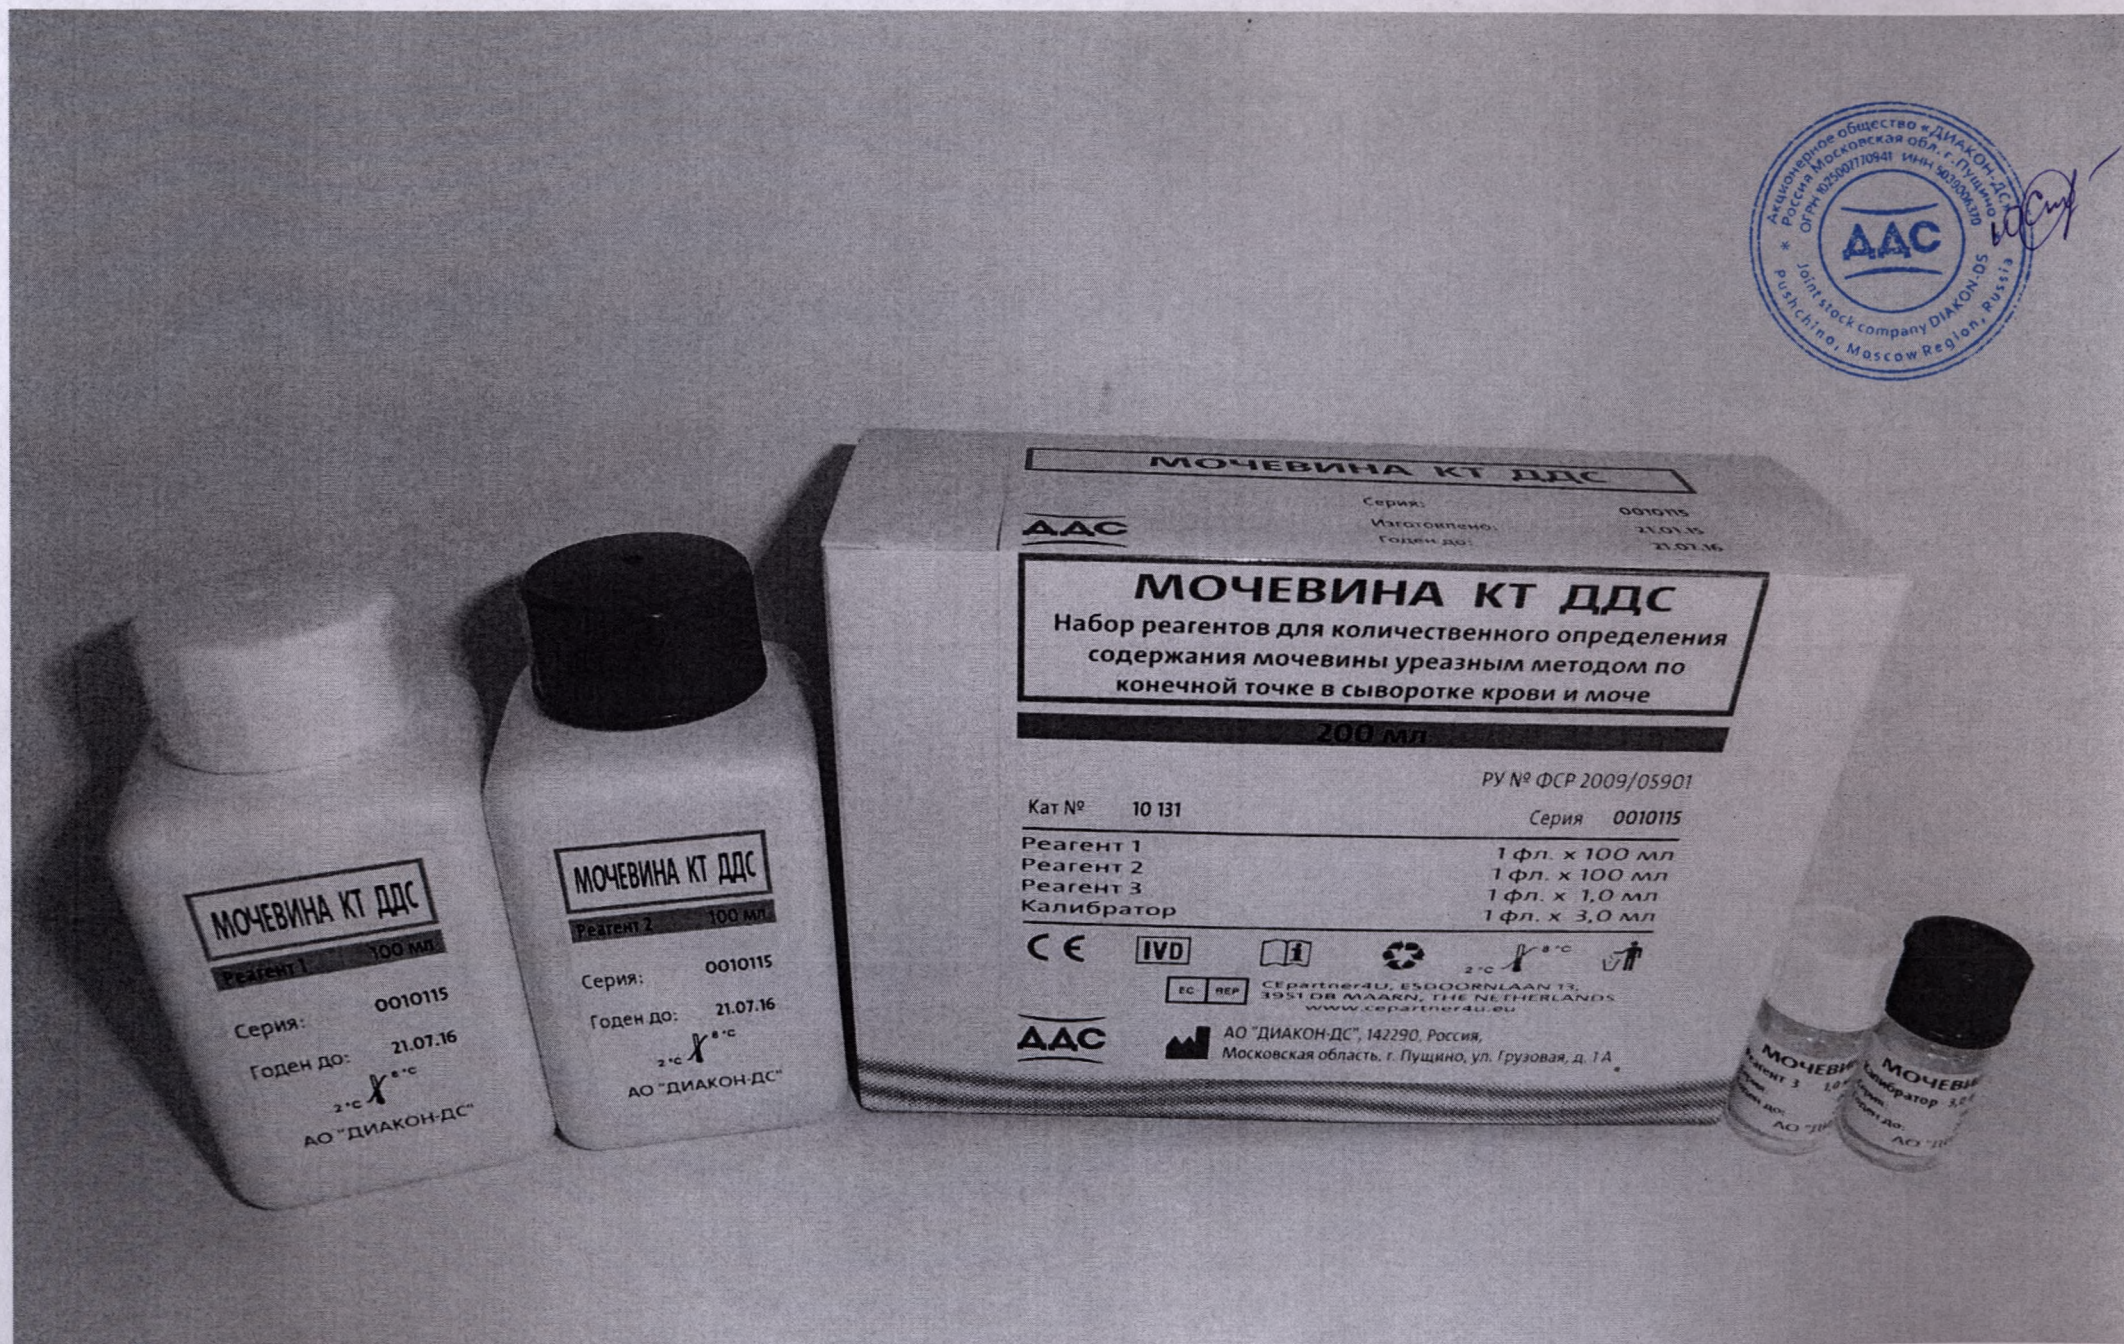


Внешний вид

Набора реагентов для количественного определения содержания мочевины уреазным методом по конечной точке в сыворотке крови и моче (МОЧЕВИНА КТ ДДС)

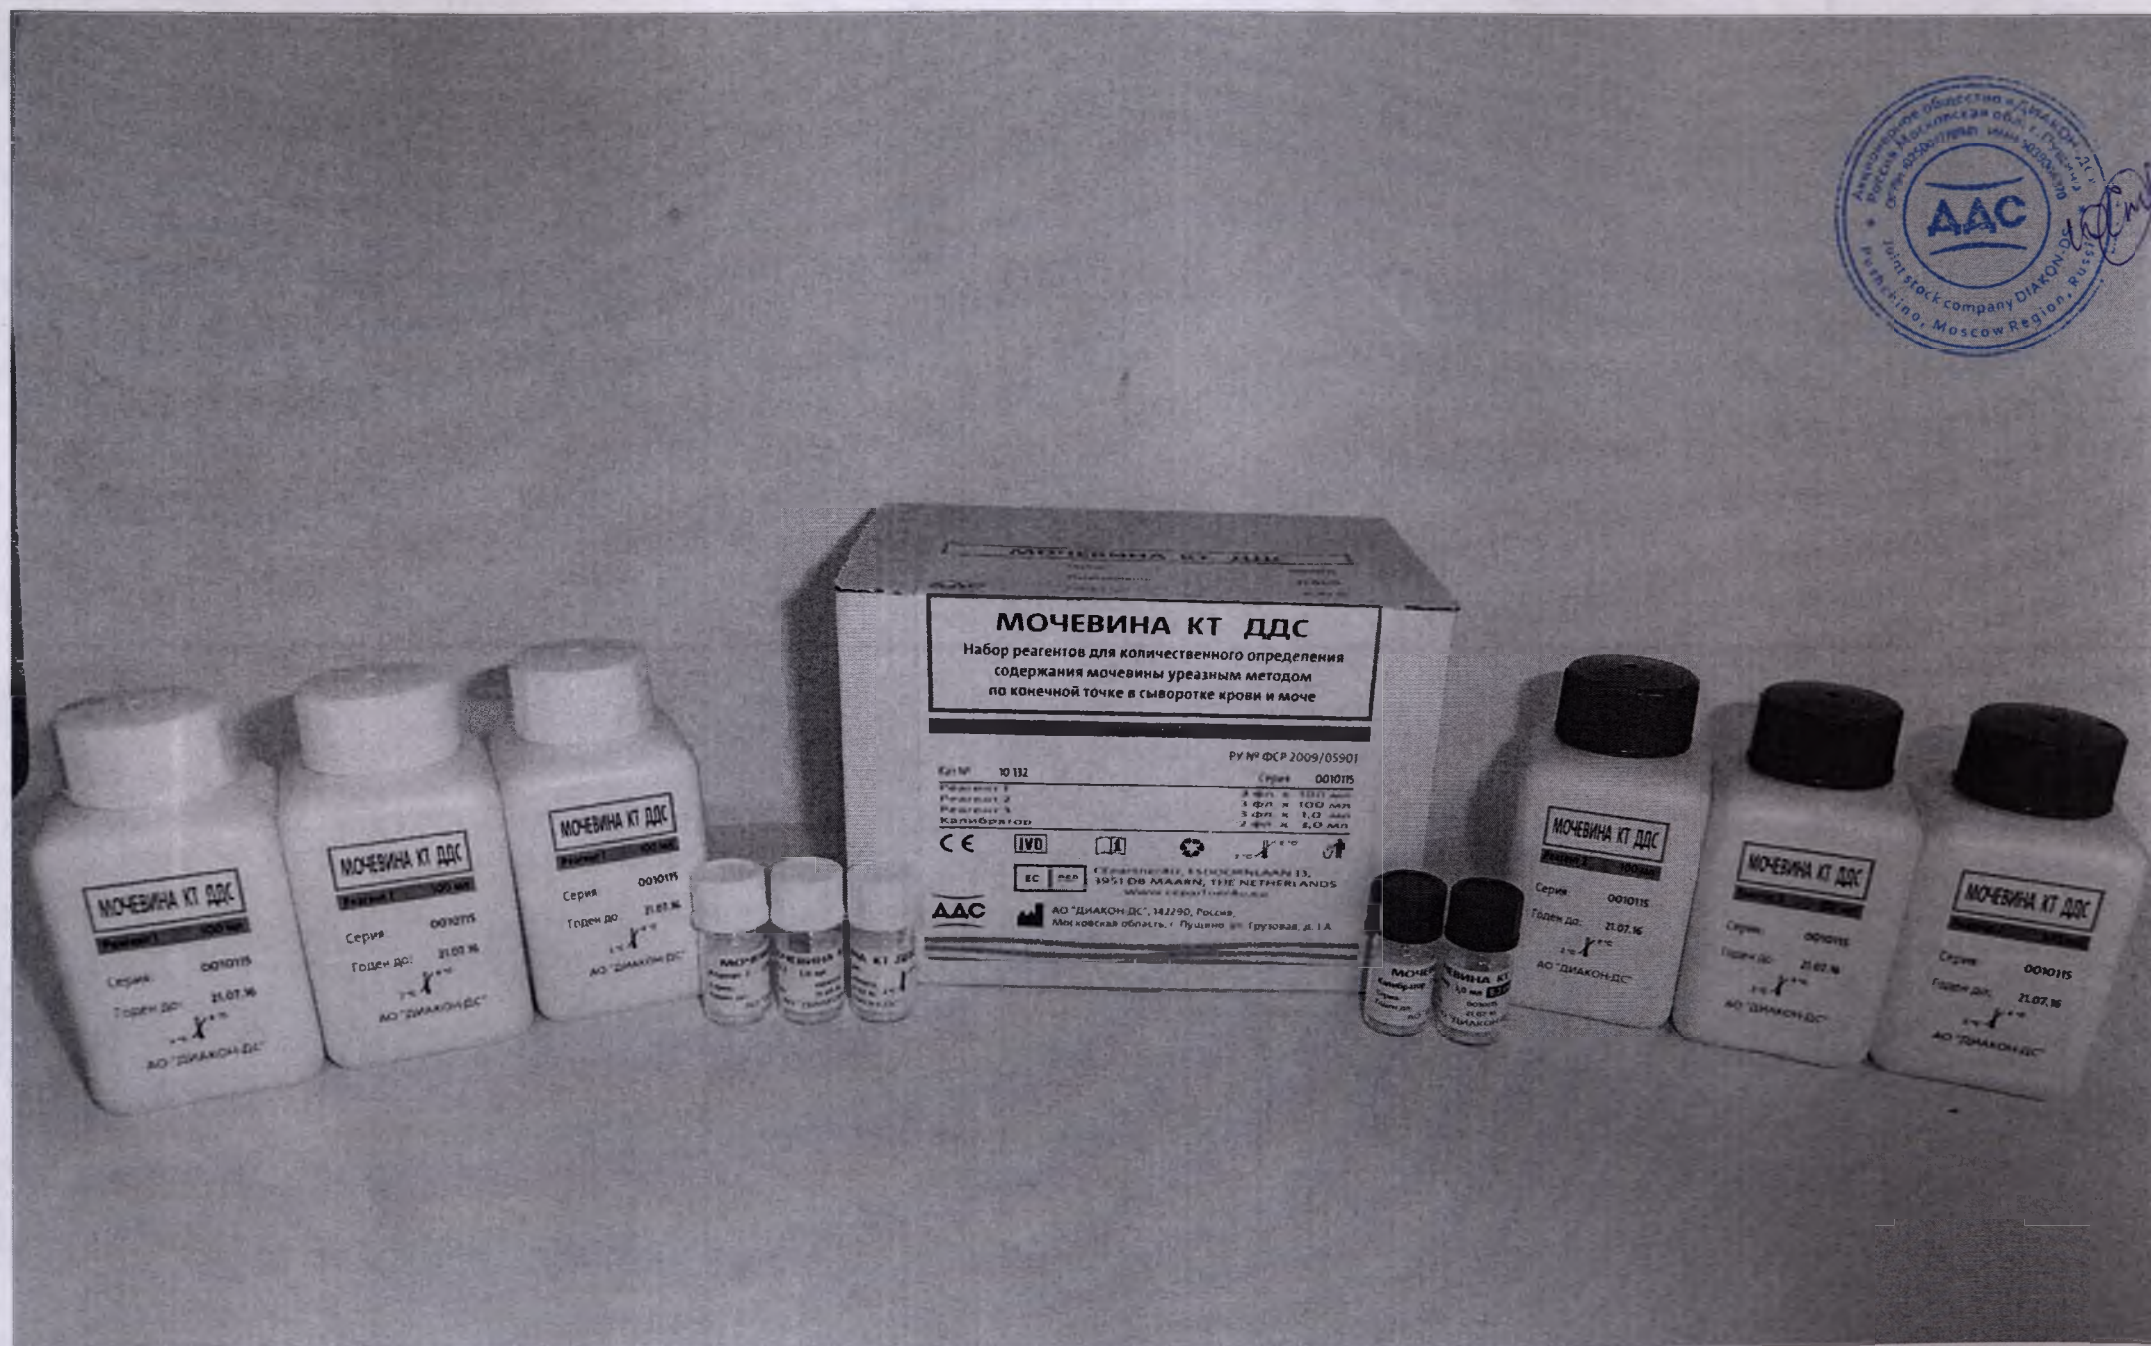

Внешний вид

Набора реагентов для количественного определения содержания мочевины уреазным методом по конечной точке в сыворотке крови и моче (МОЧЕВИНА КТ ДДС)

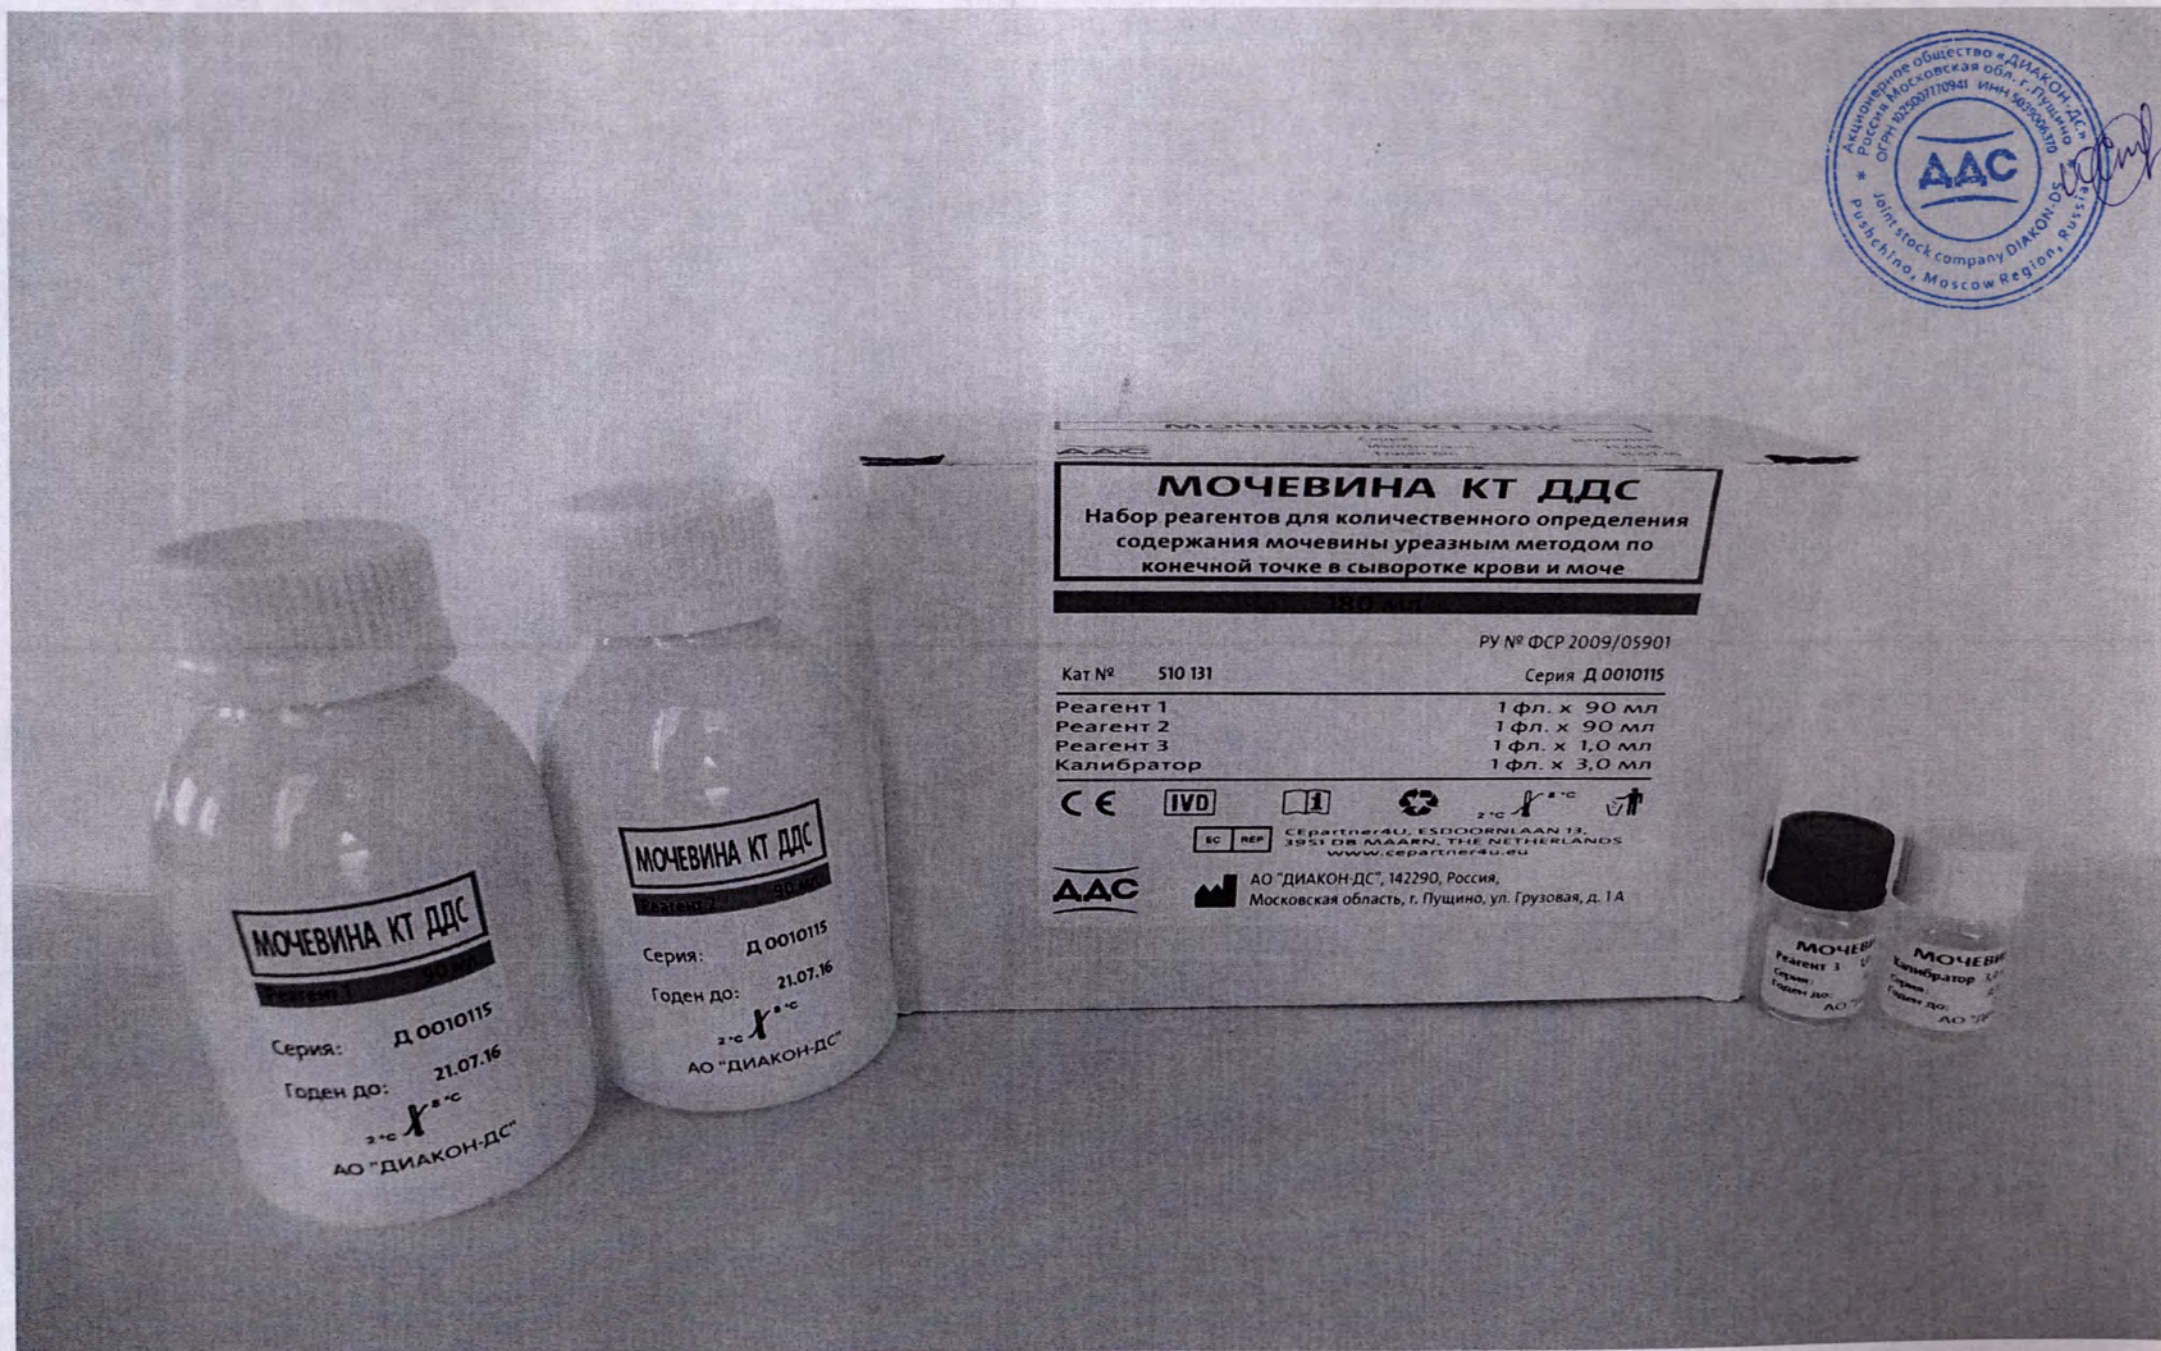

МОЧЕВИНА КТ ДДС

Набор реагентов для количественного определения содержания мочевины уреазным методом по конечной точке в сыворотке крови и моче

ПУ № ФСР 2009/05901

Кат № 510 131

Серия Д 0010115

Реагент 1	1 фл. x 90 мл
Реагент 2	1 фл. x 90 мл
Реагент 3	1 фл. x 1,0 мл
Калибратор	1 фл. x 3,0 мл



CEPARTNER4U, ESDOORNLAAN 13,
3951 DB MAARN, THE NETHERLANDS
www.cpartner4u.eu




АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия,
Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1А

МОЧЕВИНА КТ ДДС

Серия: Д 0010115

Годен до: 21.07.16




АО "ДИАКОН-ДС"

МОЧЕВИНА КТ ДДС

Серия: Д 0010115

Годен до: 21.07.16



АО "ДИАКОН-ДС"

МОЧЕВИНА

Реагент 3

Серия: Д 0010115

Годен до: 21.07.16

АО "ДИАКОН-ДС"

МОЧЕВИНА

Калибратор


Серия: Д 0010115

Годен до: 21.07.16

АО "ДИАКОН-ДС"

Внешний вид

Набора реагентов для количественного определения содержания мочевины уреазным методом по конечной точке в сыворотке крови и моче (МОЧЕВИНА КТ ДДС)

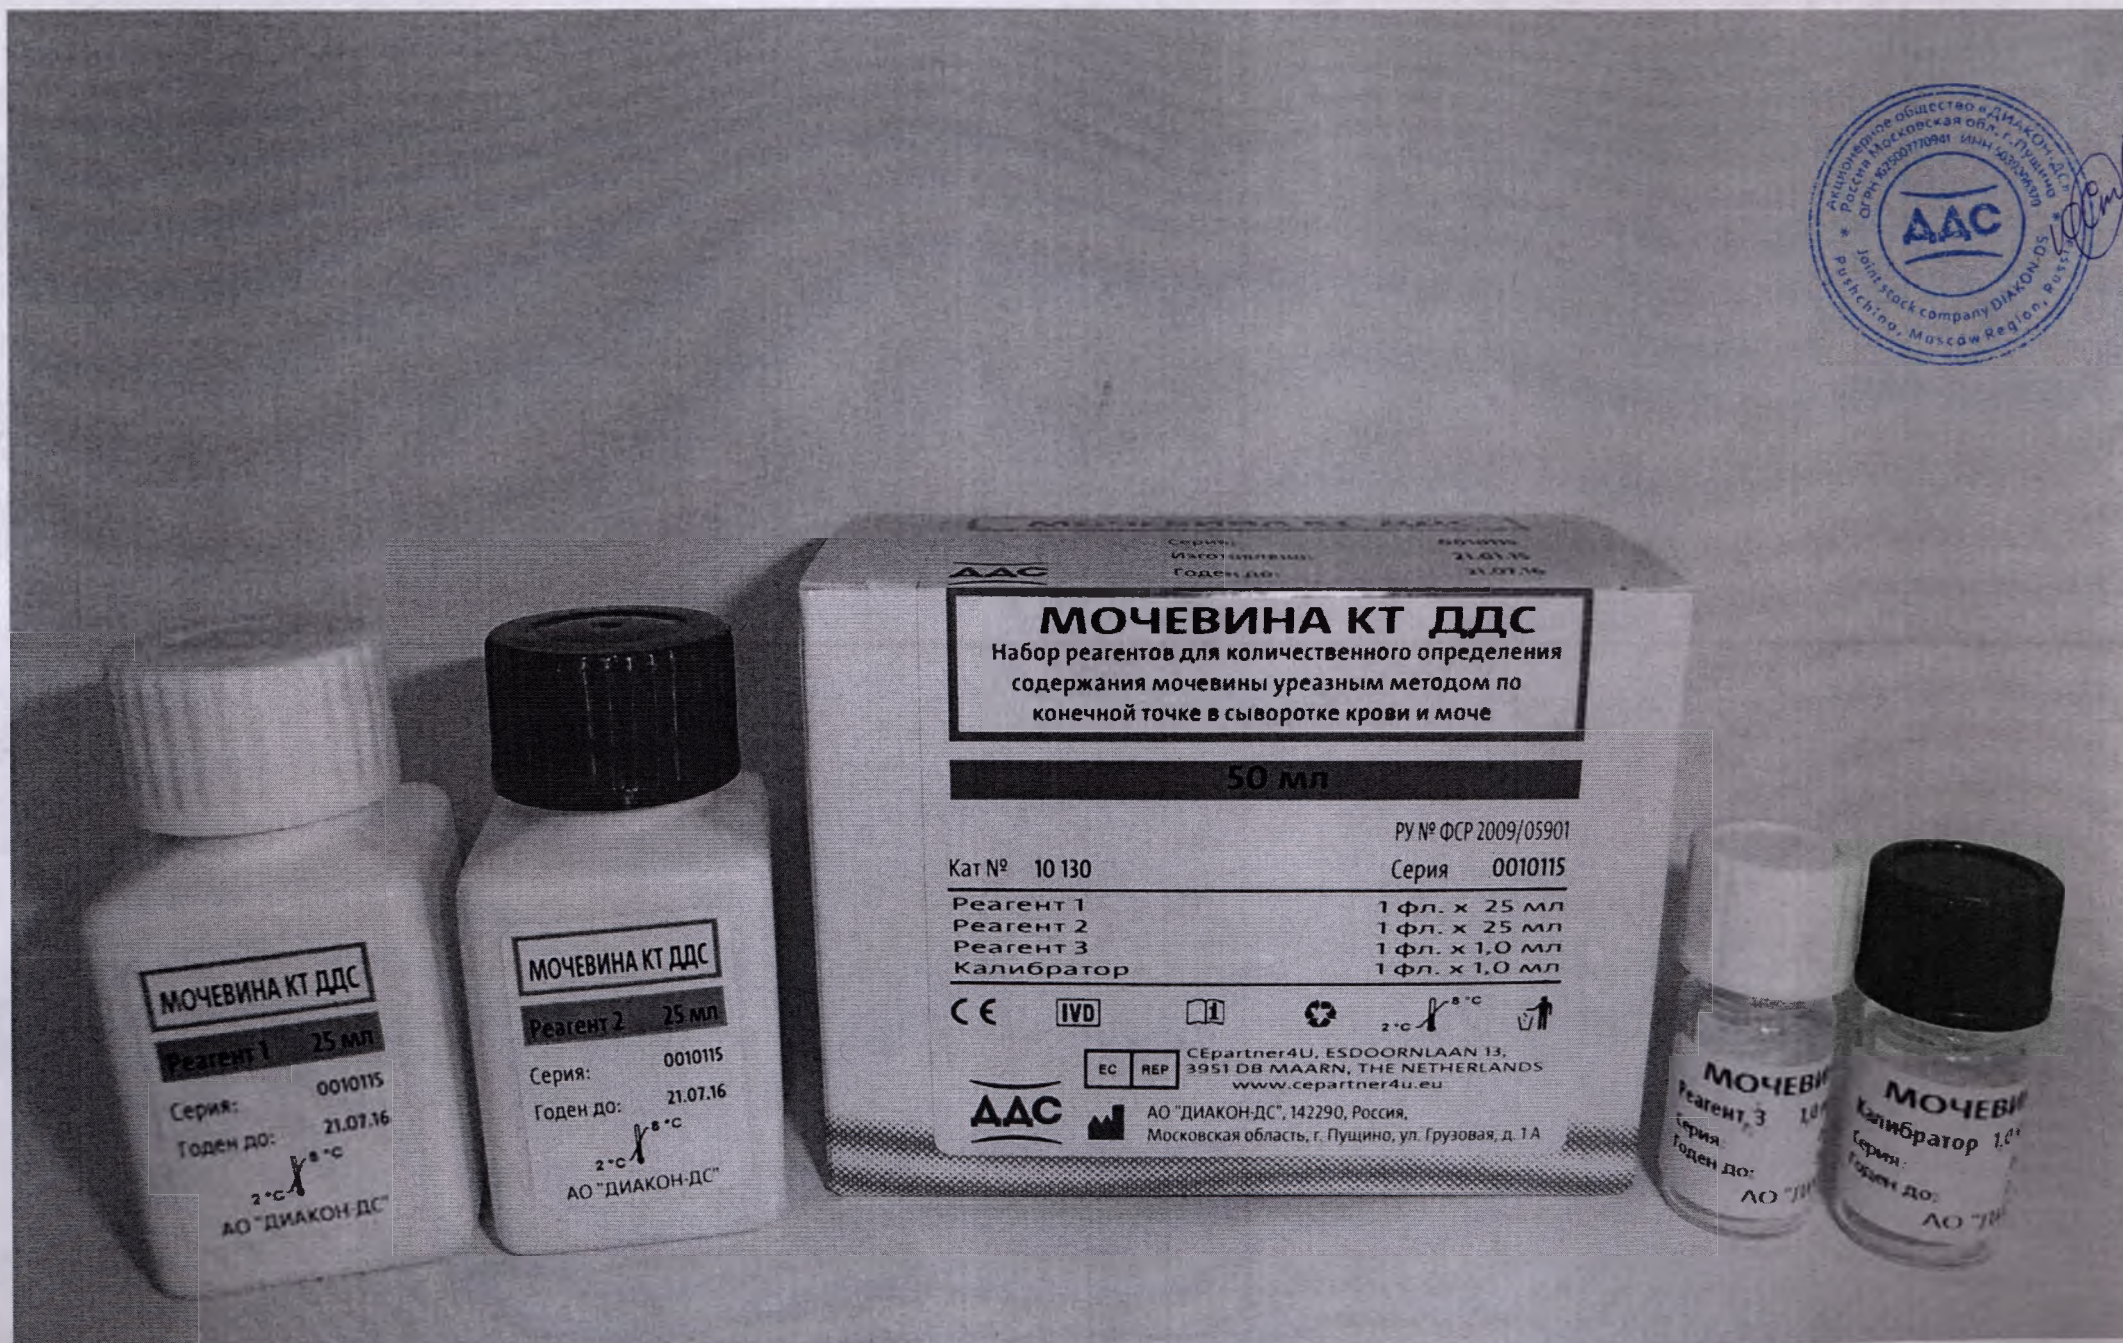

Внешний вид

Набора реагентов для количественного определения содержания мочевины уреазным методом по конечной точке в сыворотке крови и моче (МОЧЕВИНА КТ ДДС)

