



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ**iuStar 160.**


154
iuStar 300.

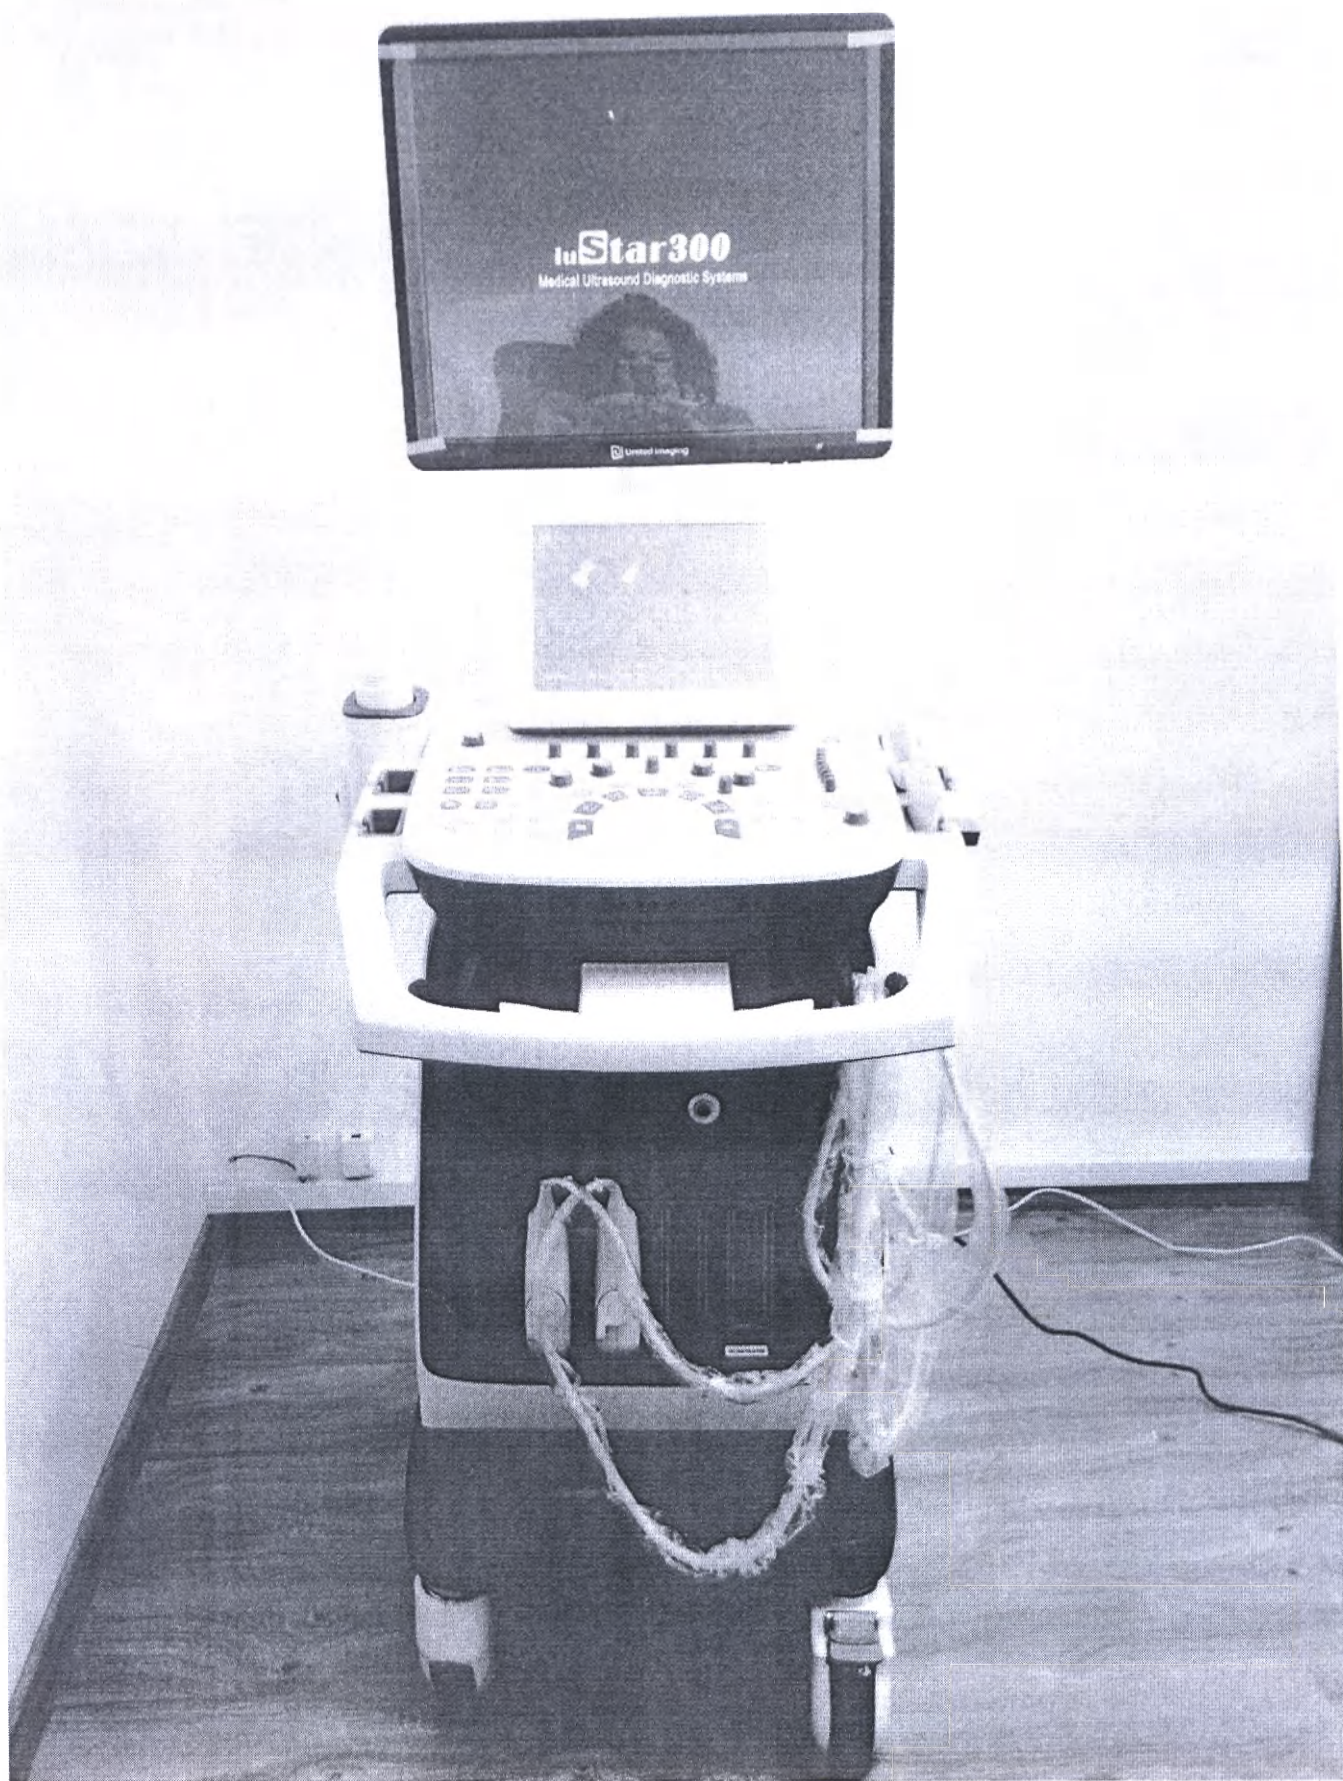


Главный блок iuStar 160.

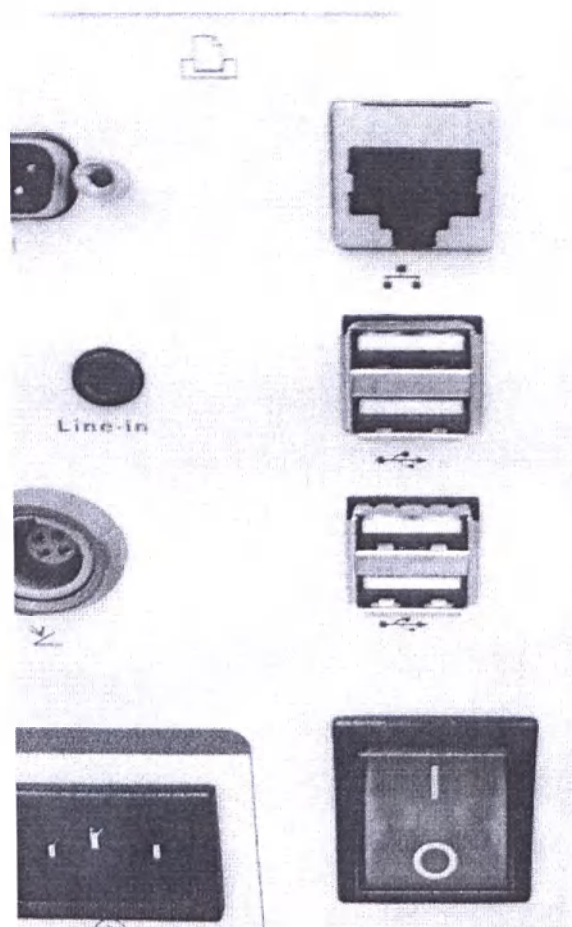


Главный блок iuStar 300.

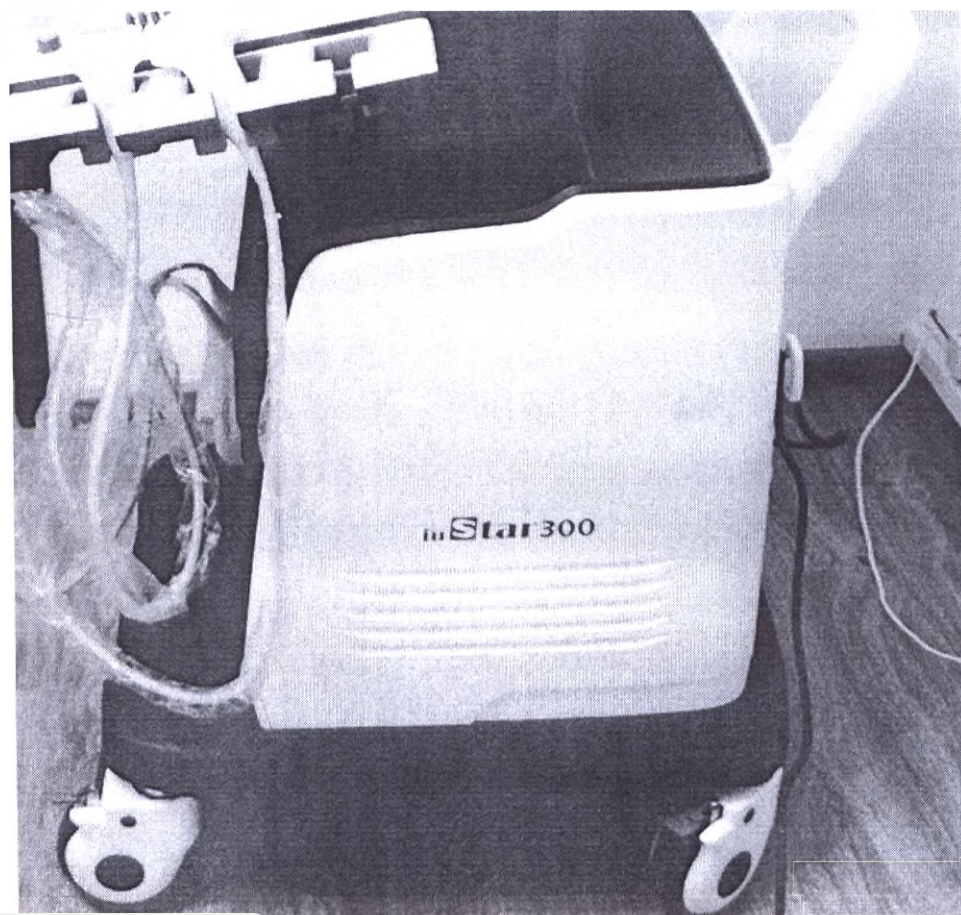


Цветной ЖК монитор высокой чёткости.

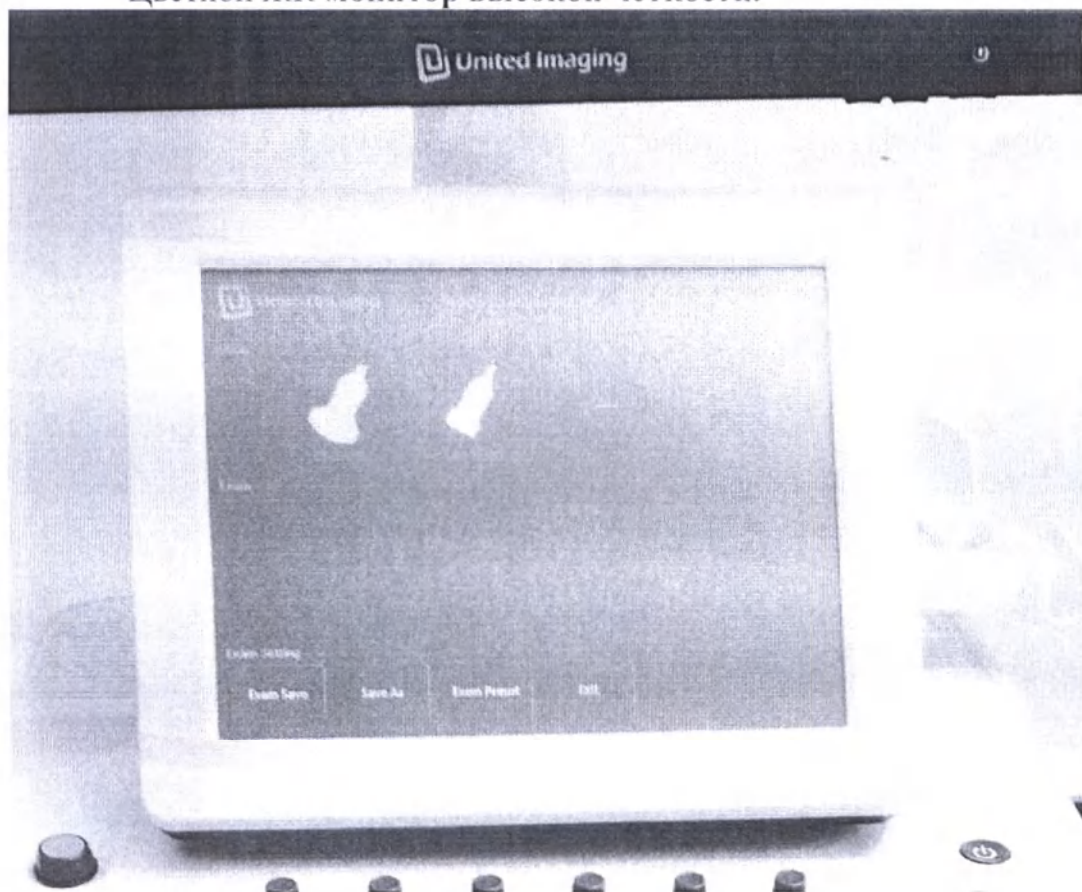


Блок В-режима визуализации.

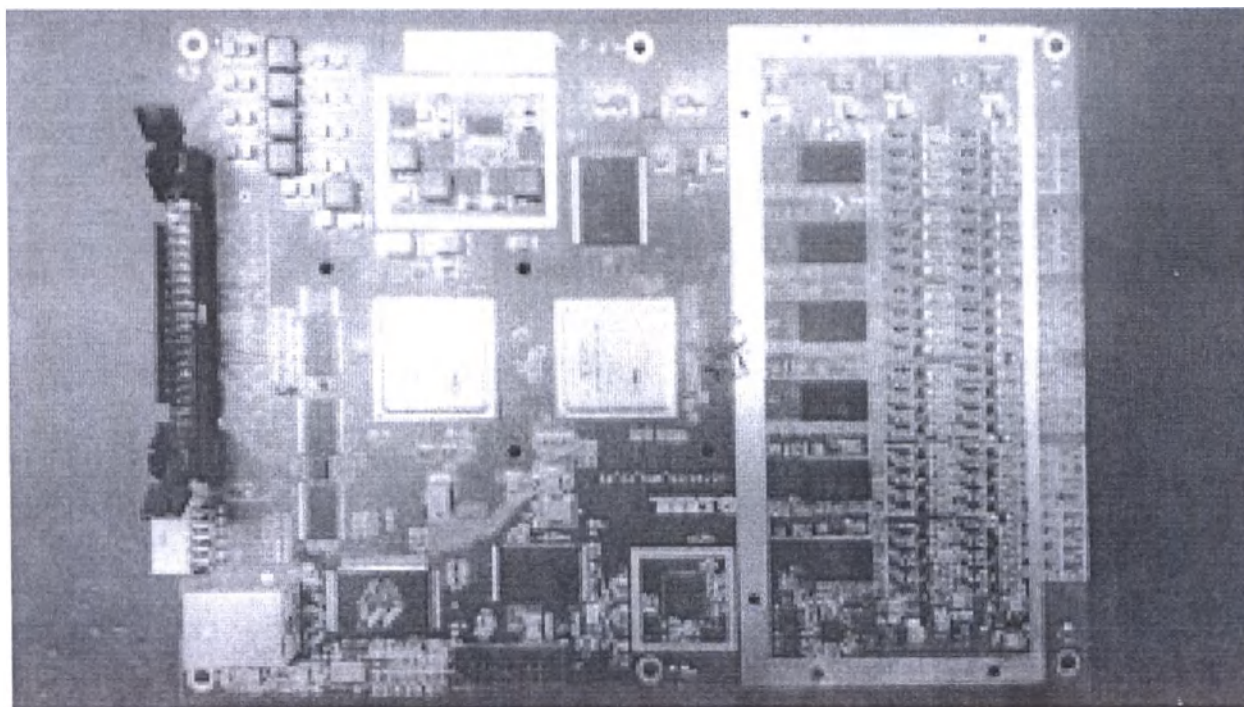


Блок М-режима визуализации.

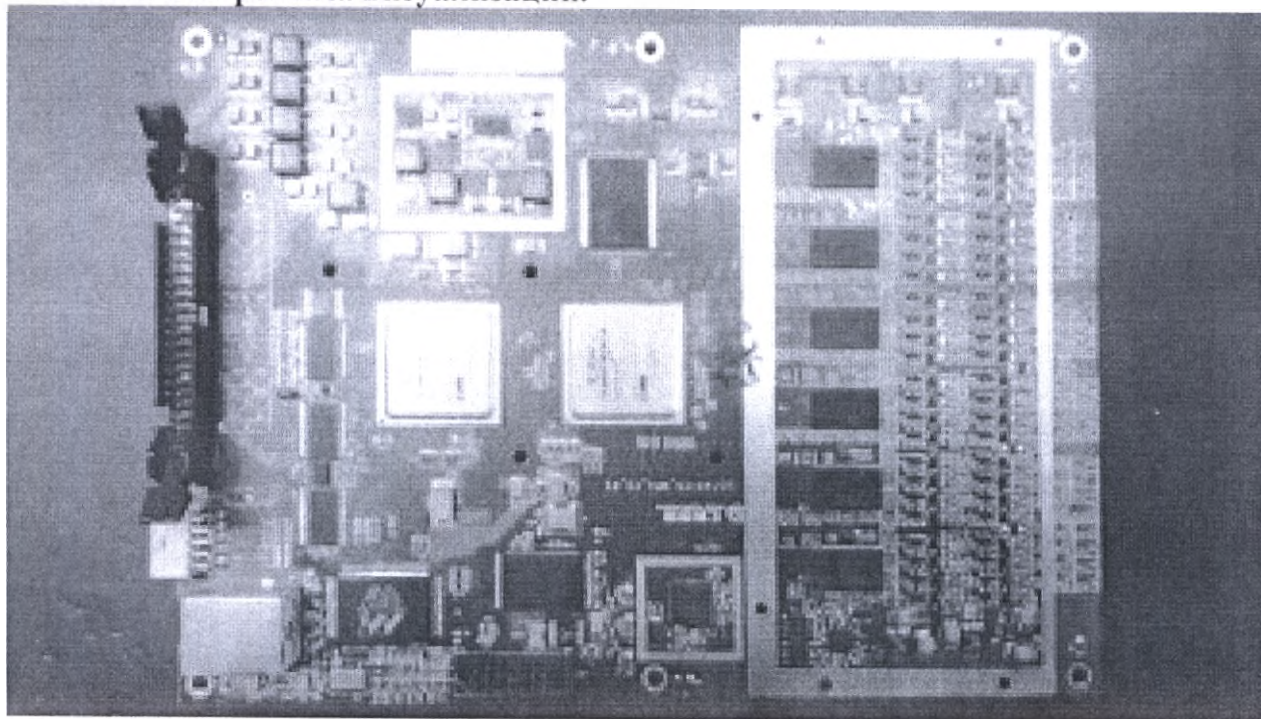


Блок цветного доплера визуализации.

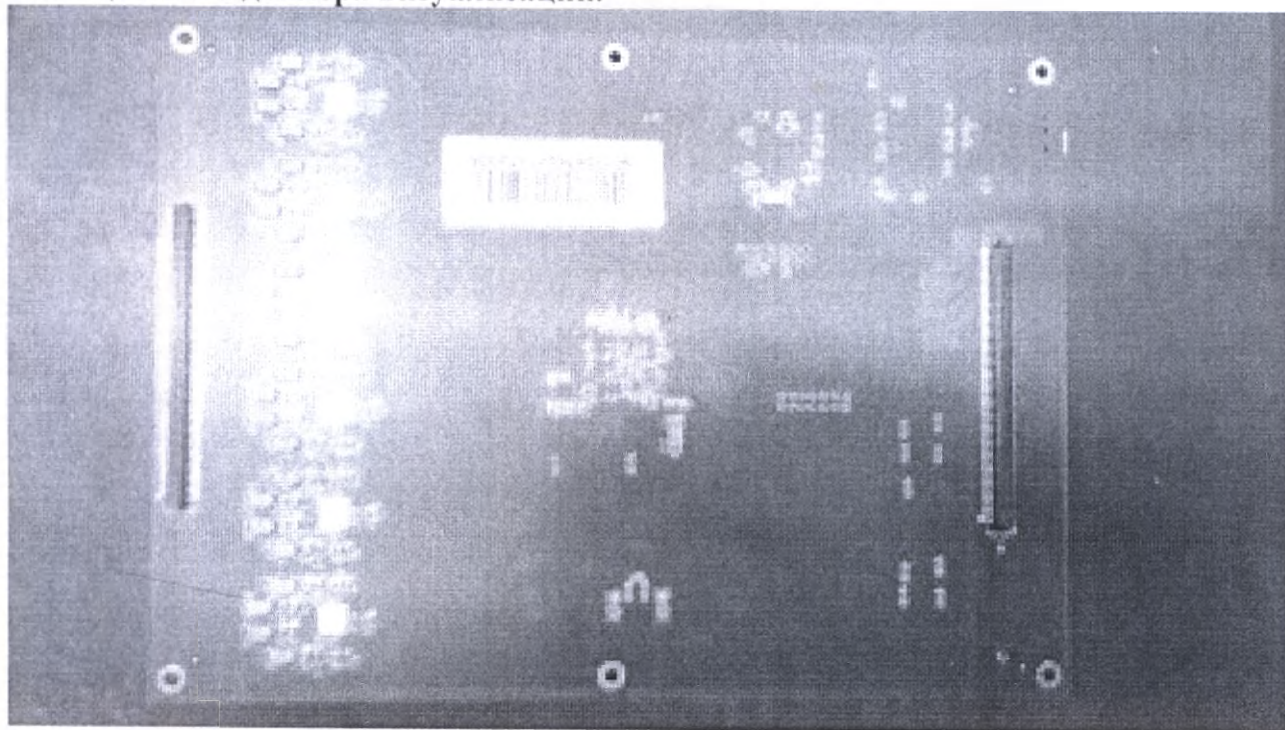


Блок импульсного доплера.

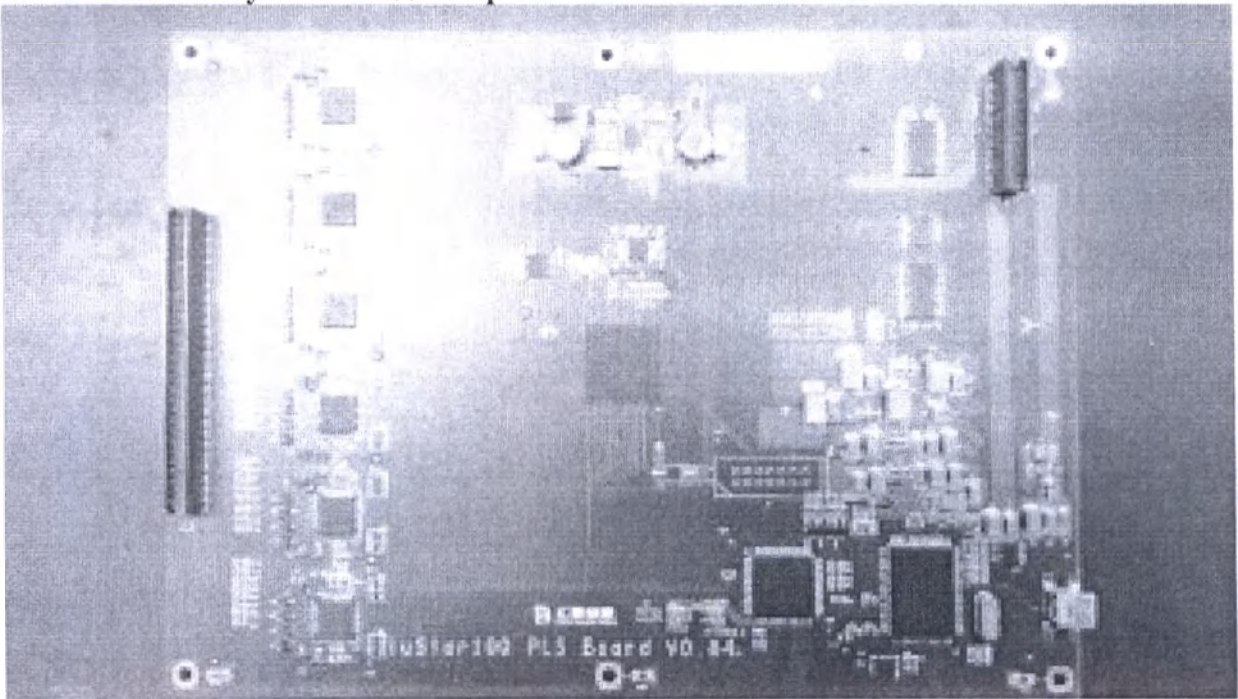

Блок питания переменного/постоянного тока.

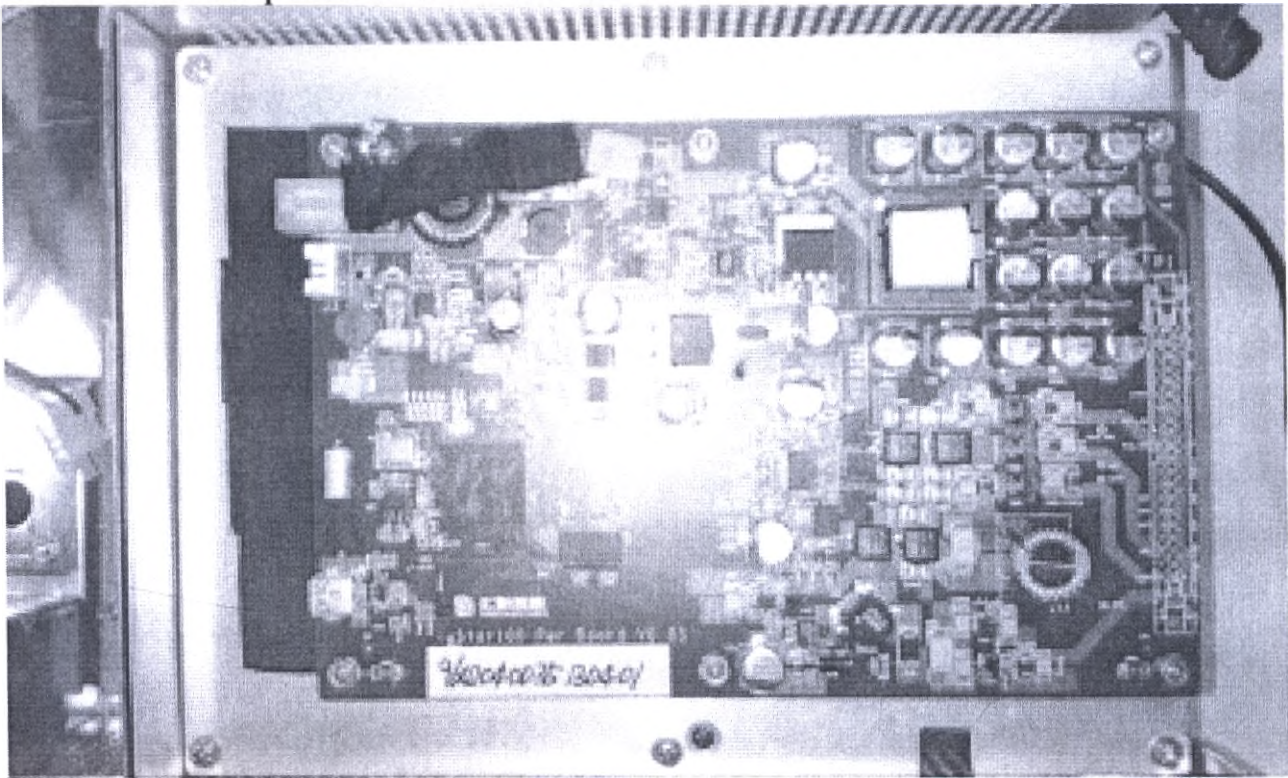


Блок ЭКГ.

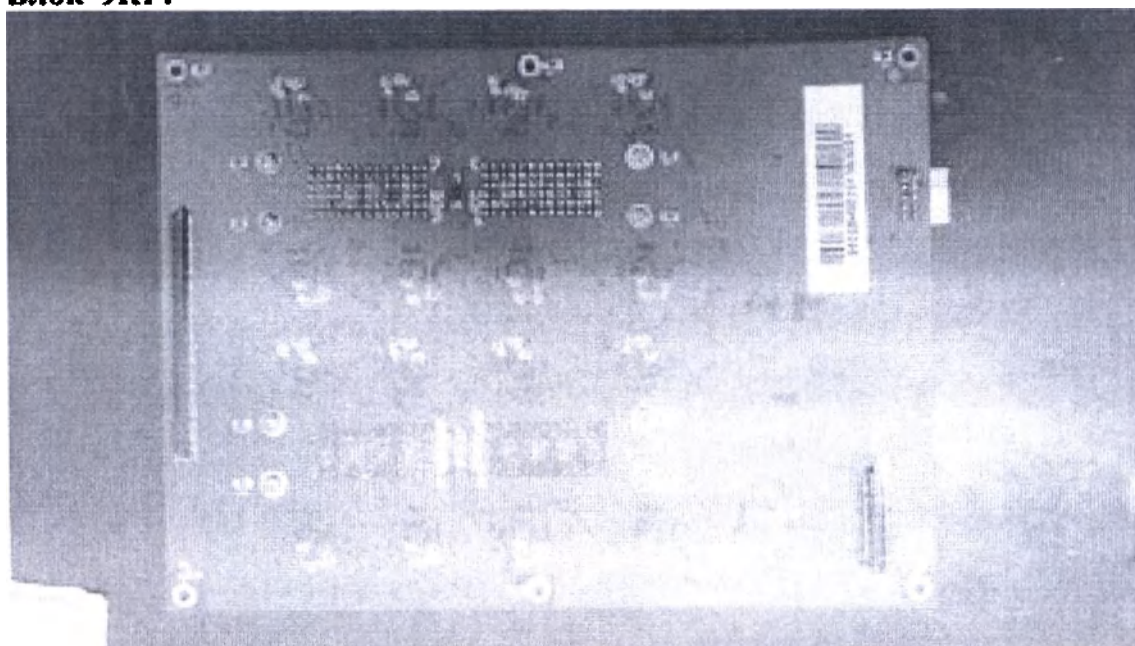


Жесткий диск торговой марки Seagate или Western Digital или Toshiba или Samsung.



Устройство для записи дисков DVD-RW Samsung или LG или Sony

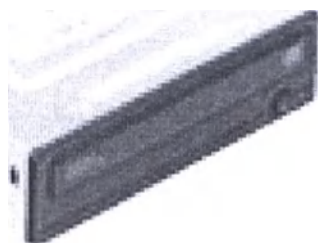


Порты USB, не более 6 шт.

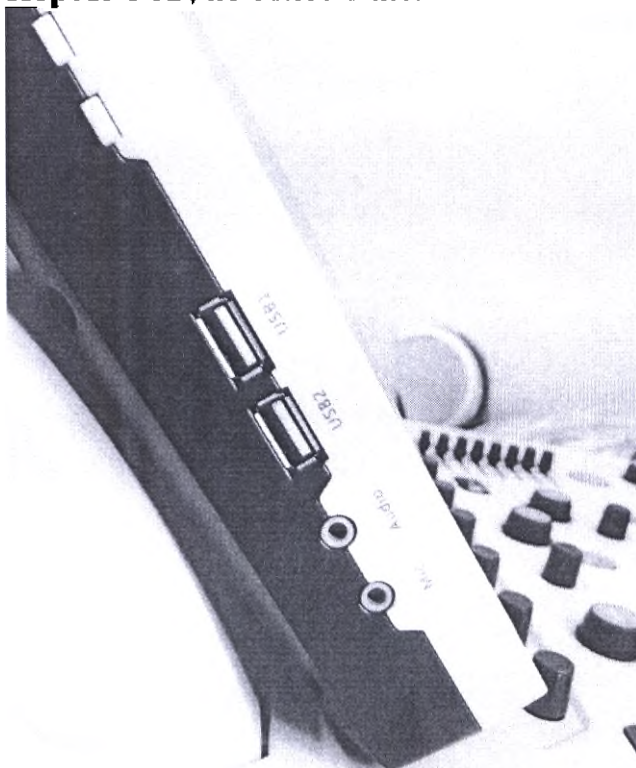

**Программное обеспечение DICOM.
Клавиатура.**



Кабель электропитания.

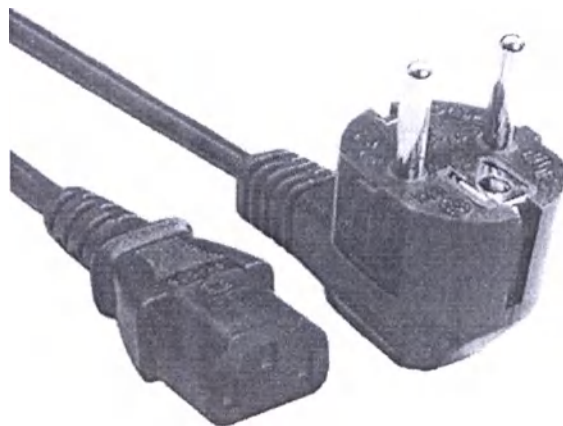


III. Принадлежности:


1. Датчик линейный серии L, не более 6 шт.



2. Датчик конвексный серии С, не более 6 шт.

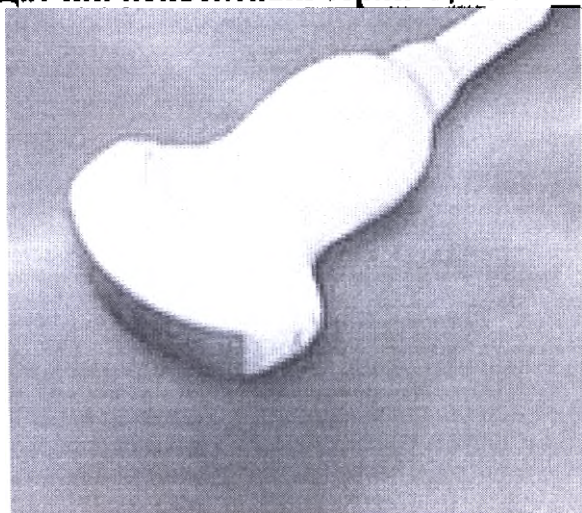

3. Датчик микроконвексный серии МС не более 6 шт.




4. Датчик объёмный серии V, не более 6 шт.




5. Датчик секторный фазированный серии Р, не более 6 шт.




6. Датчик внутриполостный серии EV, не более 6 шт.

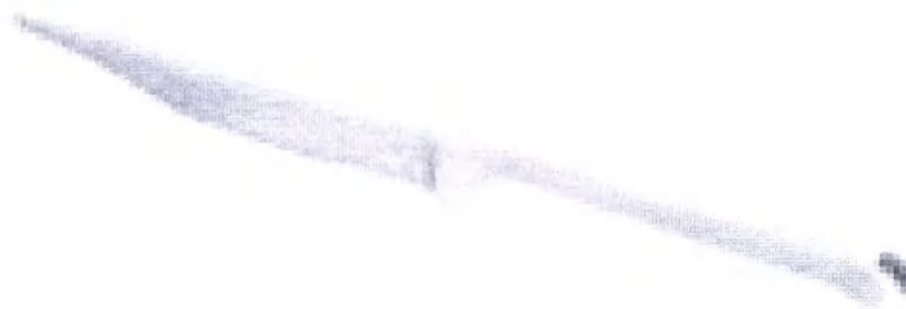


7. Датчик линейный широкополосный, не более 6 шт.




8. Датчик биплановый трансректальный, не более 6 шт.

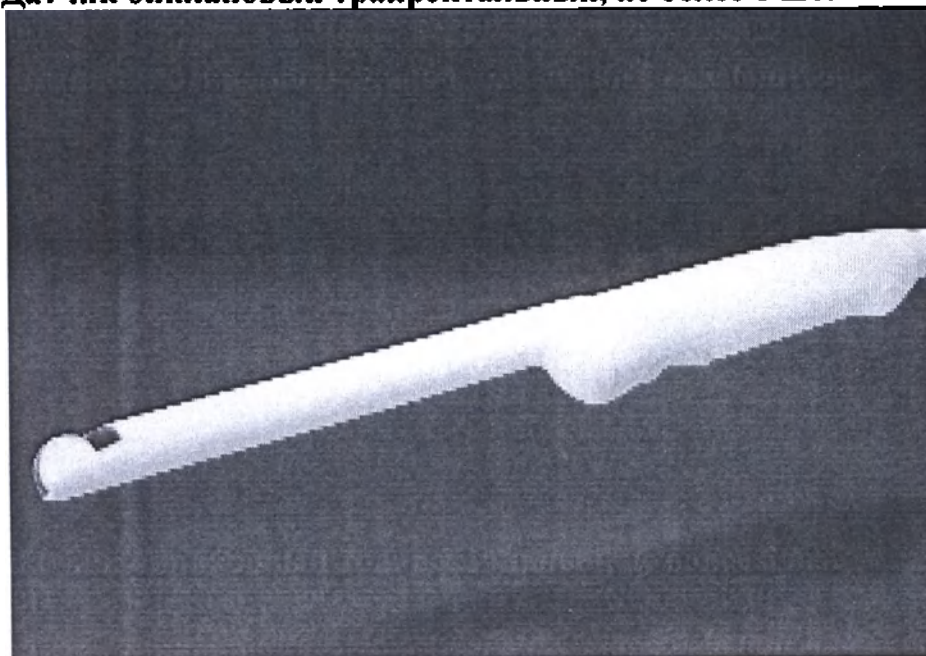


9. Датчик фазированный педнатрический, серии Р, не более 6 шт.




10. Датчик эндовагинальный, не более 6 шт.

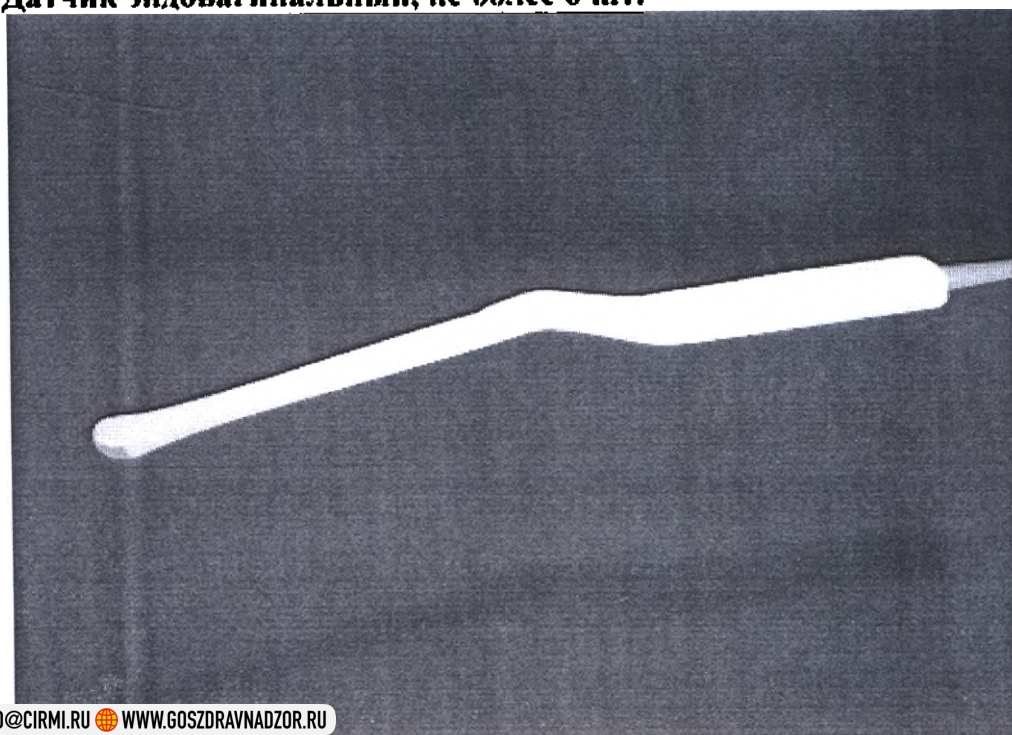


11. Датчик карандашного типа, не более 6 шт.

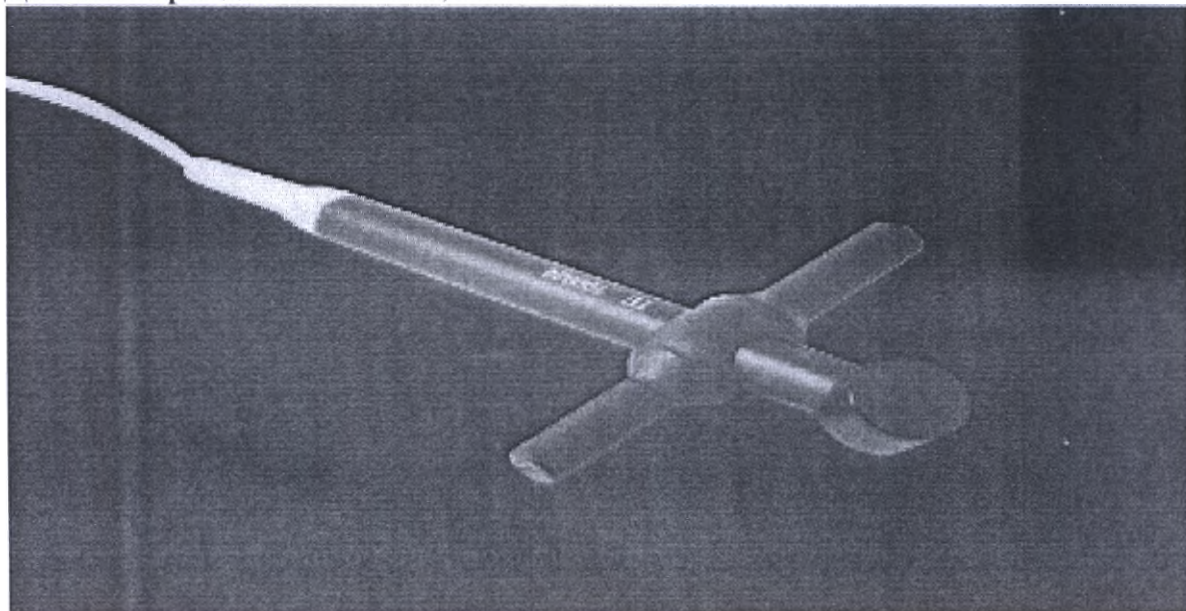


12. Датчик чреспищеводный, не более 6 шт.

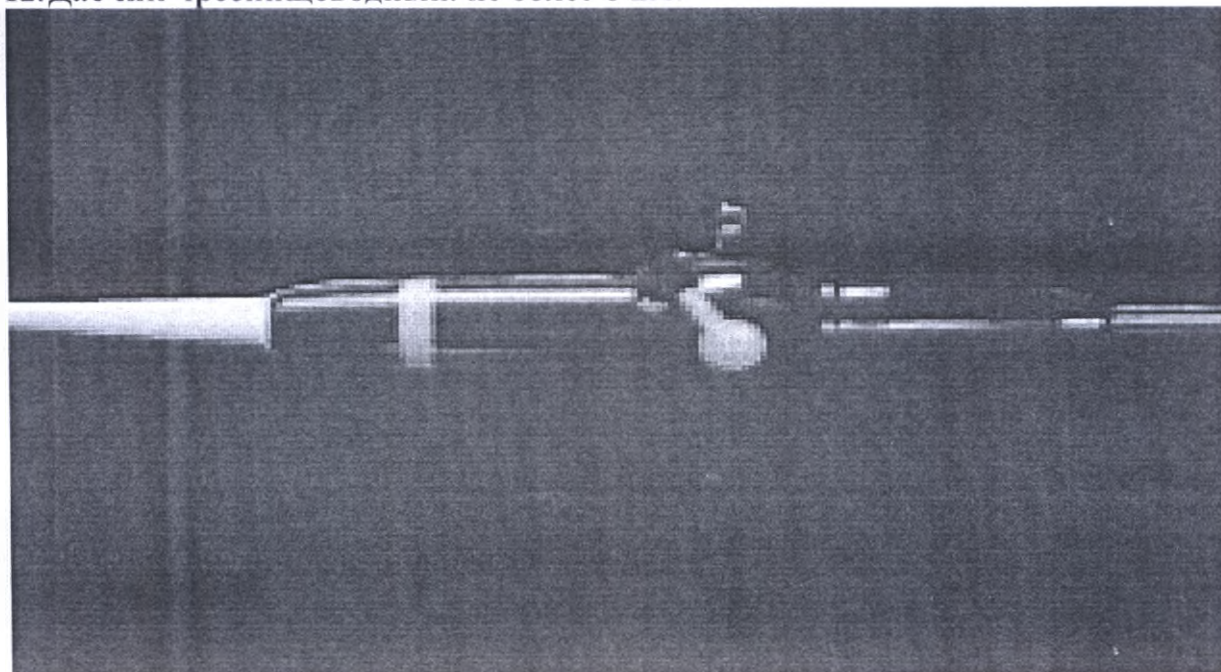


13. Датчик объемный микроконвексный внутриполостной 4D, не более 6 шт.

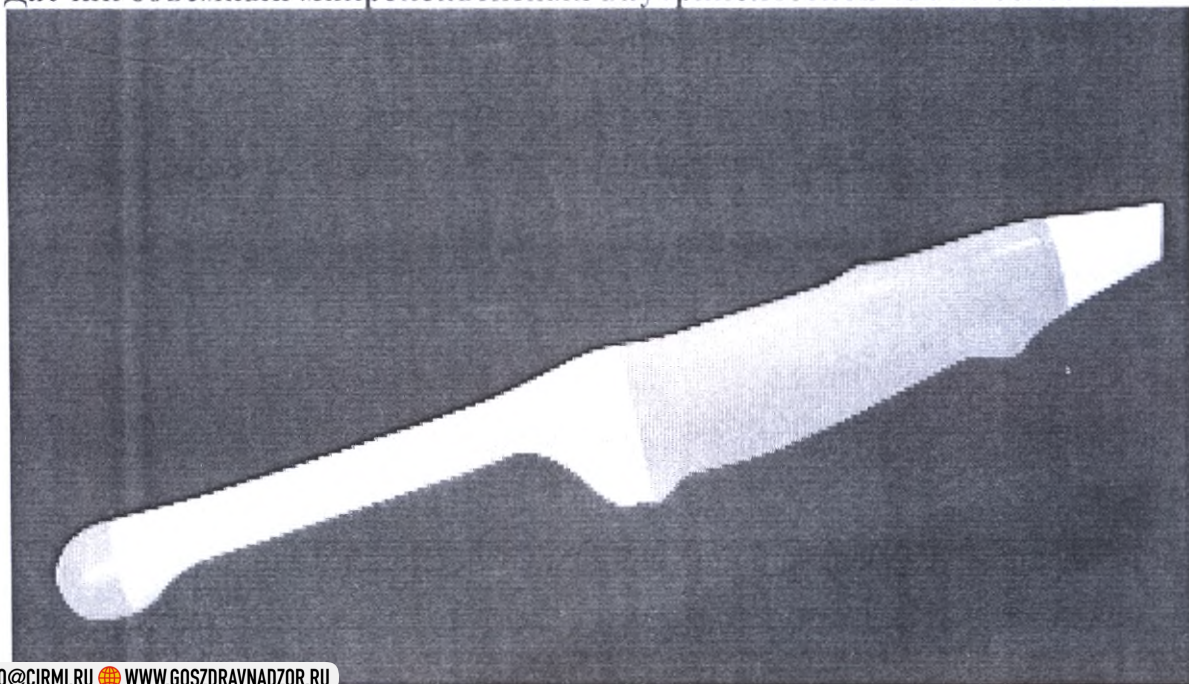

14. Датчик микроконвексный, ректовагинальный. не более 6 шт.

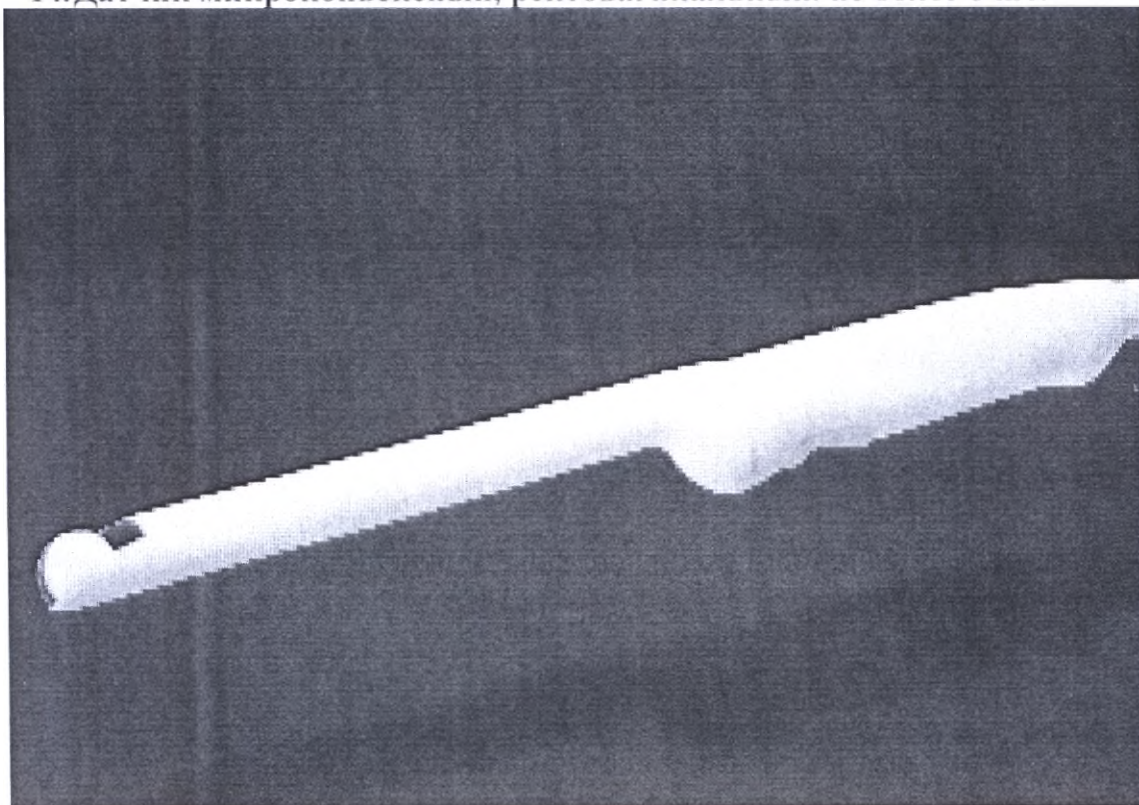


15. Обучающее программное обеспечение UniTutor.

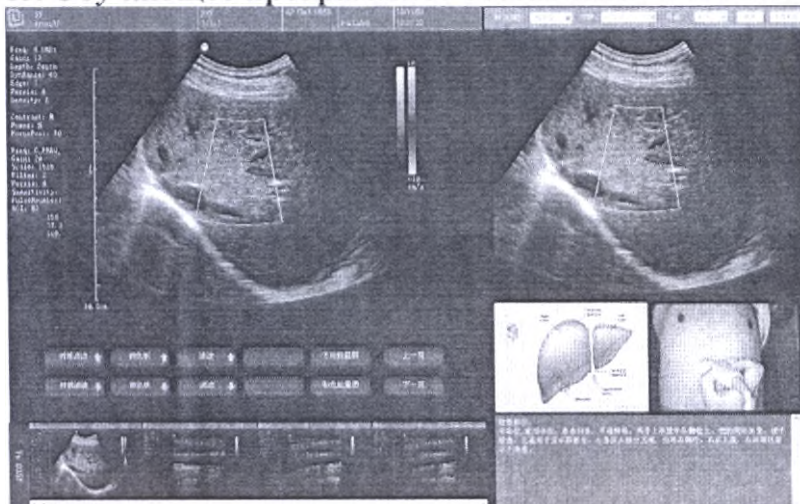


16. Механизм опускания и поднятия рабочей панели.



17. Подогреватель геля.

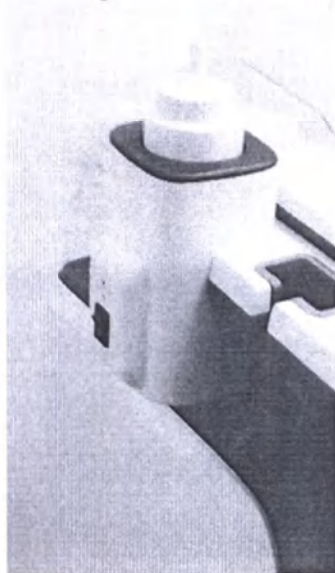


18. Блок 3D/4D визуализации.

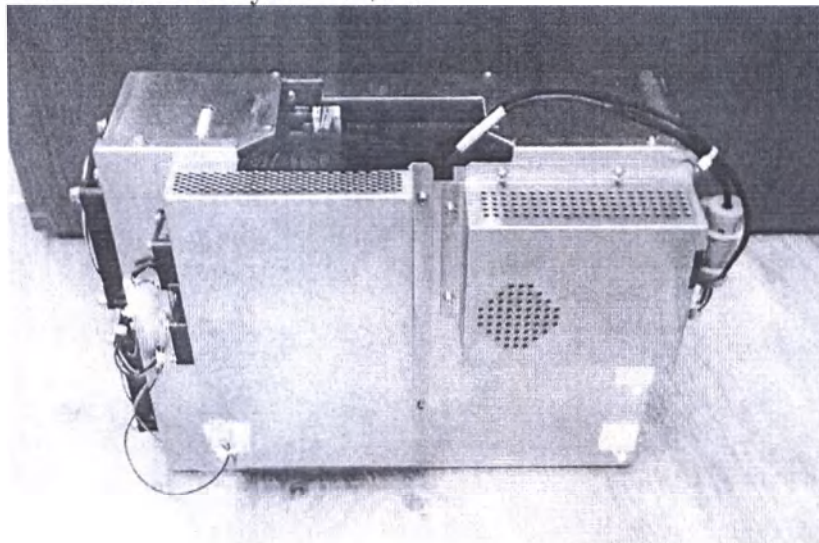

19. Блок отображения «картинка в картинке».


20. Принтер цветной торговой марки Mitsubishi или SONY.

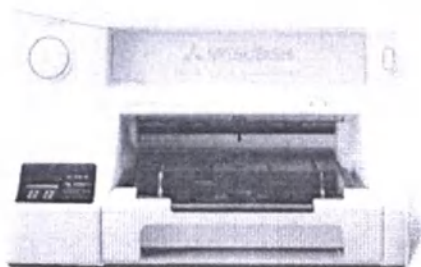

160
21. Принтер чёрно-белый торговой марки Mitsubishi или SONY.




22. Кабели для подключения принтера, не более 3 шт.

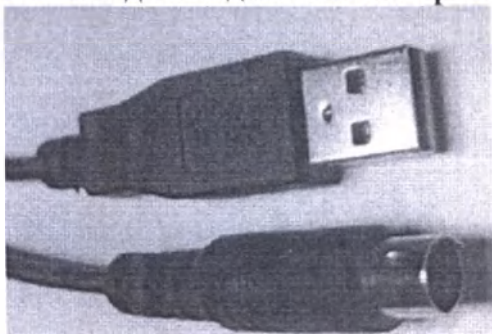

23. Набор для сублимационной печати (плёнка и чернила) для цветного принтера

24. Термобумага для чёрно-белого принтера.

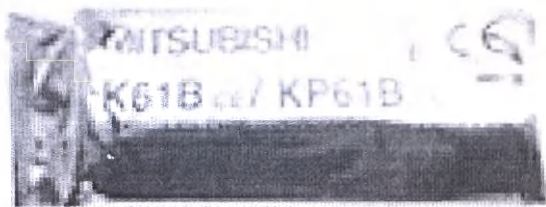


25. Источник бесперебойного питания торговой марки Eaton или GE или Jovyatlas.



26. Дополнительные цветные ЖК мониторы высокой чёткости, не более 2 шт.



27. Сетевая карта.

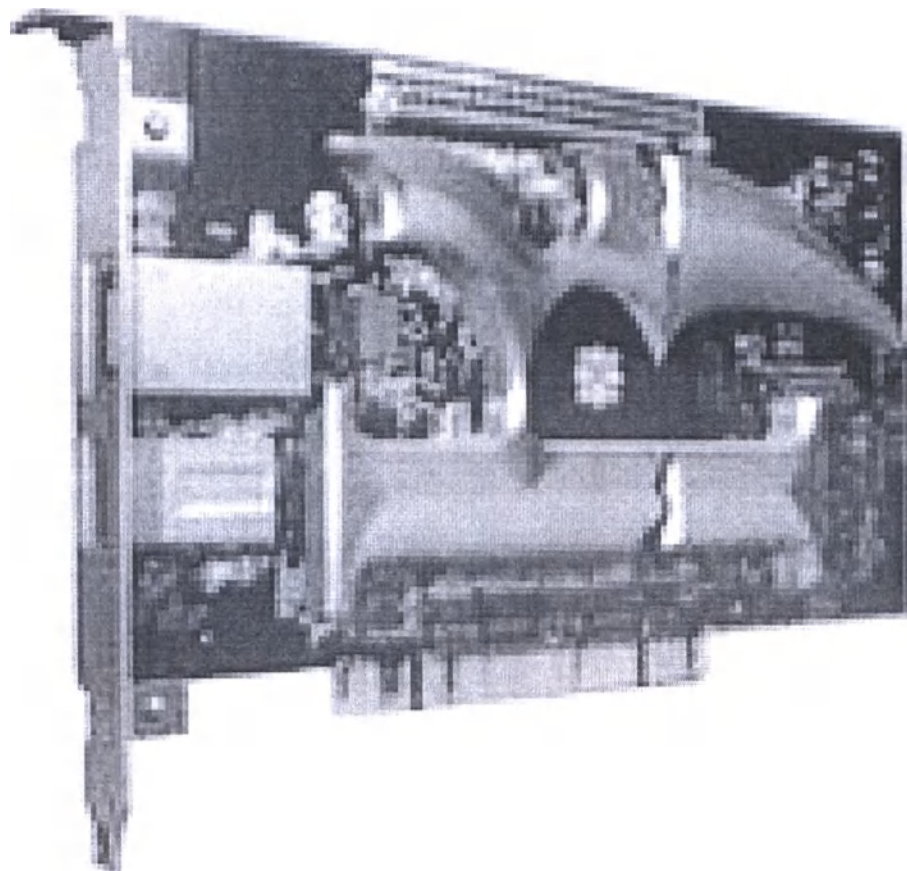


28. Сумка на колёсиках для транспортировки системы.




29. Аккумуляторы торговой марки MGL или POWERLONG, не более 3 шт.



30. Мобильная тележка для перемещения.

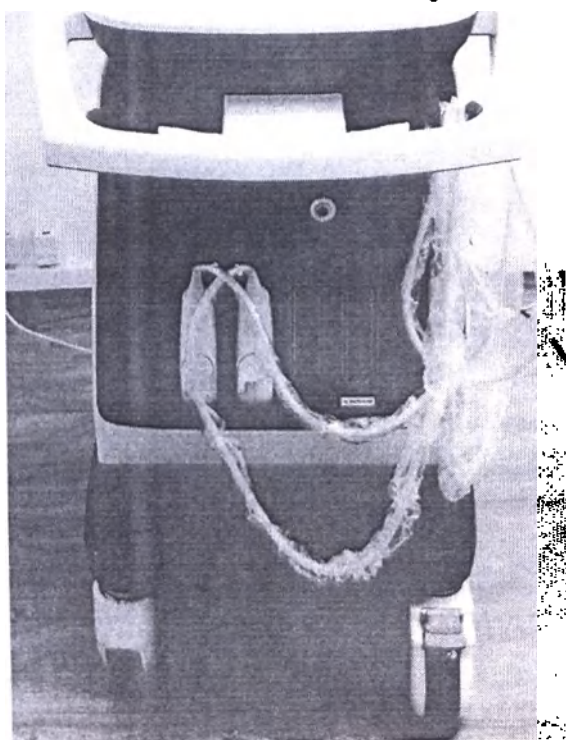

31. Держатель для датчиков.

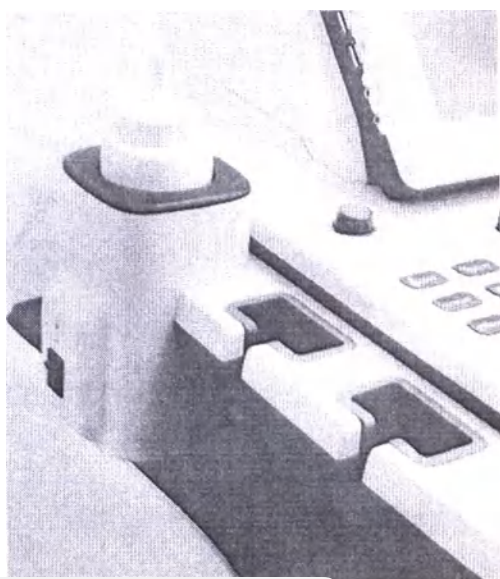

32. Цветной сенсорный экран высокой точности



Генеральный директор
от имени ООО «Юнайтед Текнолоджис»



Р.Р.Хазиахмедова

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 18 листов
Р.Р. Хезихидово
Генер. директор



ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Аппарат ультразвуковой диагностический серии «iuStar», варианты исполнения:



iuStar 160



iuStar 300



United Imaging Systems

iuStar300

Medical Ultrasound Diagnostic Systems

Input 220V ~, 50/60Hz, 300VA

CE 0197

SN 97010200011307036

2013-11-05



AC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)


Add: Elffestrasse 80,
D-20537 Hamburg Germany
Tel: 0049-40-2513175
Fax: 0049-40-255726



UNITED IMAGING SYSTEMS(BEIJING)CO;LTD

Add: 109 Bldg. 8, No. 8 West Dongbeiwan Rd.
Haidian Dist. Beijing 100193, P.R. China
Tel: +86-10-82626921
Fax: +86-10-62669095

Образец маркировки

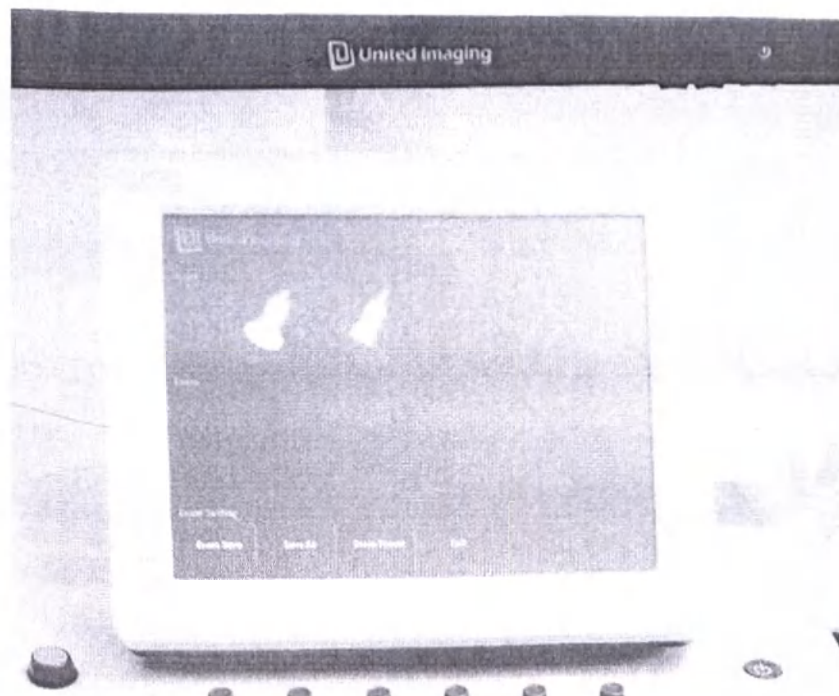

цветной ЖК – монитор высокой четкости