

Фотографии
Ультразвукового диагностического аппарата
WS80A–RUS
и его принадлежностей.



Специальный LED Монитор



Сенсорная панель

Электронная консоль

Панель управления

Нагреватель геля



евой кабель



SAMSUNG

SAMSUNG MEDISON

SAMSUNG MEDISON

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АППАРАТ

WS80A - RUS

Руководство

Том 1



WS80A - RUS


Руководство

Том 2




датчики конвексные:



CA1-7A,

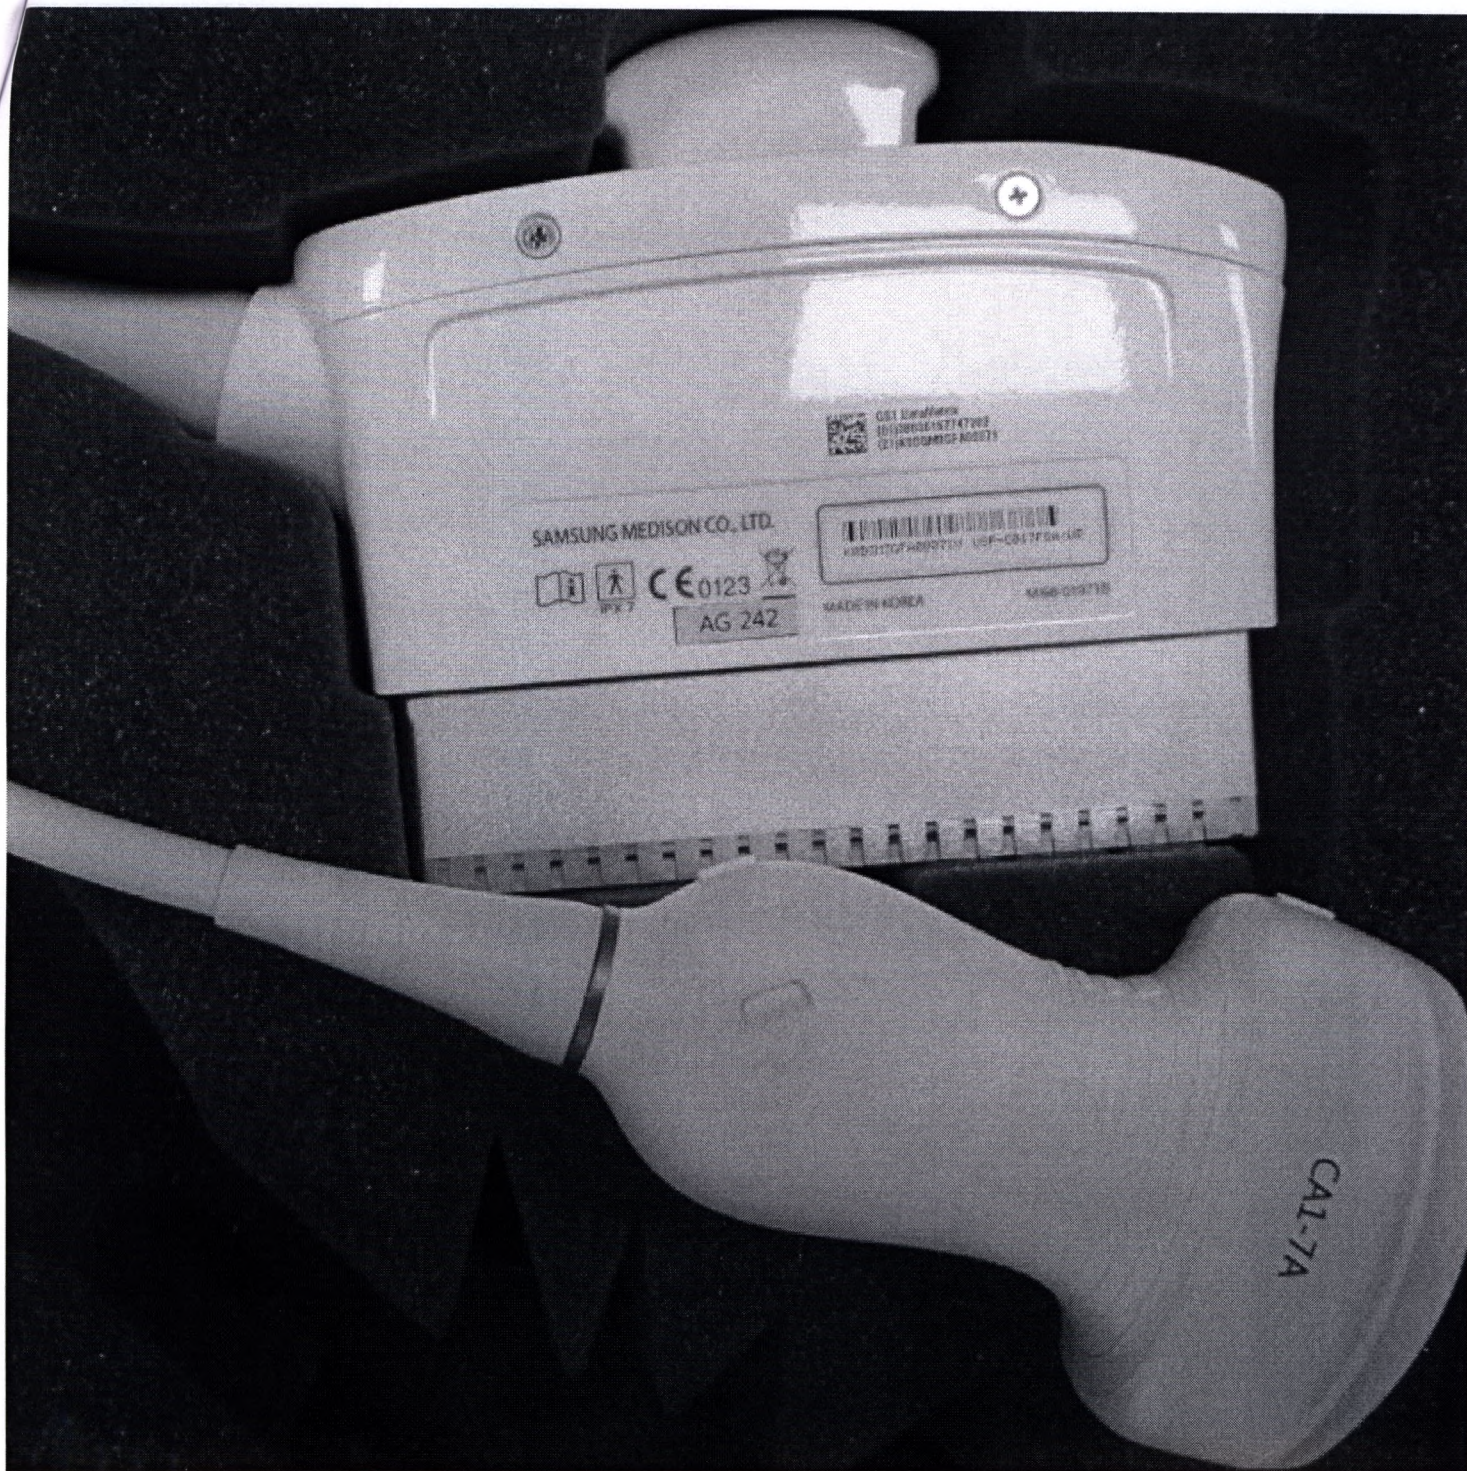

CA2-8A,

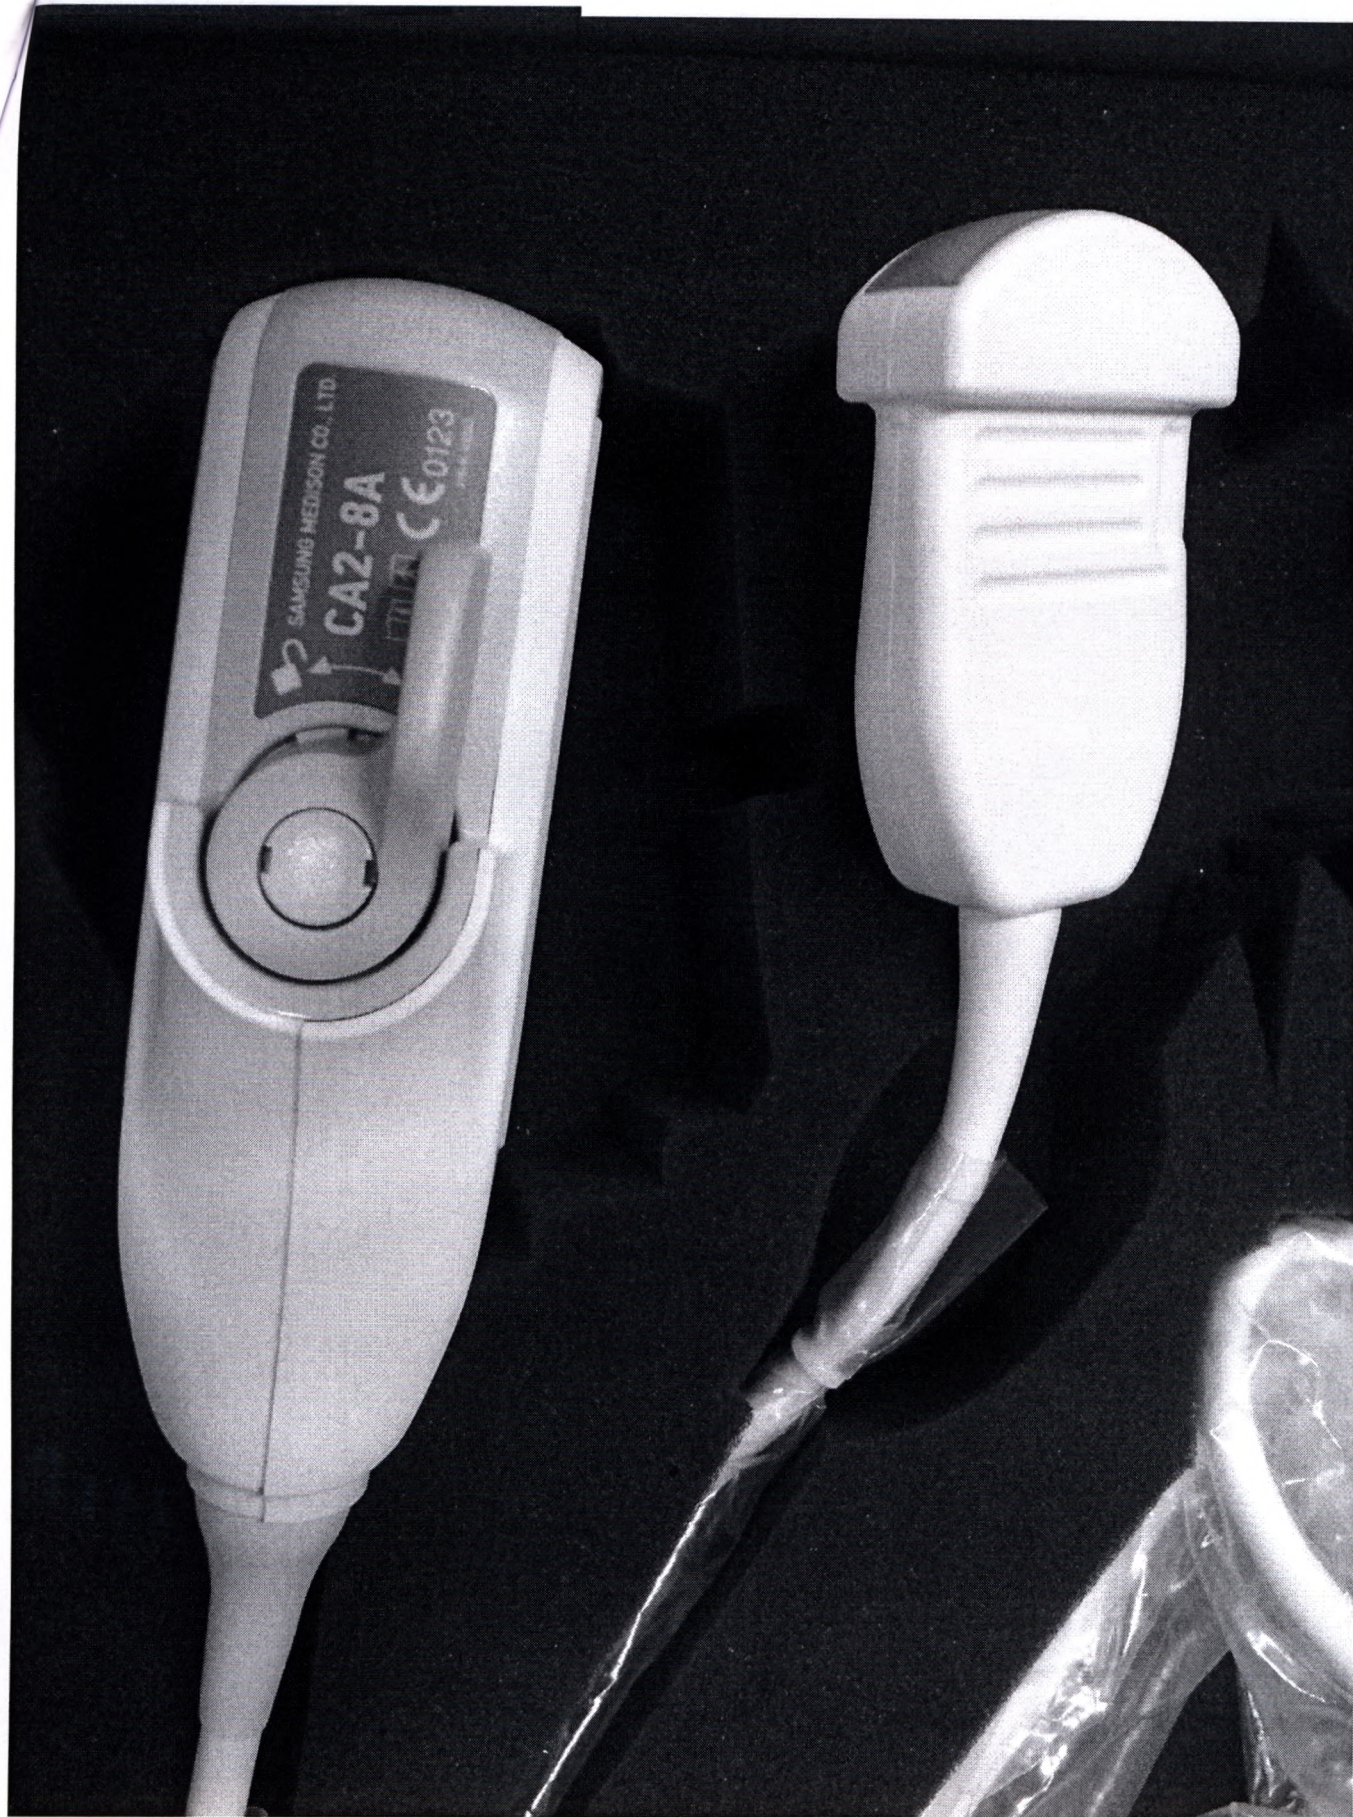


Частоты: F 4-9, C2-6; МГц.

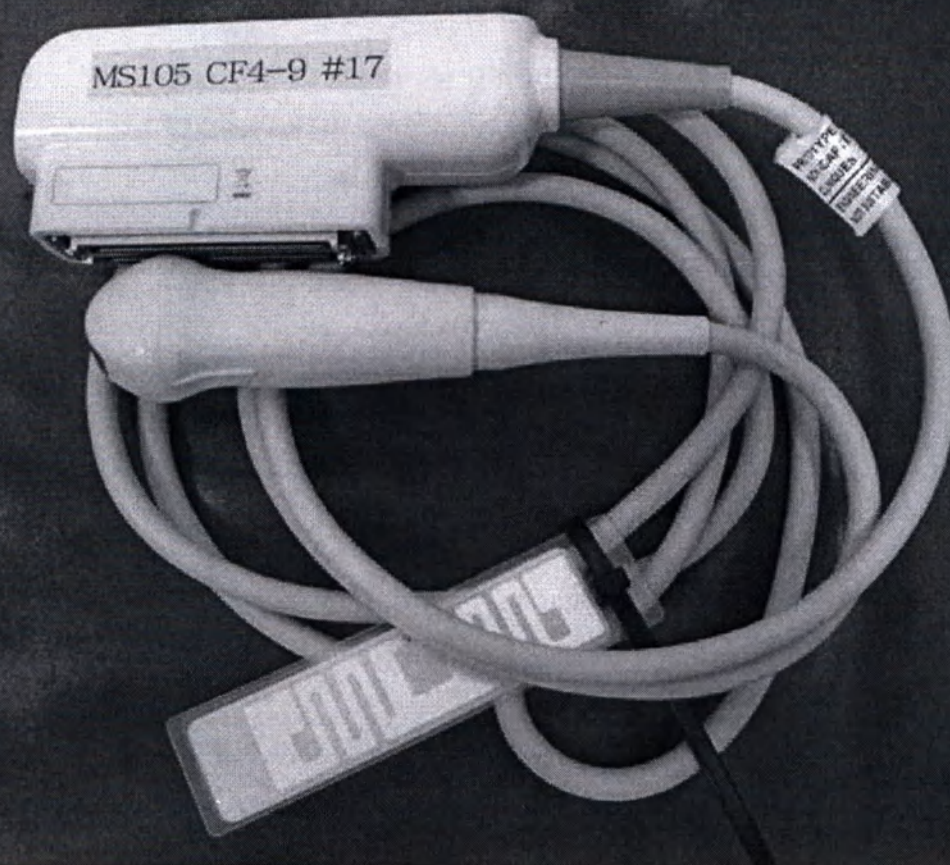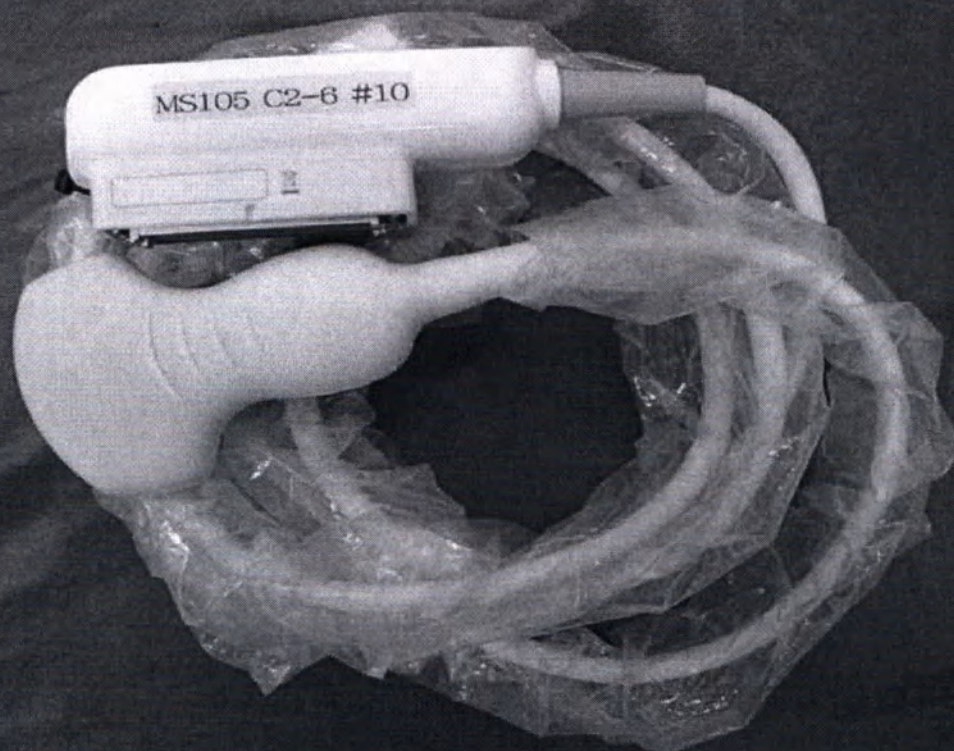


Датчик конвексный-монокристалльный: SC1-6; МГц.




Датчики конвексные-эндокавитальные:
VR5-9,

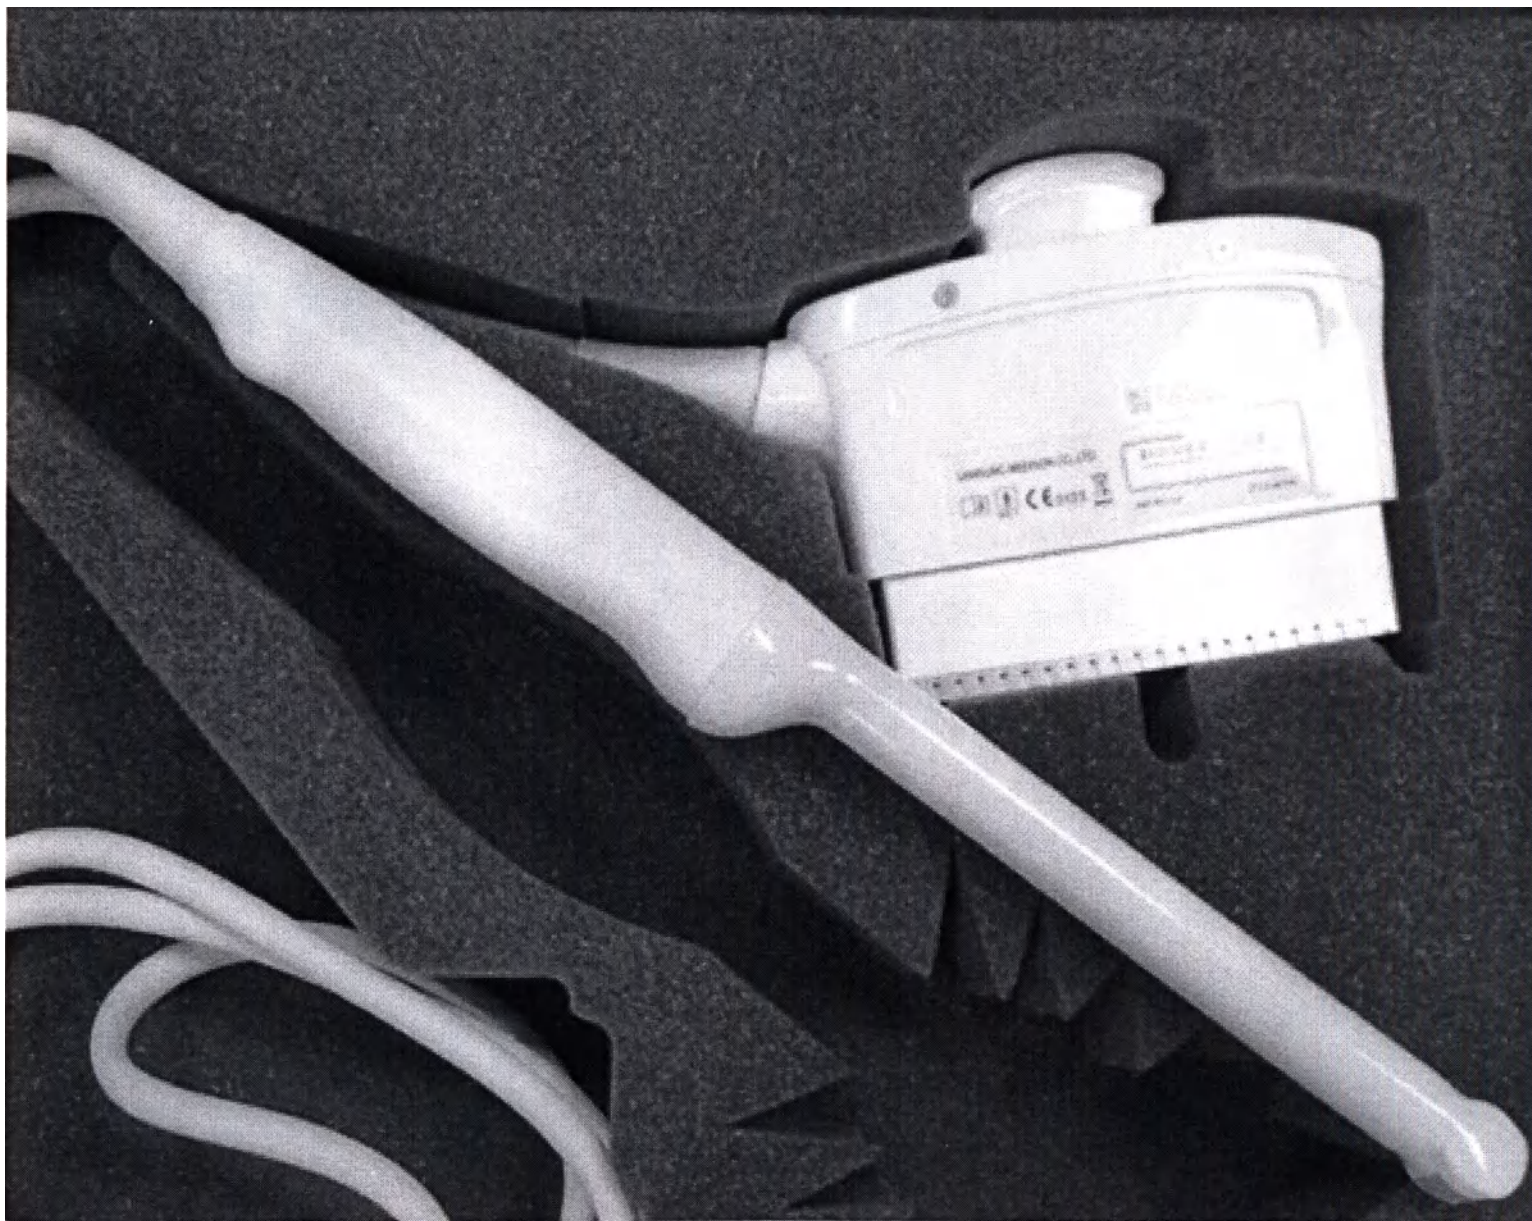

E3-12A,

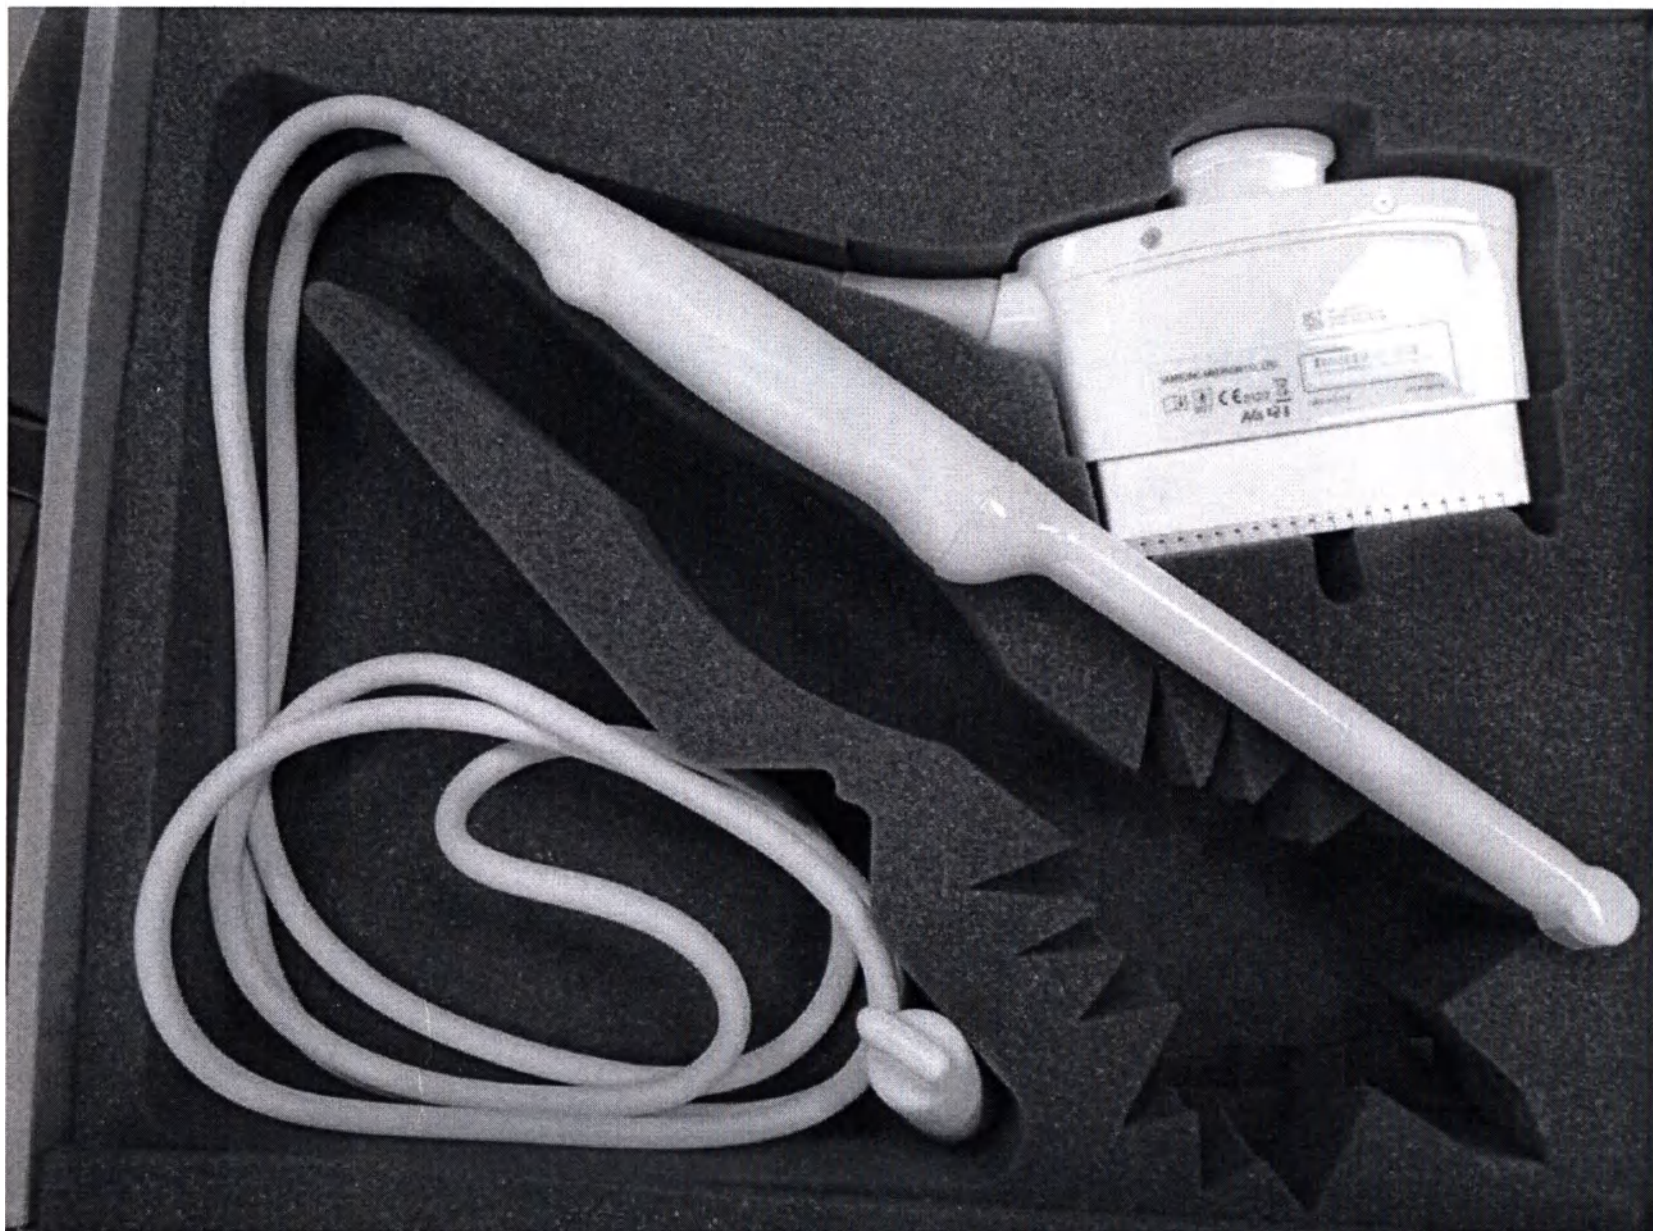

ЕА2-11В МГц

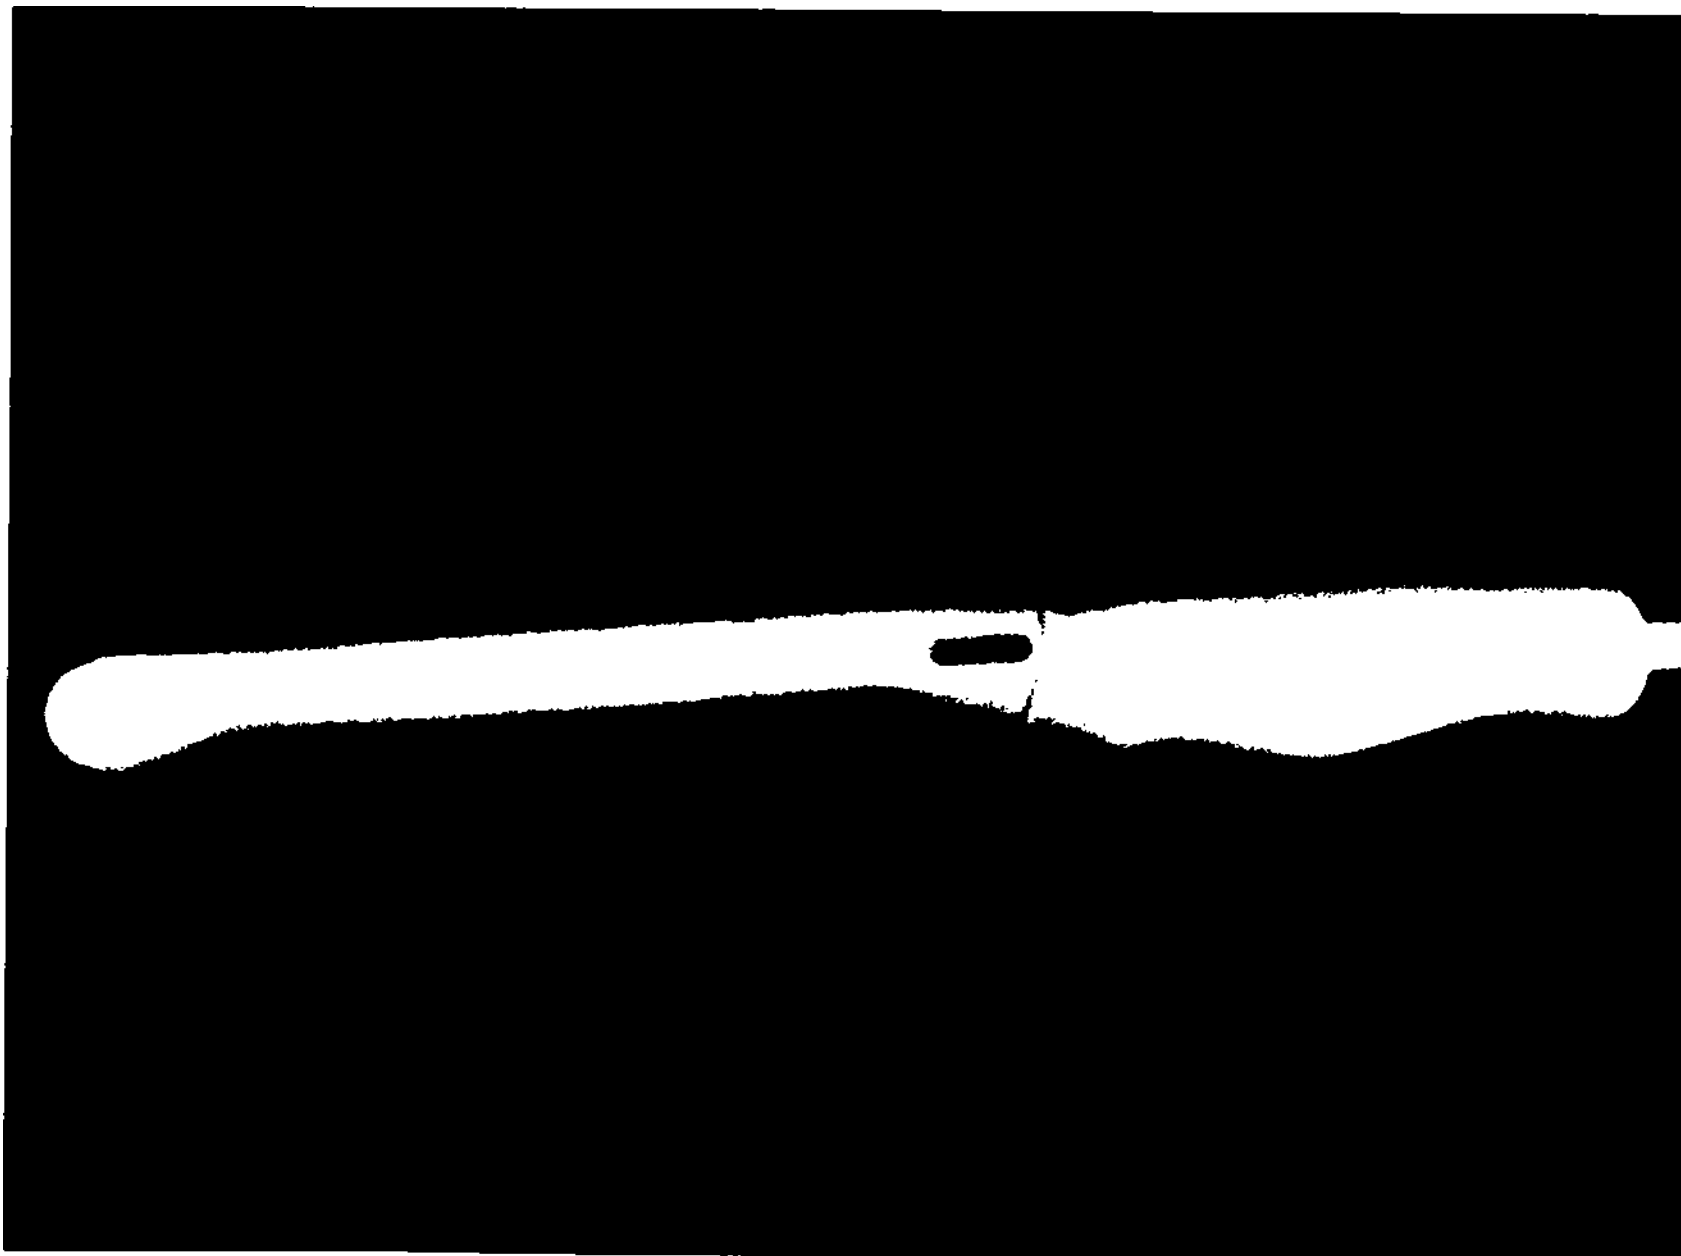


датчики линейные:


LS-13,




L3-12A,

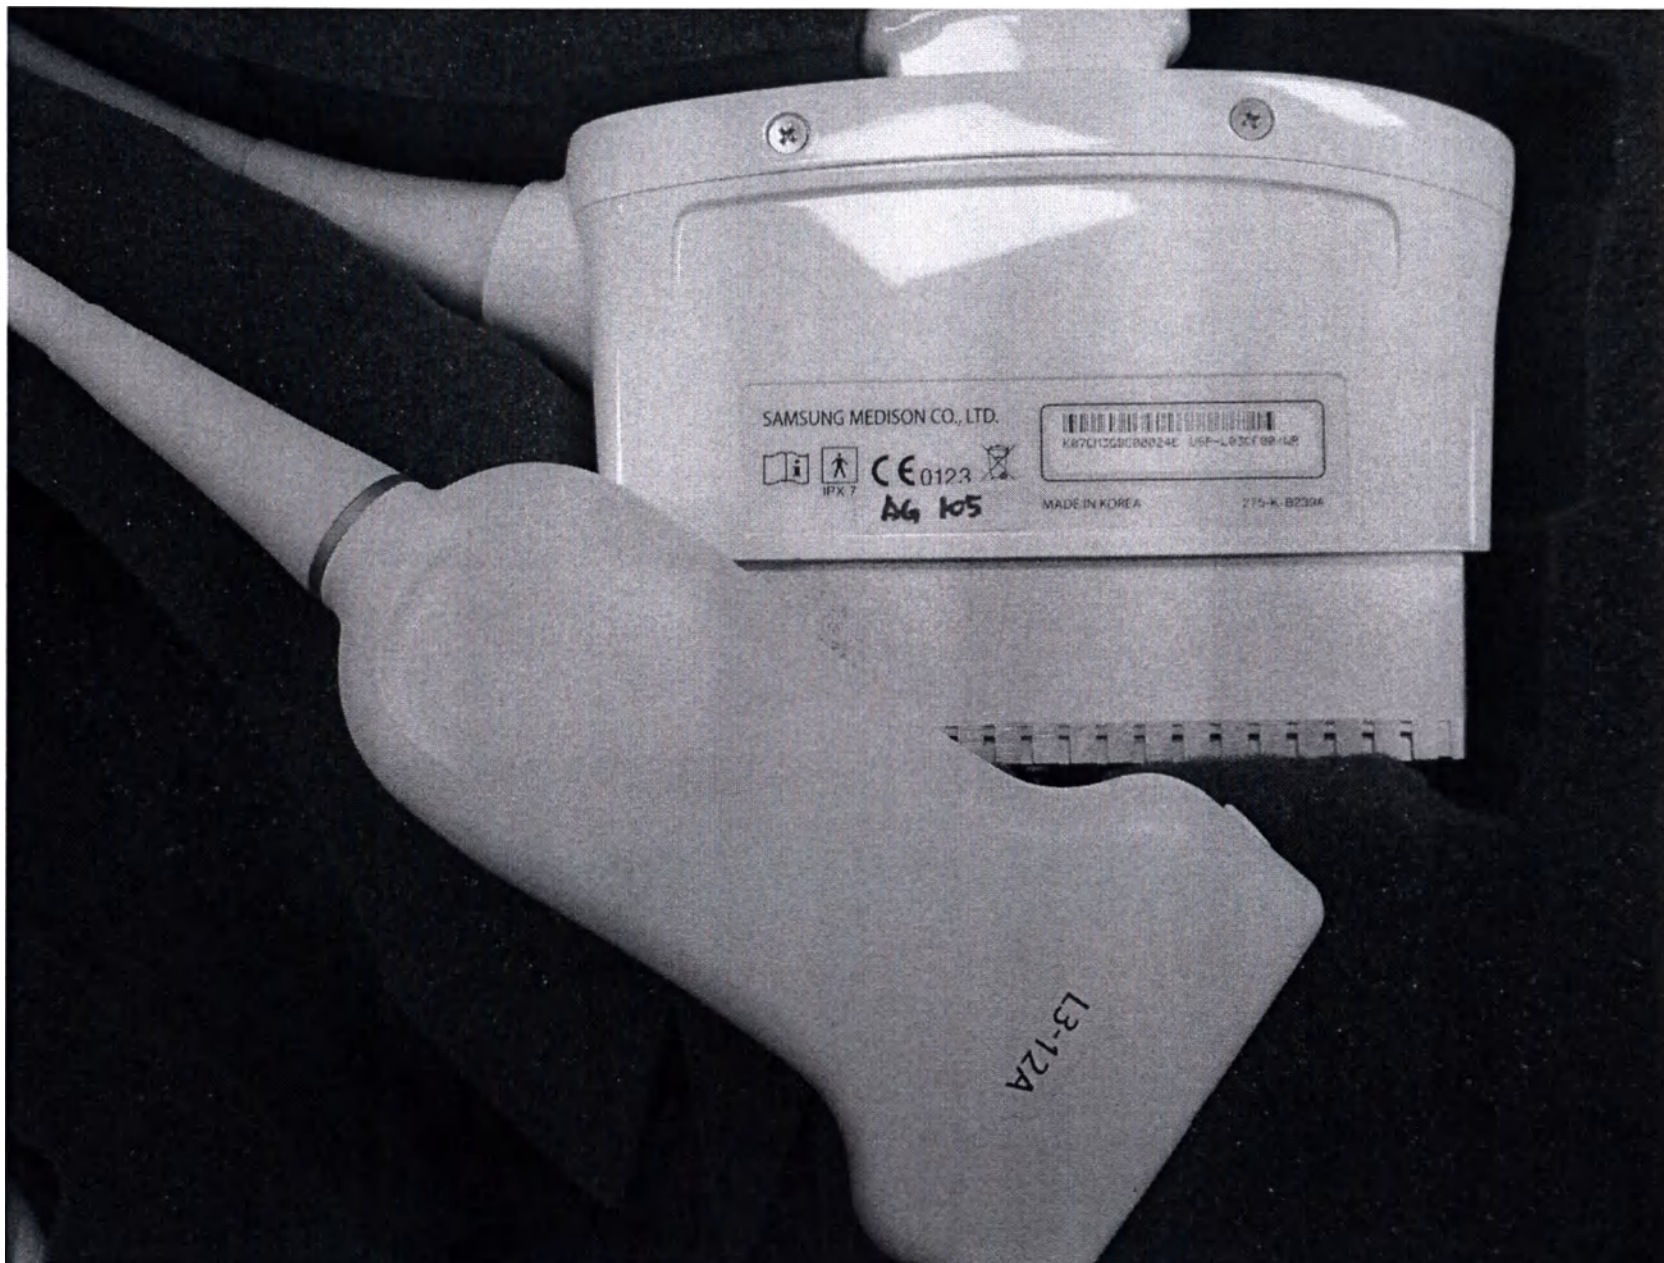


LA3-16A, LA2-9A,

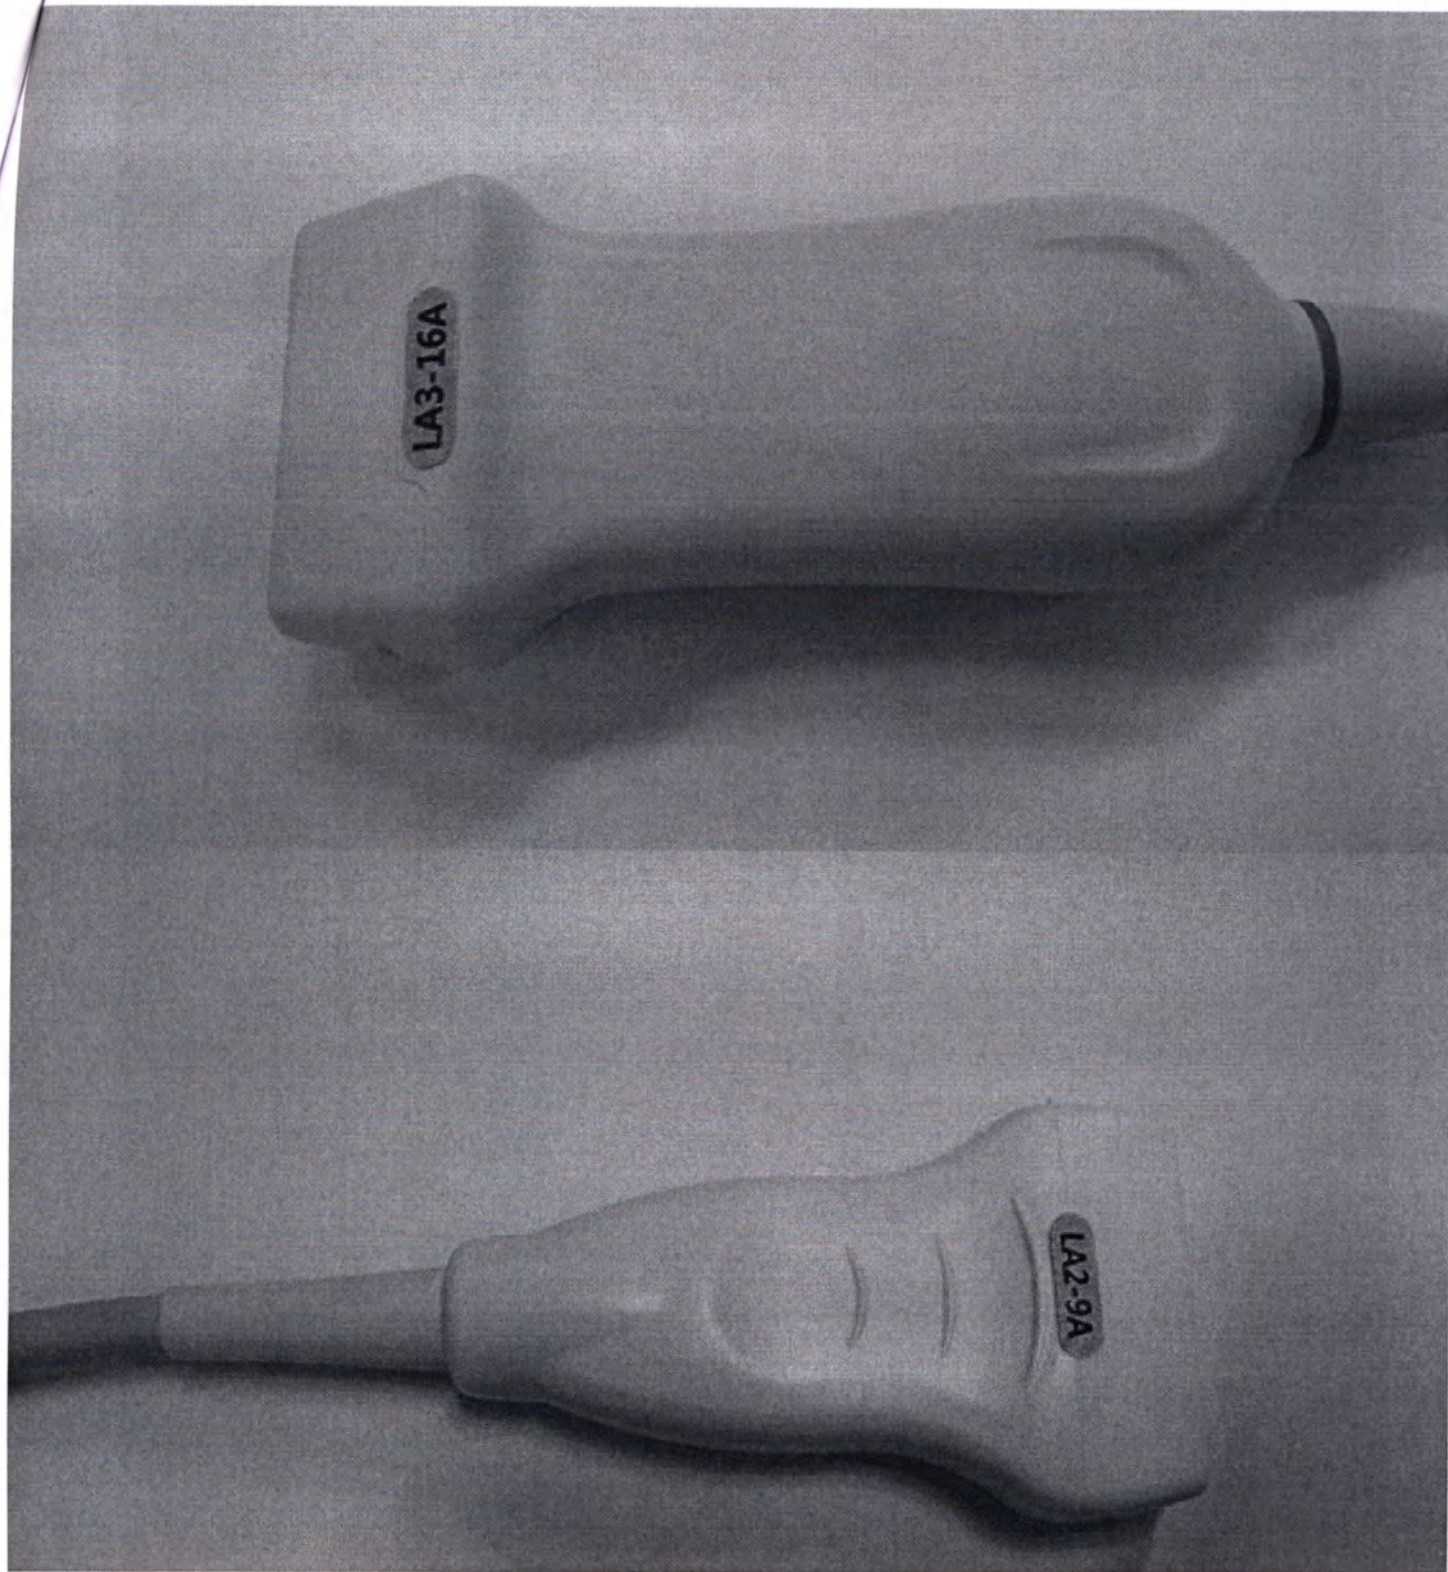

LA3-16AI МГц.

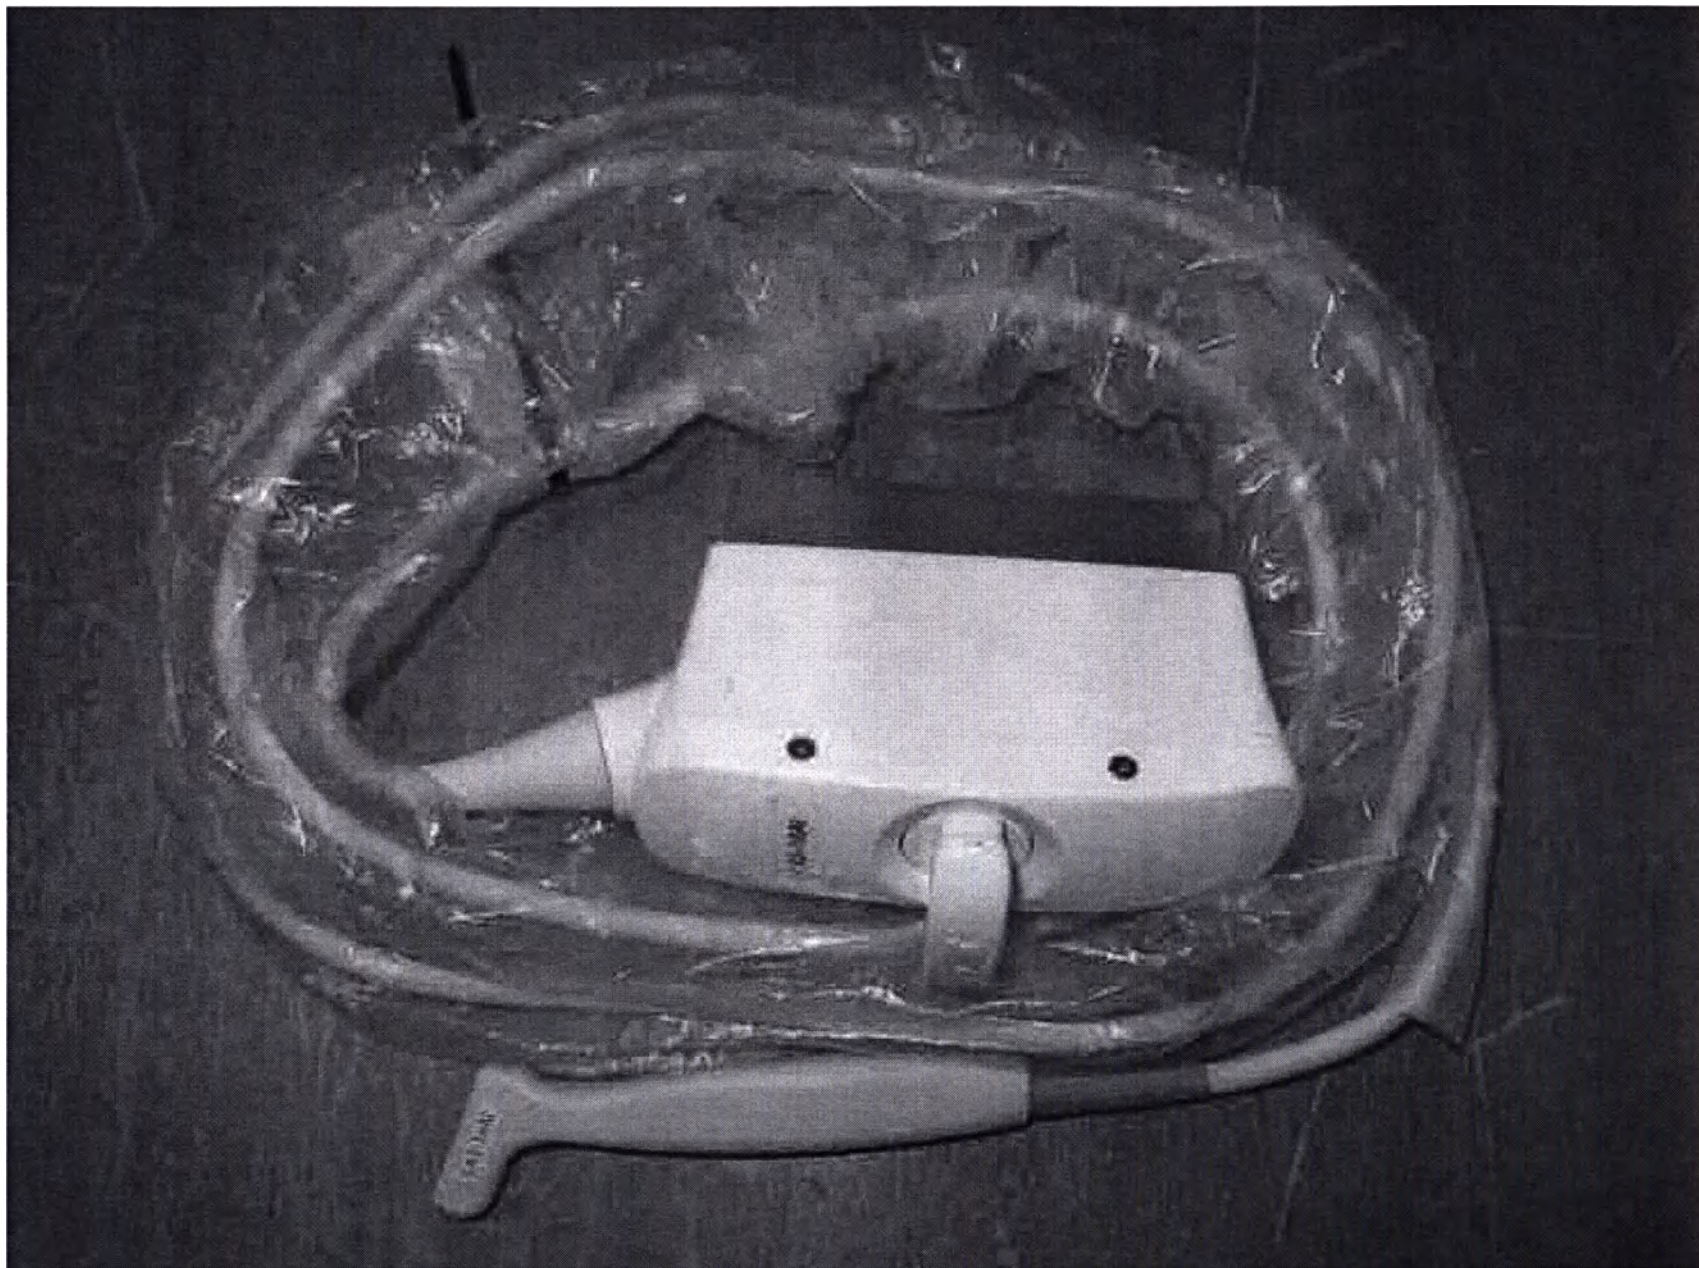


Датчики фазированные:
PE 2-4,

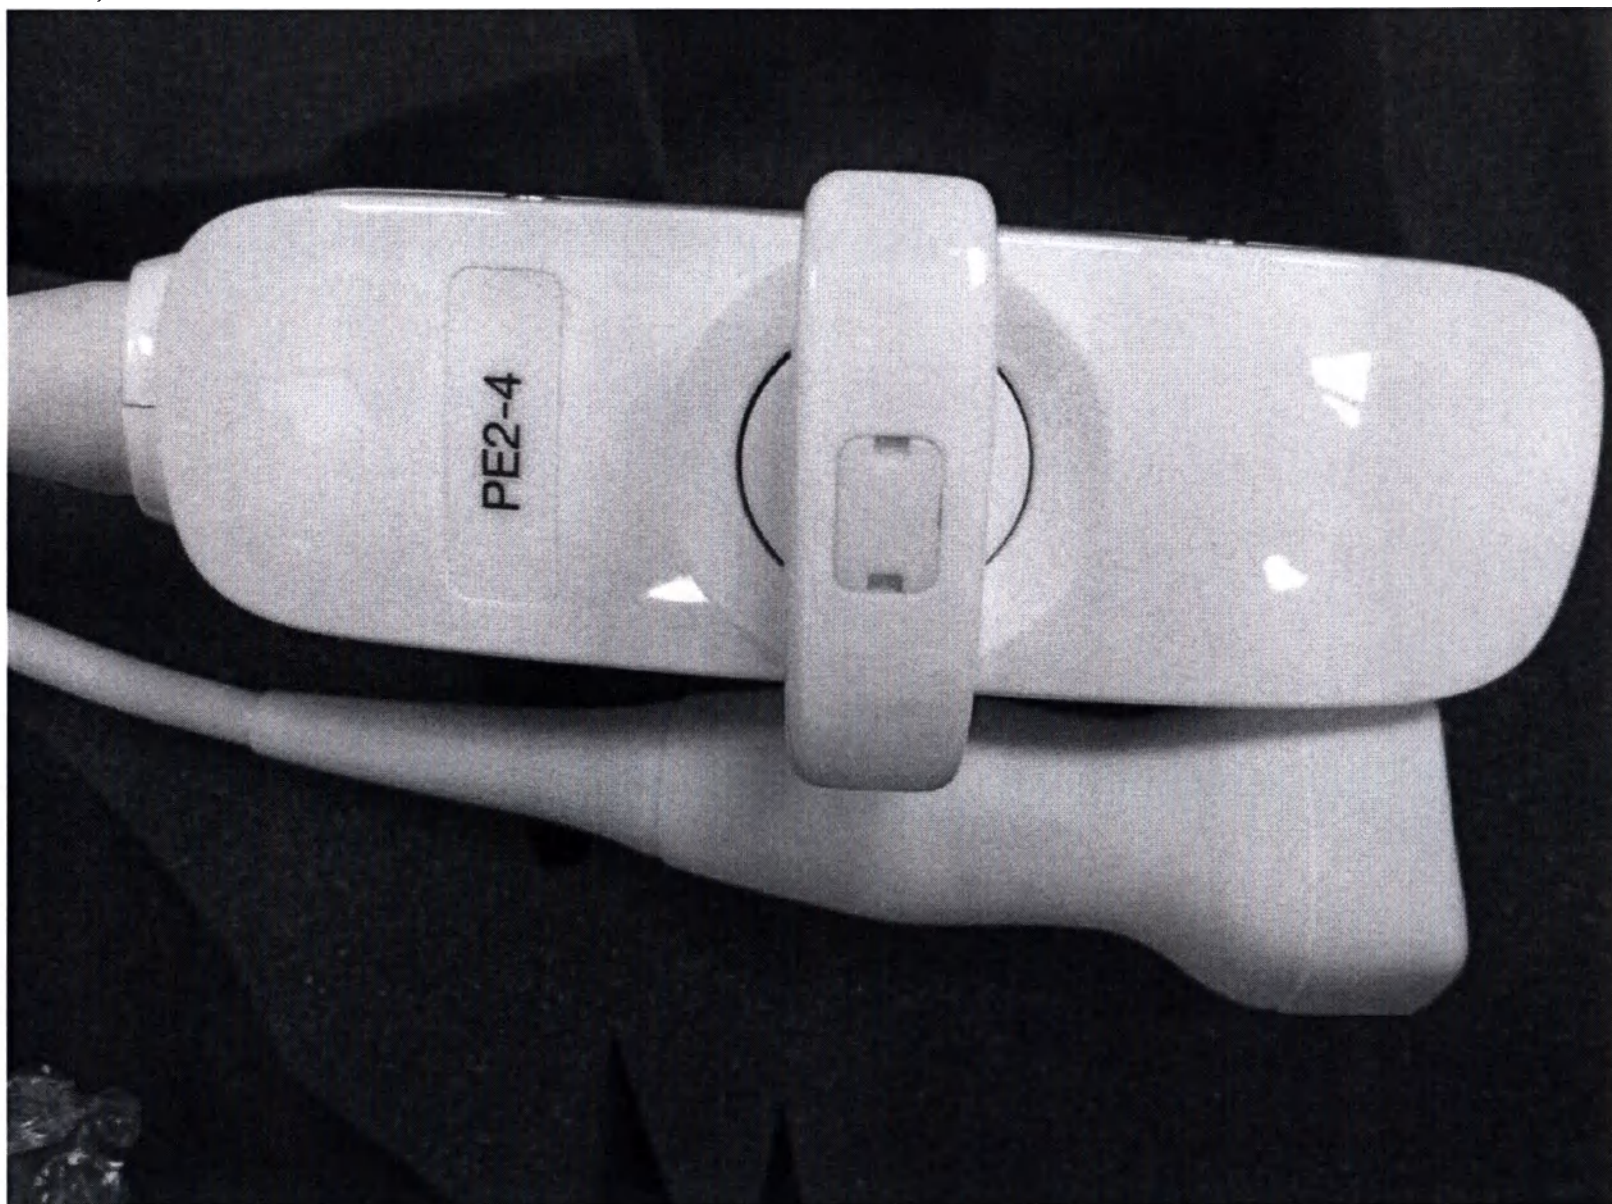

SP3-8,



РА-12, РА4-12В, РА3-8В, МГц.

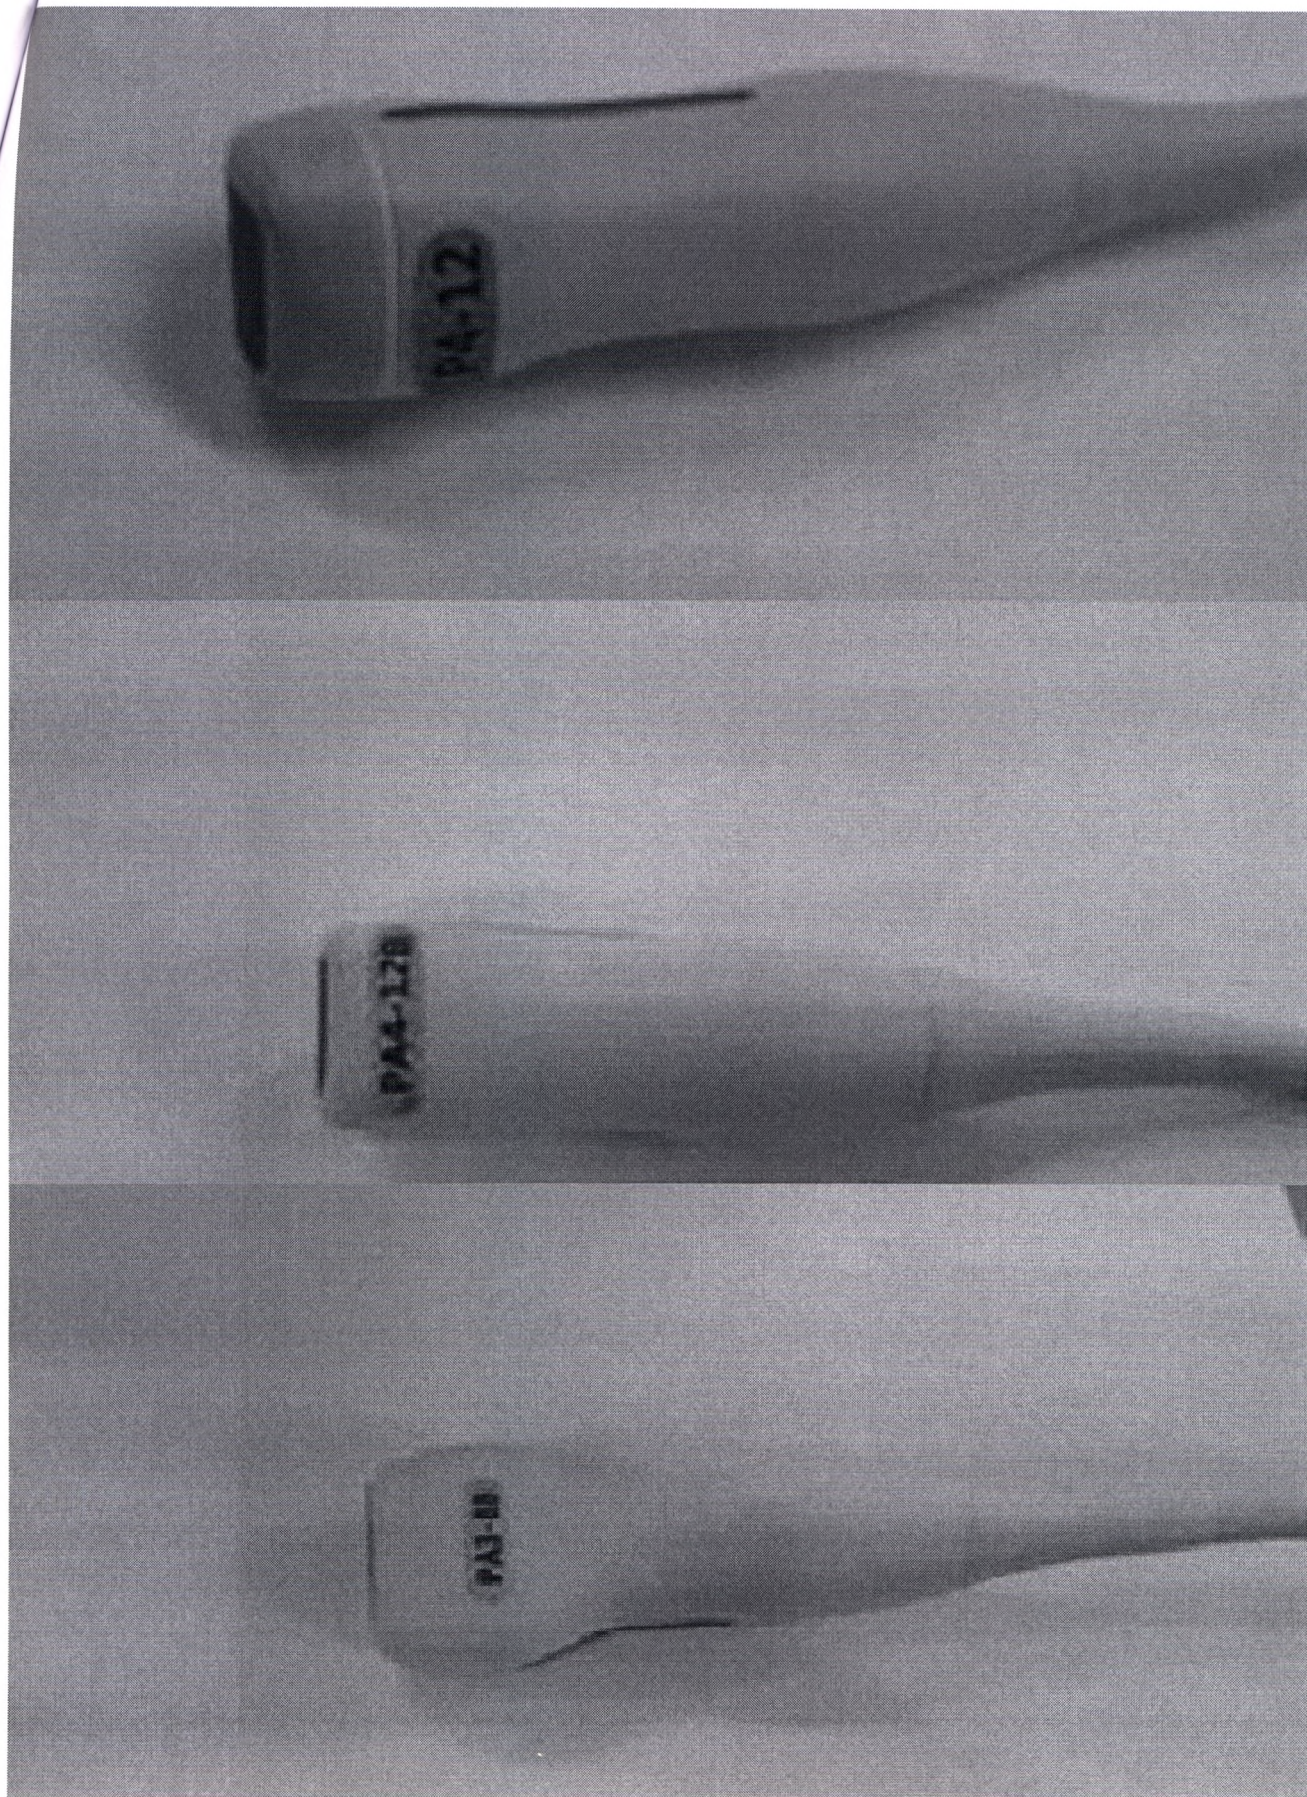


Датчики объемные :
V4-8,




V5-9,



CV1-8A,

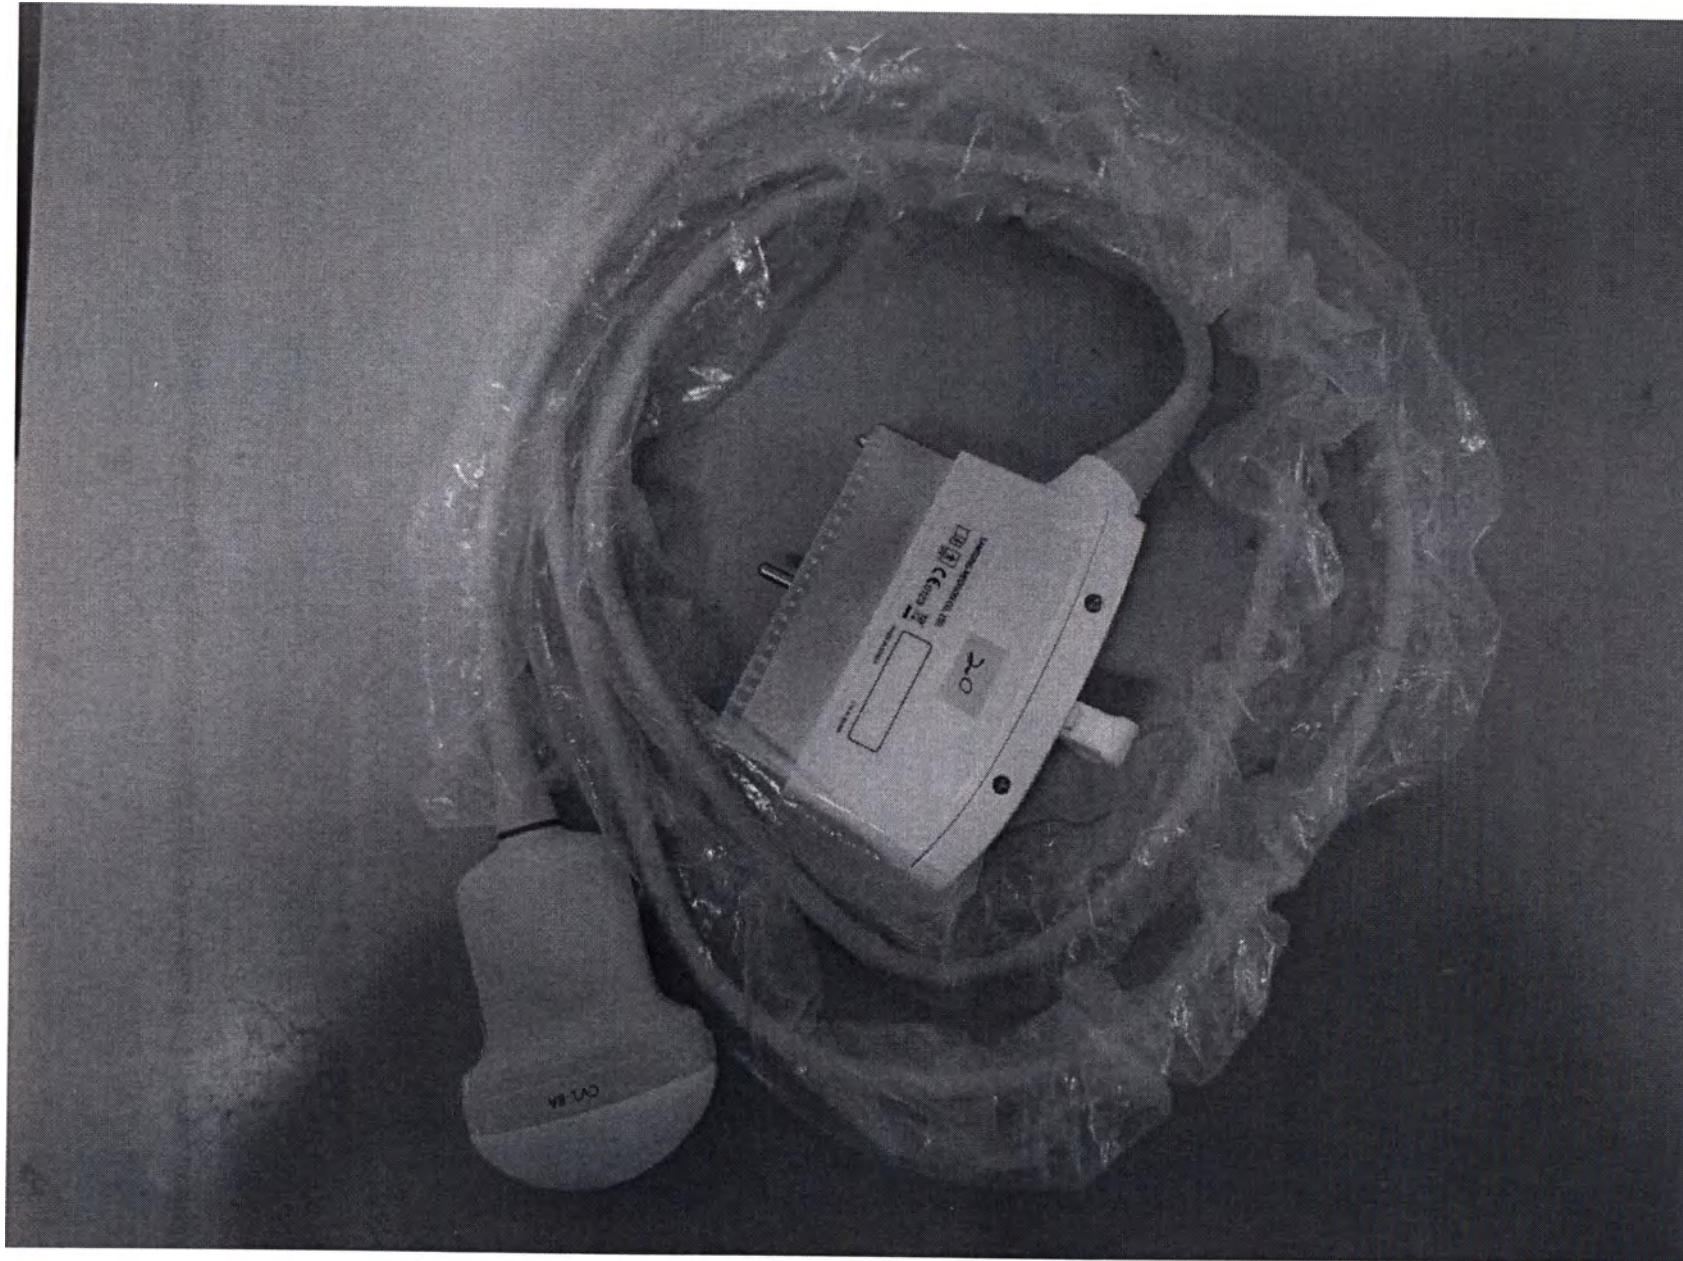


LV3-14A МГц.

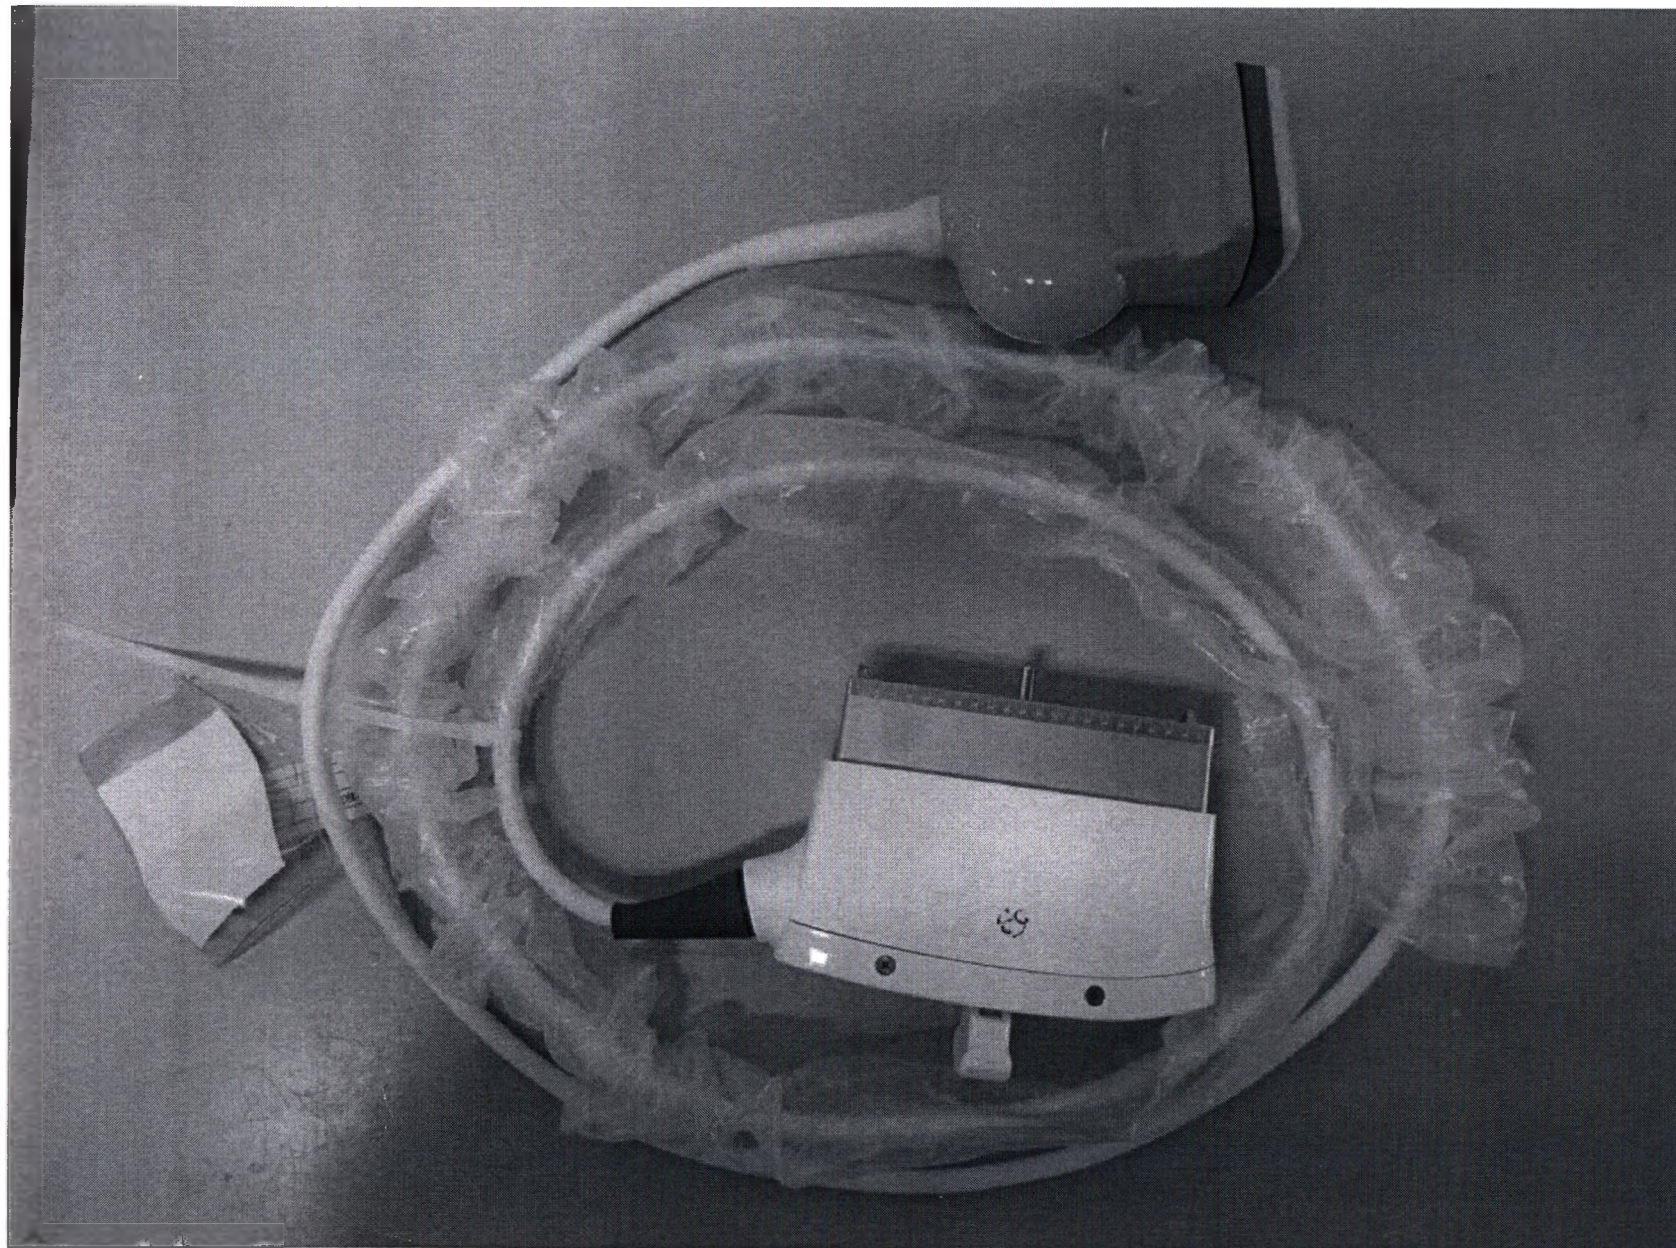


абор для проведения биопсии:

направляющая иглы

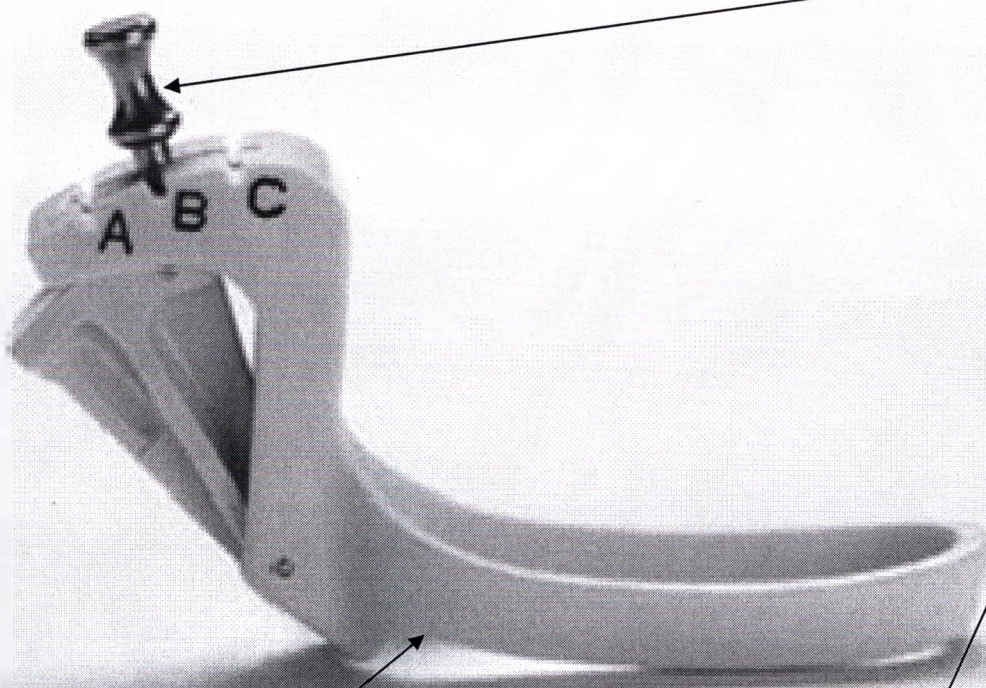


Насадка для биопсии

Крепление

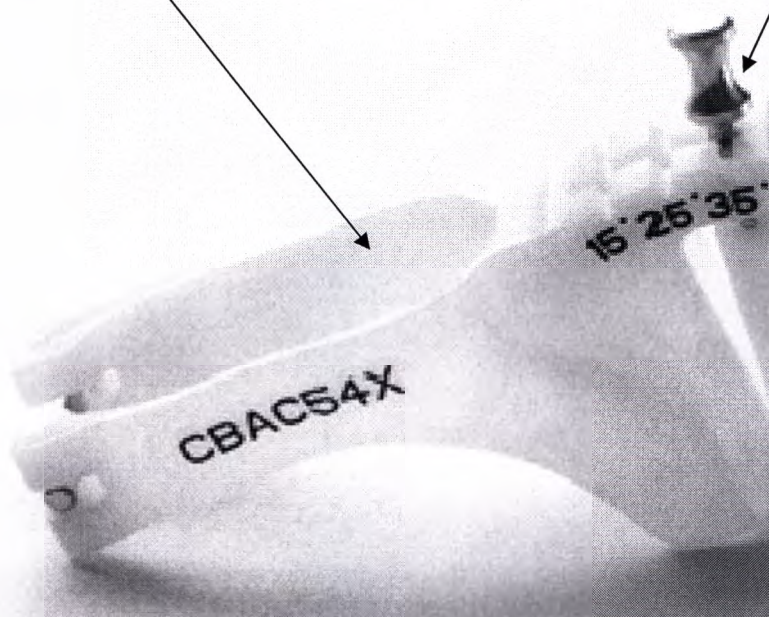

Набор для проведения биопсии:


Насадка для биопсии

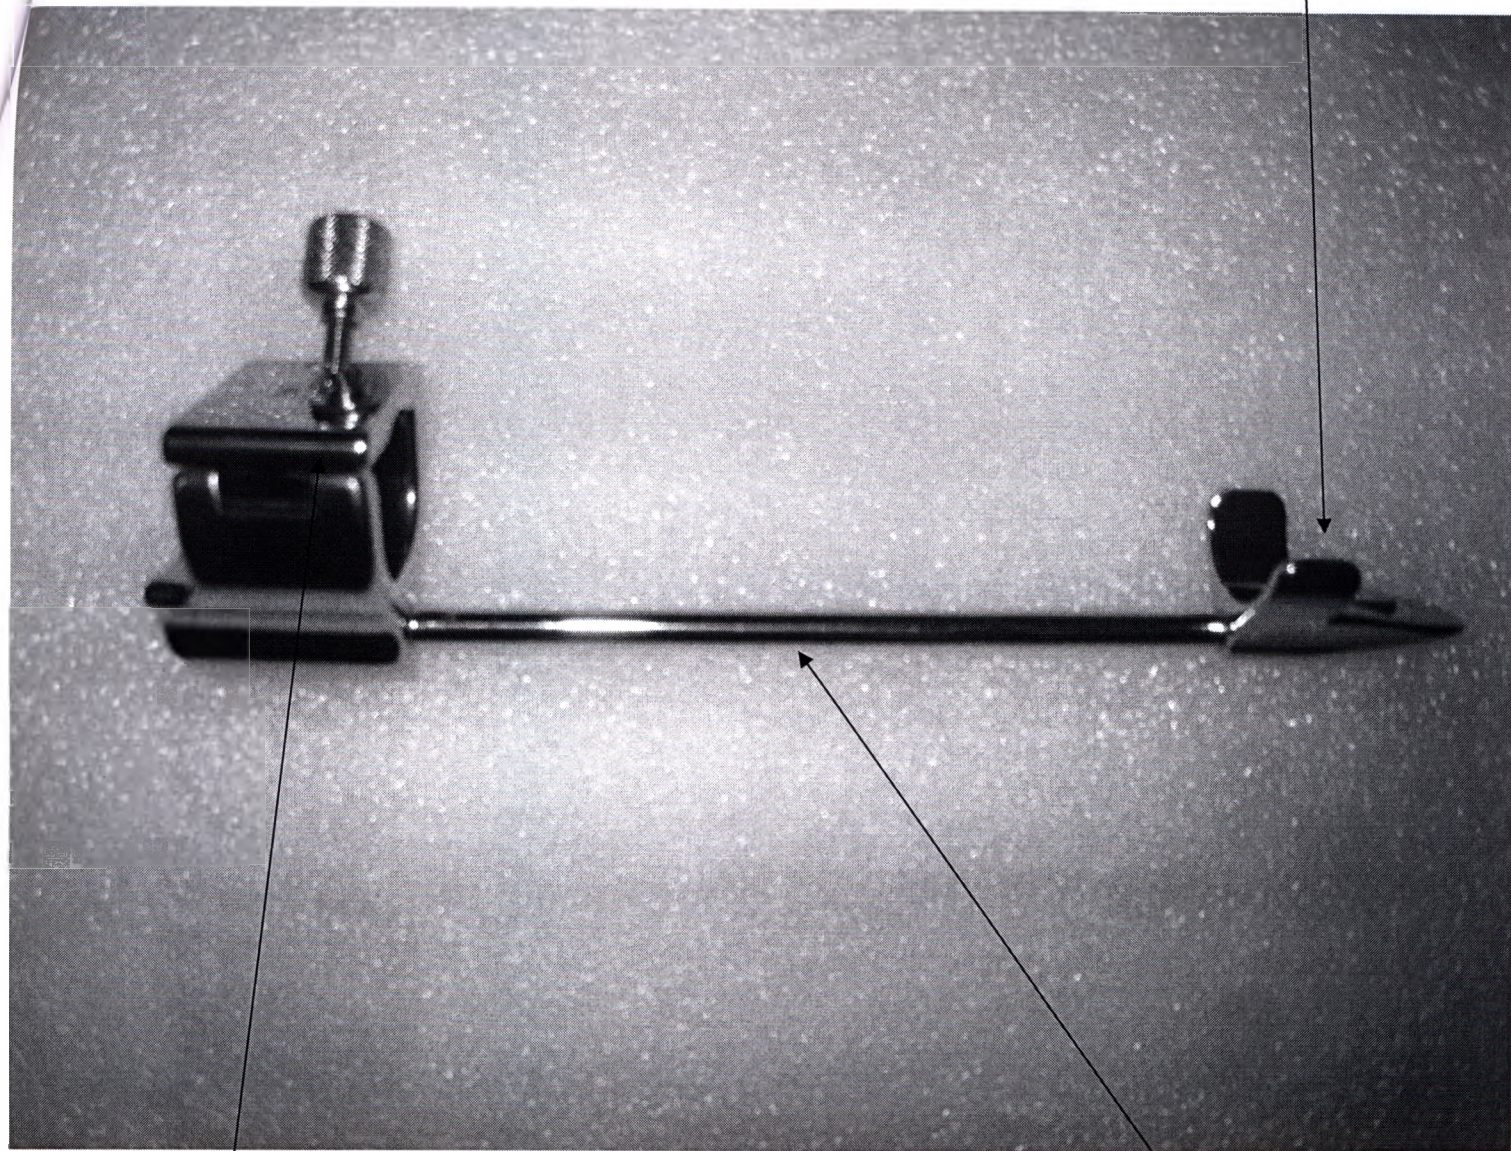


Крепление

Направляющая иглы


ЭКГ Модуль

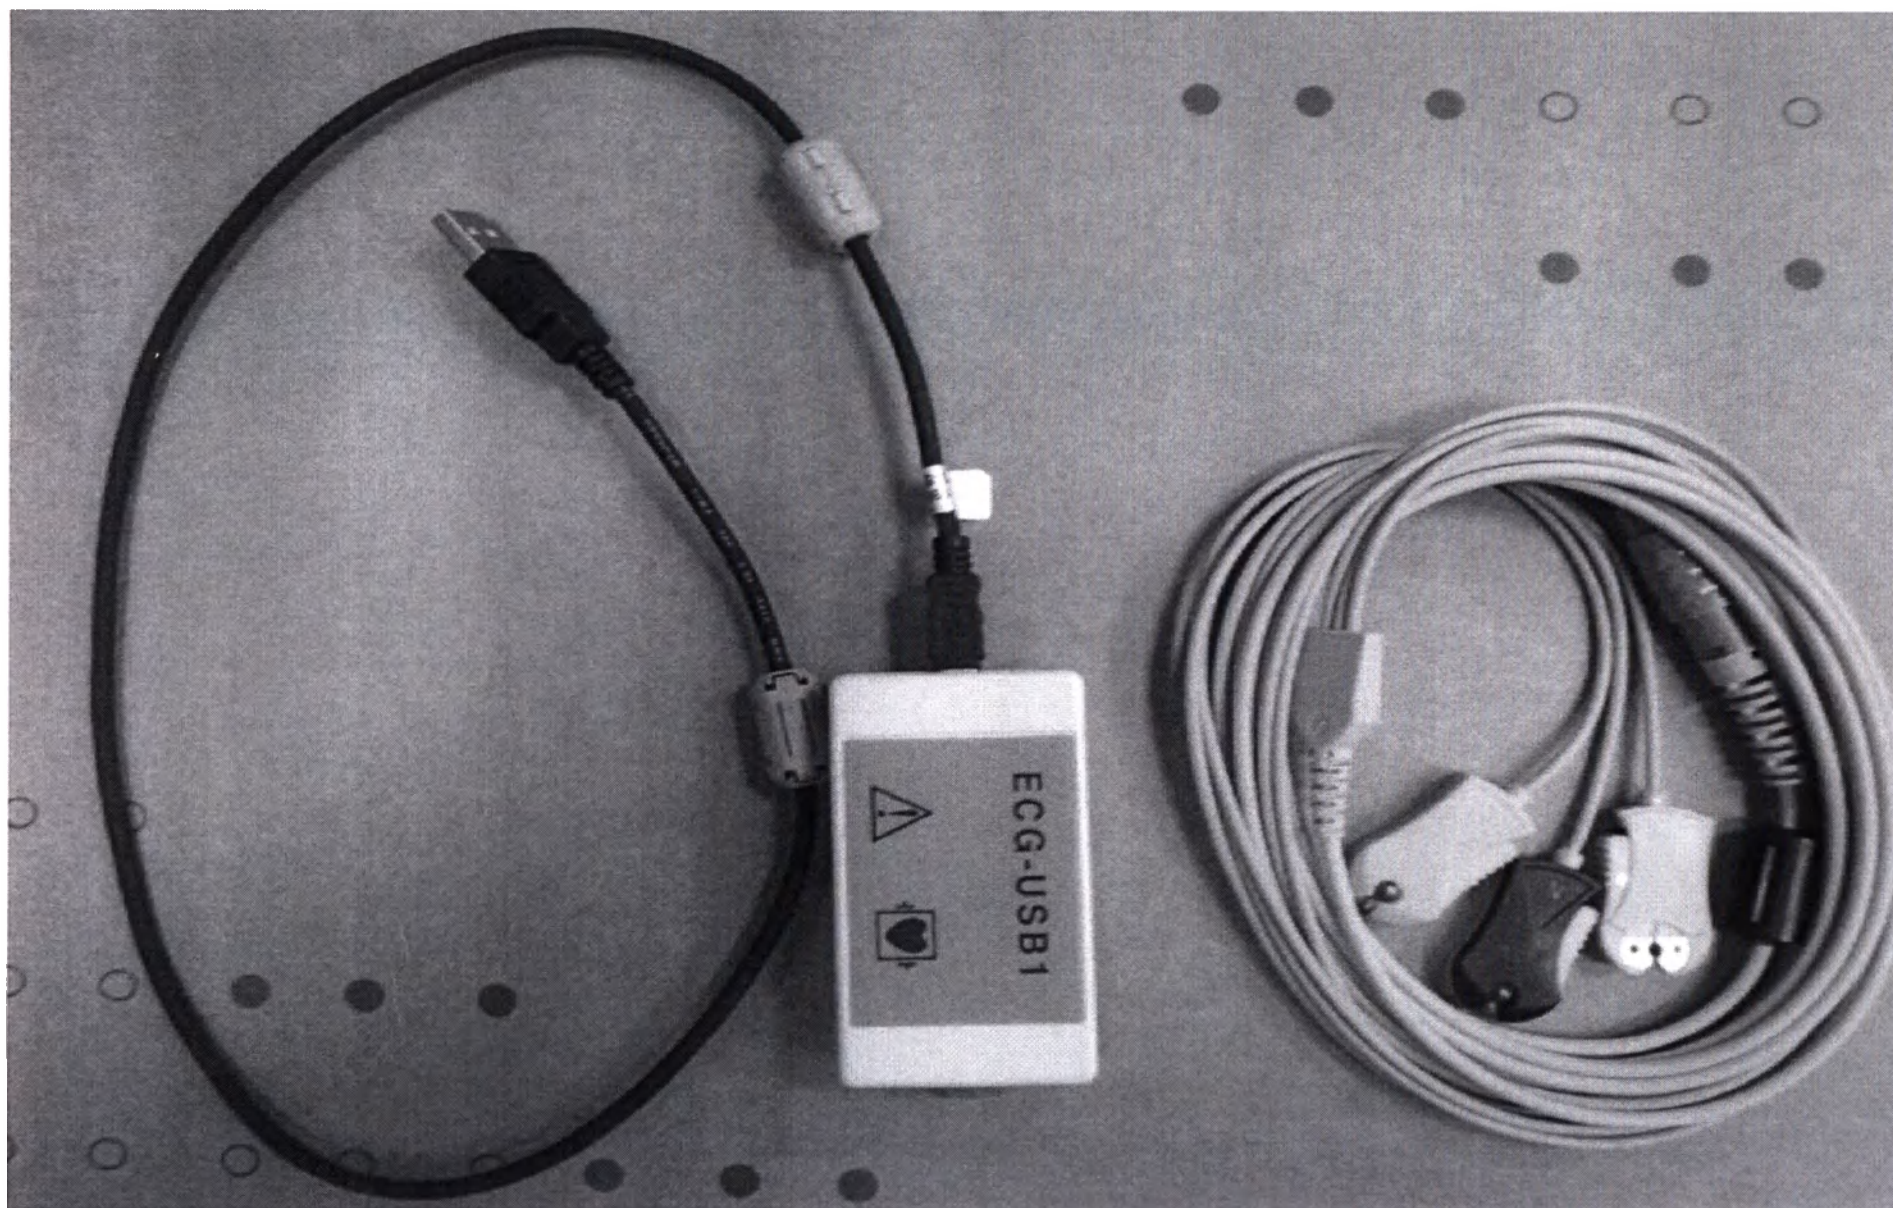


Соединительные провода и кабели.

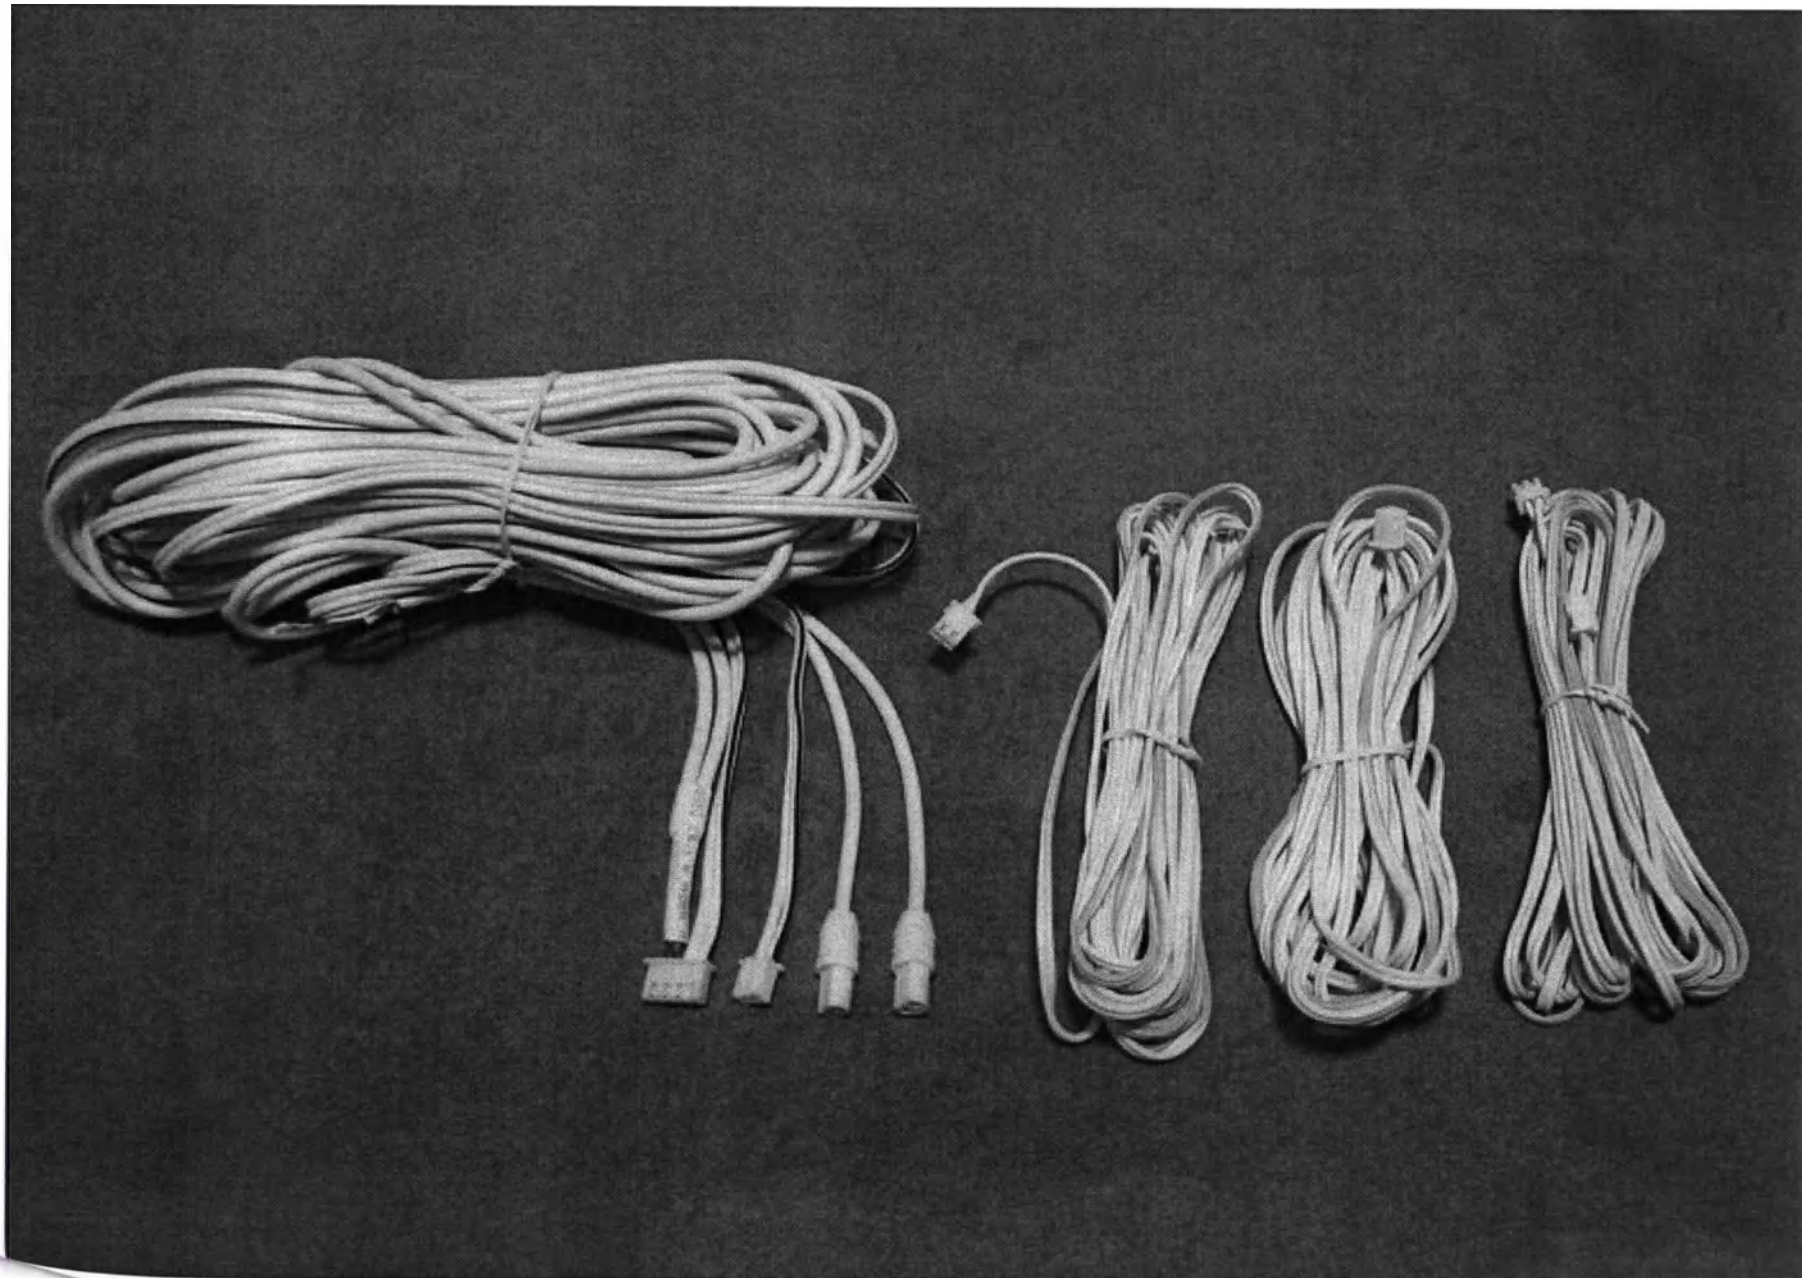


Ножной переключатель

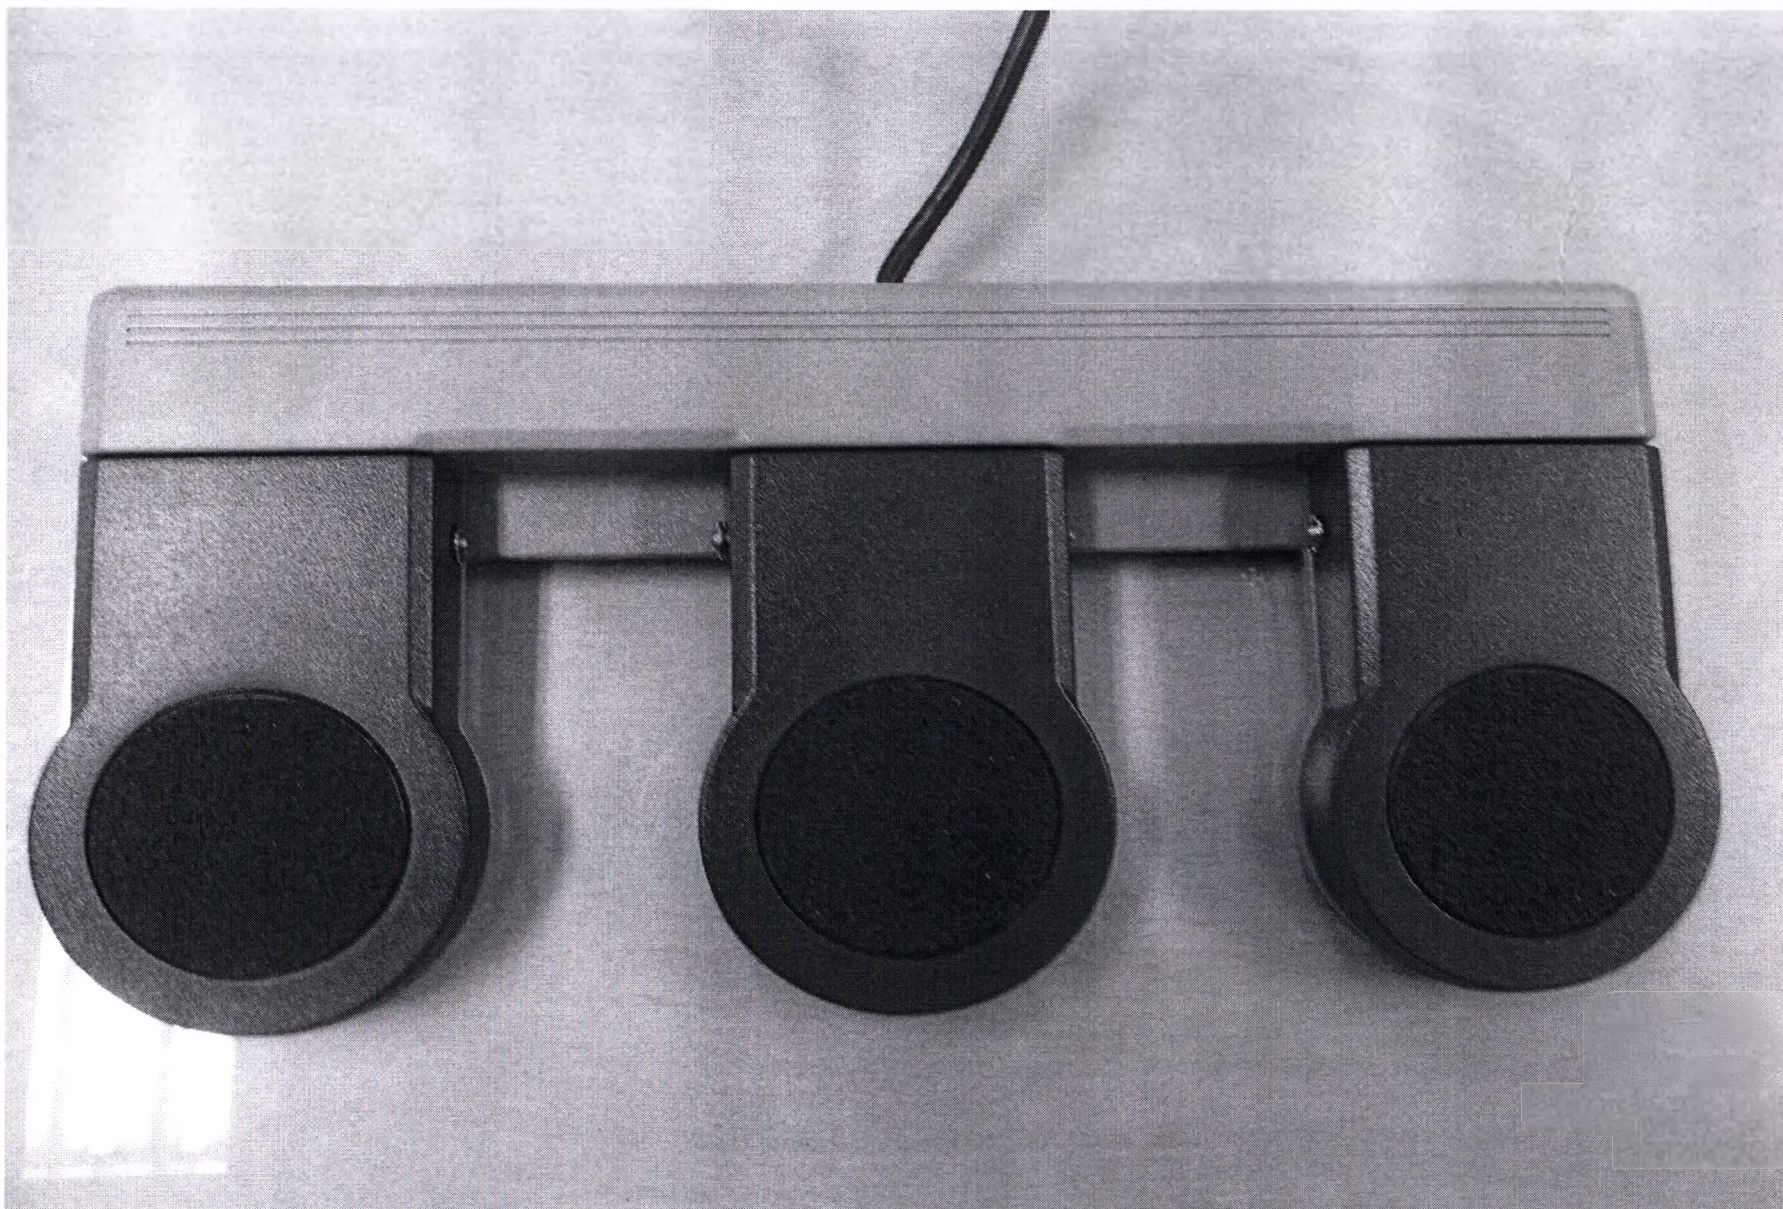


Кабель заземления

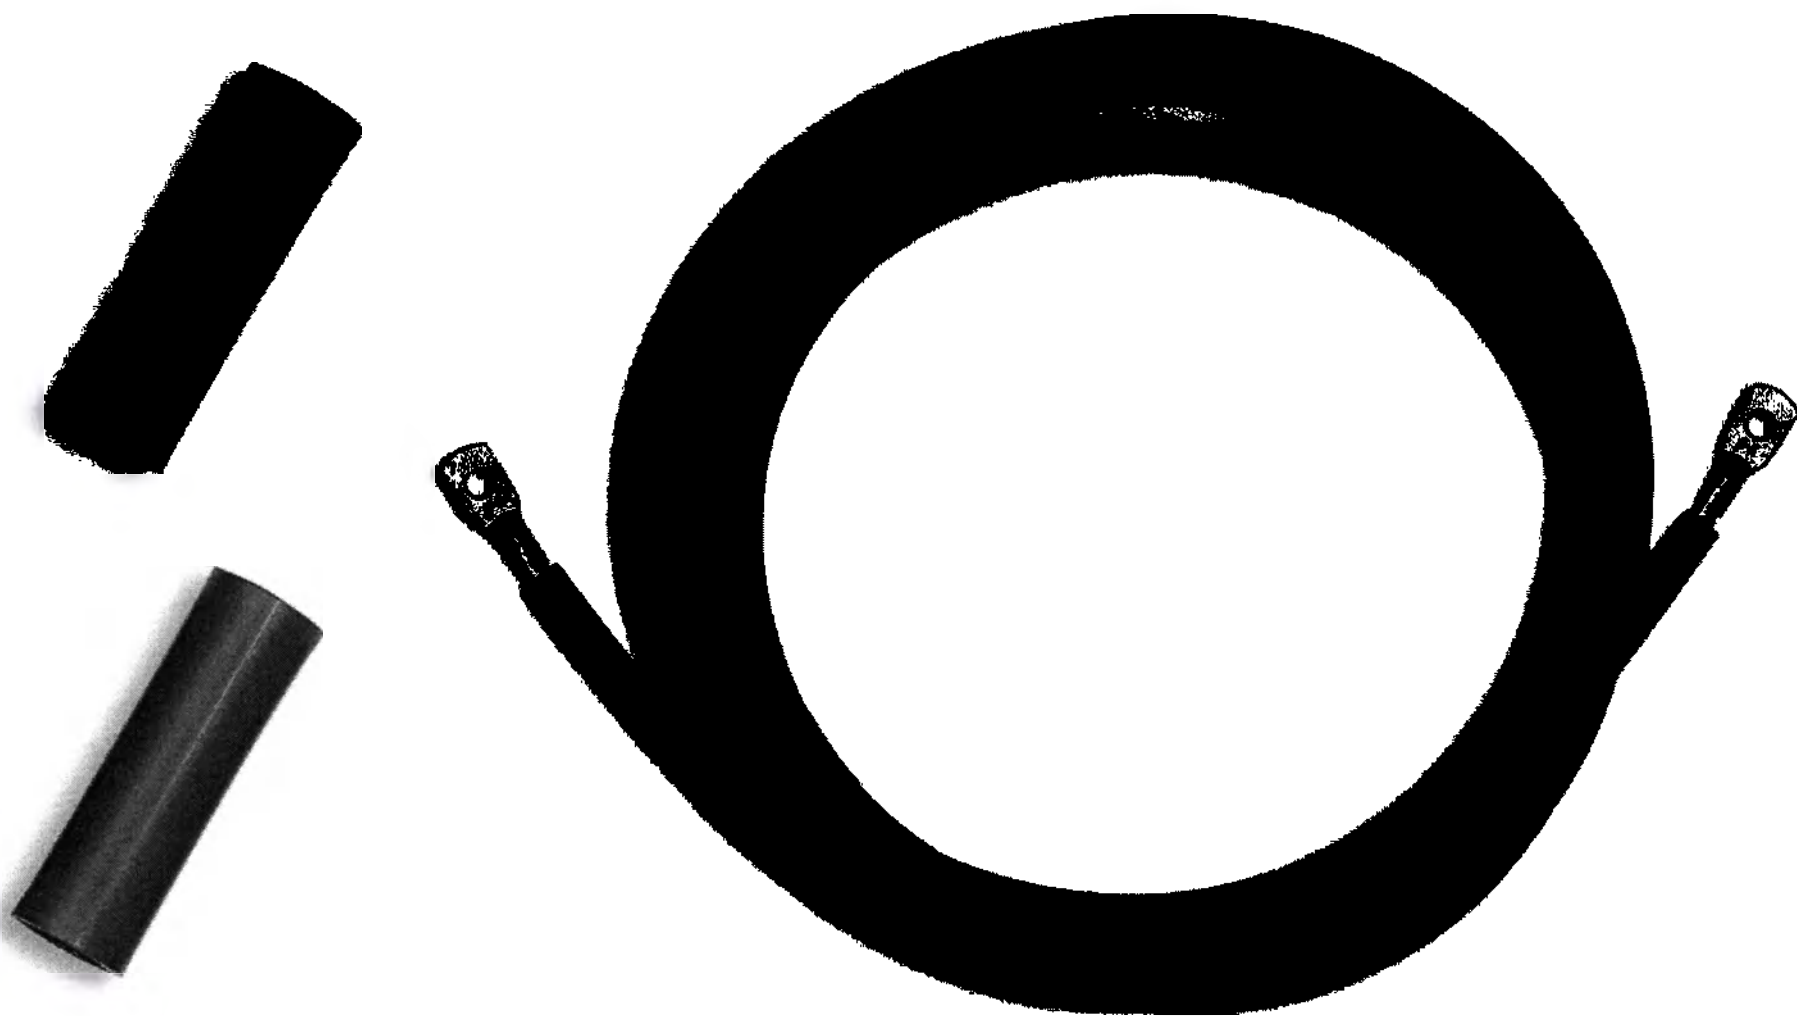

Лицензионный ключ для активаций функций и режимов

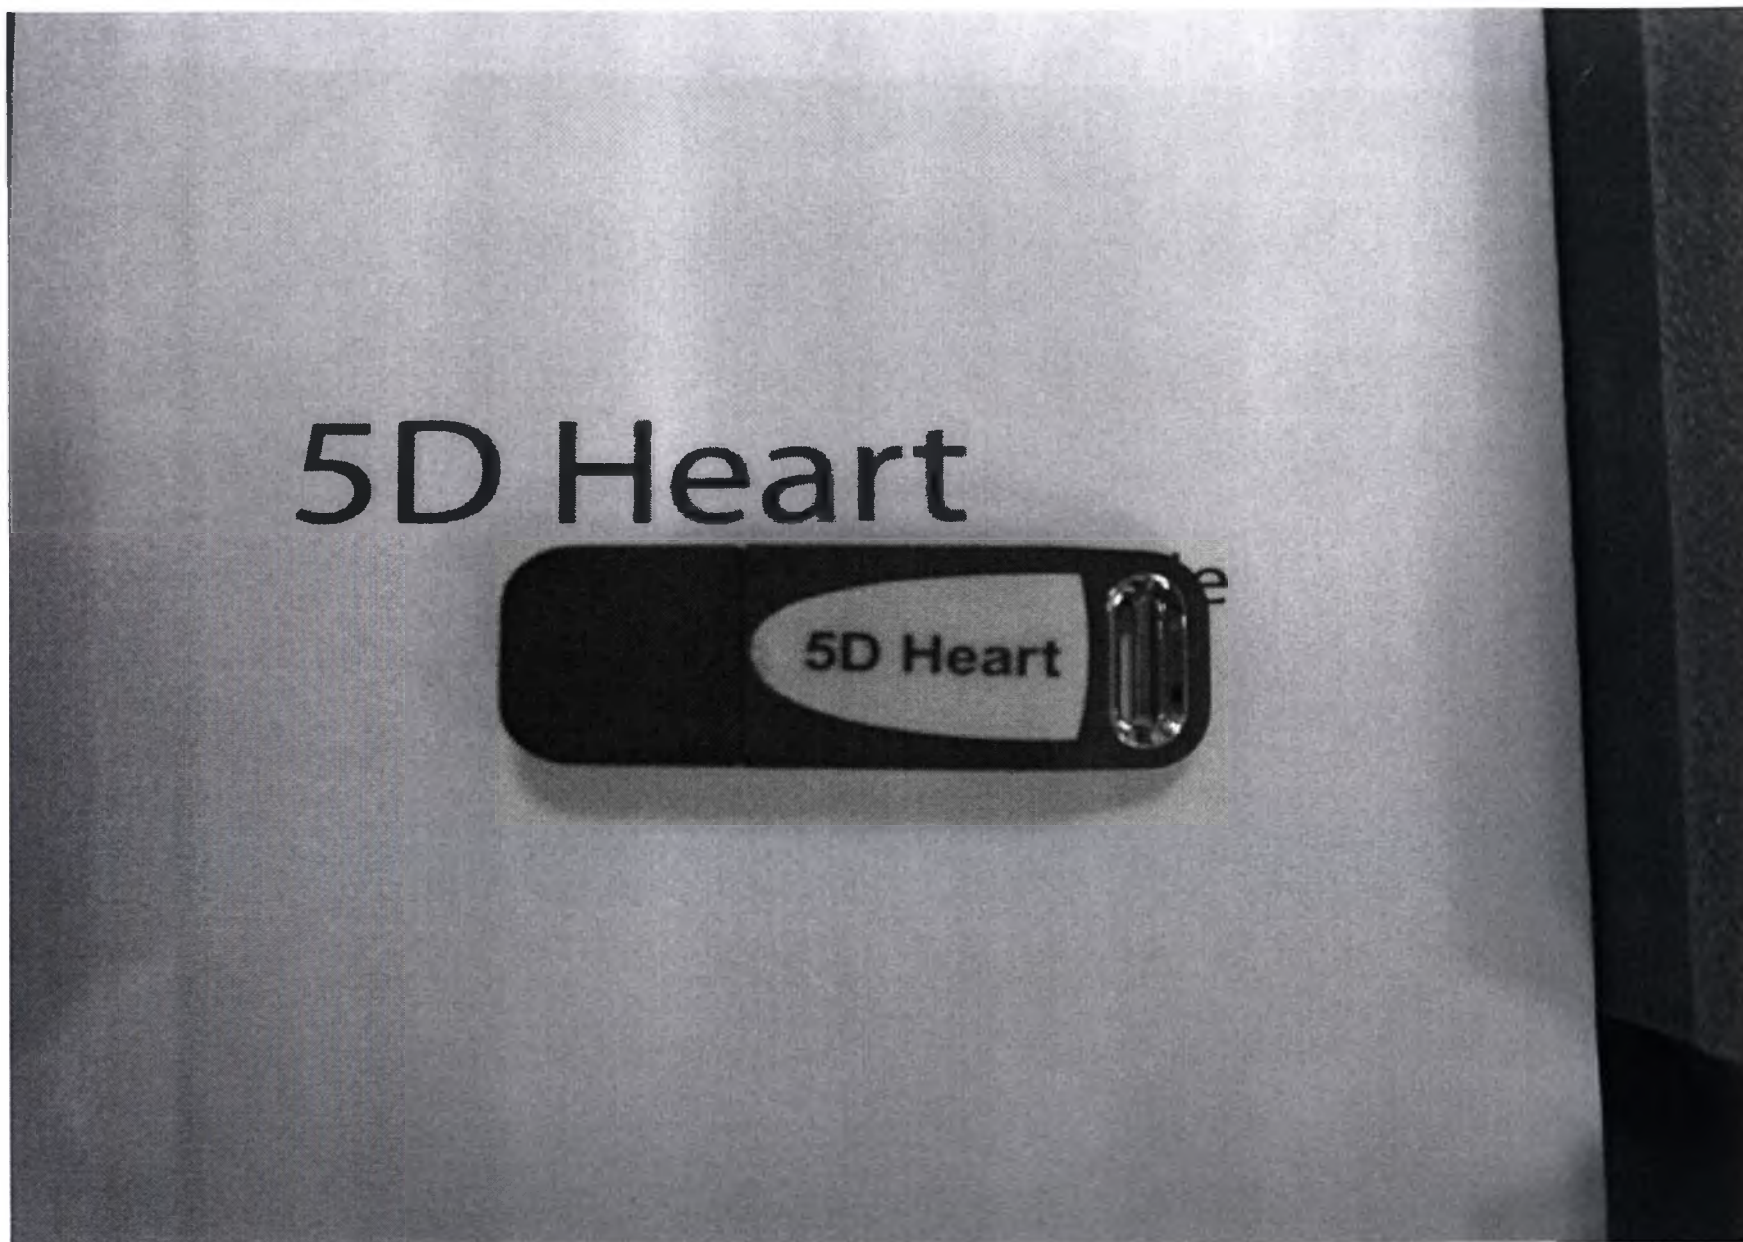

Лицензионный ключ для активации функции определения комплекса Интима/Медиа (Авто IMT+); Экран с активной функцией.

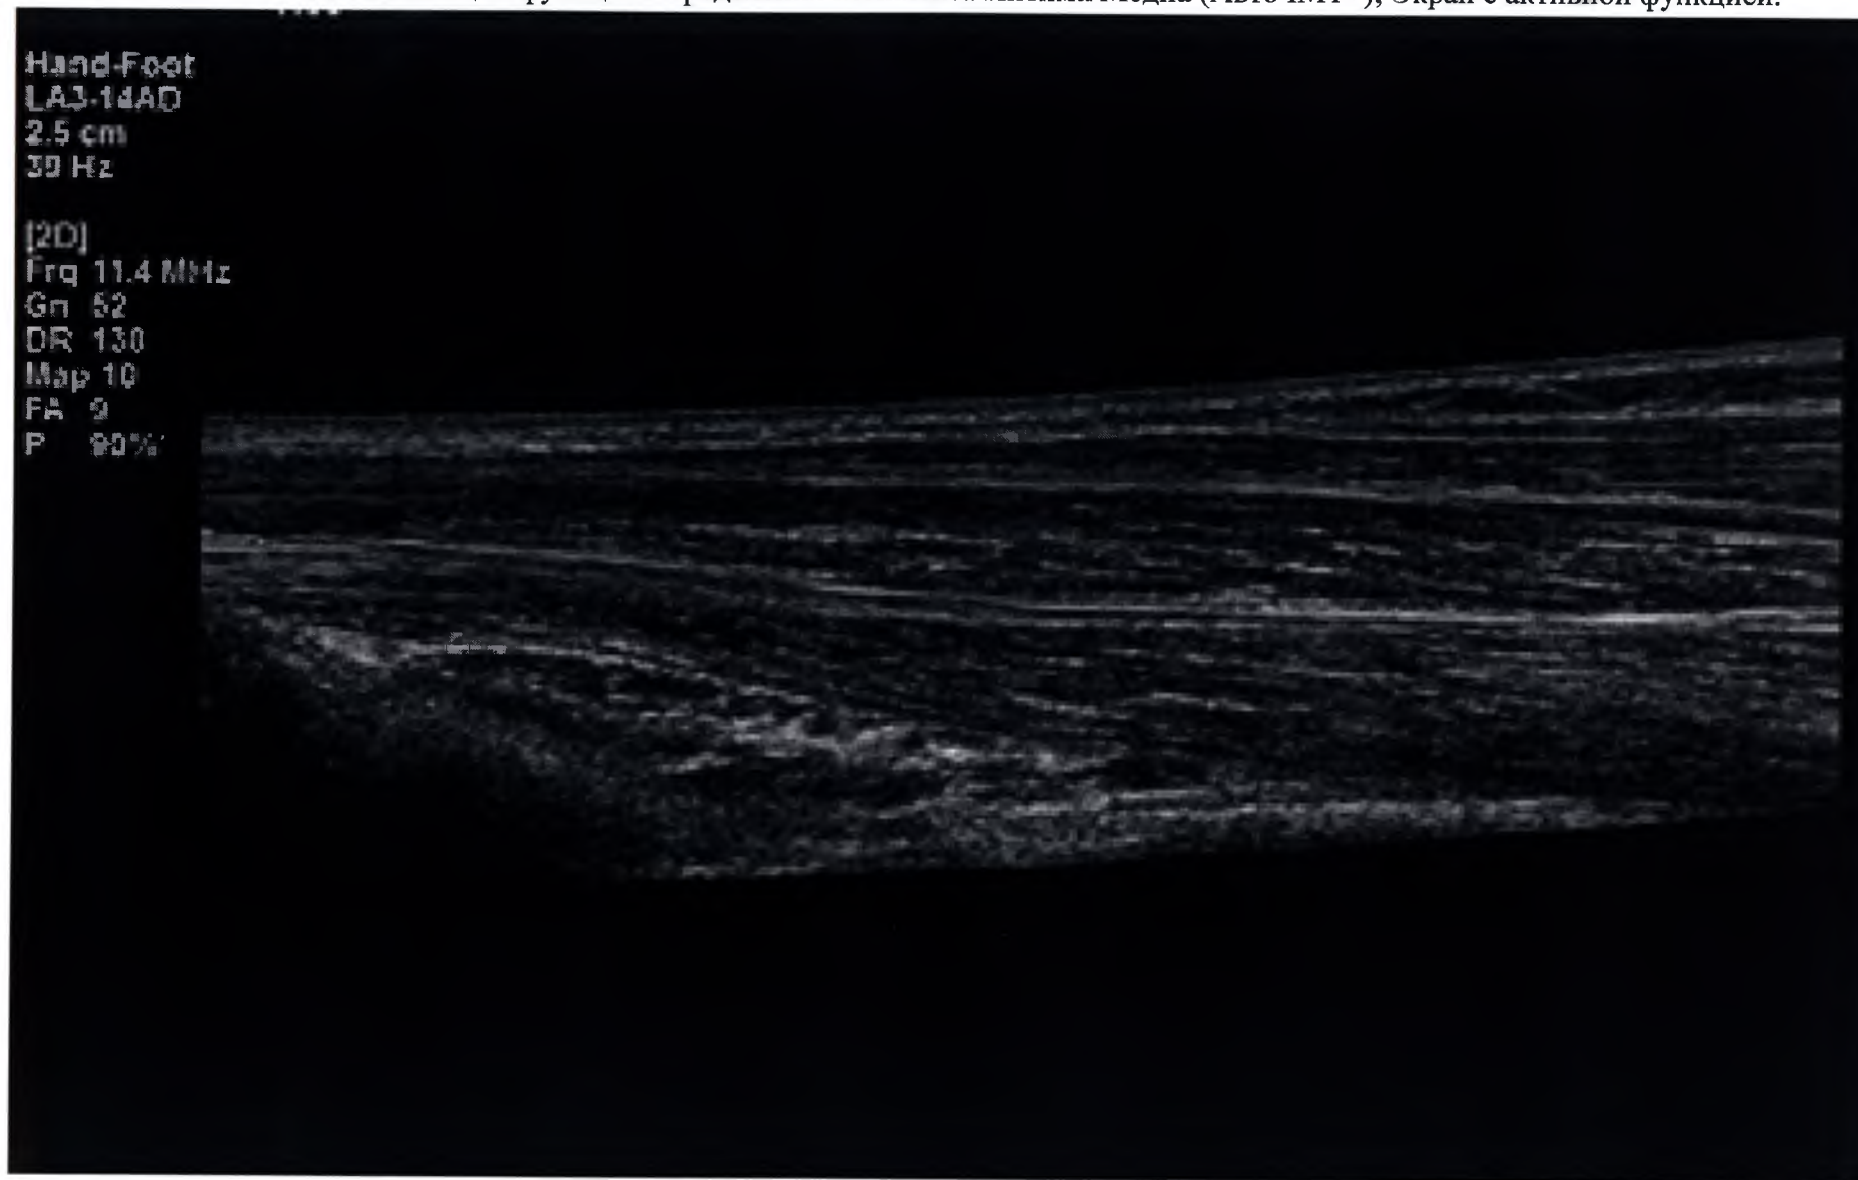

Лицензионный ключ для активации функции, обеспечивающей передачу данных DICOM 3.0; Экран с активной функцией.

Настройка DICOM

Имя AE

Set AETitle

Название станции

Set Station Name

№ порта

104

Имя службы	Псевдоним	Имя AE	IP адрес	Порт	Запрос	Проверка
ХРАНИЕНИЕ	123	12	10.20.13.2	104		

Добавить

Правка

Удалить

Тест

Очередь

Формат отправки DICOM

2D-режим

Цветной

Режим ЦДК

Цветной

Компр. DICOM

Непод. изобр.


Несж.

☒ Сохранить СтрОтч в конце осмотра

Лицензионный ключ для активации функции проведения кардиологических измерений. Экран с активной функцией.

взрослого-камерн.	ЭхоКГ взрослого-клапан	ЭхоКГ взрослого-Системный	детск. ЭхоКГ	Выход
ЛЖ (2D)		Об.ЛЖс.(по Симпсону)	Масса ЛЖ	Маркер тела
ПЖ (2D)		ПП		Аорта
Все КДР ЛЖ (2D)	МЖПд	ВнутрДиамЛЖ(д)	ТЗСЛЖд	
Все КСР ЛЖ (2D)	МЖПс	ВнутрДиамЛЖ(с)	ТЗСЛЖс	
				активировать дані
Пакеты			шрифта 11	Результат действ Переместить
3. Кардиология				

Лицензионный ключ для активации функции получения панорамного изображения. Экран с активной функцией.

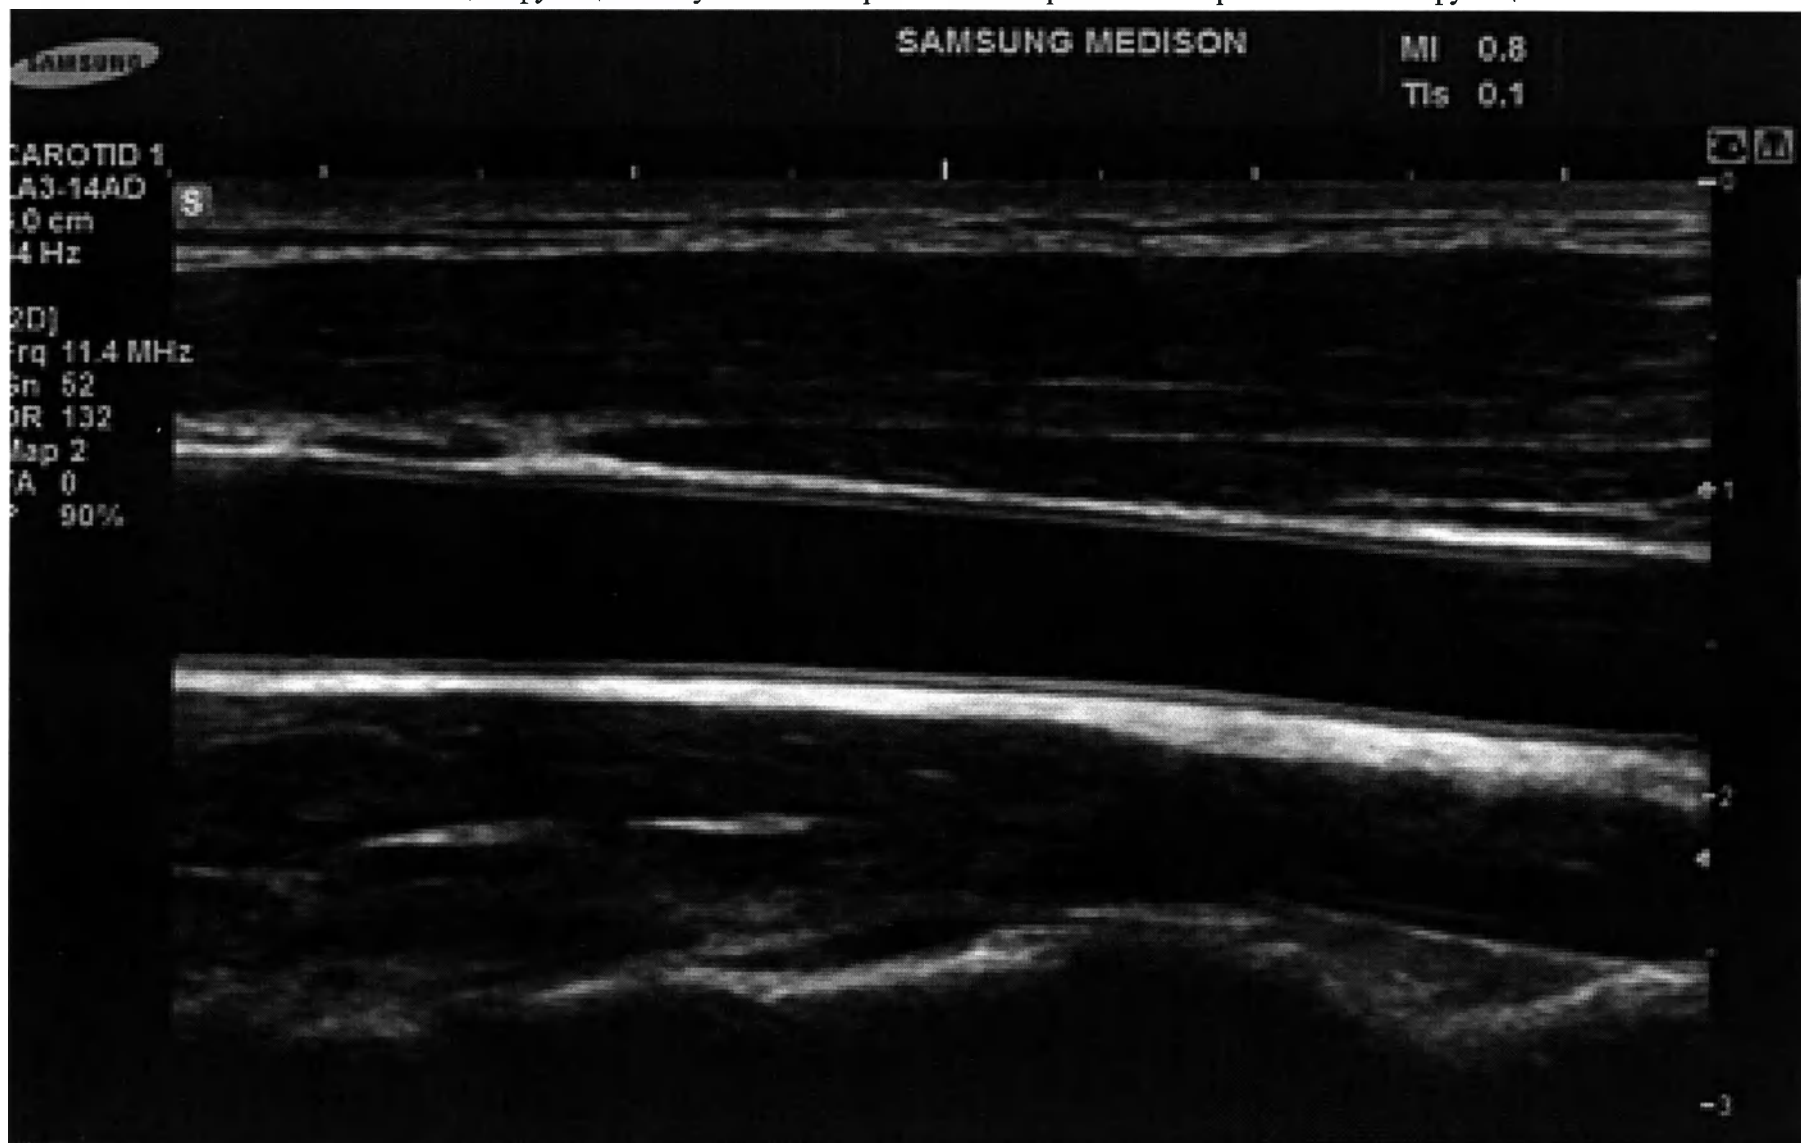

Лицензионный ключ для активации режима эластографии (Elastoscan). Экран с активной функцией.



Лицензионный ключ для активации функции записи данных на внешний носитель ADVR. *Экран с активной функцией.

Дополнительное оборудование

Модель видеосигна

Built-In Recorder

COM

Линейная передача

Ножной переключатель

Влево

Сохранить

Средний

Стоп-кадр

Вправо

Стоп-кадр

Настройка печати

Ориентация печати

Книжная

Альбомная

Клавиша Печать

Печать1

Печать2

Локальная область печати

Видеовыход (1280 x 872)

Тольк. изобр.

Настр. печ. изобр.

Печать1

Сброс

2D

3D

Gamma

10

Brightness

100

Contrast

100

Метод записи ADVR

Выбор носителя

DVD

USB


Экспорт на мобильное устройство

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Лицензионный ключ для активации функции получения изображения высокой четкости HDVI-USB. Экран с активной функцией.



Лицензионный ключ для активации режима получения объемных данных в режиме реального времени 4D. Экран с активным режимом.

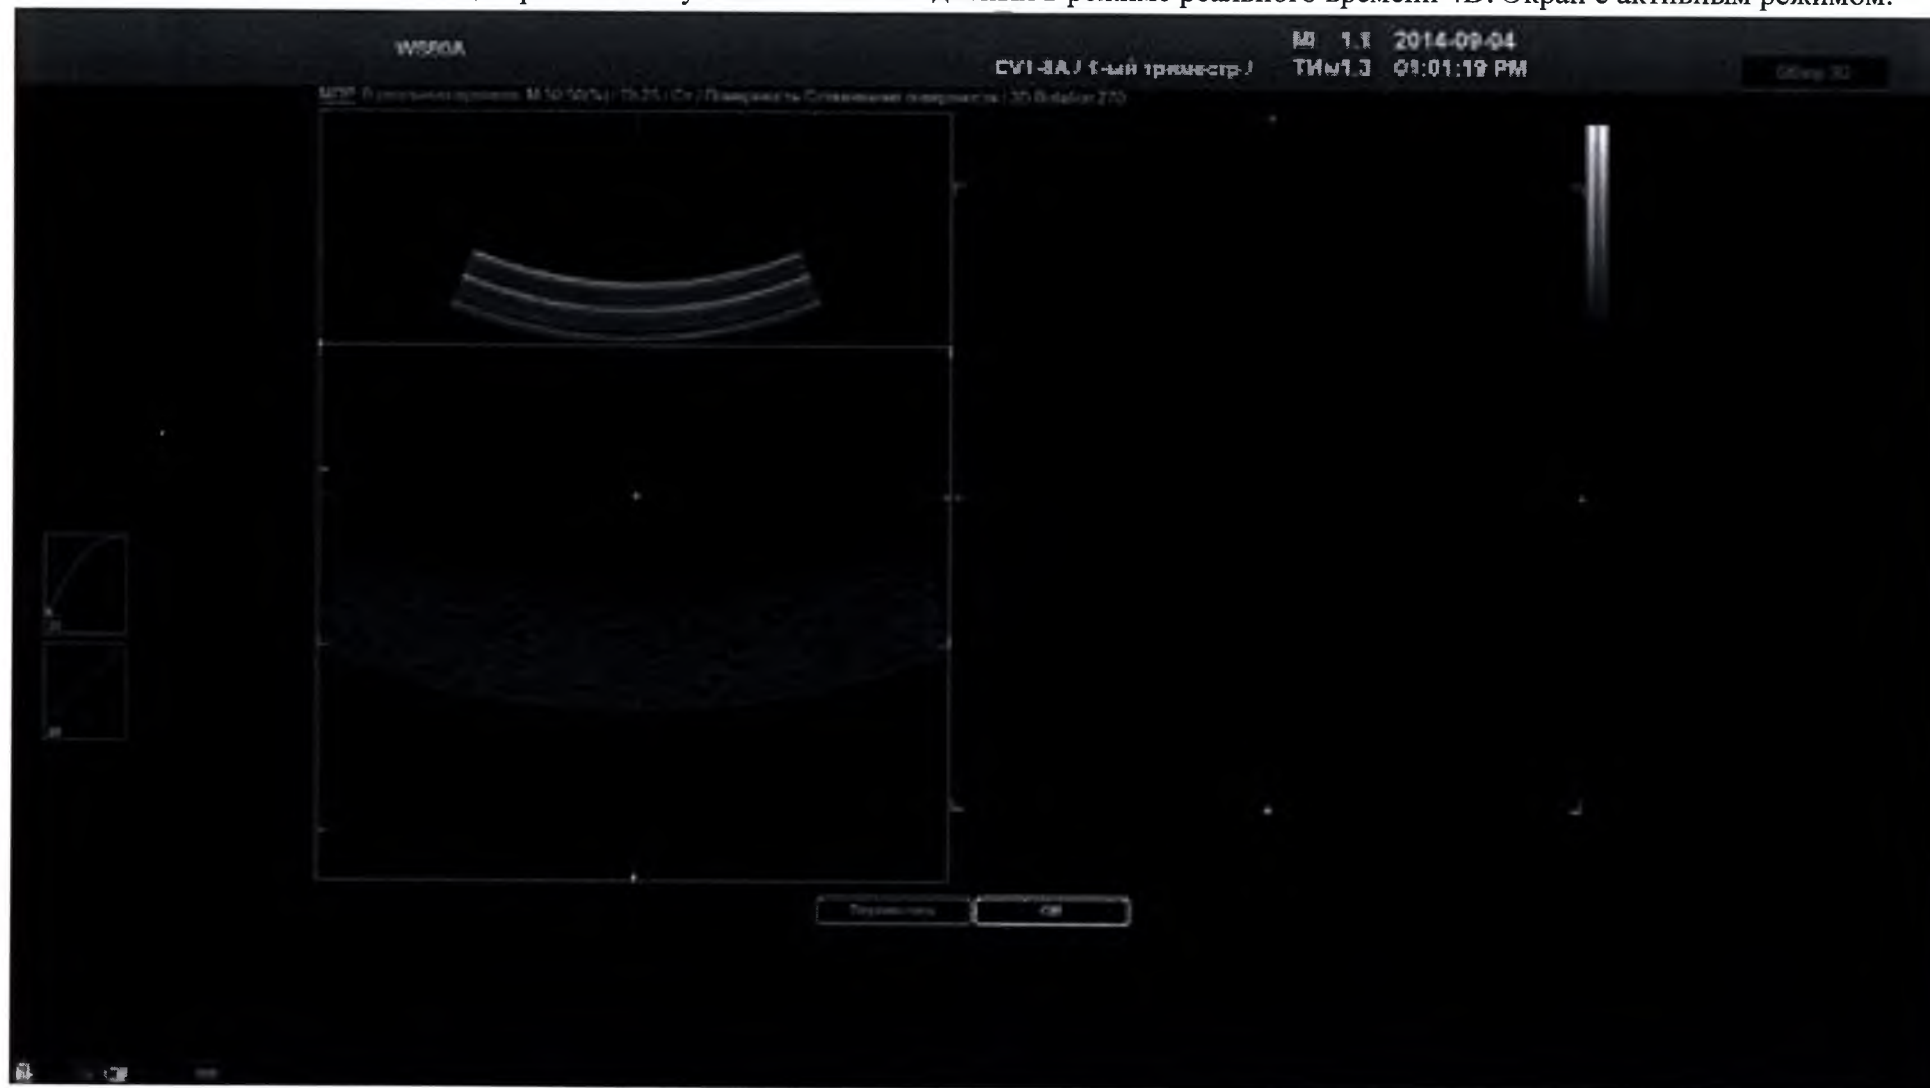

Лицензионный ключ для активации режима обработки трехмерного изображения в 3DXI. Экран с активным режимом.




Лицензионный ключ для активации режима получения многосрезовых ультразвуковых изображений и измерения объемов тканей 3DMXI



Лицензионный ключ для активации функции регистрации работы сердца плода в режиме XI STIC. Экран с активной функцией.




Лицензионный ключ для активации функции исследований в режиме постоянно-волнового доплера; Экран с активным режимом.

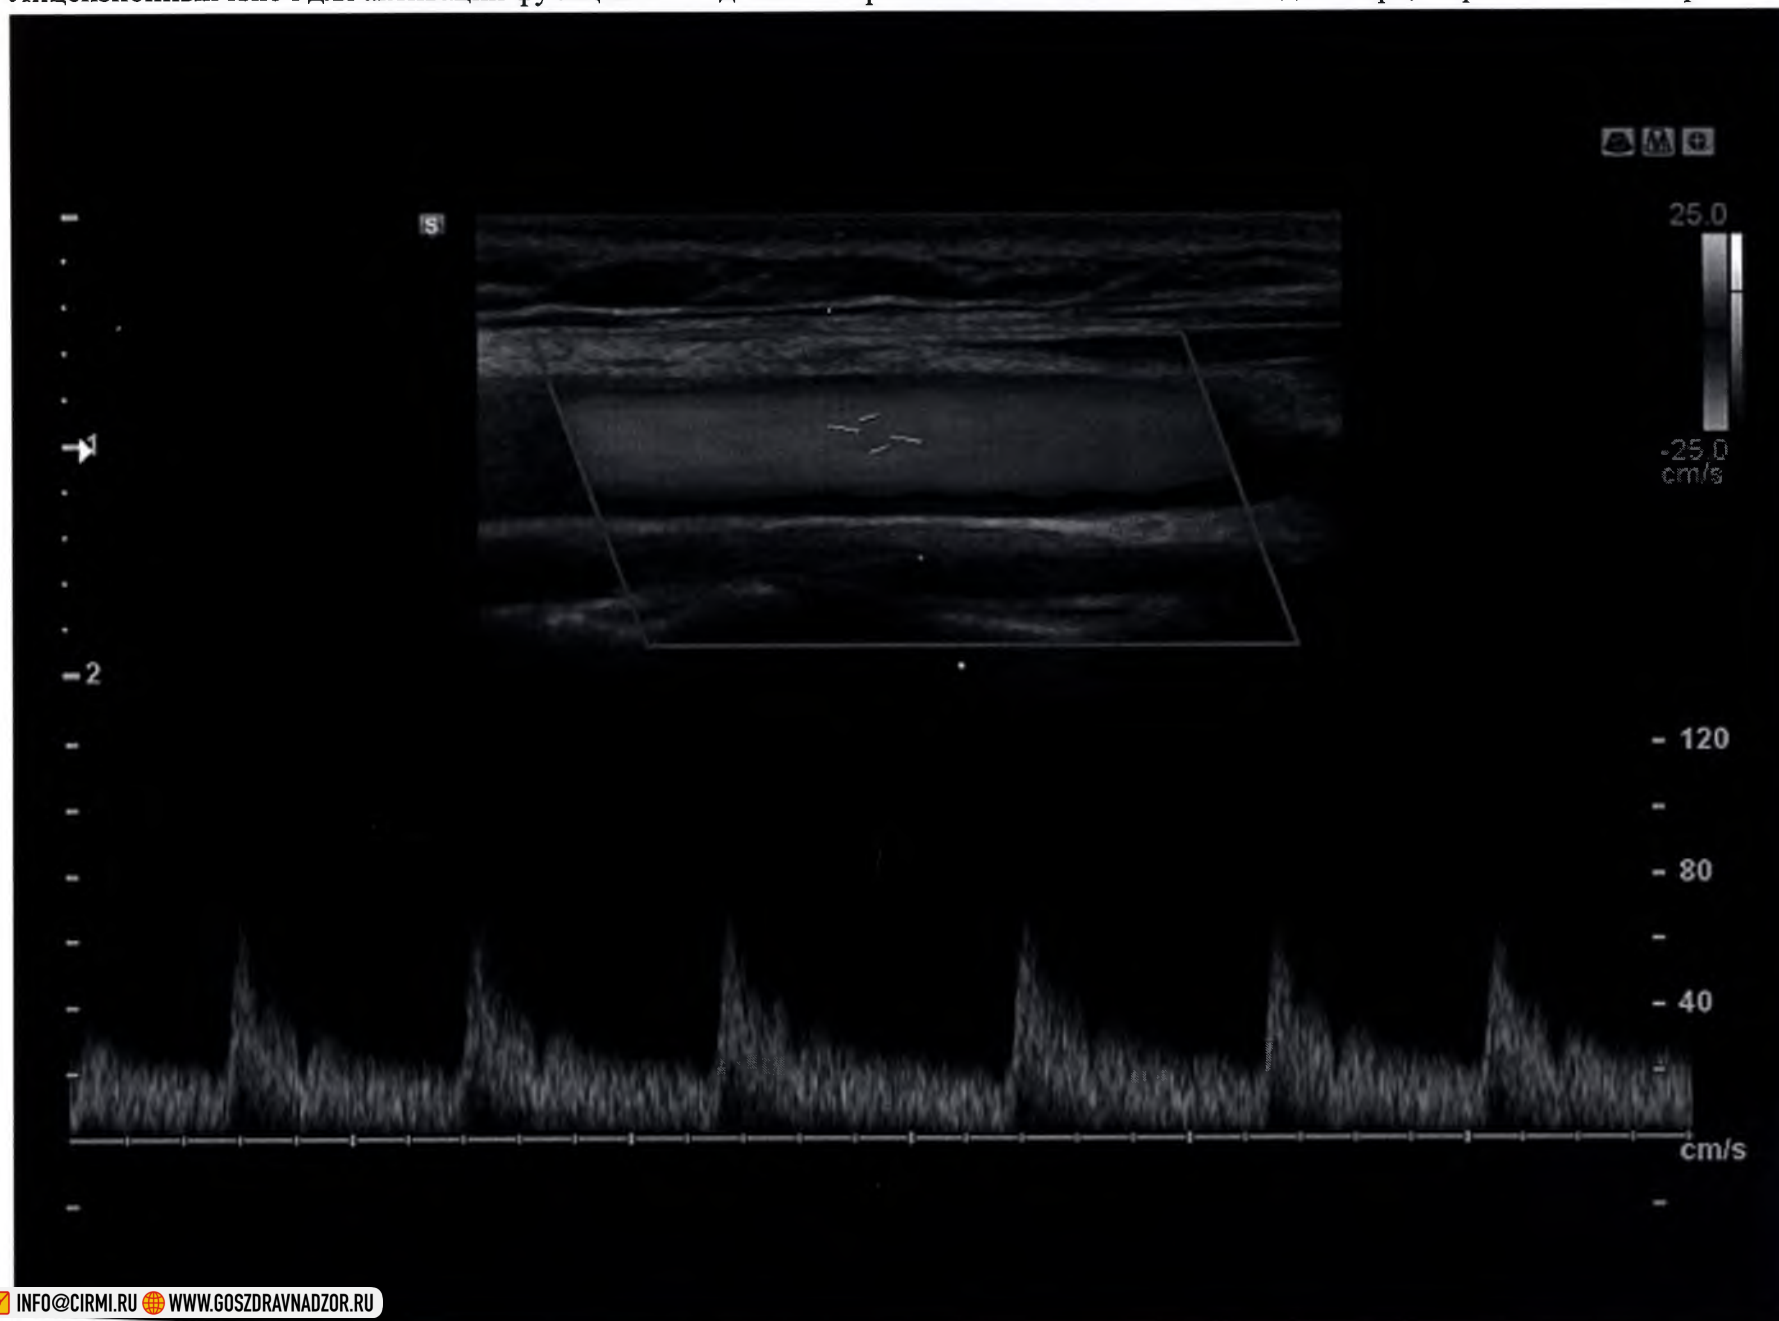

Лицензионный ключ для активации режима Realistic Vue; Экран с активным режимом.



Лицензионный ключ для активации функции E-Breast; Экран с активной функцией.

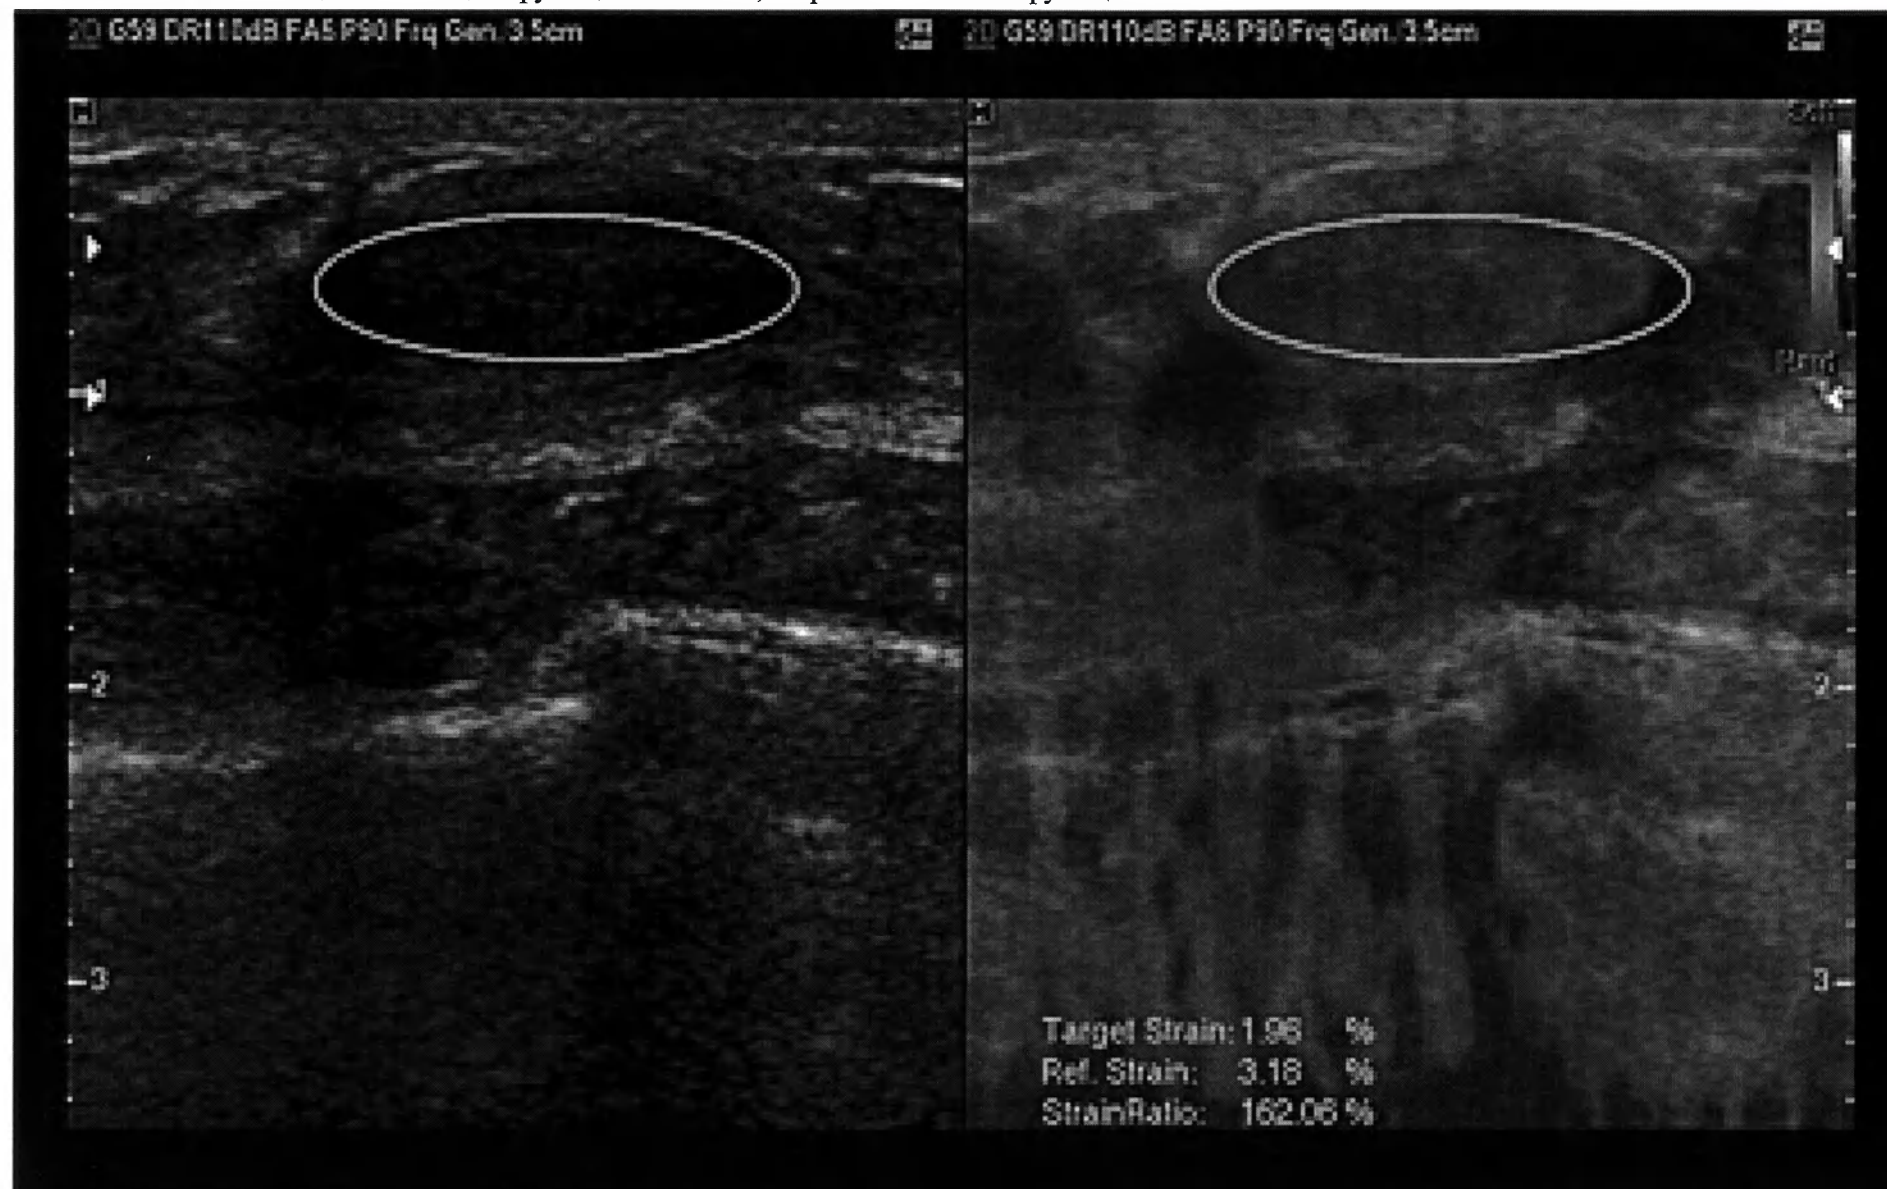


Лицензионный ключ для активации функции E-Thyroid; Экран с активной функцией.




Лицензионный ключ для активации функции 5D NT; Экран с активной функцией.




Лицензионный ключ для активации функции 5D LB; Экран с активной функцией.

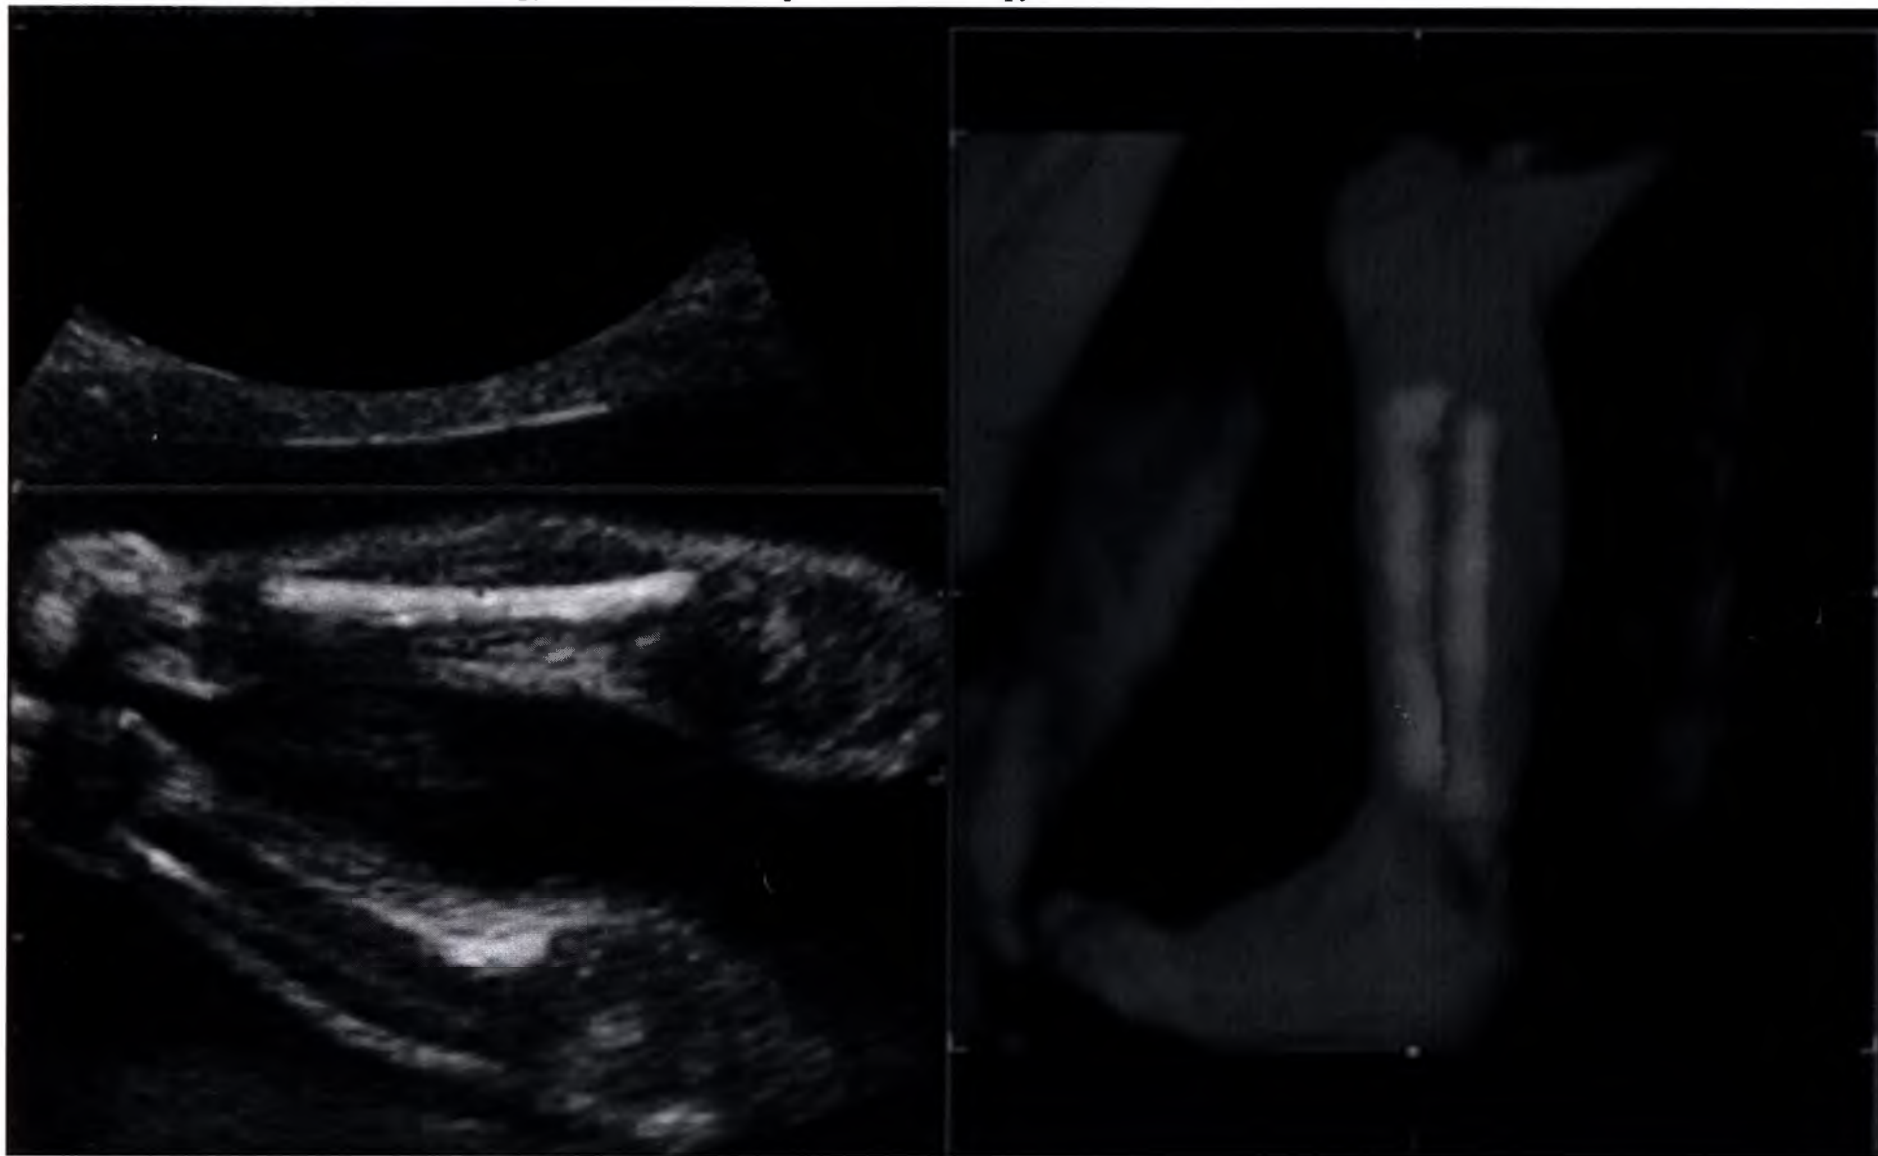


Лицензионный ключ для активации функции 5D CNS; Экран с активной функцией.

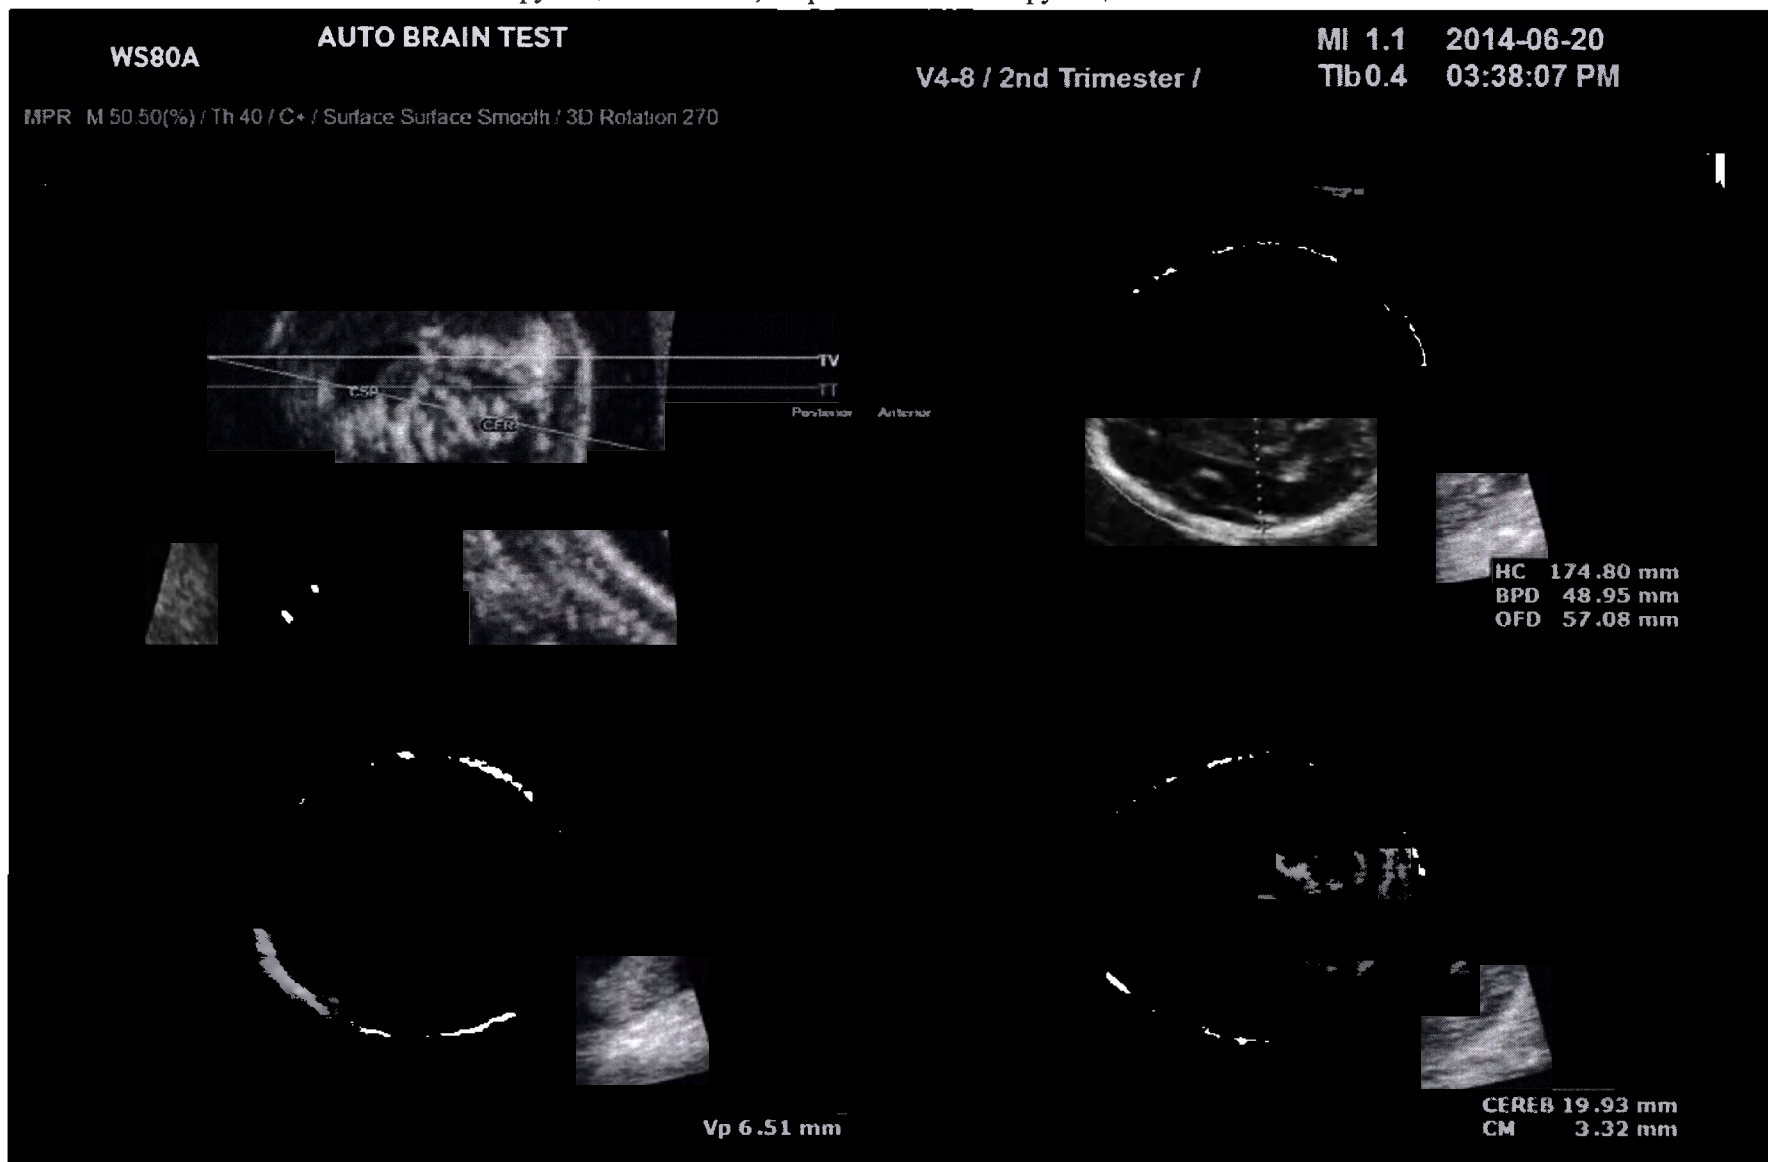

Лицензионный ключ для активации функции 5D Heart; Экран с активной функцией.

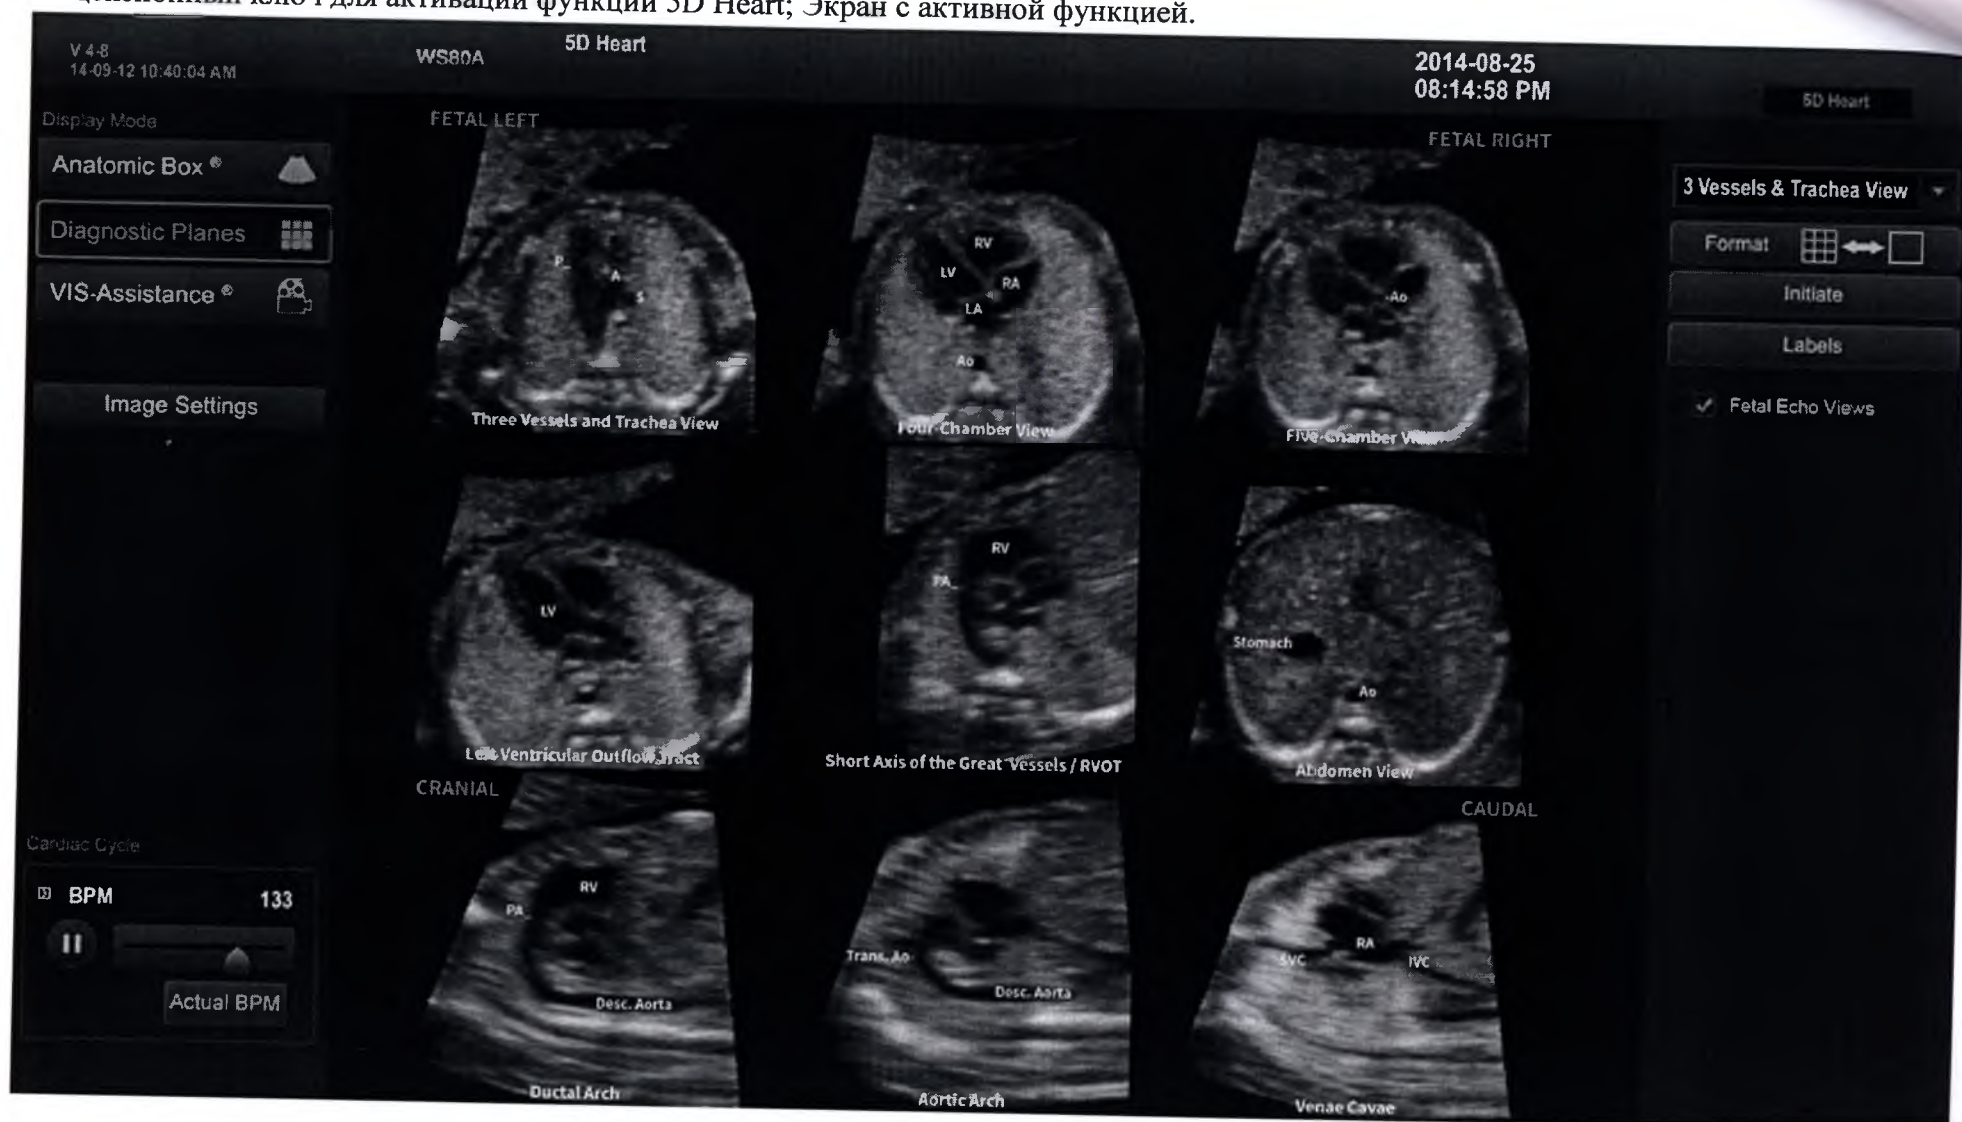

Лицензионный ключ для активации функции 5D Follicle; Экран с активной функцией.

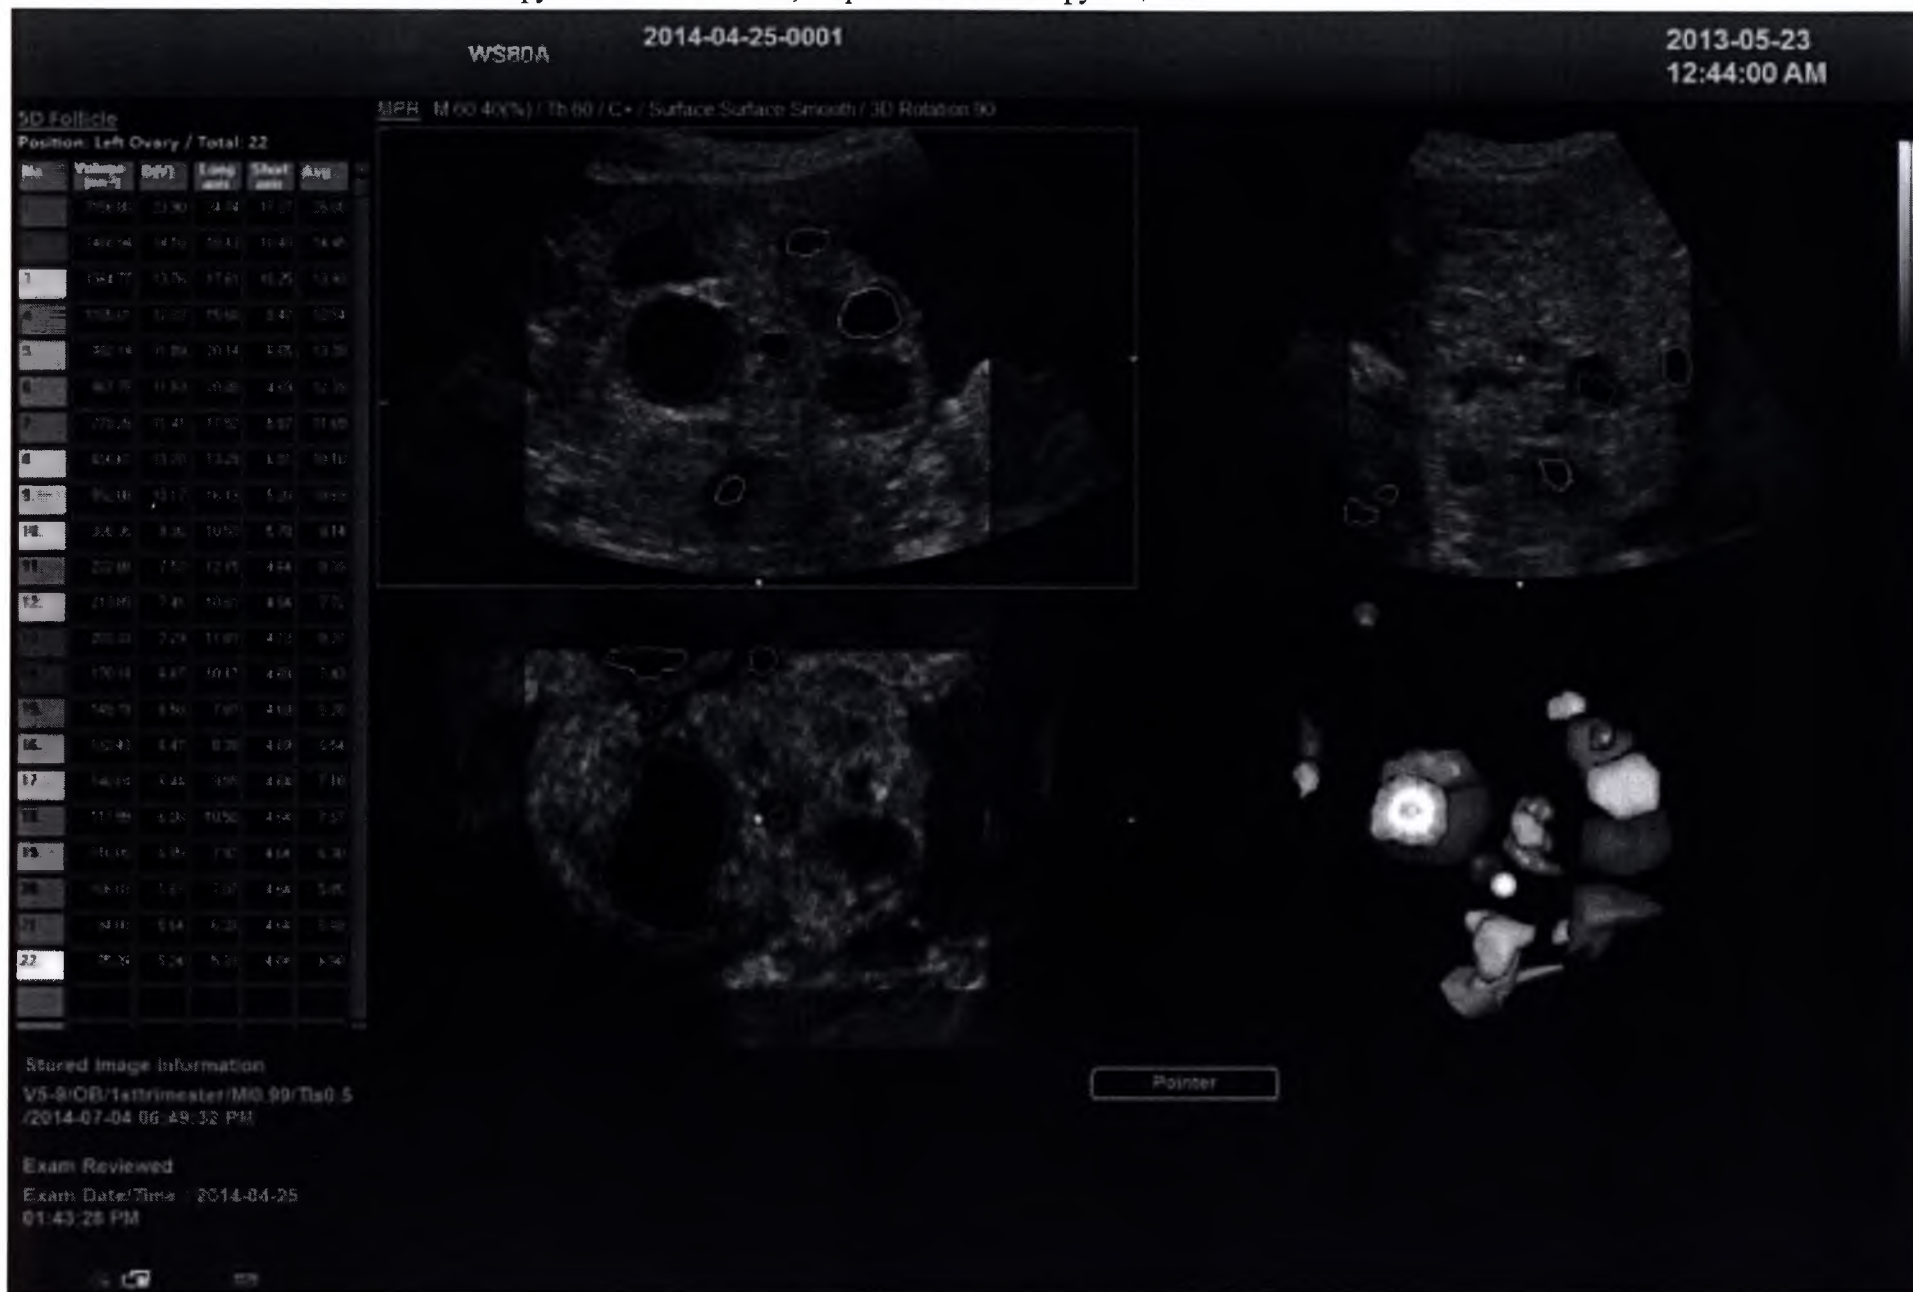

Лицензионный ключ для активации функции 2D NT; Экран с активной функцией.



Лицензионный ключ для активации функции MPI; Экран с активной функцией.



Лицензионный ключ для активации функции Elite upgrade; Экран с активной функцией.



Лицензионный ключ для про





54 (nursing)
sample (nursing)