


Комплекс лазерный общий вид






Аппарат лазерный медицинский Латус-М вид спереди

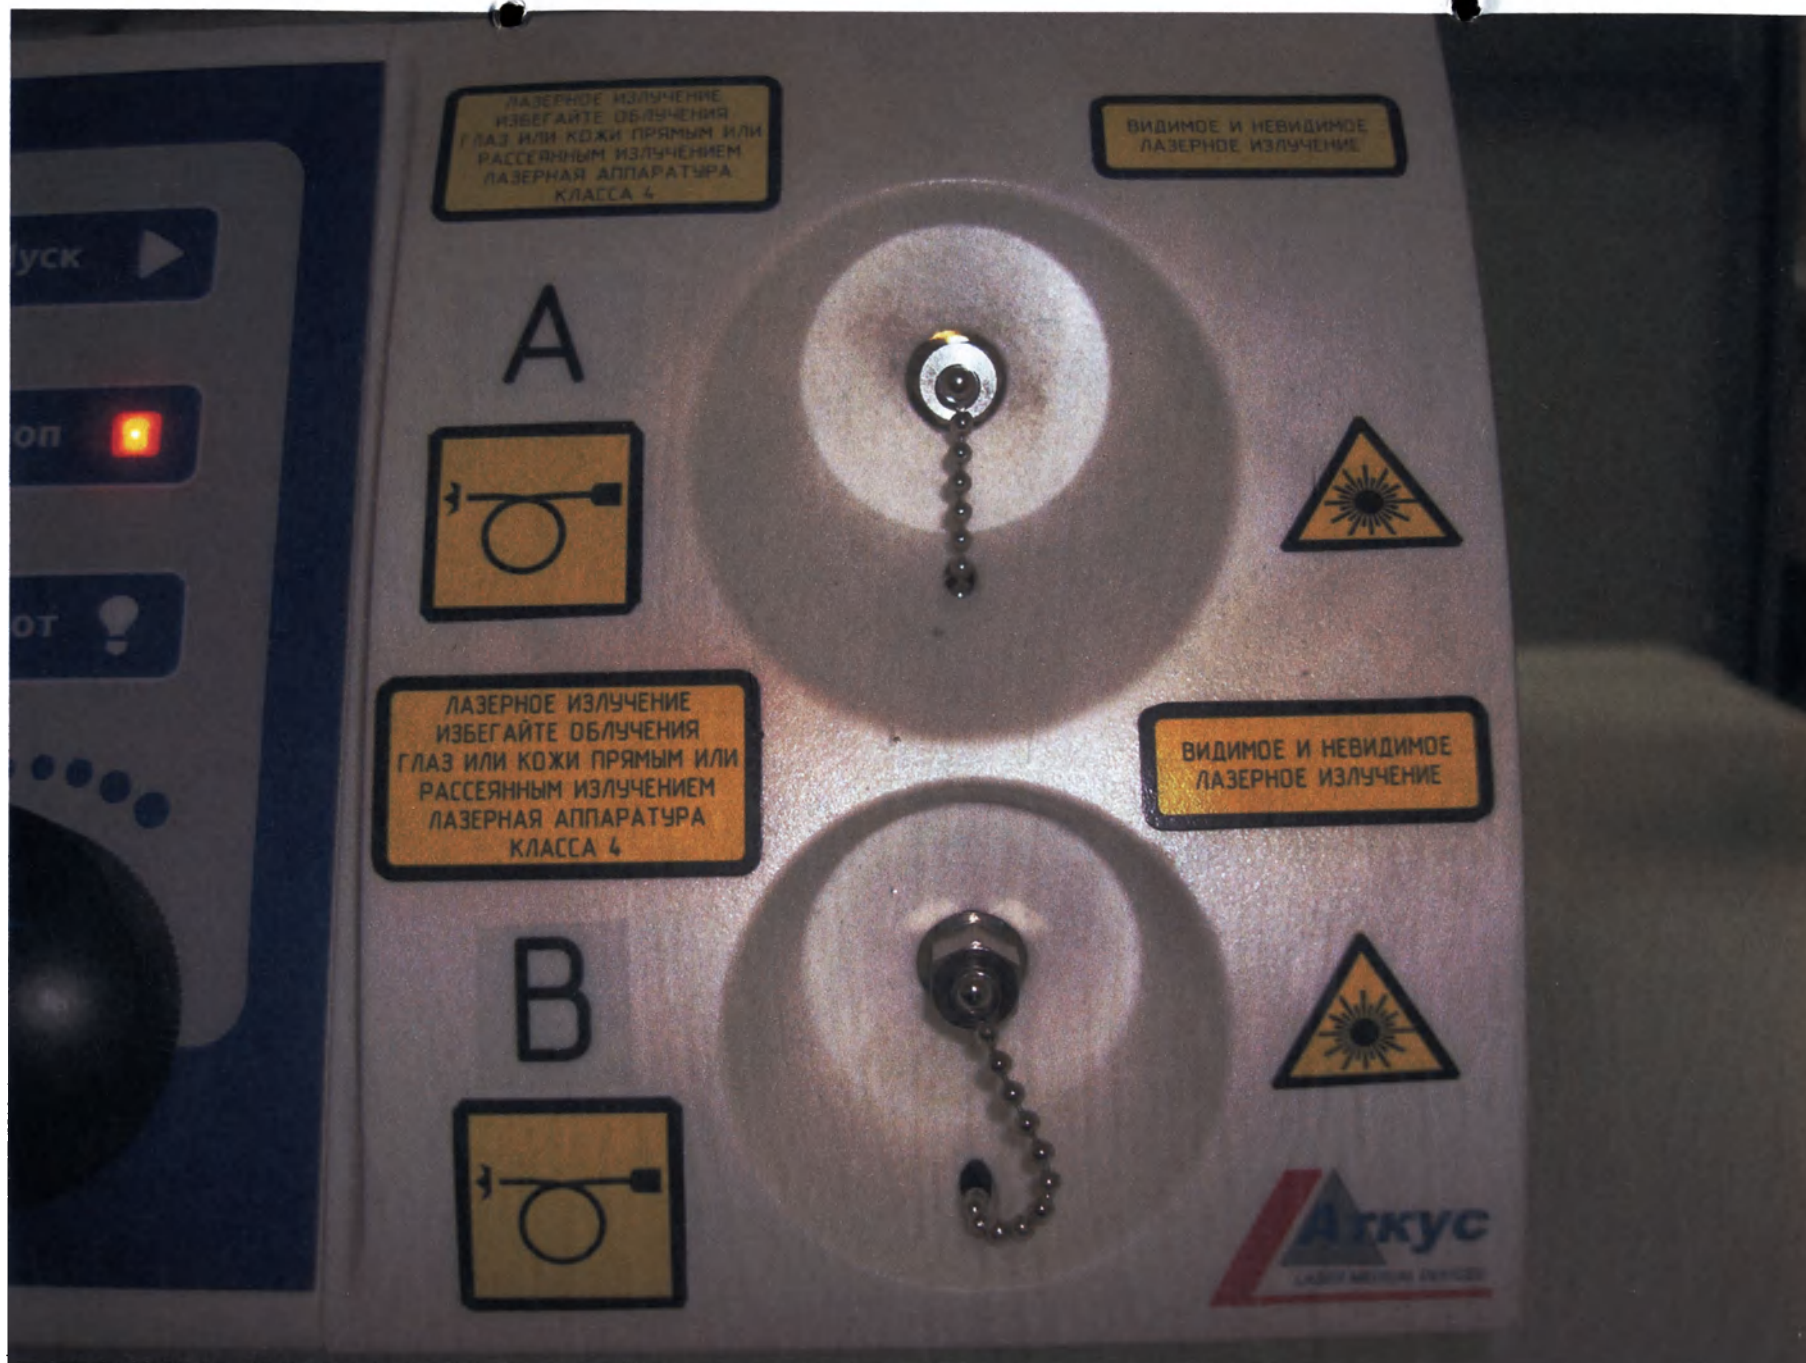

Аппарат лазерный медицинский Латыс-М вид спереди

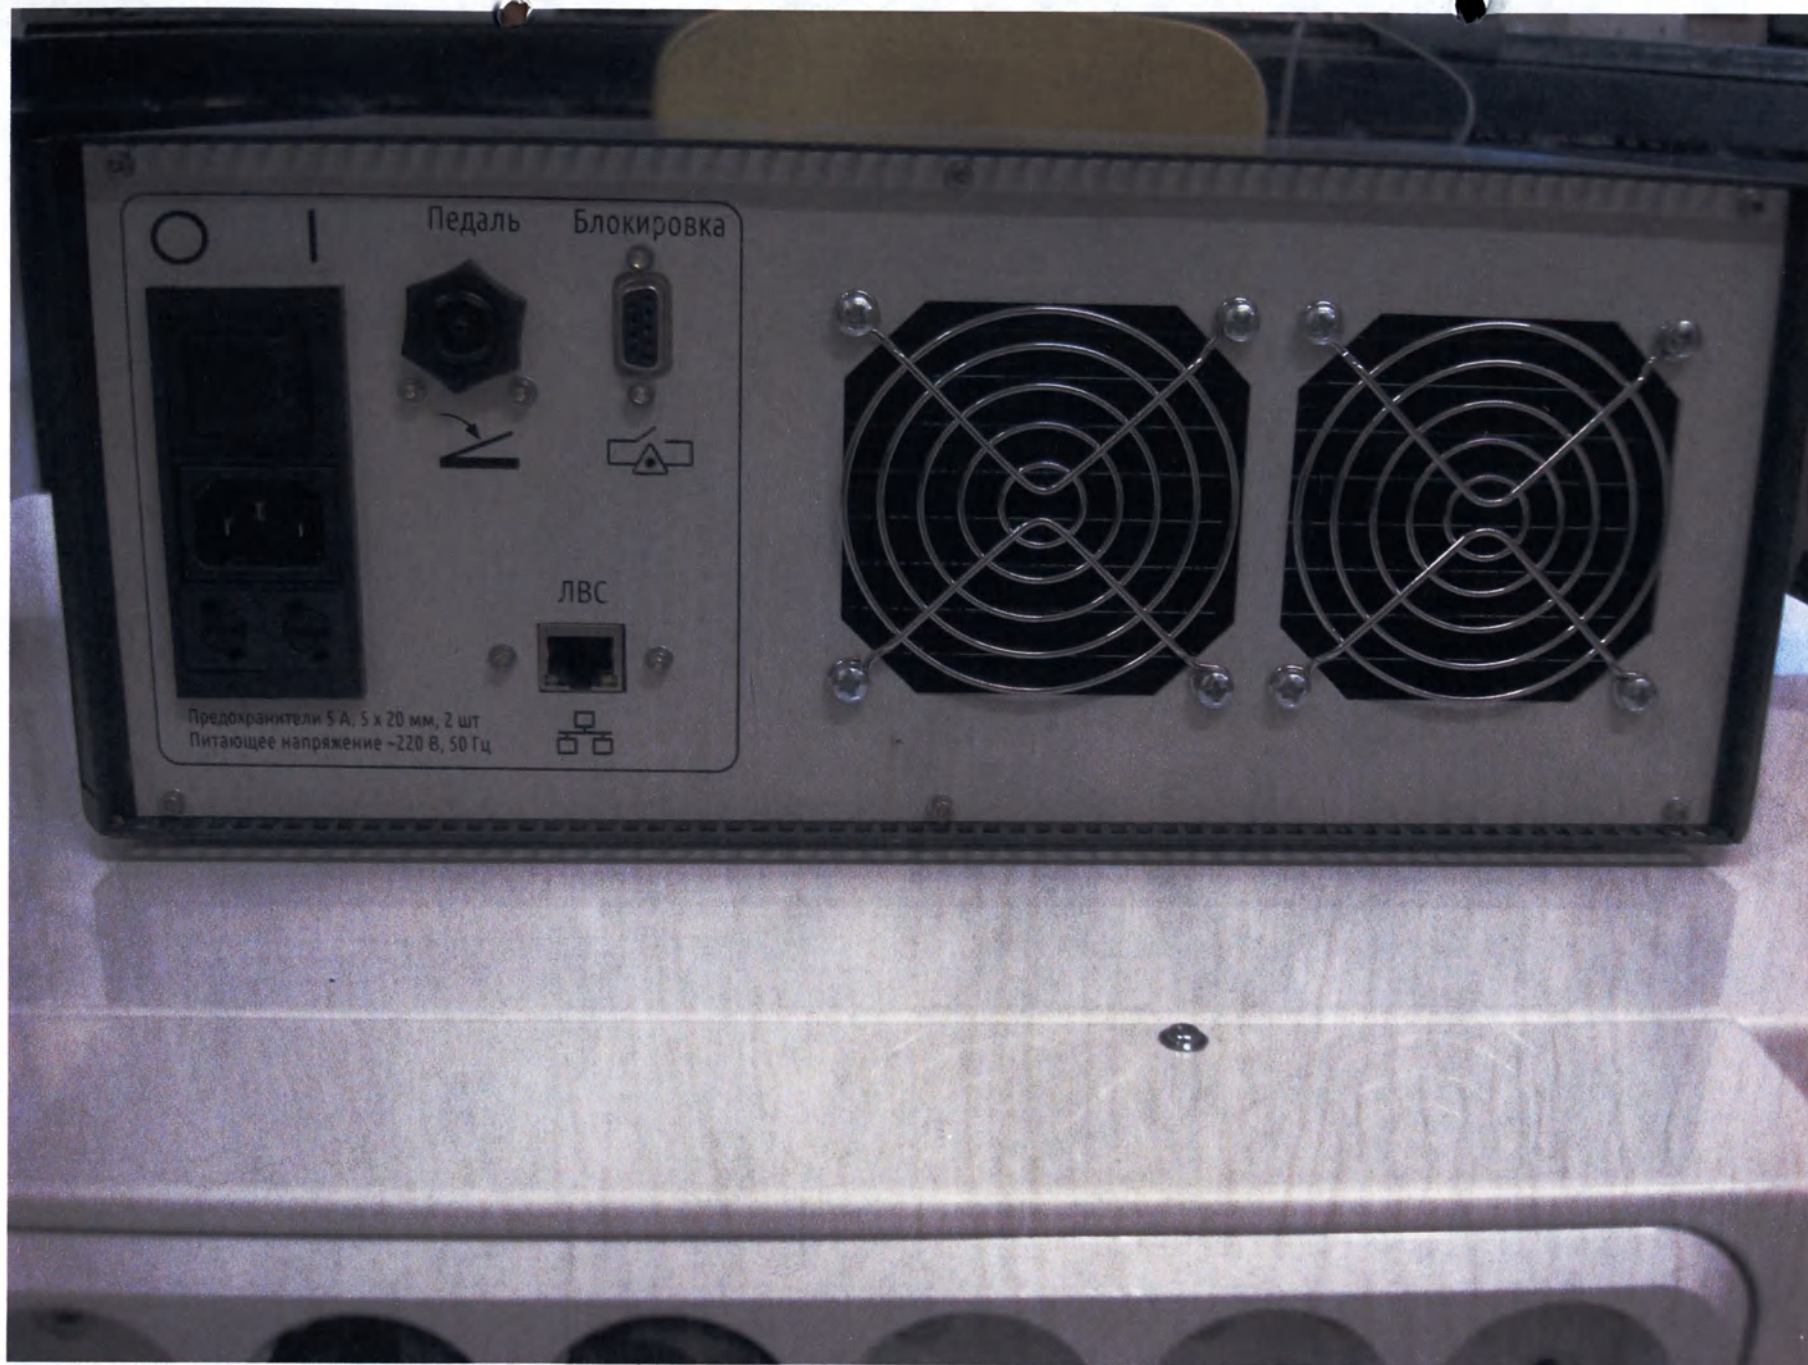

Аппарат лазерный медицинский Латыс-М вид сзади

Аппарат лазерный медицинский ЛАТУС -М

Зав. №0002

АМШЛ.941143.003ТУ

Максимальная оптическая мощность 60 Вт

Длина волны излучения 660 ± 20 , 808 ± 10 , 960 ± 20 , 1470 ± 30 нм

Питание $\sim 220 \text{ В} \pm 10\%$, 50 Гц

Класс лазерной опасности - IV

Потребляемая мощность - не более 400 ВА

Изготовлено ООО «Аткус»

194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса,

д. 27, корп.5, лит. А,

Тел. +7 812 294 25 32

E-mail: sales@atcsd.ru


www.atcus.ru



Маркировка



Блок питания аппарата светодиодного медицинского Латус-М вид спереди

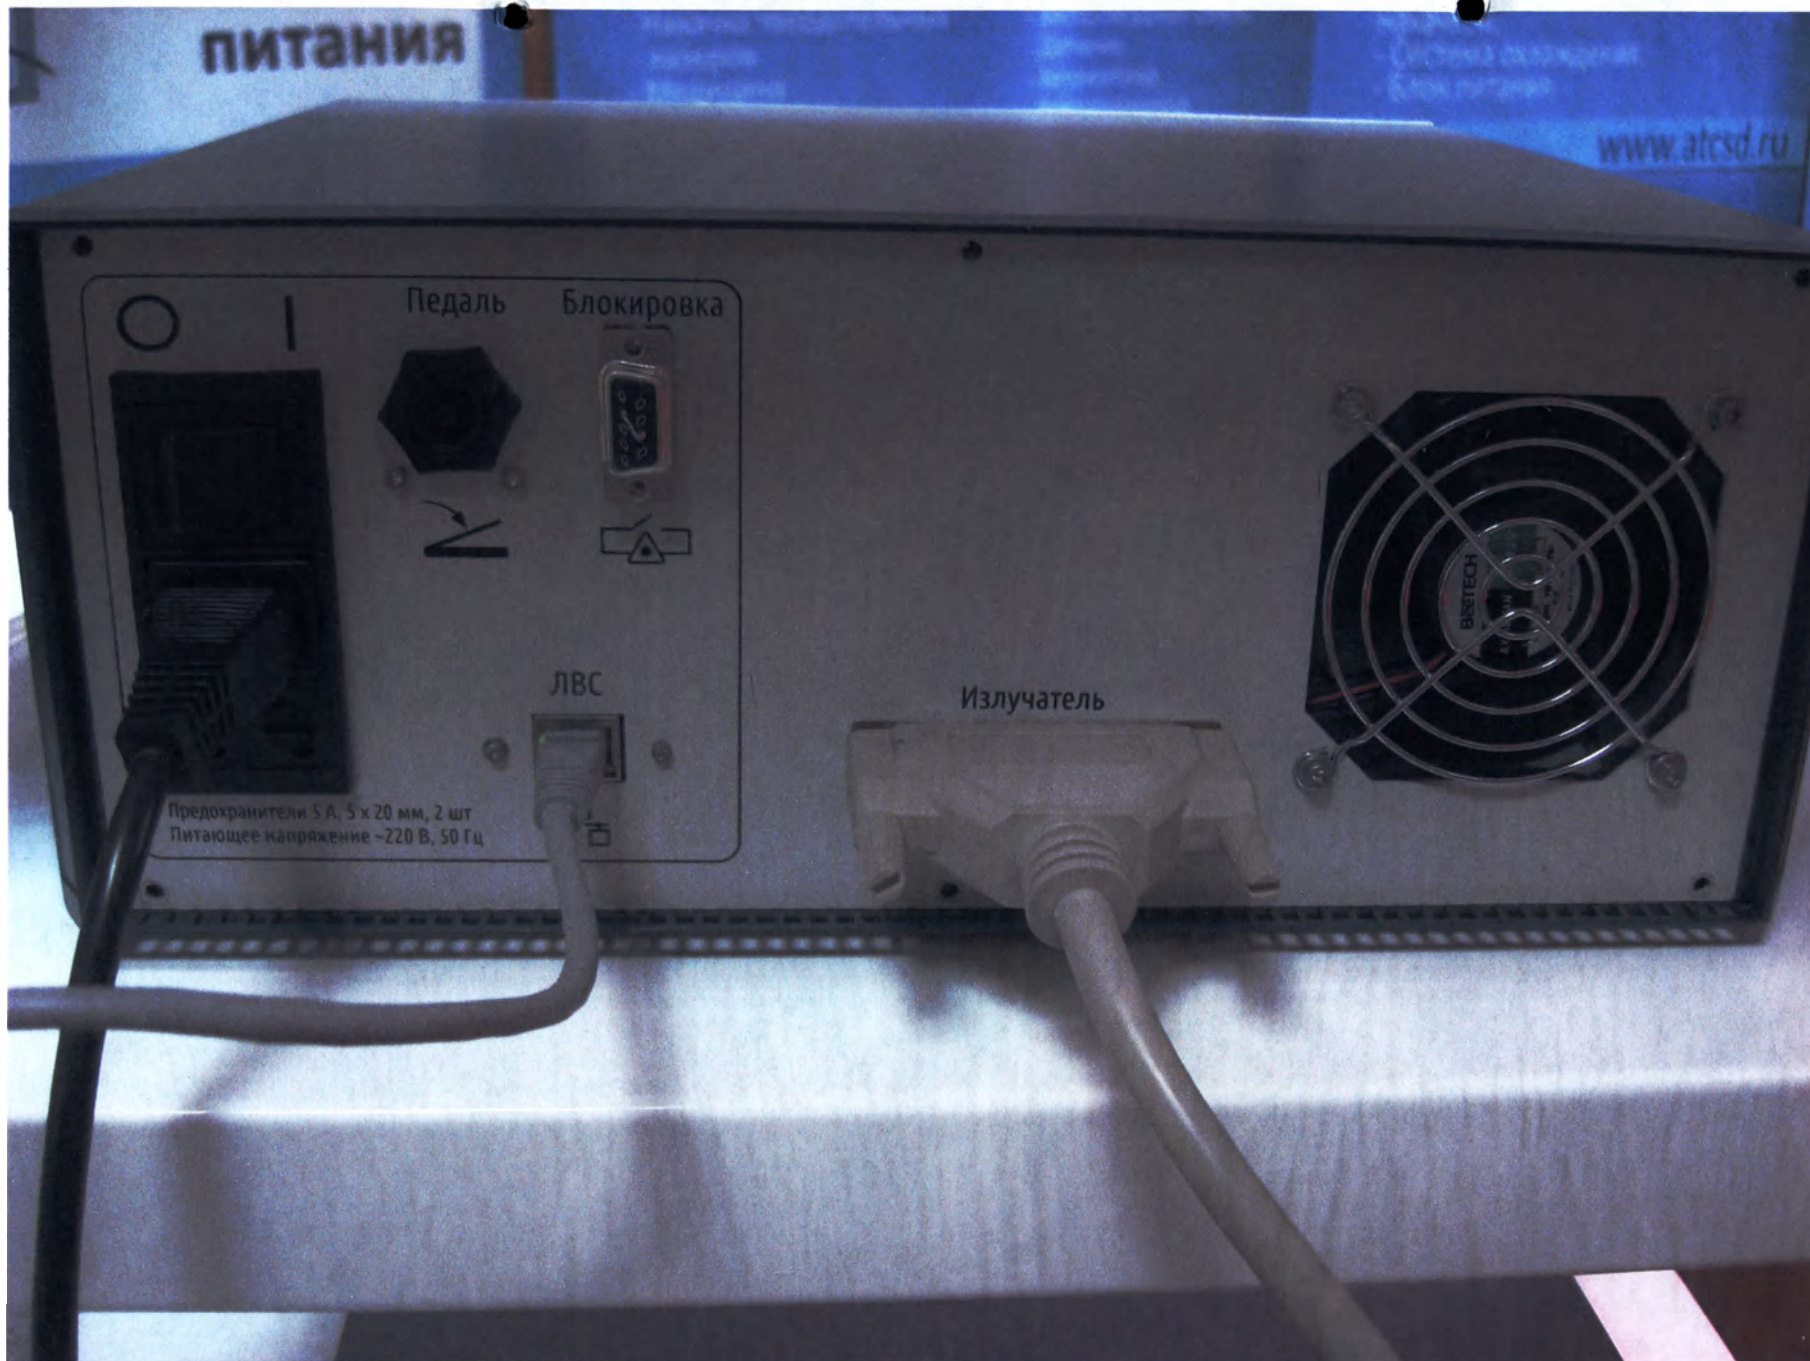

Блок питания аппарата светодиодного медицинского Латус-М вид сзади



Излучатель аппарата светодиодного медицинского Латус-М

Аппарат светодиодный медицинский ЛАТУС -М
Зав. №0002

АМШЛ.941143.003ТУ

Максимальная оптическая мощность 60 Вт

Длина волны излучения 660 ± 10 нм

Питание $\sim 220 \text{ В} \pm 10\%$, 50 Гц

Потребляемая мощность - не более 900 ВА

Изготовлено ООО «Аткус»

194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса,

д. 27, корп.5, лит. А,


Тел. +7 812 294 25 32

E-mail: sales@atcsd.ru


www.atcus.ru




Маркировка

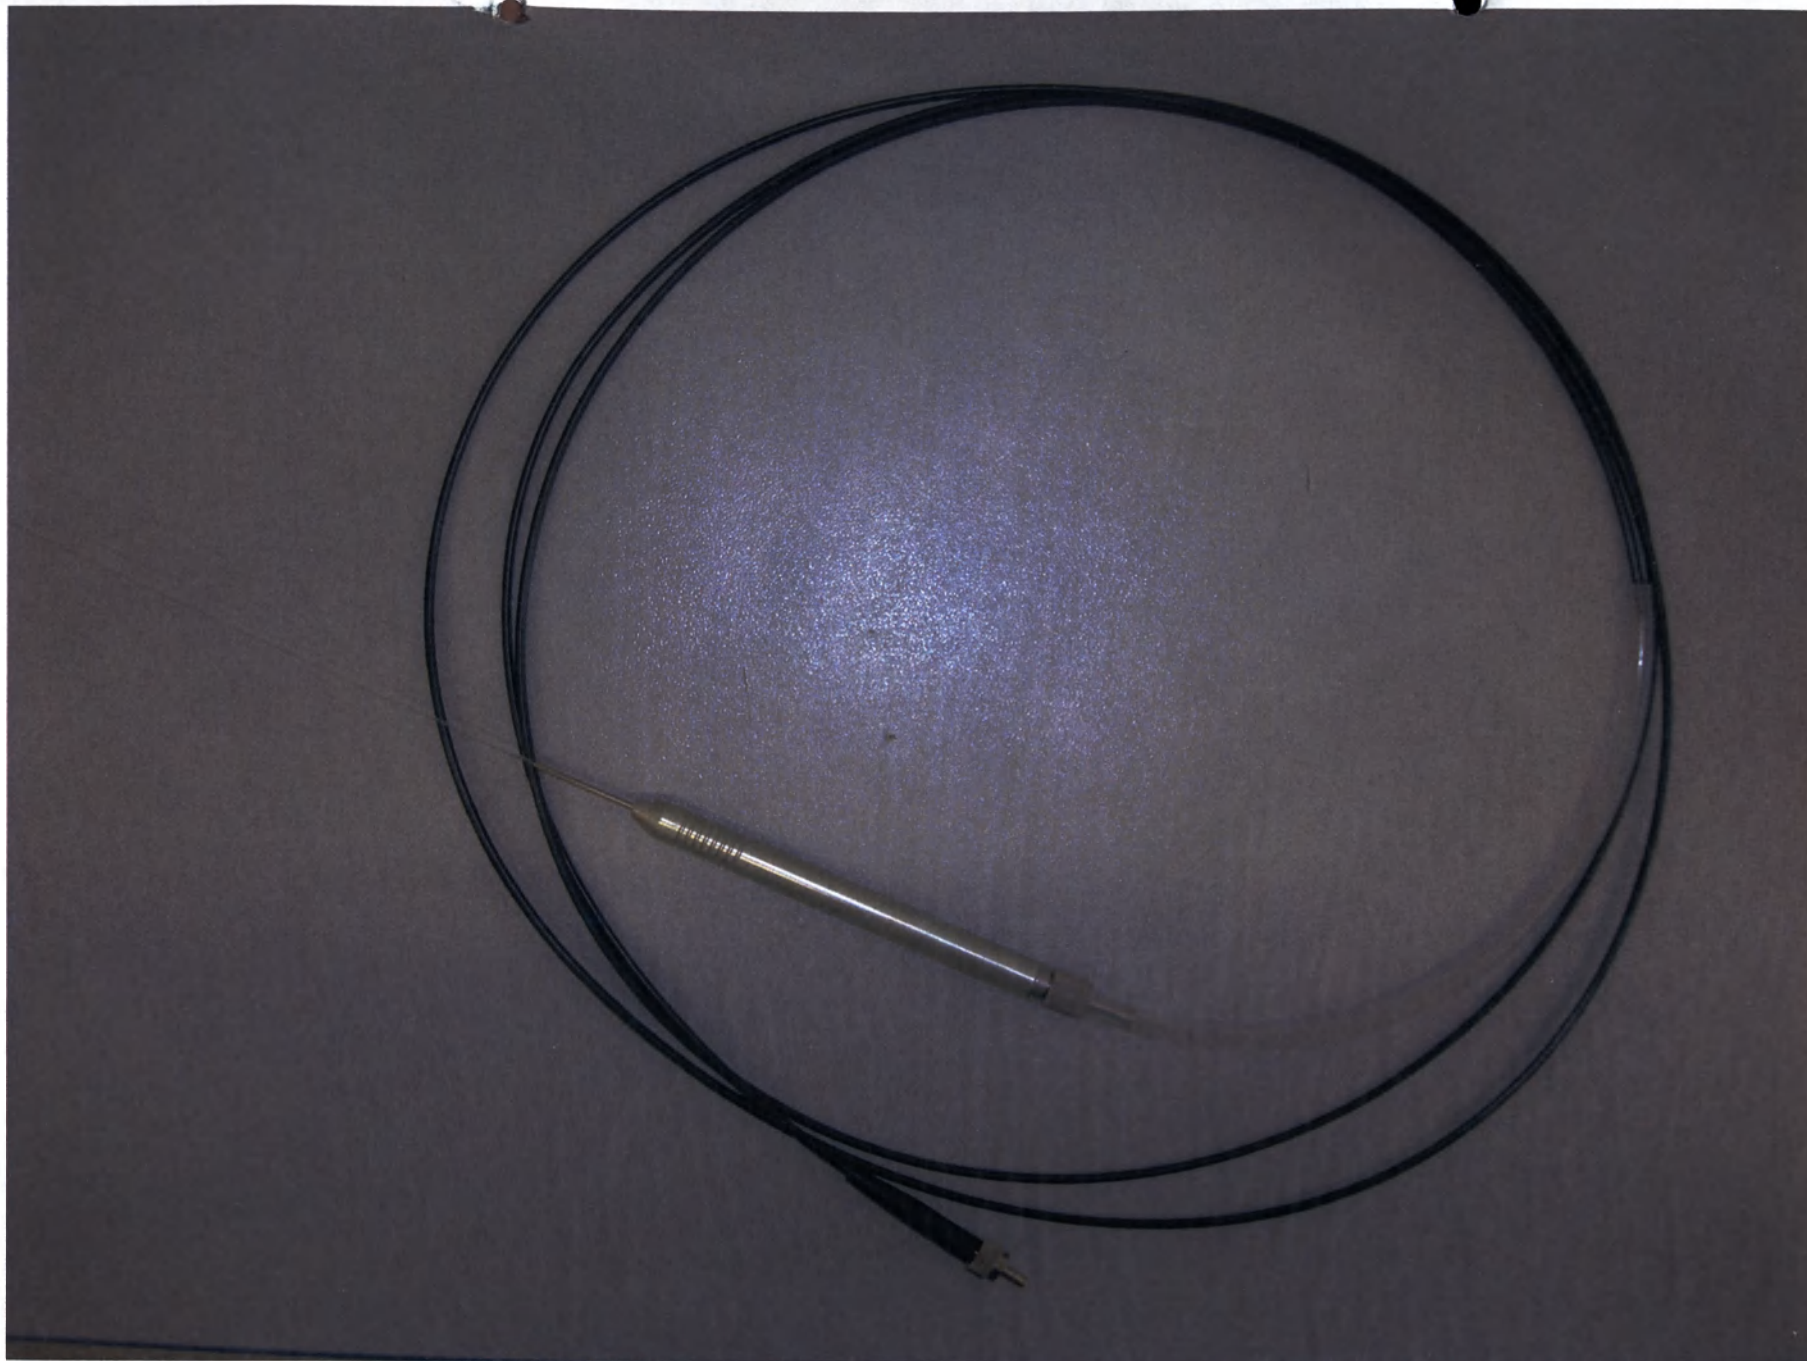

Волоконно-оптический инструмент 400-СМА905

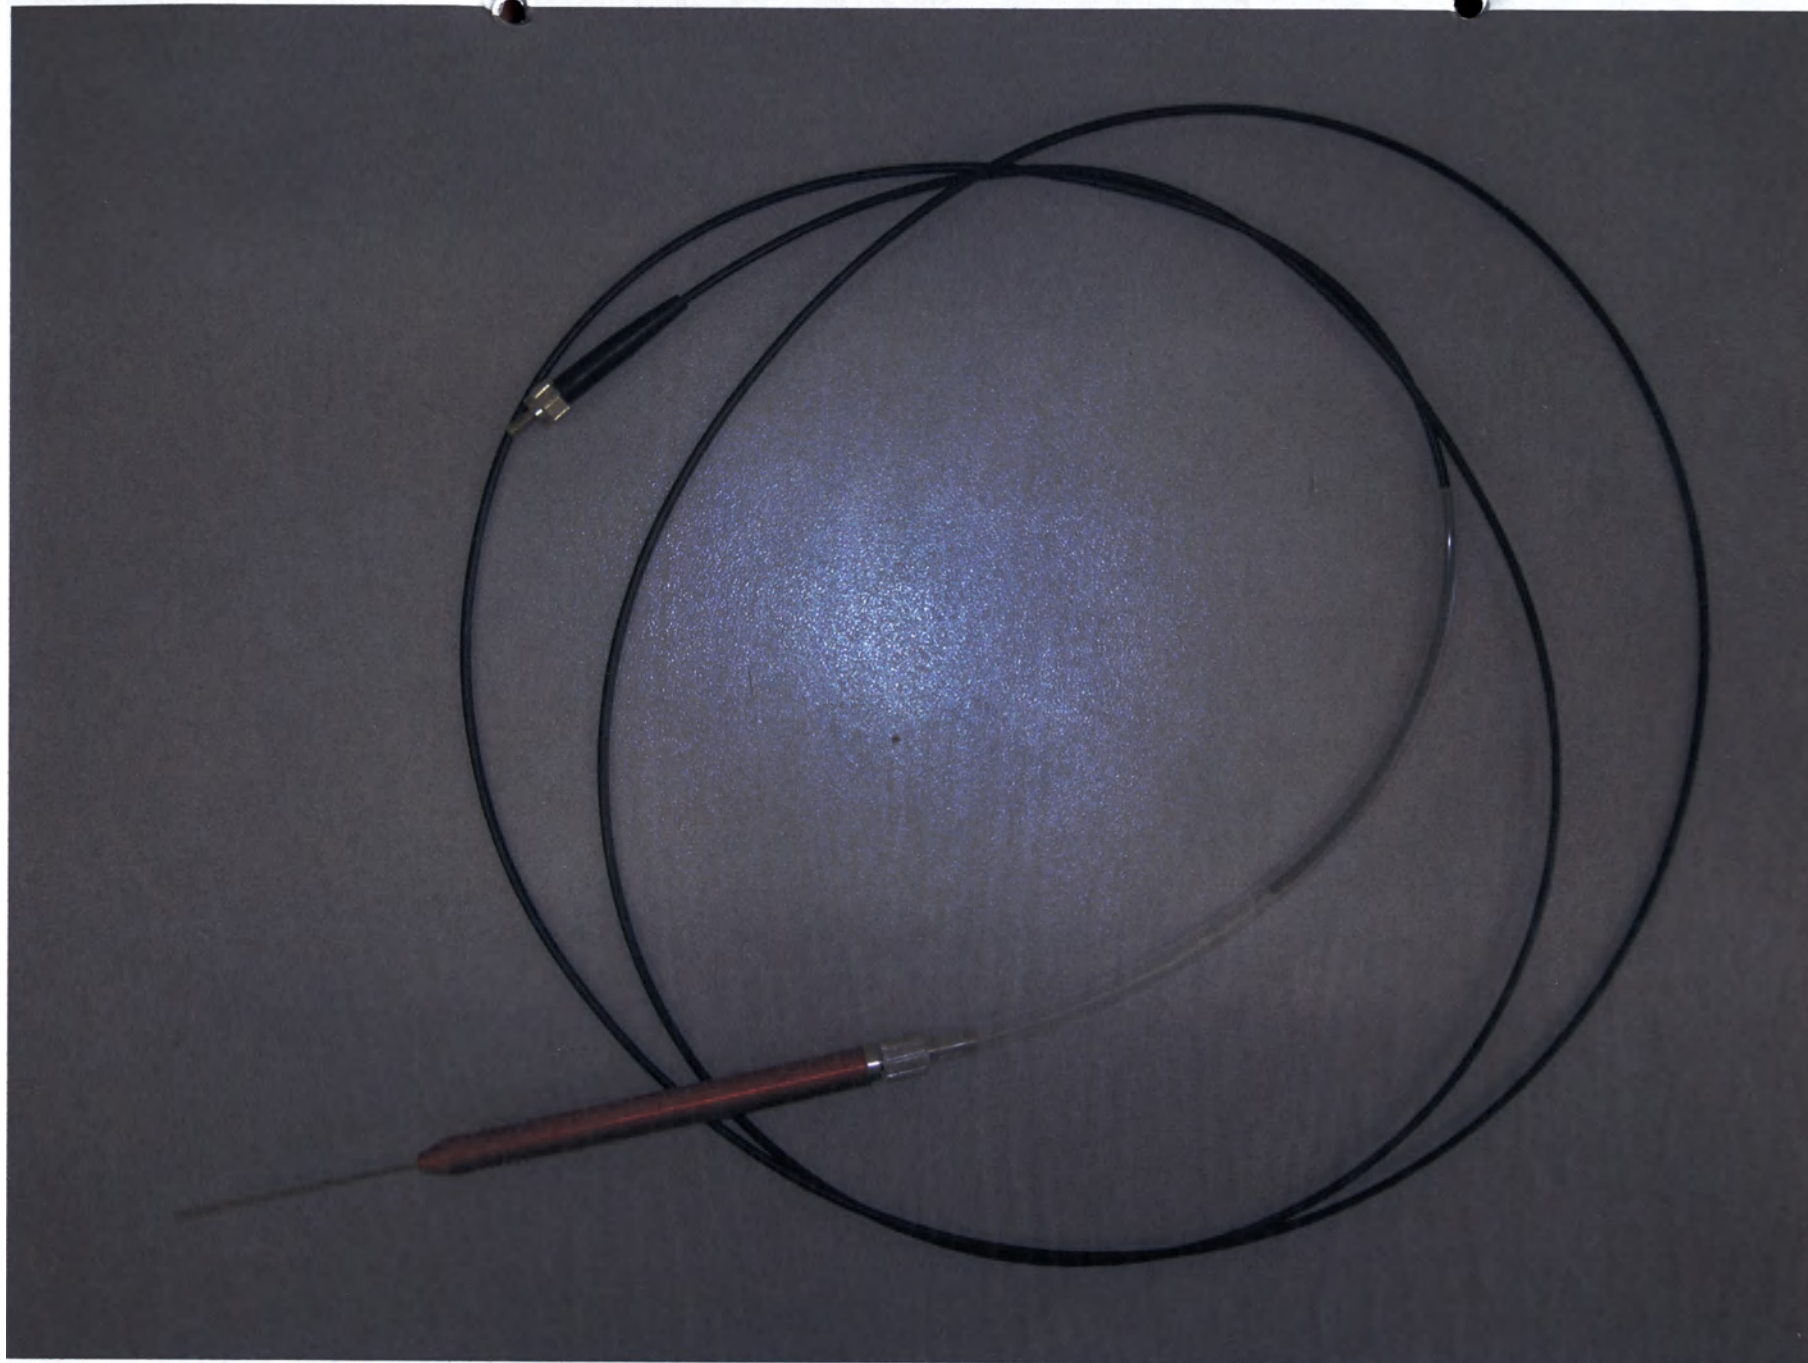


Волоконно-оптический инструмент 600-СМА905

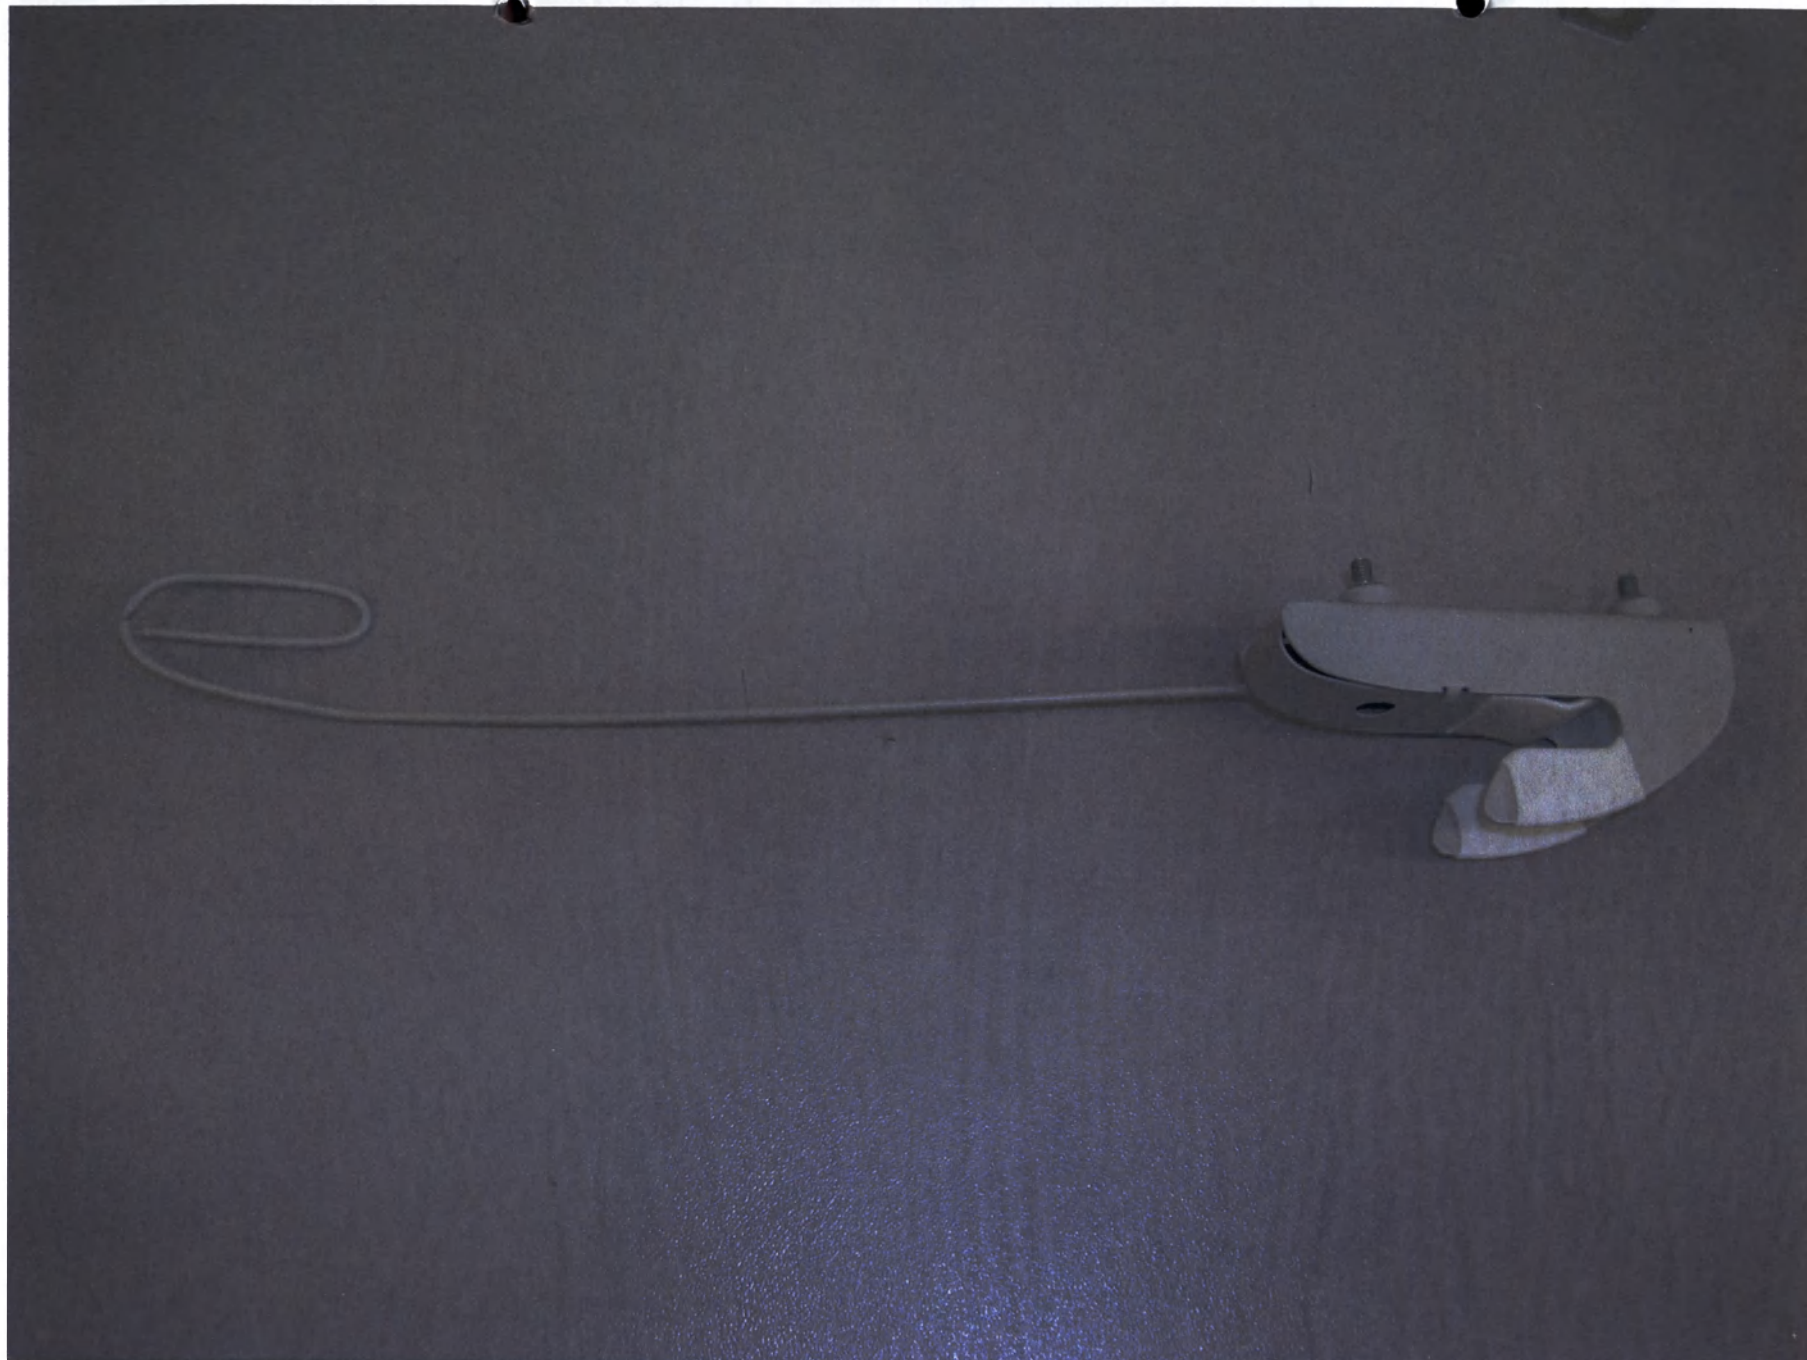

Держатель волоконно-оптического инструмента ДВ1



Очки защитные для врача TYPE-2

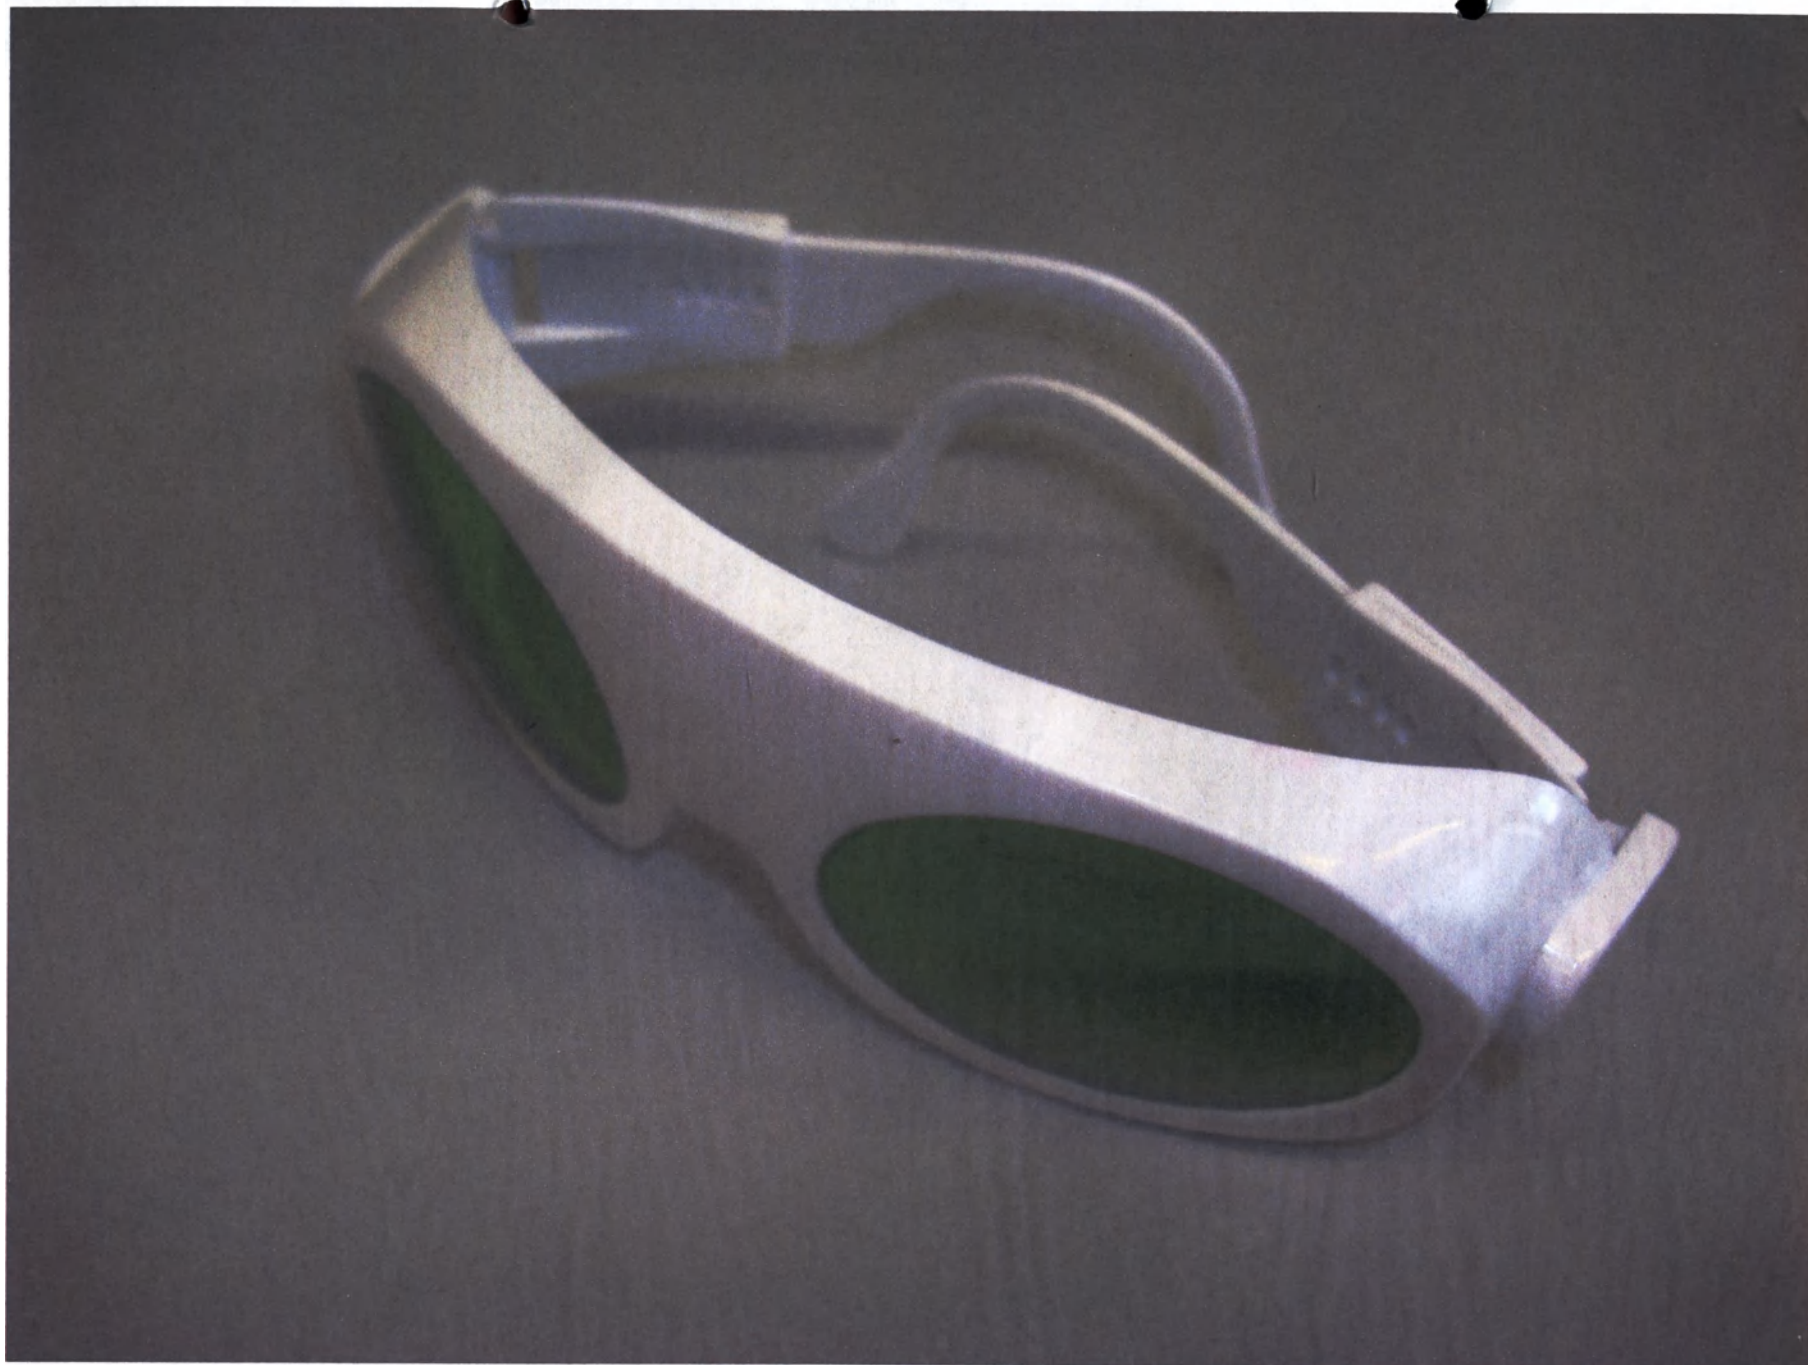


Очки защитные для врача TYPE-3




Очки защитные для пациента



Педа́ль пневматическая 6448-00 HERGA

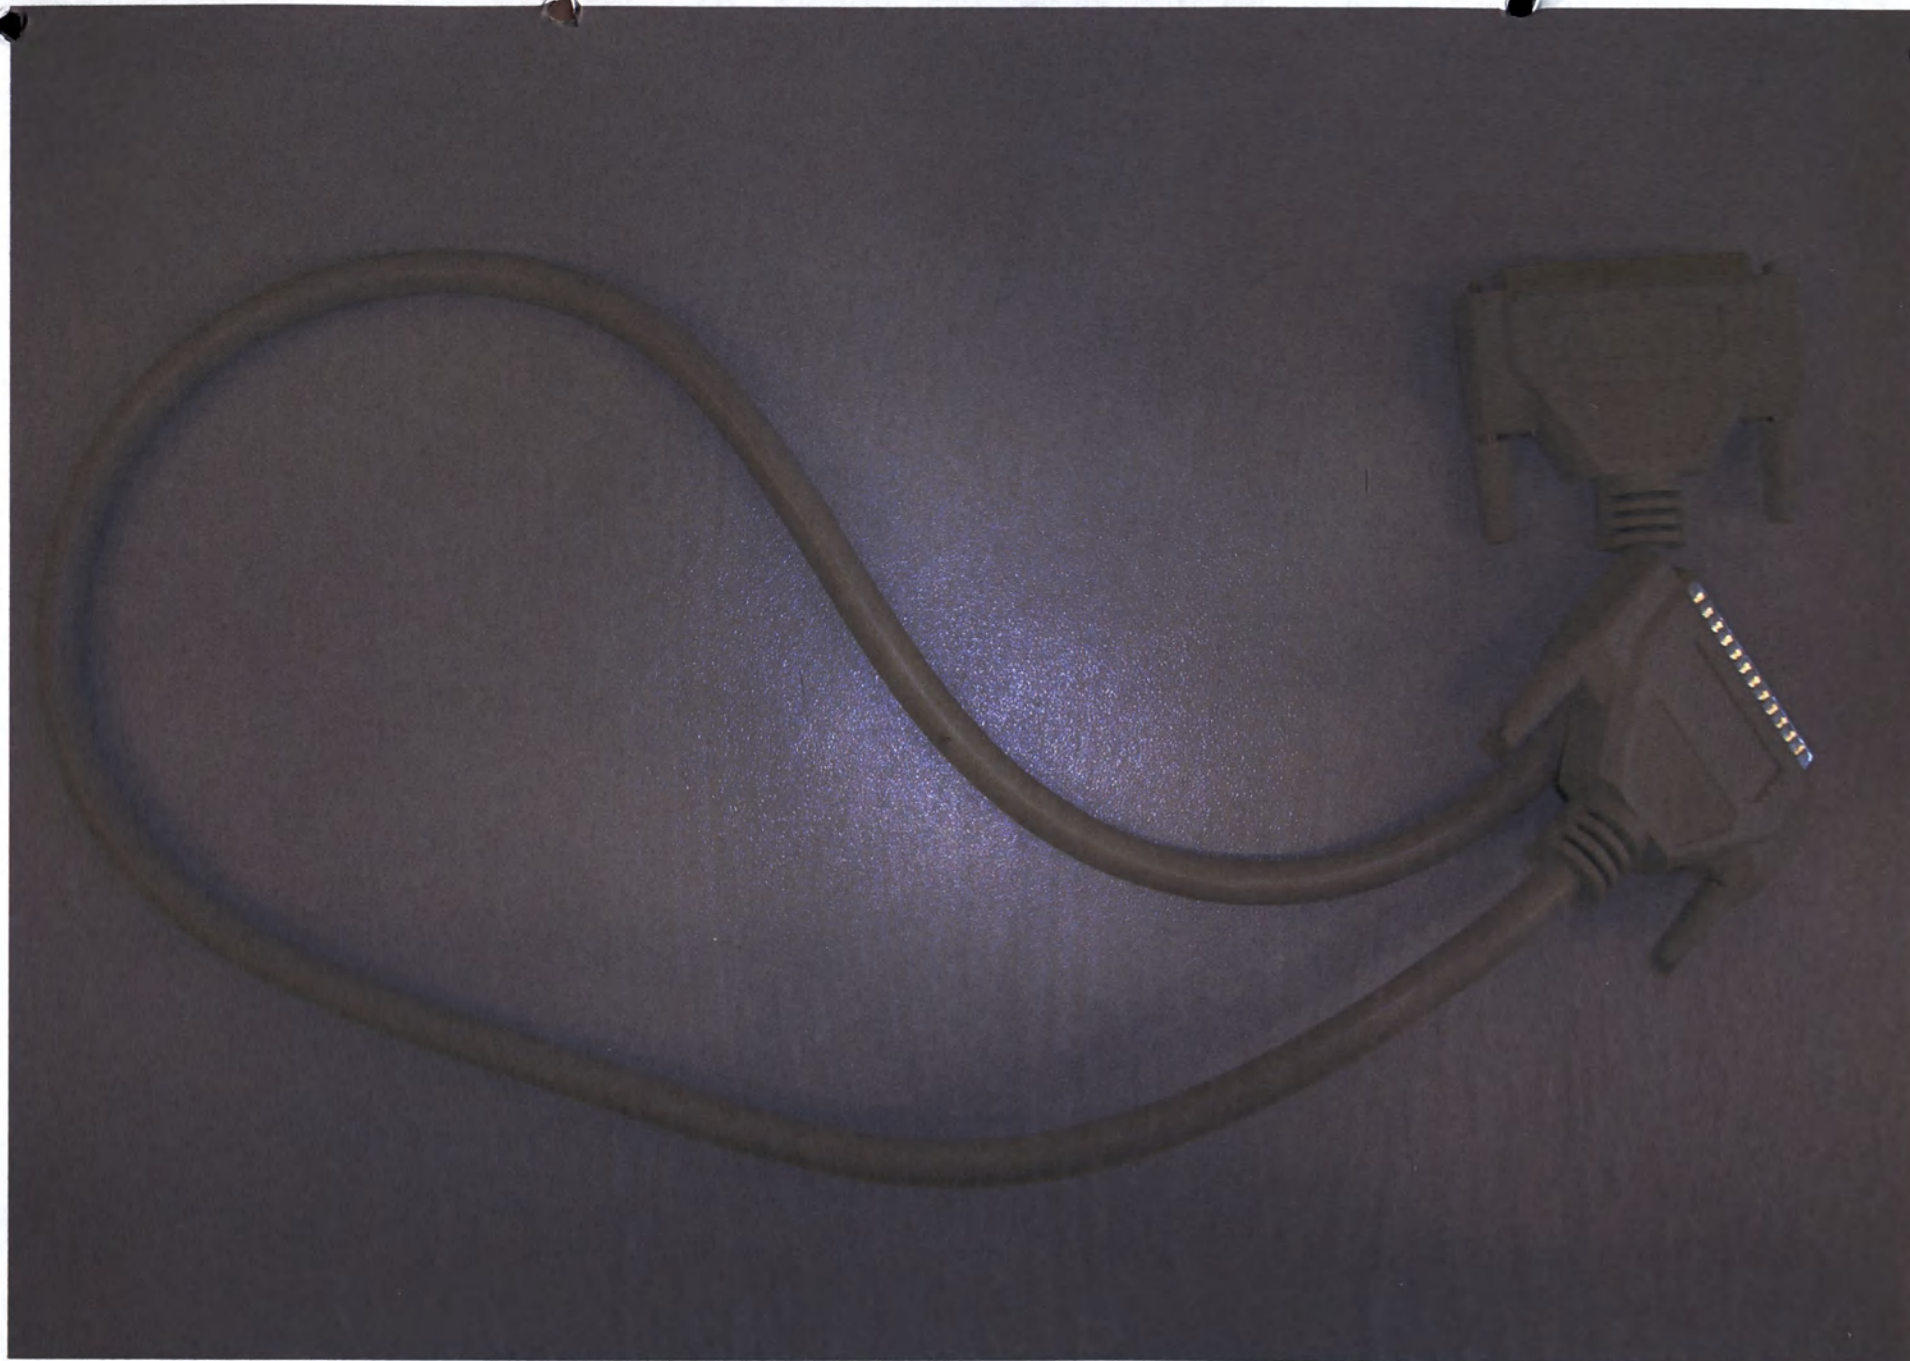


Кабель соединительный DB37M-DB37F

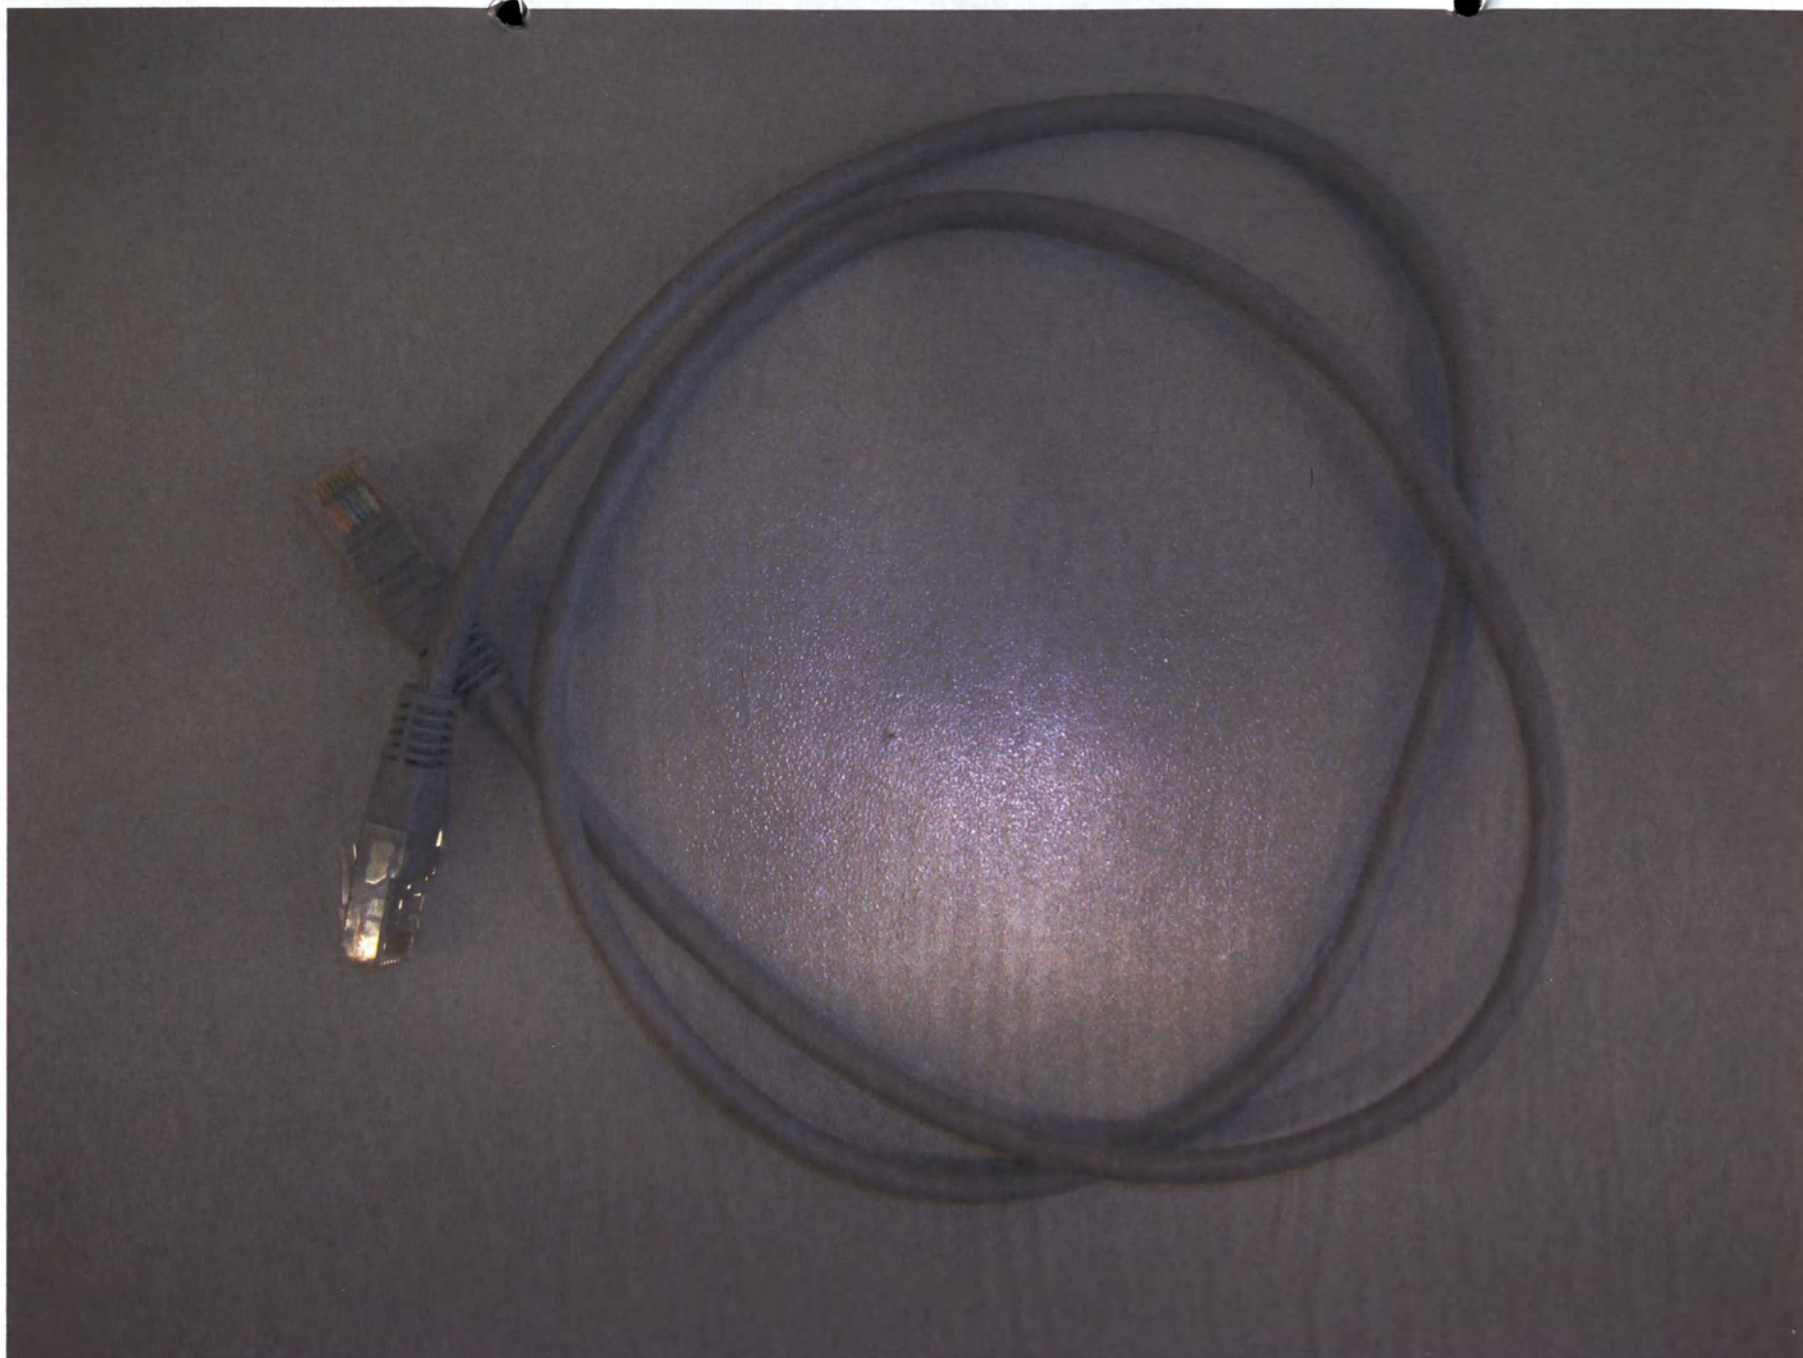

Кабель UTP4 cat.5e "Cabletech"



Шнур сетевой PC-186-VDE "Gembird"

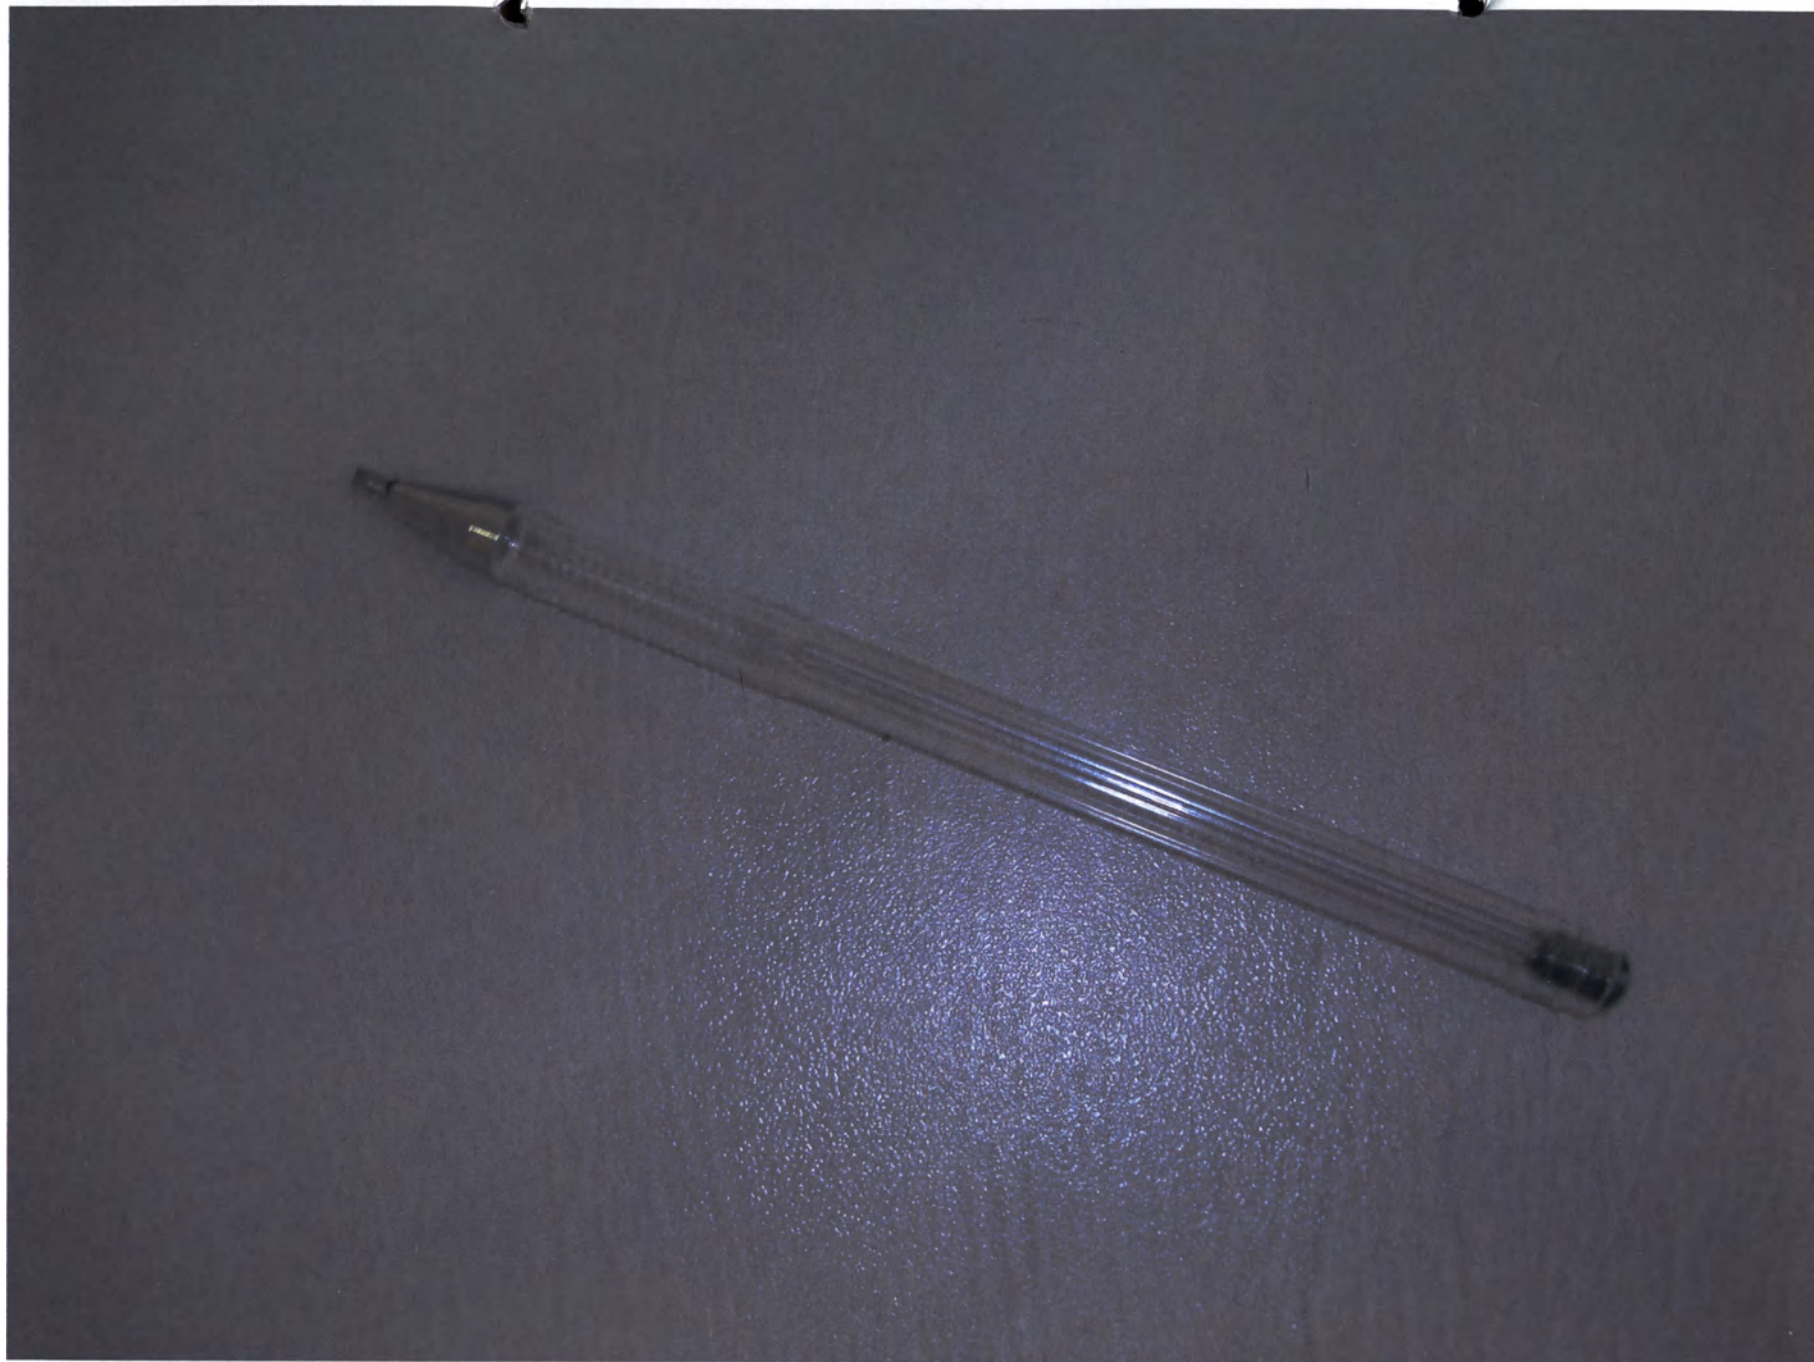

Скалыватель волоконно-оптического инструмента BK60M Стриппер ST-500ESD



Стриппер ЛИС-ST-500 Jonard



Ключи блокировки SRL-5-D-S-2