


ОБЩИЙ ВИД АППАРАТА

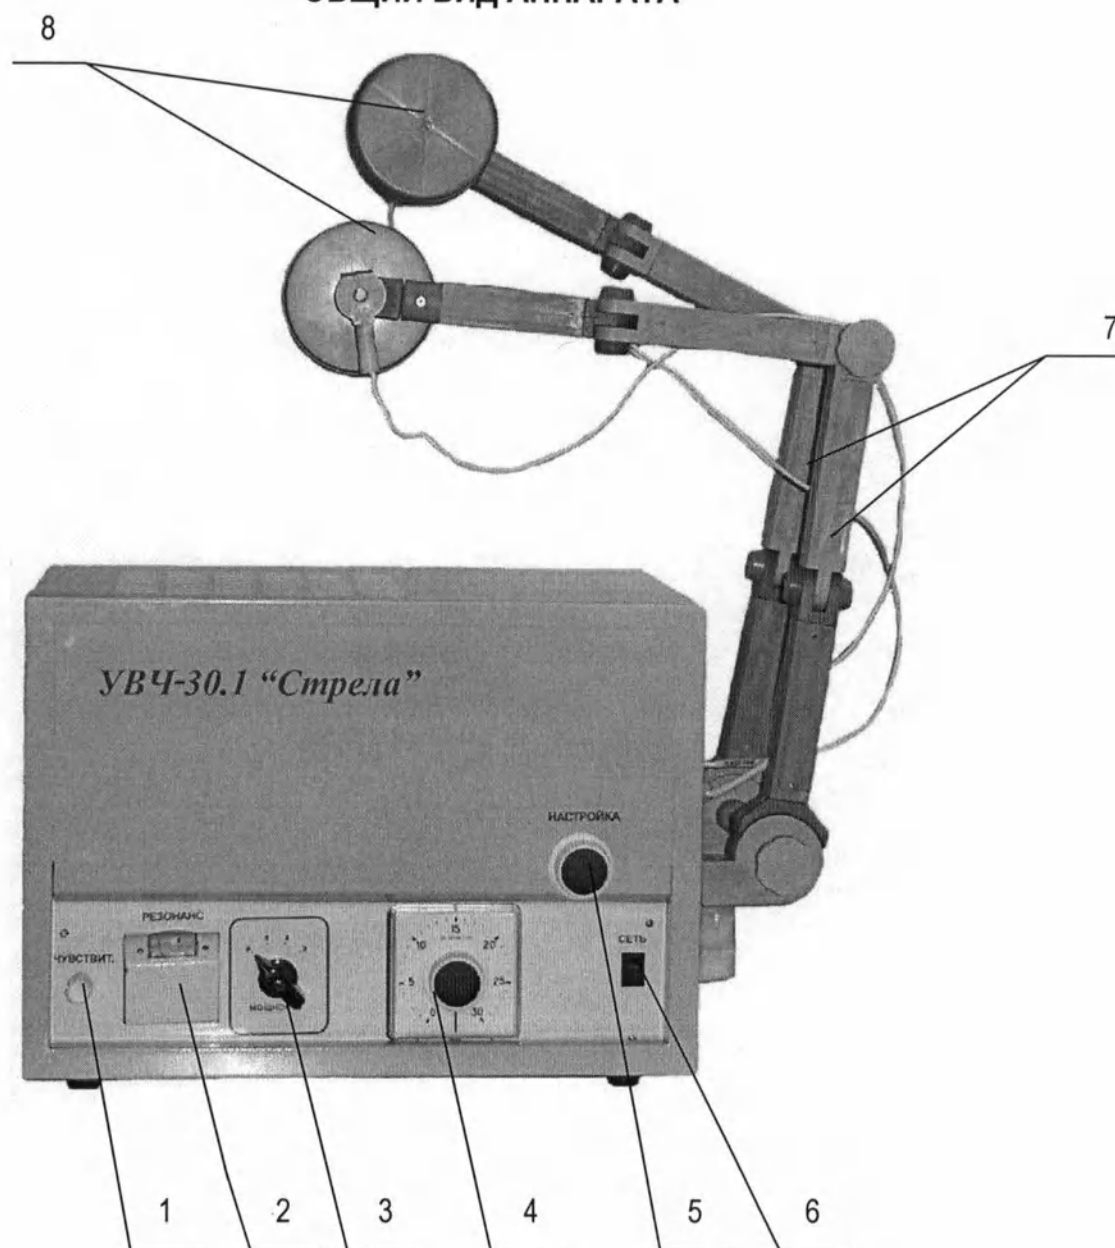

1. Ручка ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ;
2. Индикаторный прибор РЕЗОНАНС;
3. Переключатель МОЩНОСТЬ;
4. Часы процедурные;
5. Ручка НАСТРОЙКА;
6. Тумблер СЕТЬ;
7. Электрододержатели;
8. Электроды.

Рис. 1

					ЯКУЛ.941525.002 РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		8