

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель

генерального директора

ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России



А.А. Костин

2016 г.

**Оценка соответствия медицинского изделия в форме клинических  
испытаний**

**Фото предоставленного медицинского изделия.**

**Микробиореактор БАВР.422522.001 по ТУ 9443-001-89584548-2014,  
разработанный ООО НТЦ «БиоКлиникум» 115088, г. Москва, ул.  
Угрешская, д.2, стр.85.**

Фотографии объекта испытаний:

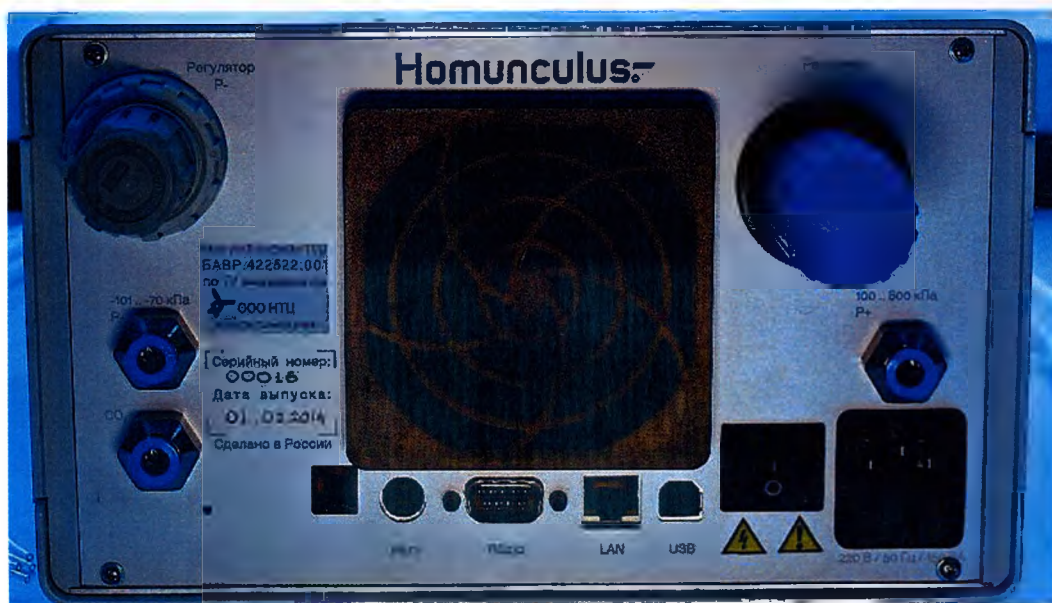


Рисунок 1 – Вид сзади. Маркировка медицинского изделия.

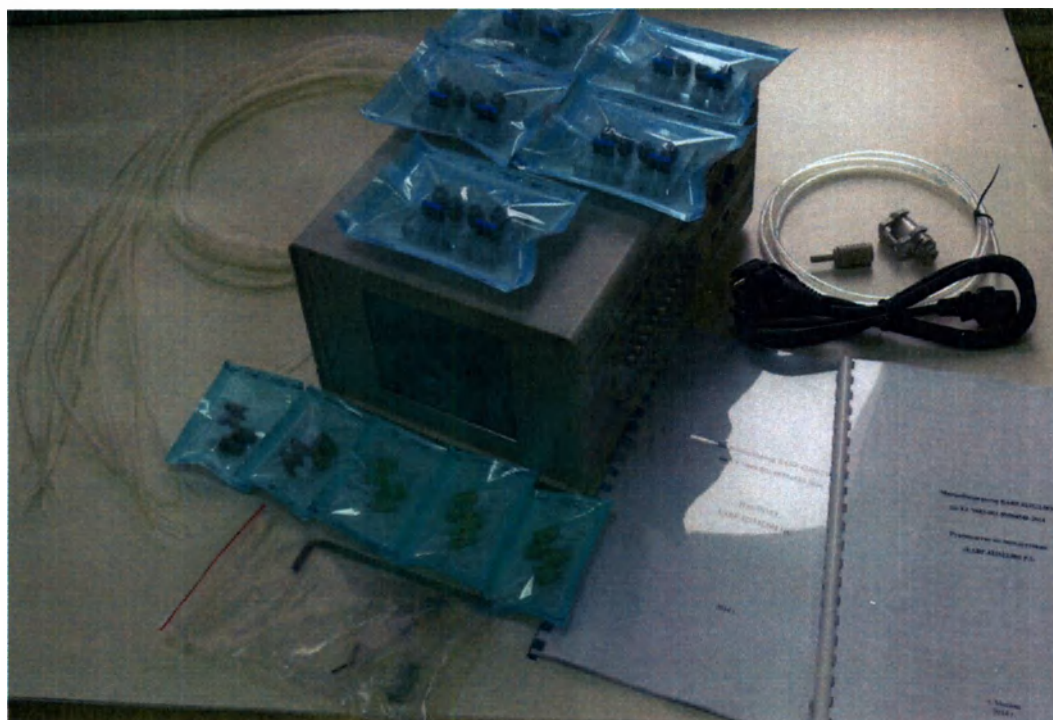


Рисунок 2 – Общий вид медицинского изделия.

Всего прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 2 листов.

Первый заместитель генерального  
директора ФГБУ "НМИРЦ" Минздрава  
России

А. А. Костин

