



Фотографическое изображение

**Катетер для гистеросальпингографии
производства «Аргон Медикал Девайсес, Инк.» (Argon Medical Devices, Inc.)**

1. Катетер для гистеросальпингографии 5.5F×40 см в комплекте со шприцом 2 мл

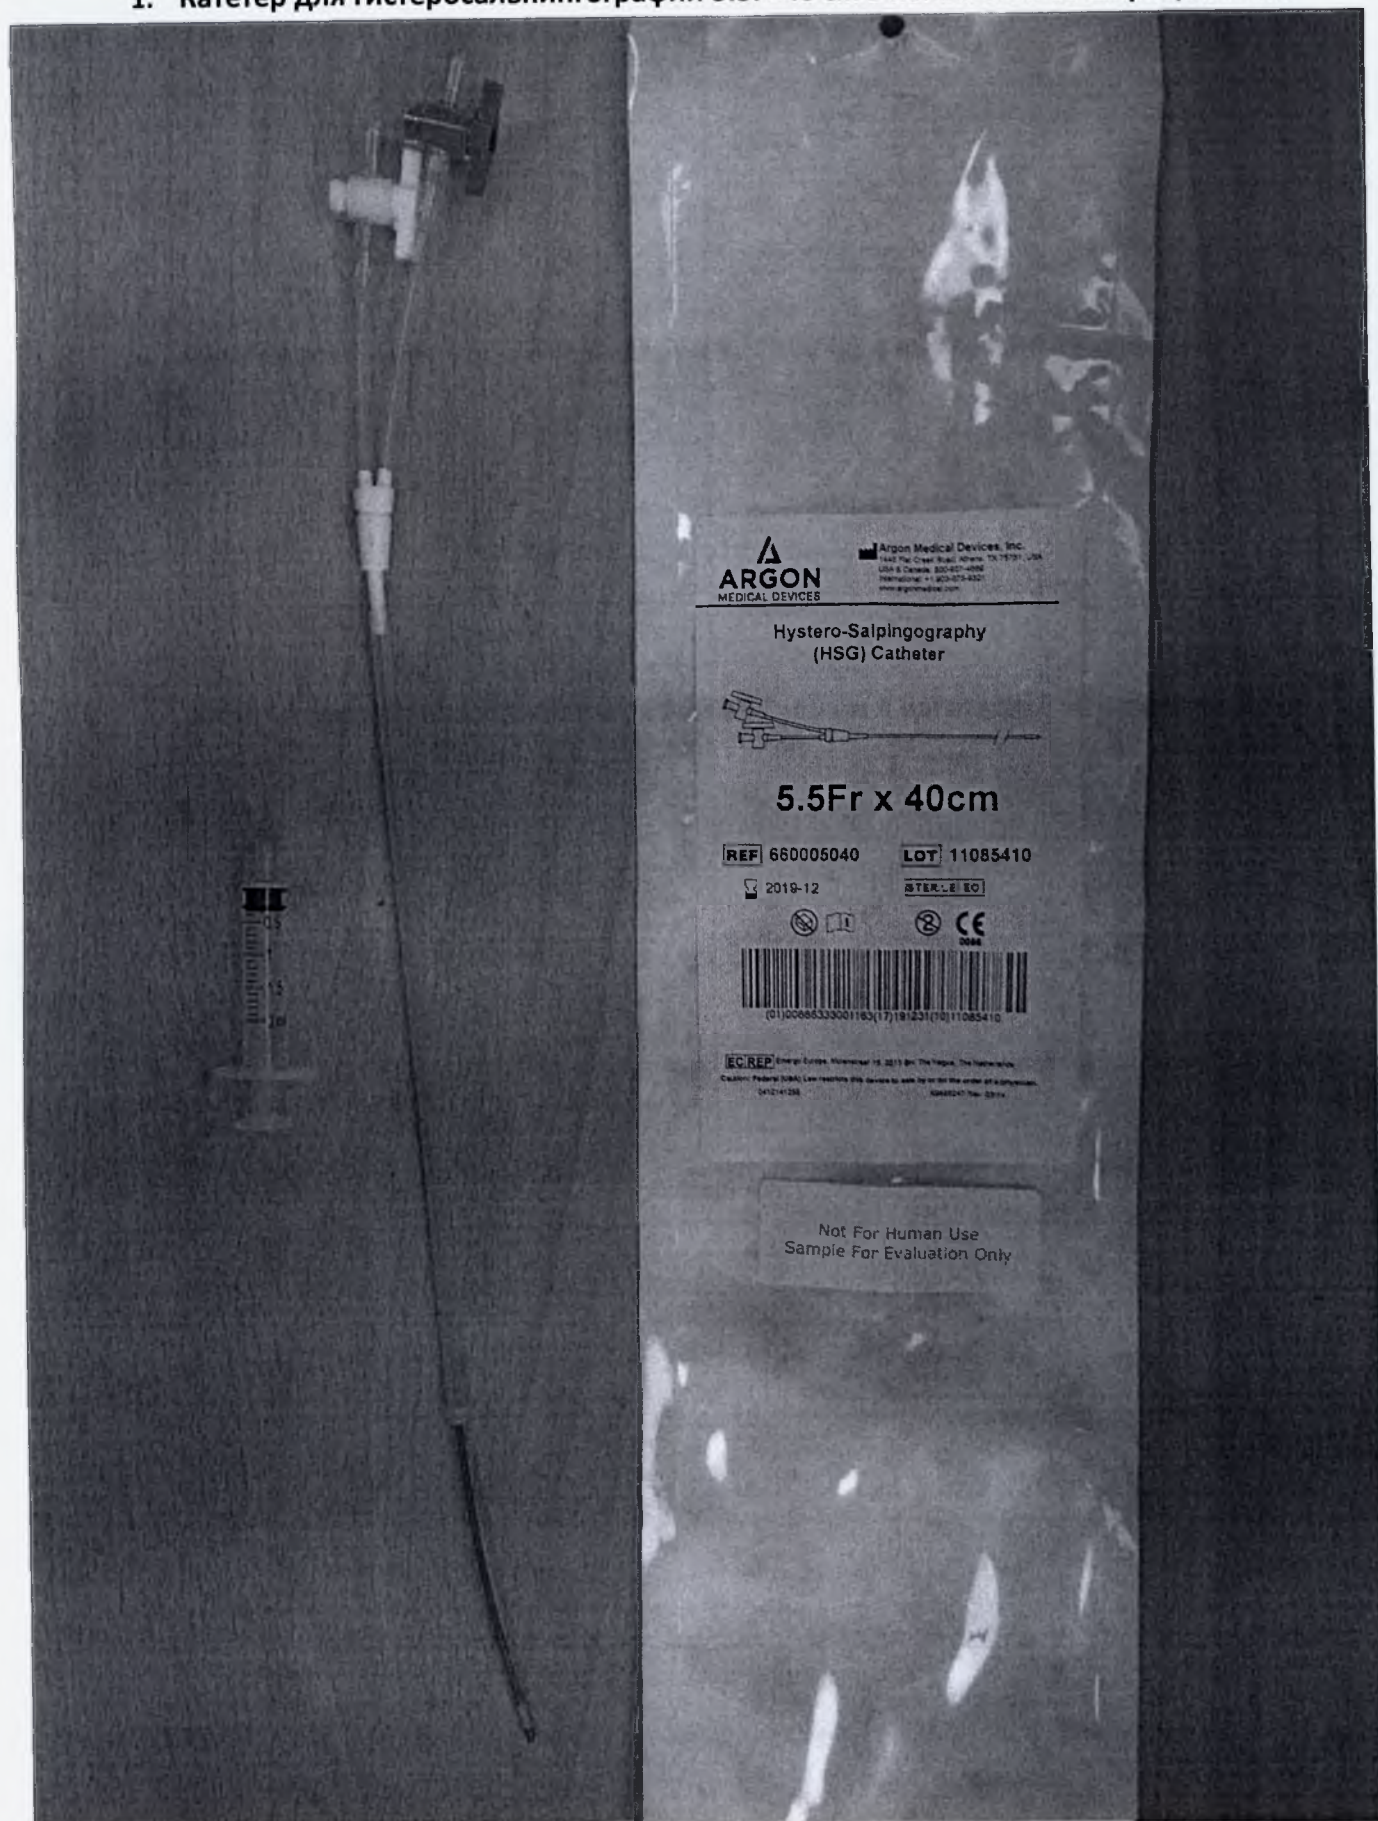

2. Катетер для гистеросальпингографии 7F×40 см в комплекте со шприцом 3 мл.

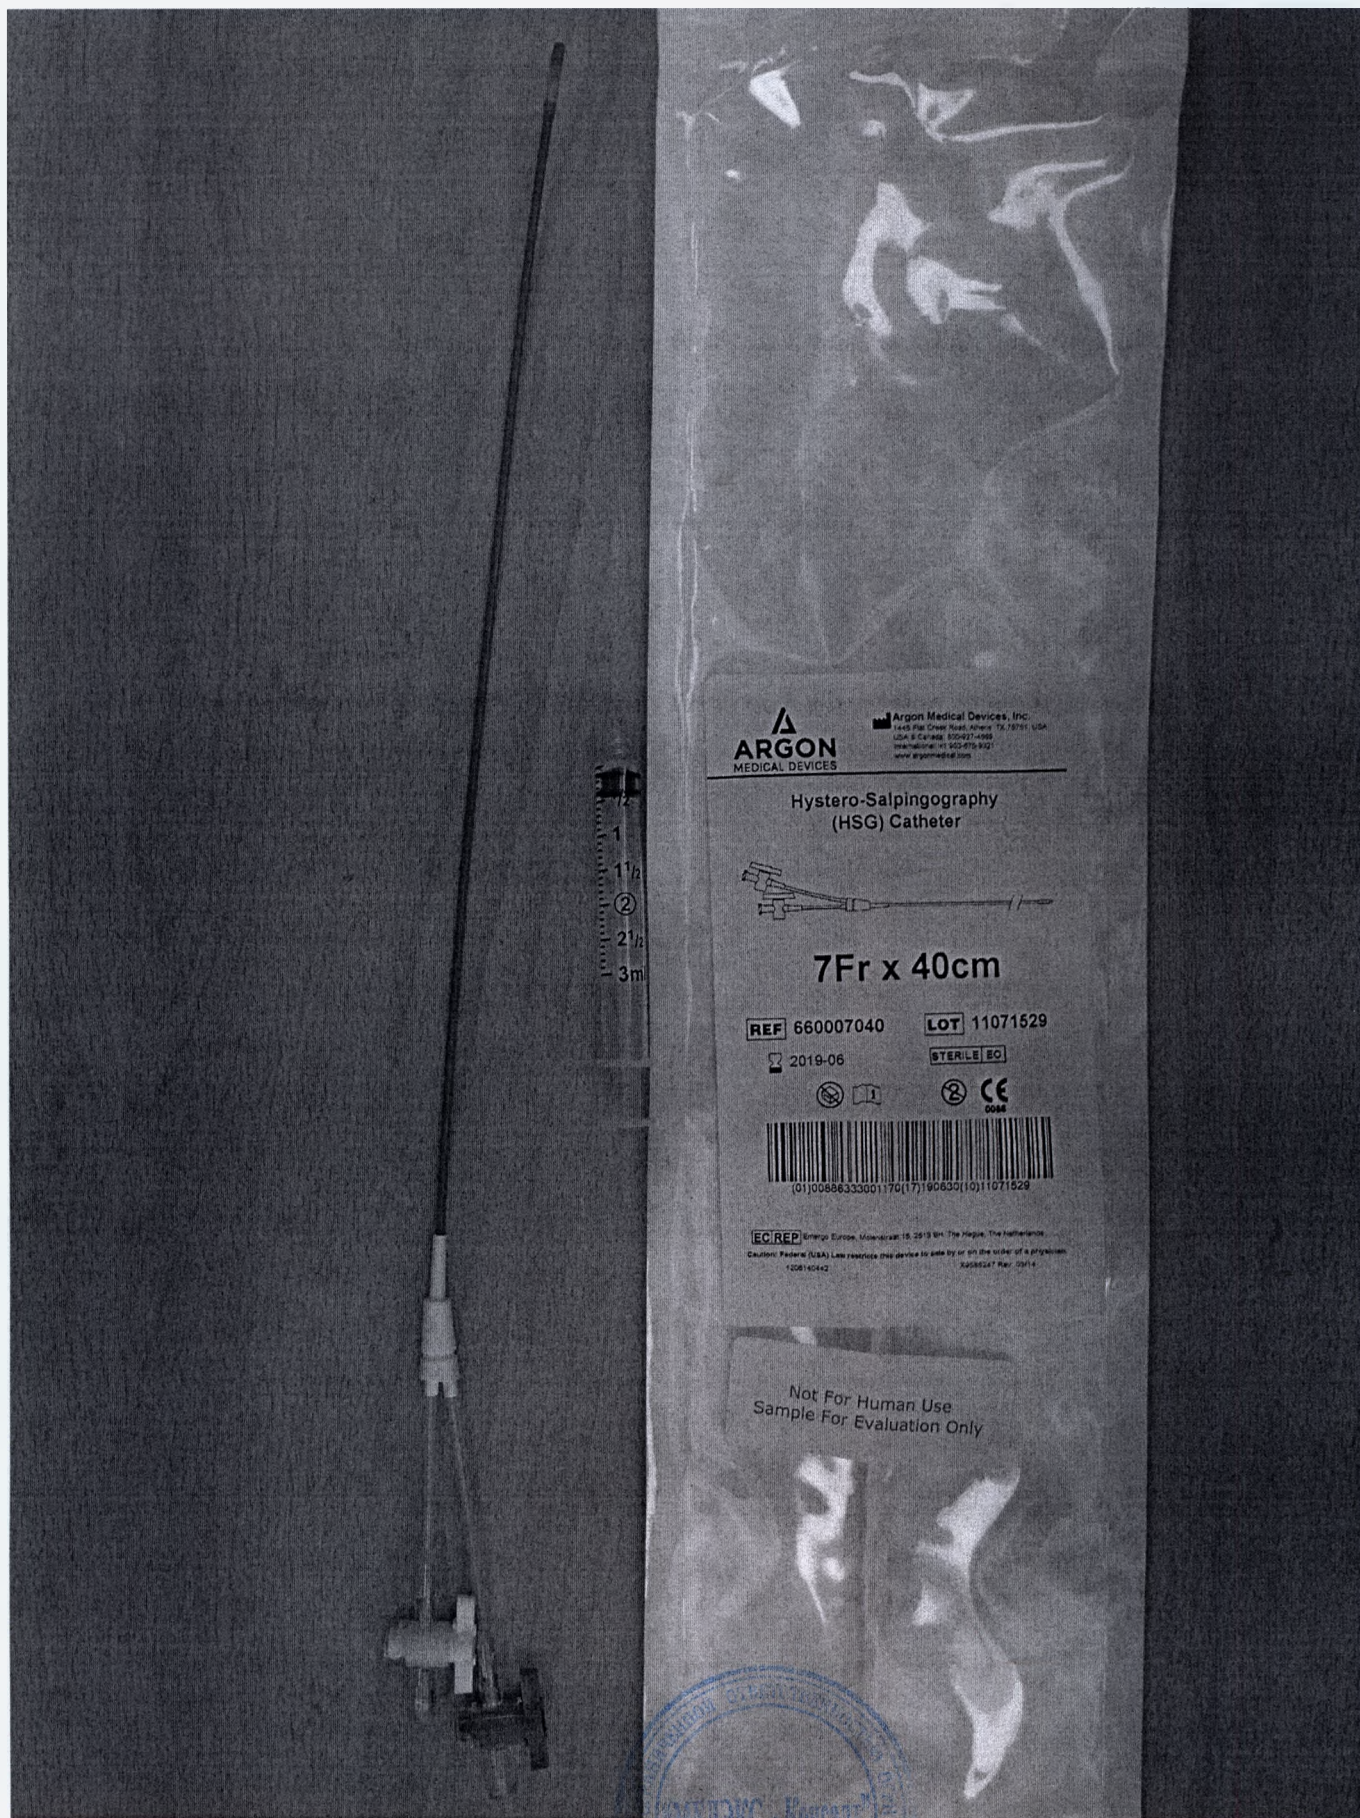

Генеральный директор
ООО «МЕДЭКС – Консалт»

«24» июня 2015
Т.В. Нам

Всего пронумеровано, сшито и
скреплено печатью и подписью 3 листов

Генеральный директор

ООО «МЕДЭКС-Консалт»


Нам Т.В. _____



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ


Катетер для гистеросальпингографии

производства «Аргон Медикал Девайсес, Инк.» (Argon Medical Devices, Inc.)

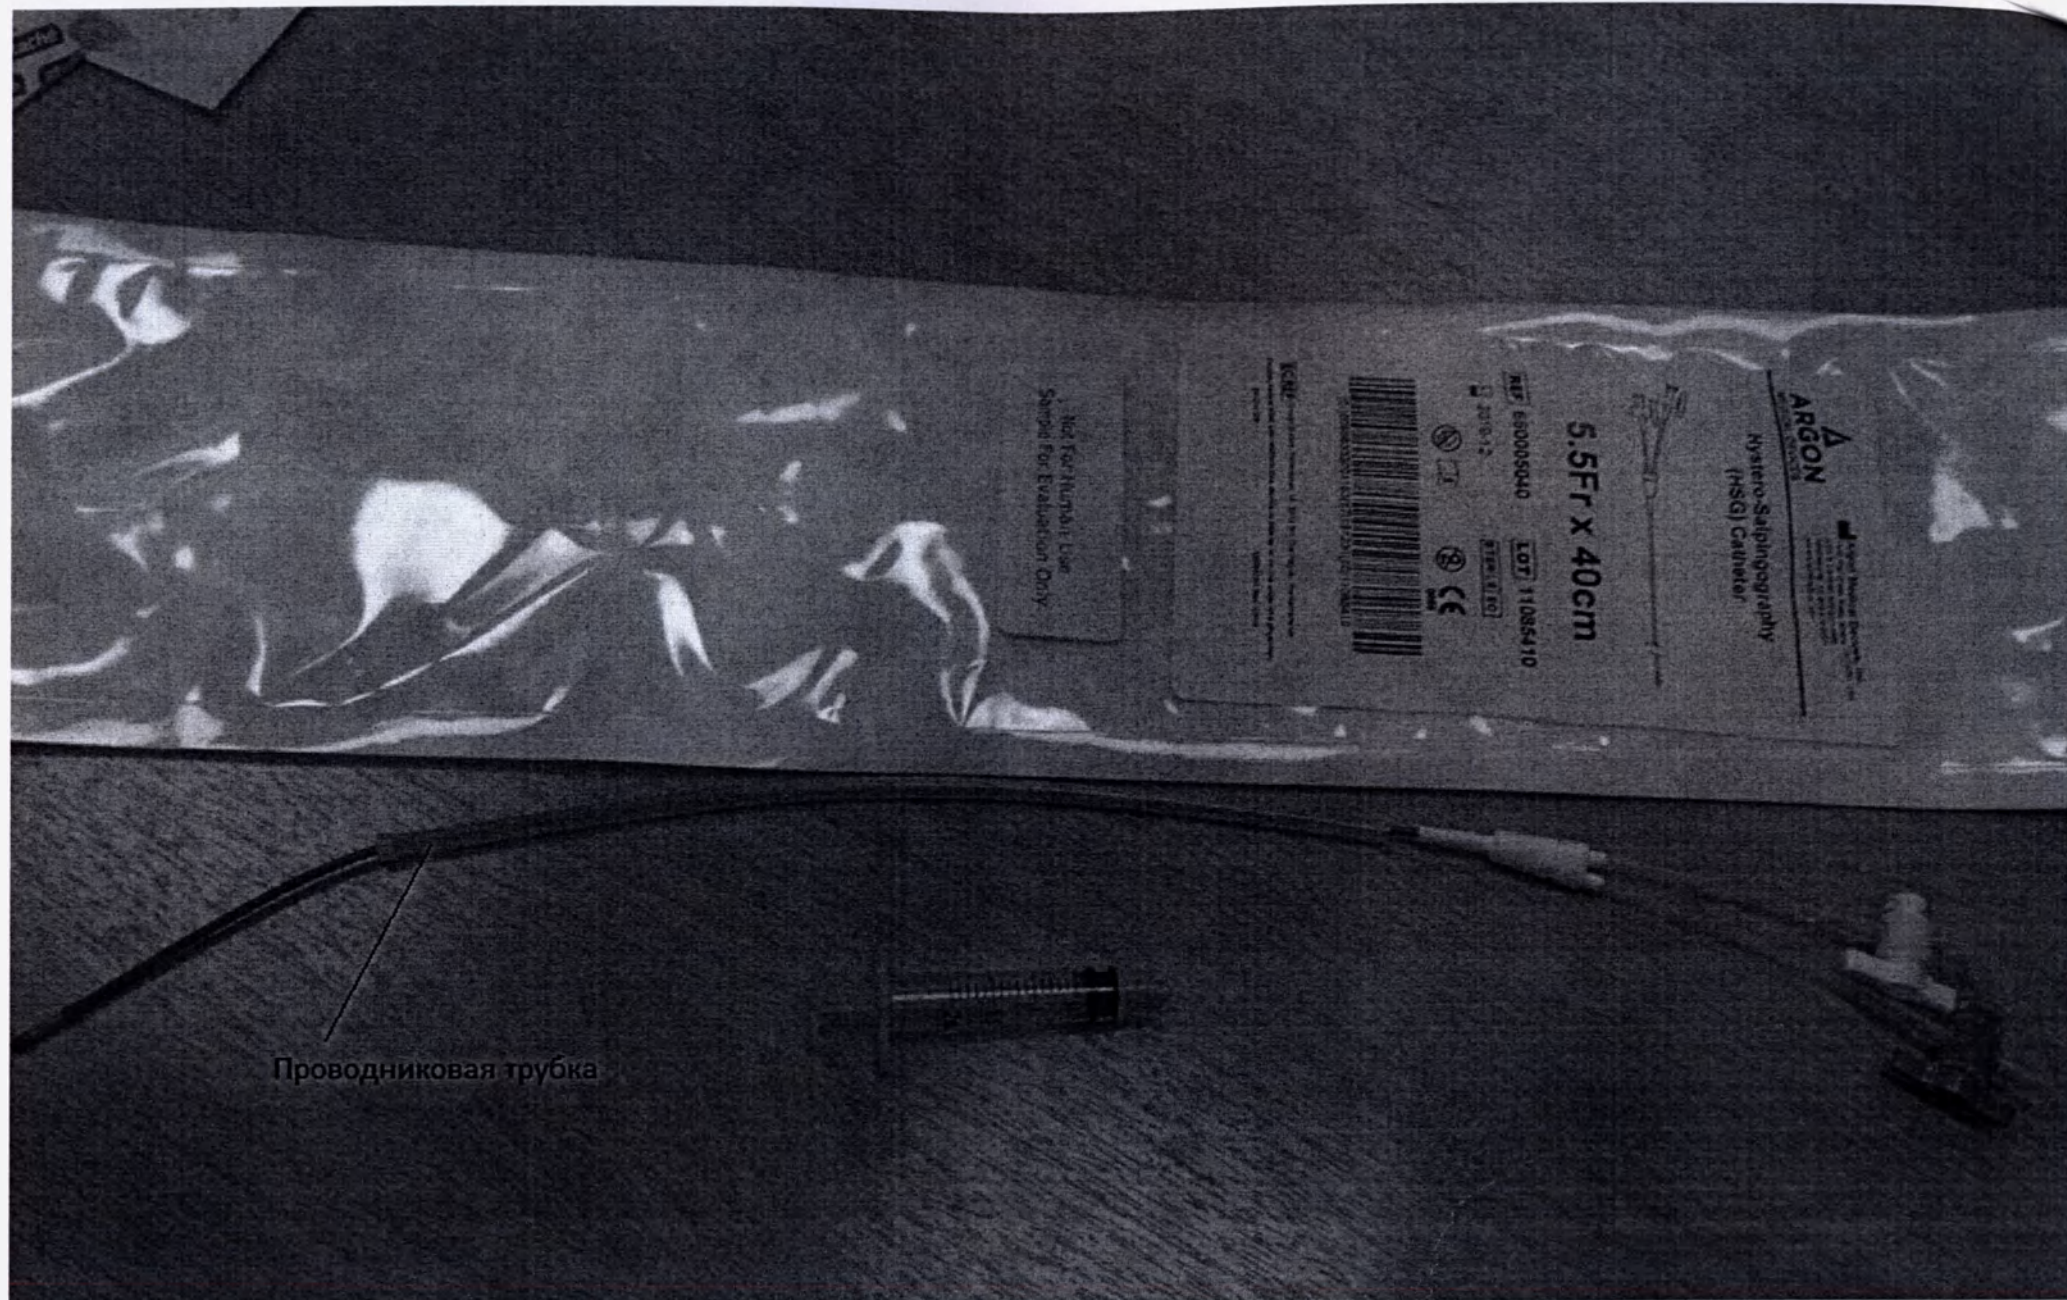

Проводниковая трубка

Катетер для гистеросальпингографии 5.5F×40 см в комплекте со шприцом 2 мл

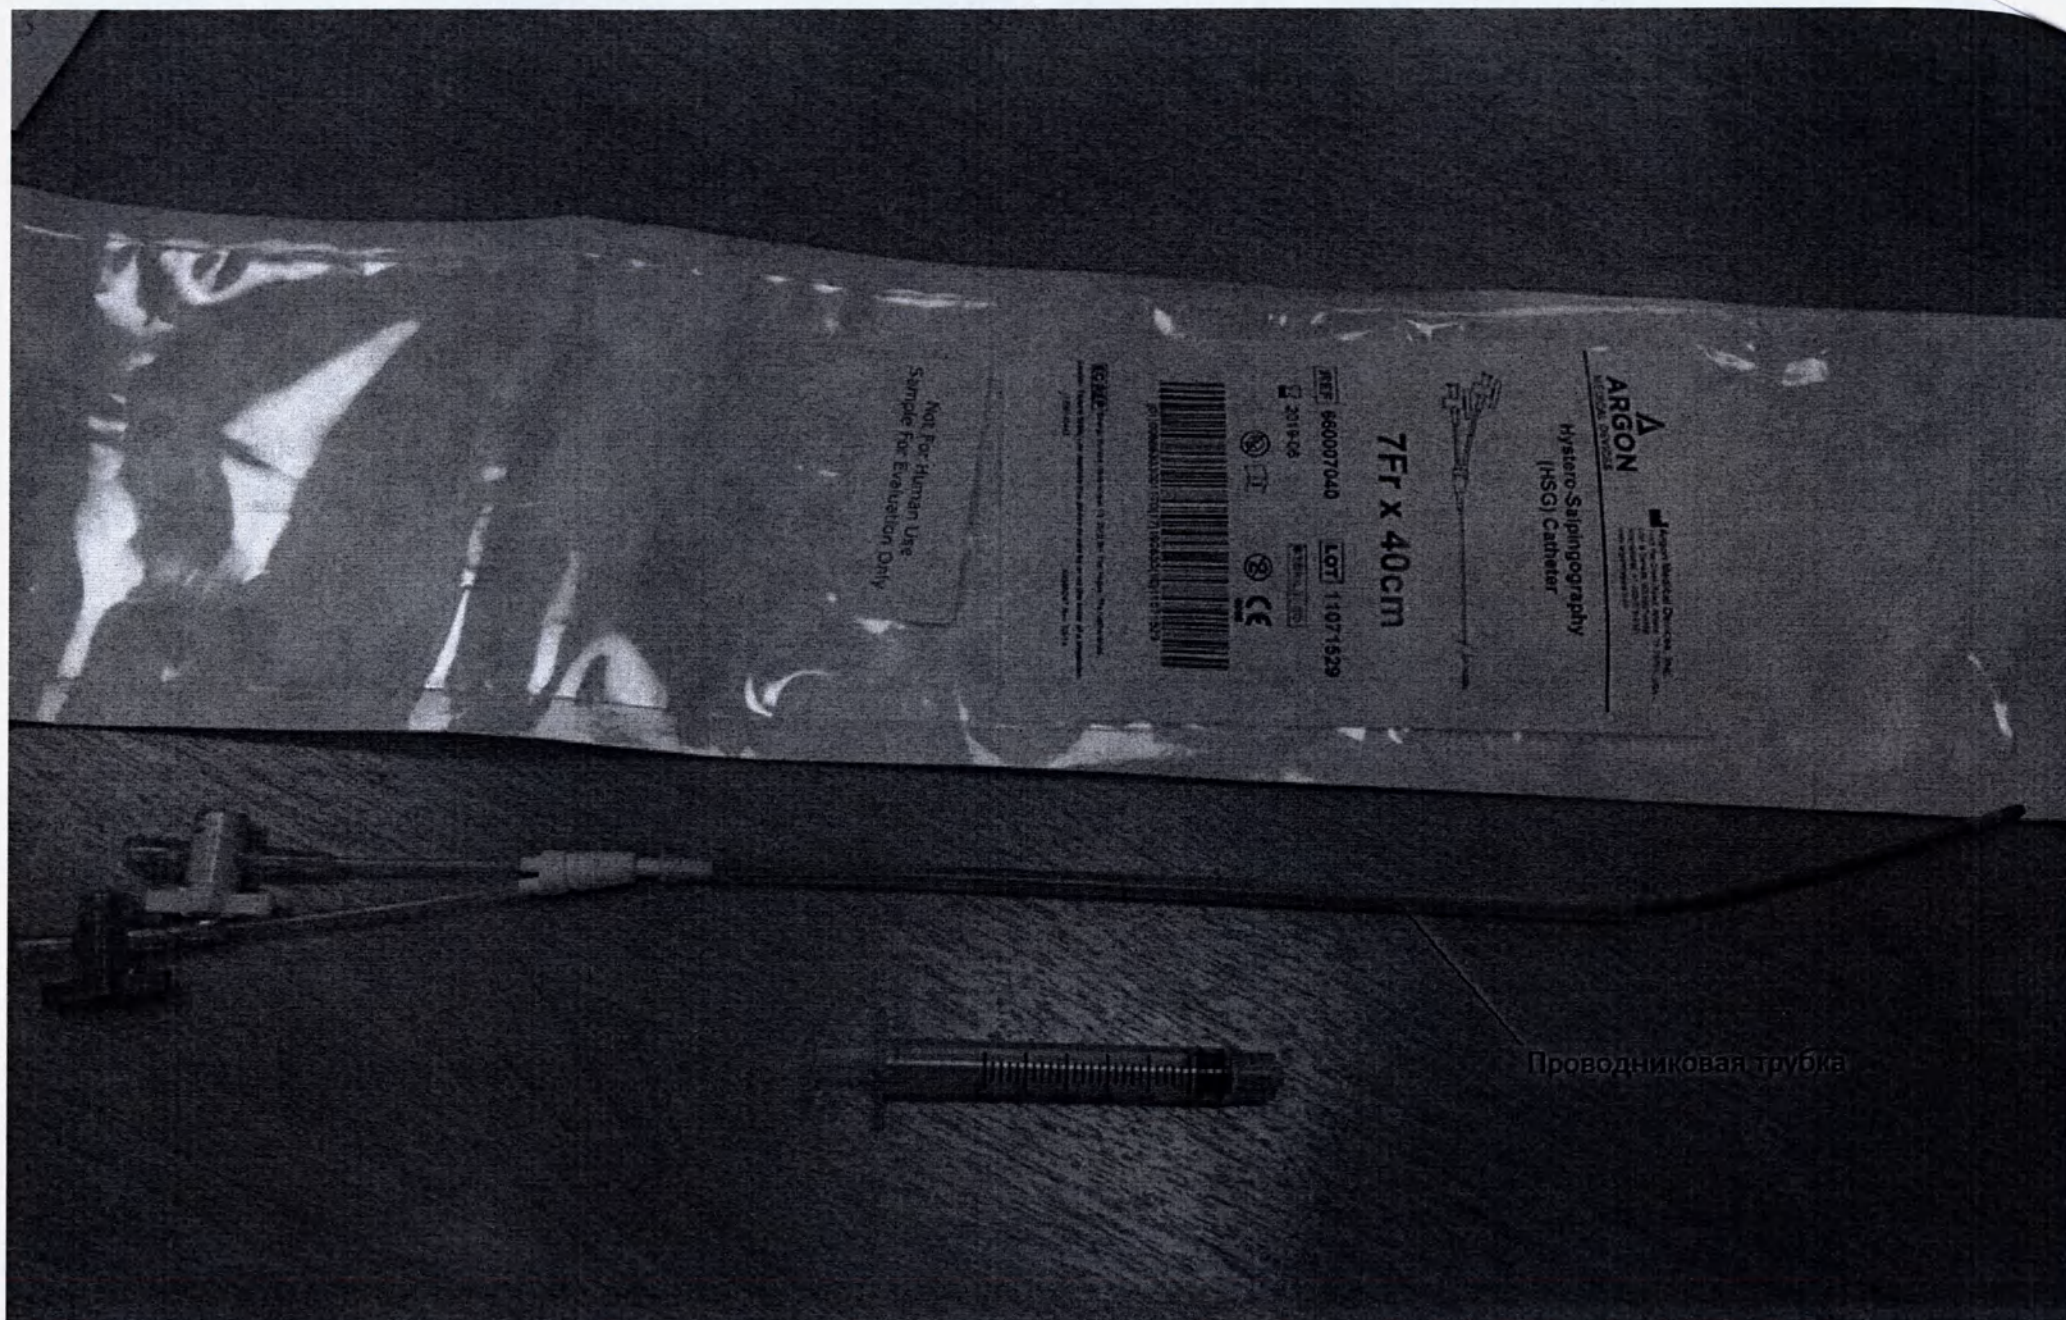

Катетер для гистеросальпингографии 7F×40 см в комплекте со шприцом 3 мл

Всего пронумеровано, сшито и
скреплено печатью и подписью 3 листов
Генеральный директор
ООО «МЕДЭКС-Консалт»
Нам Т.В. [подпись]