

Утверждаю

ООО «Диалюджик»

Чиняев Г.В.



Фотографическое изображение медицинского изделия

Система динамической спектральной кольповизуализации DySIS с принадлежностями

I. Система динамической спектральной кольповизуализации DySIS в сборе с дополнительным сенсорным монитором, или без него:

1. Рабочий узел-рука.
2. Основной блок.
3. Монитор.


II. Принадлежности:

1. Дополнительный сенсорный монитор (опция).
2. Зеркало вагинальное многоцветное узкое, размеры (S), (M), (L) – до 20 шт..
3. Зеркало вагинальное многоцветное широкое, размеры (S), (M), (L) – до 20 шт..
4. Зеркало вагинальное однократное – до 100 шт.
5. Спрей-аппликатор уксусной кислоты сменный (пустой) – до 10 шт..
6. Инструкция по эксплуатации.


производства компании: «DySIS Medical Limited», UK

Г.В.

**Система динамической
спектральной
кольповизуализации DySIS
в сборе с дополнительным
сенсорным монитором**

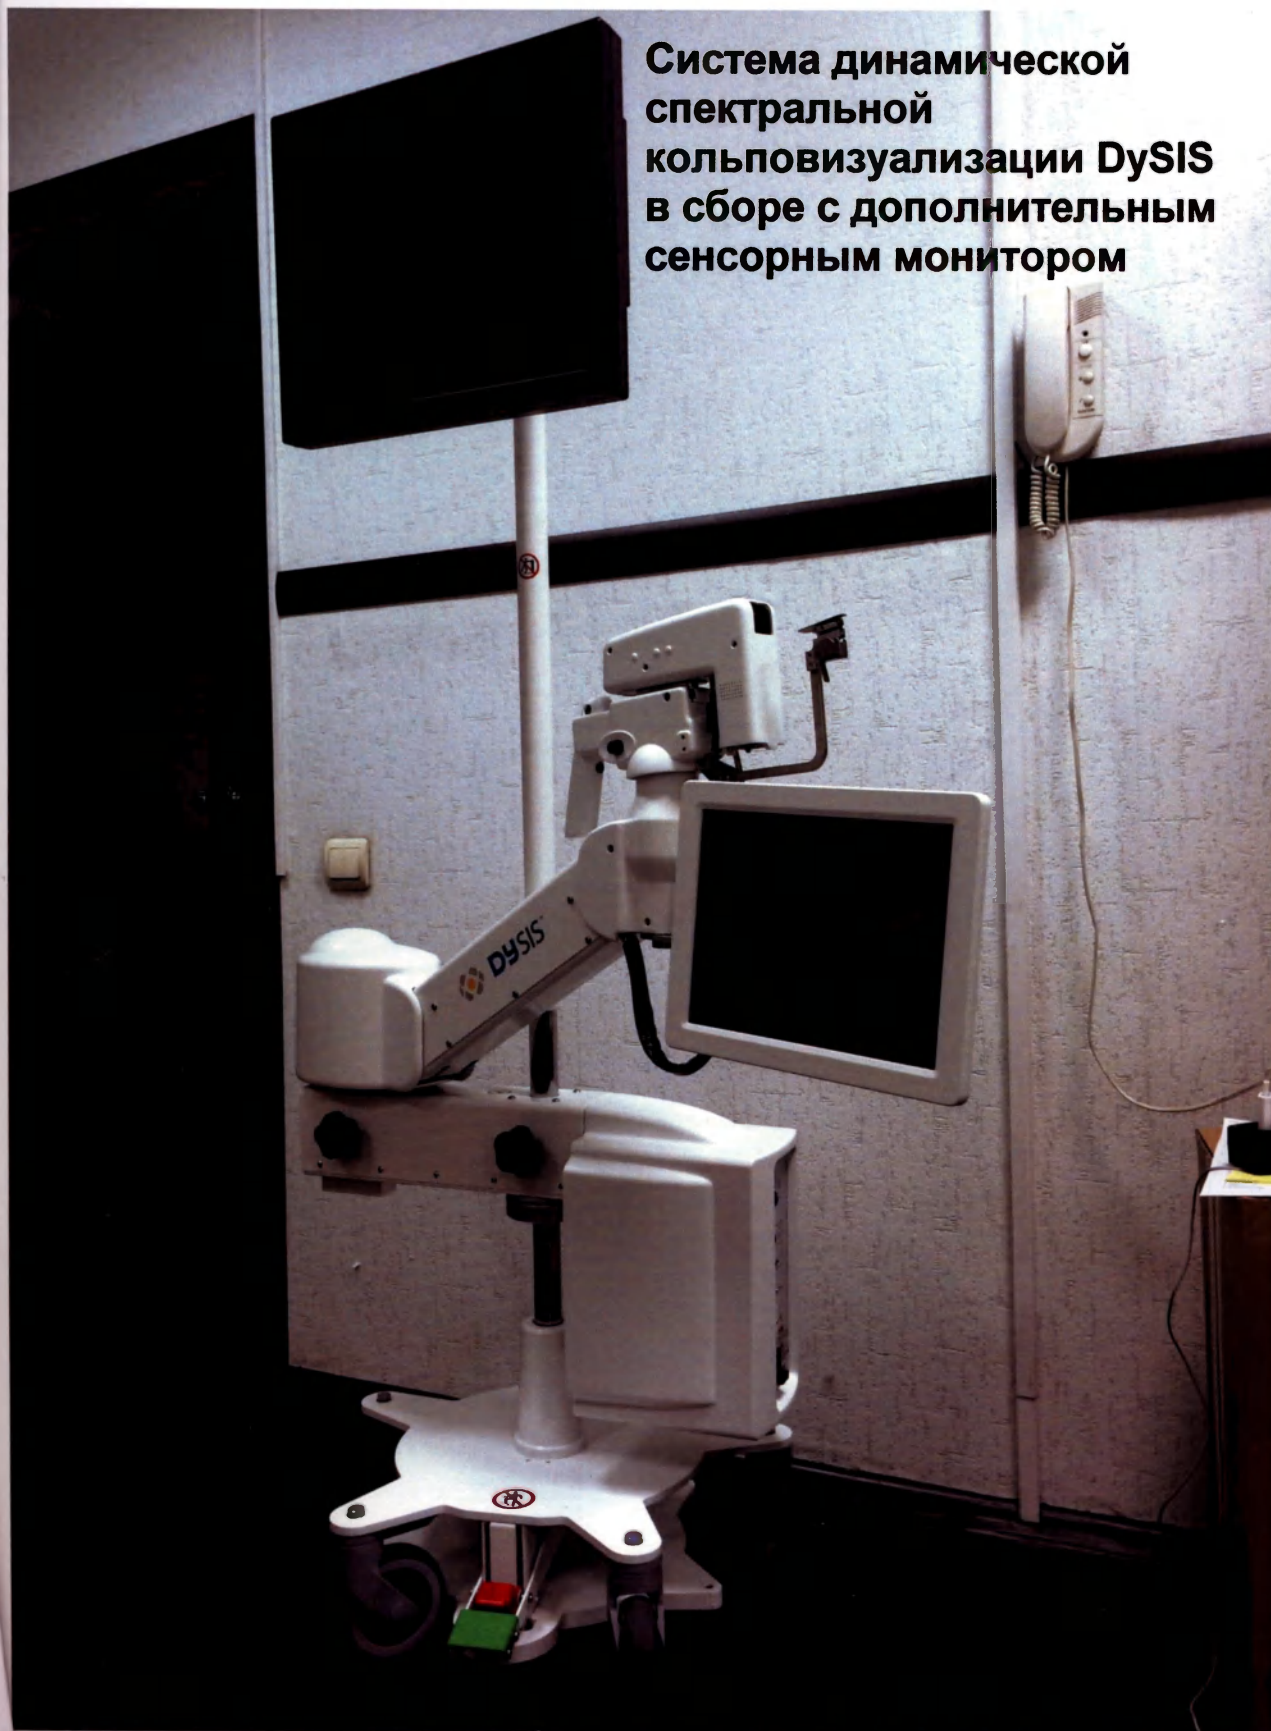

**Система динамической
спектральной
кольповизуализации DySIS
в сборе без дополнительного
монитора**

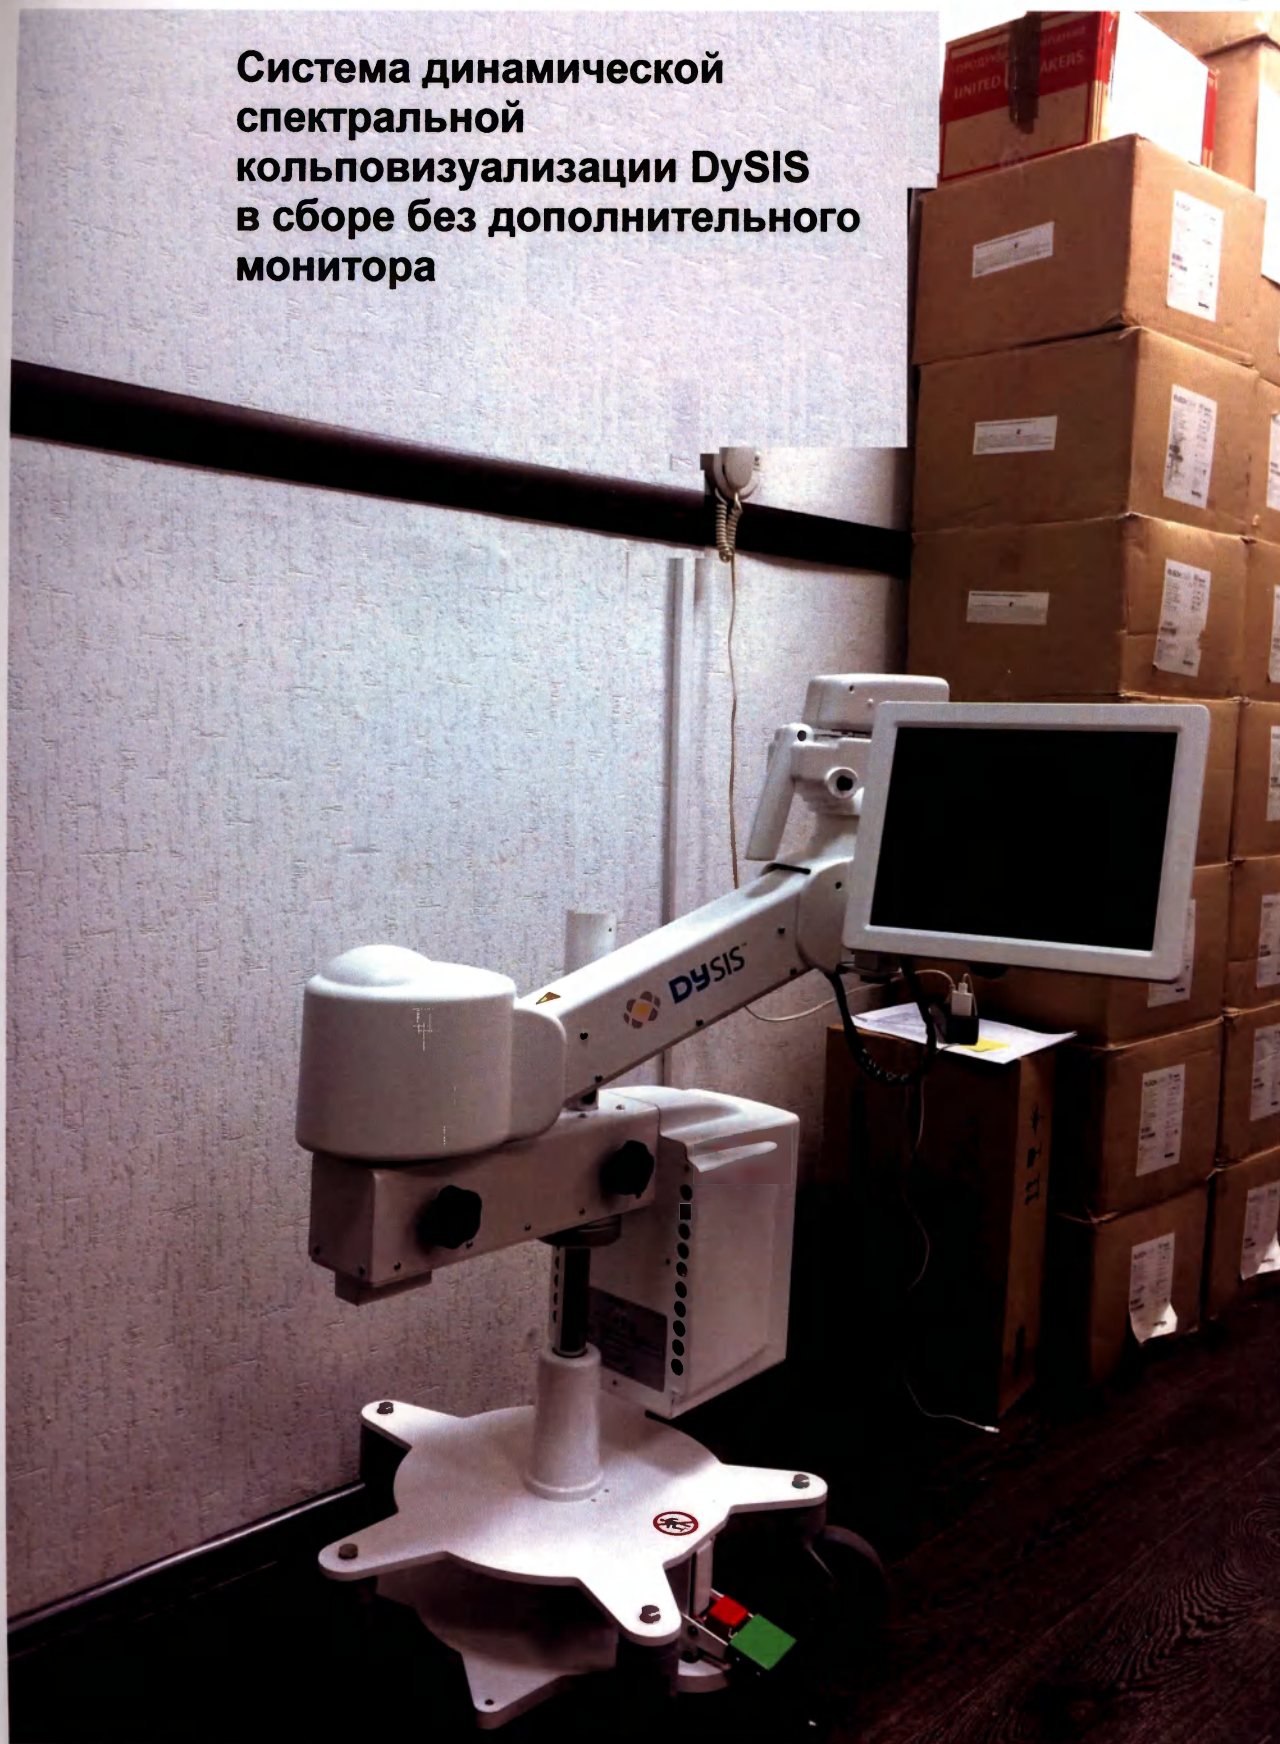

Рабочий узел-рука
системы динамической
спектральной
кольповизуализации DySIS



Основной блок системы динамической спектральной кольпо- визуализации DySIS



Монитор

*Элемент системы динамической спектральной
кольповизуализации DySIS*



Дополнительный сенсорный монитор





**Зеркало вагинальное
многоразовое узкое**
к системе динамической спектральной
кольповизуализации DySIS

**Зеркало вагинальное многоразовое широкое
к системе динамической спектральной
кольповизуализации DySIS**





Зеркало вагинальное одноразовое
к системе динамической спектральной кольповизуализации DySIS

**Спрей-аппликатор уксусной кислоты сменный
(пустой) к системе динамической спектральной
кольповизуализации DySIS**



Прошито и скреплено -71-
печатью ООО «Диалогик»

Генеральный директор
ООО «Диалогик»



Чиня