




Дополнительная защита от излучения с энергией 511 кэВ для ионизационной камеры

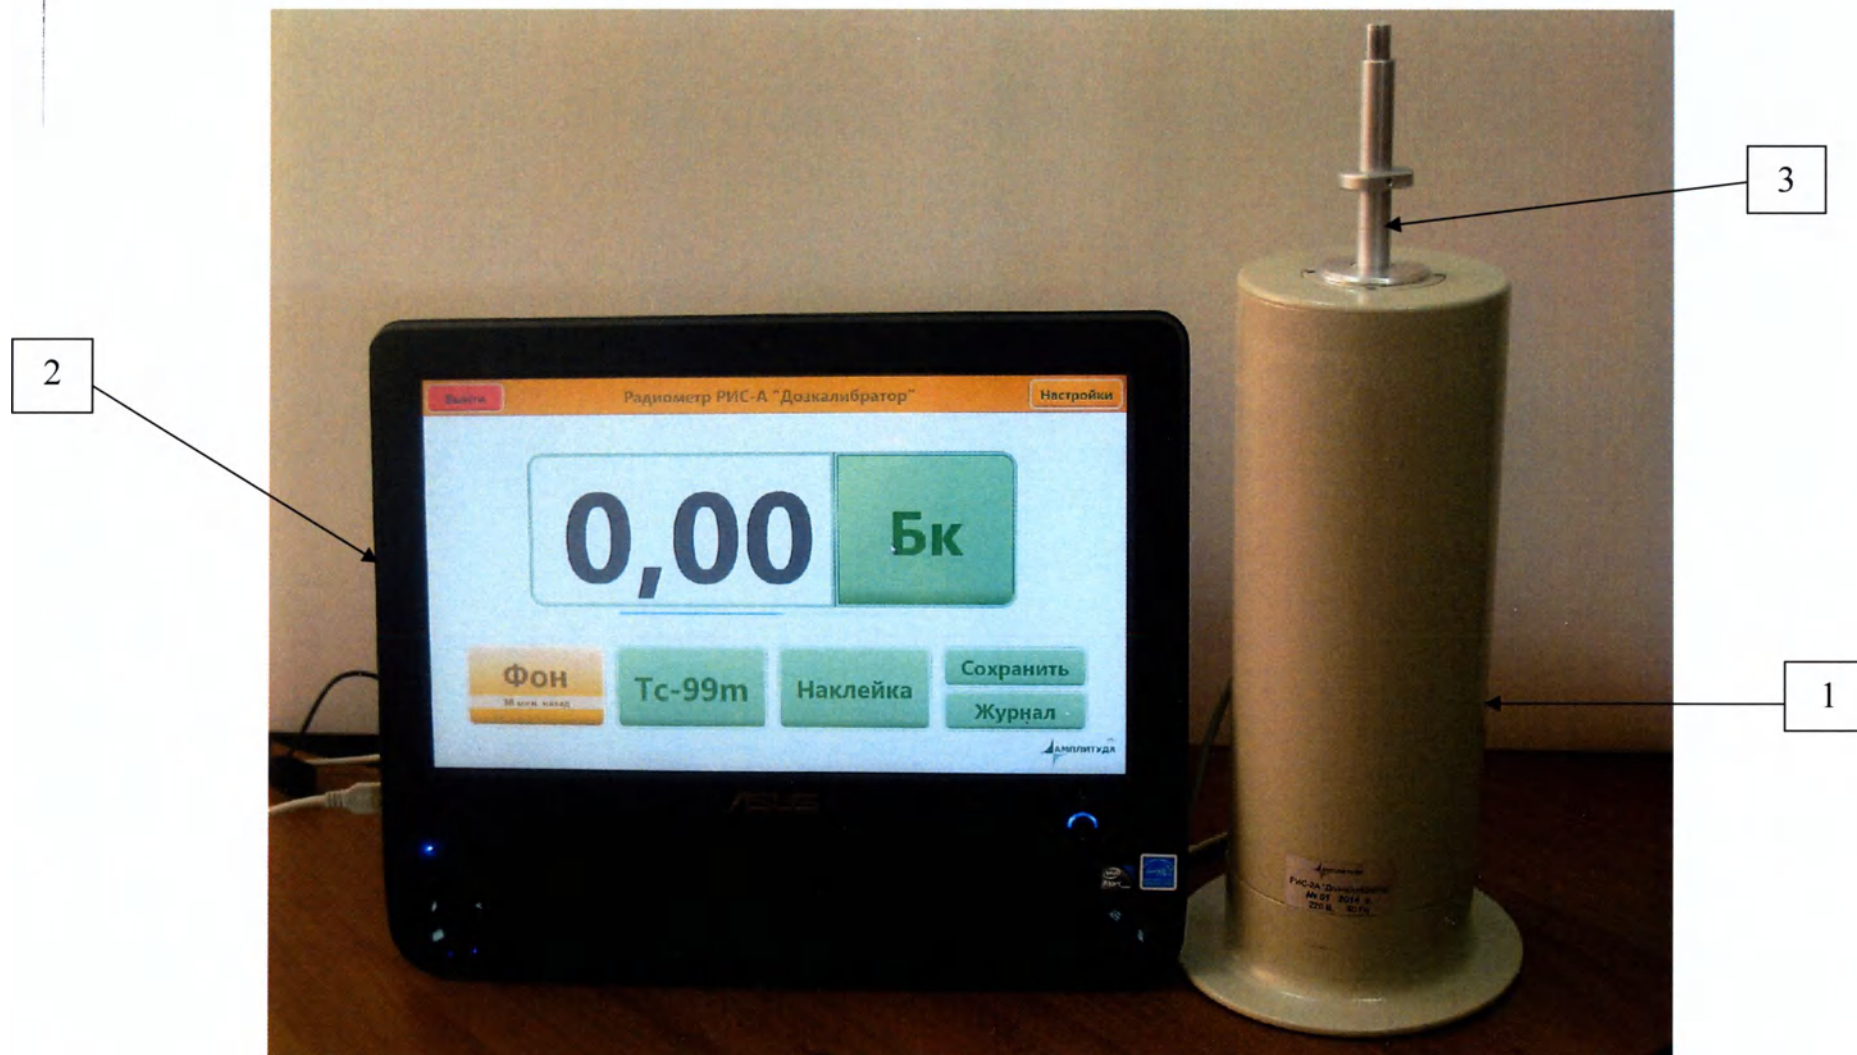

Радиометр активности радионуклидов РИС-2А «Дозкалибратор»

- 1 – устройство детектирования на основе ионизационной камеры типа ИКТ-02А;
2 – ПК с ПО РИС-А; 3 – захват-устройство для флаконов.



Радиометр активности радионуклидов РИС-4А «Дозкалибратор»

1 — устройство детектирования на основе ионизационной камеры типа ИКТ-03А-2;
2 — ПК с ПО РИС-А; 3 — захват-устройство для флаконов; 4 — вставка для шприцев.



Радиометр активности радионуклидов РИС-3А «Дозкалибратор»

- 1 – устройство детектирования на основе ионизационной камеры типа ИКТ-03А-1;
2 – ПК с ПО РИС-А; 3 – захват-устройство для флаконов; 4 – вставка для шприцев.



Радиометр активности радионуклидов РИС-1А «Дозкалибратор»

- 1 — устройство детектирования на основе ионизационной камеры типа ИКТ-01А
- 2 — дисплейный блок
- 3 — вставка для шприцев
- 4 — захват-устройство для флаконов

Прошнуровано и
пронумеровано на 7 листах

Копия верна
Генеральный директор
ООО «НТЦ Амплитуда»
С.А. Ермилов

