

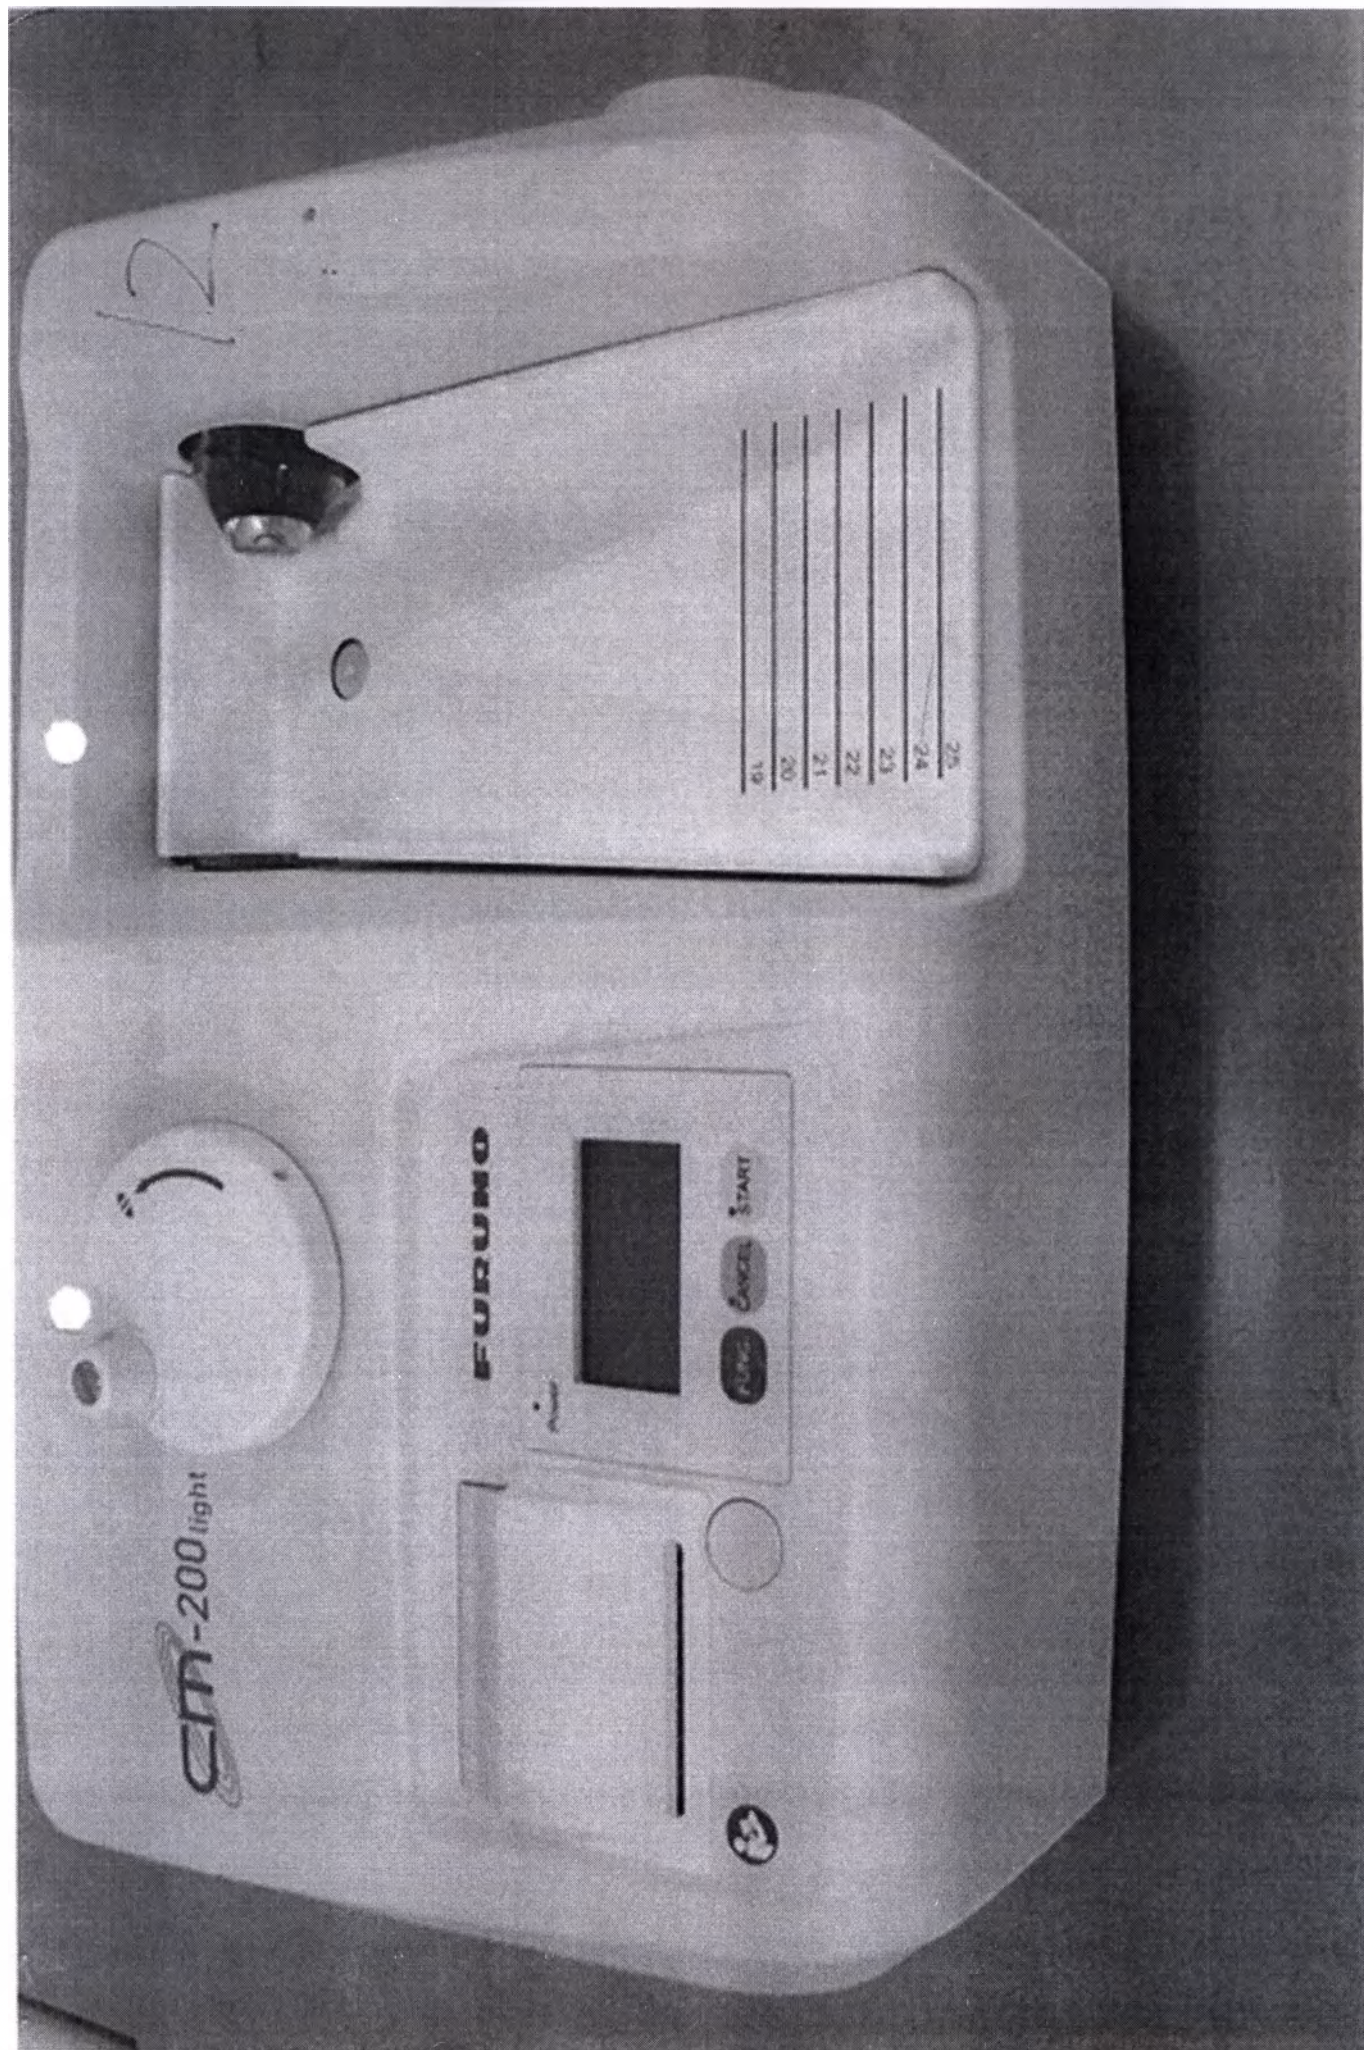


Фото 1. Ультразвуковой костный денситометр CM-200 Лайт. Общий вид изделия

Фото 2. Маркировка изделия

Product name : Ultrasound Bone Densitometer
Serial No. : CM-200 light
Supply Voltage : 7244-0111
Classification : AC100-120V, 50/60Hz, 0.6A (max)
Date of Manufacture : AC200-240V, 50/60Hz, 0.3A (max)
Class : Class I Type B
2014

Manufactured by
FURUNO ELECTRIC CO., LTD
2-20, NISHINOMIYAHAMA, NISHINOMIYA-SHI, JAPAN



AC100-120V / AC200-240V, 50/60Hz
 FUSE 2X AC250V T2AH

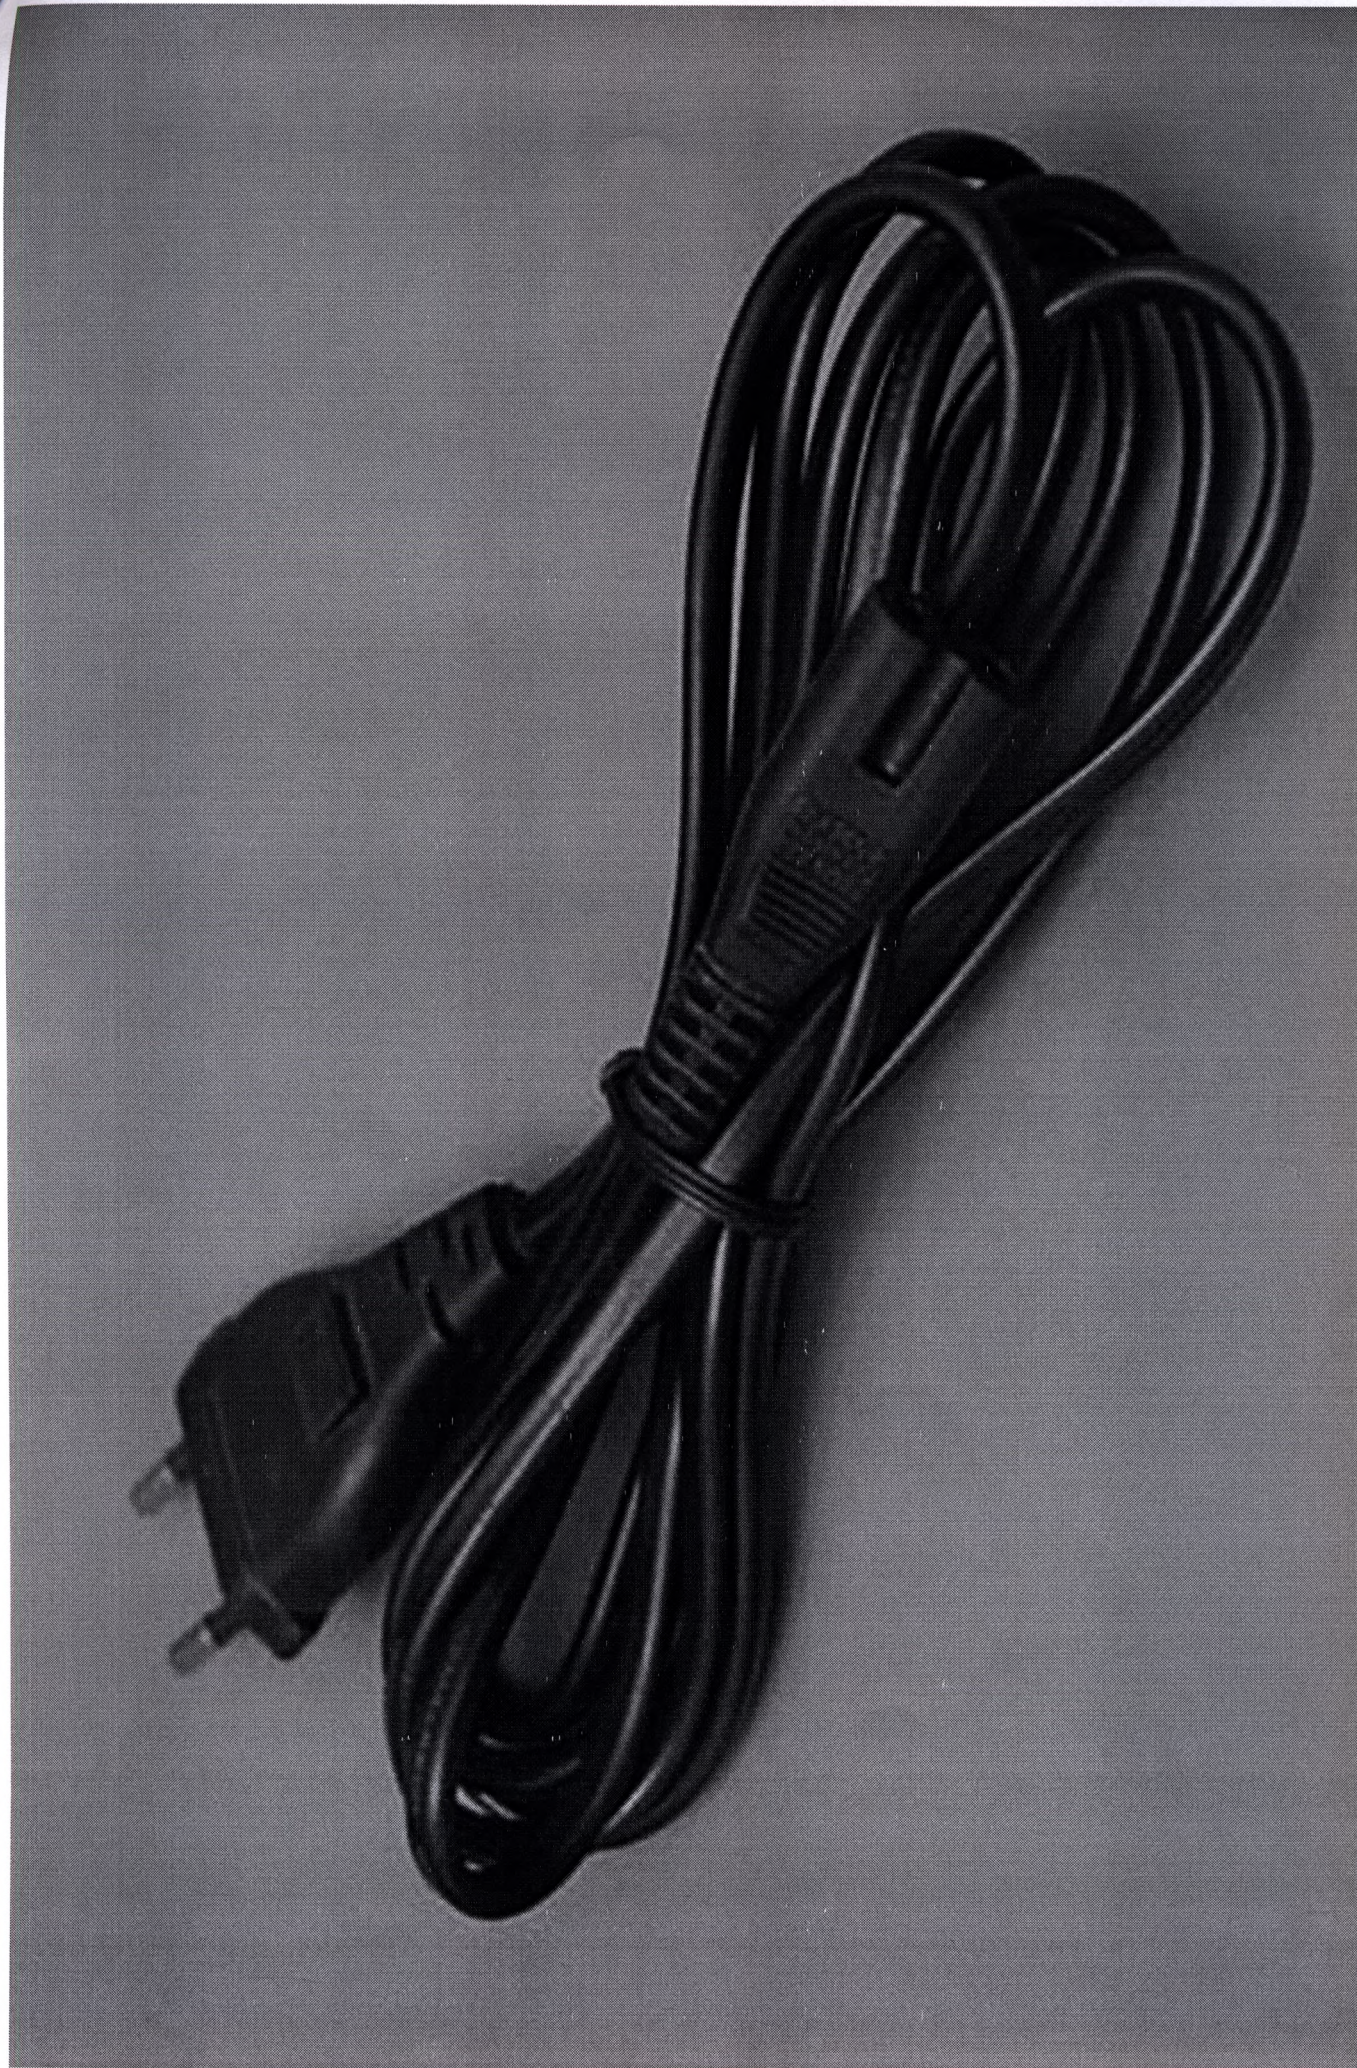


Фото 3. Шнур сетевой.

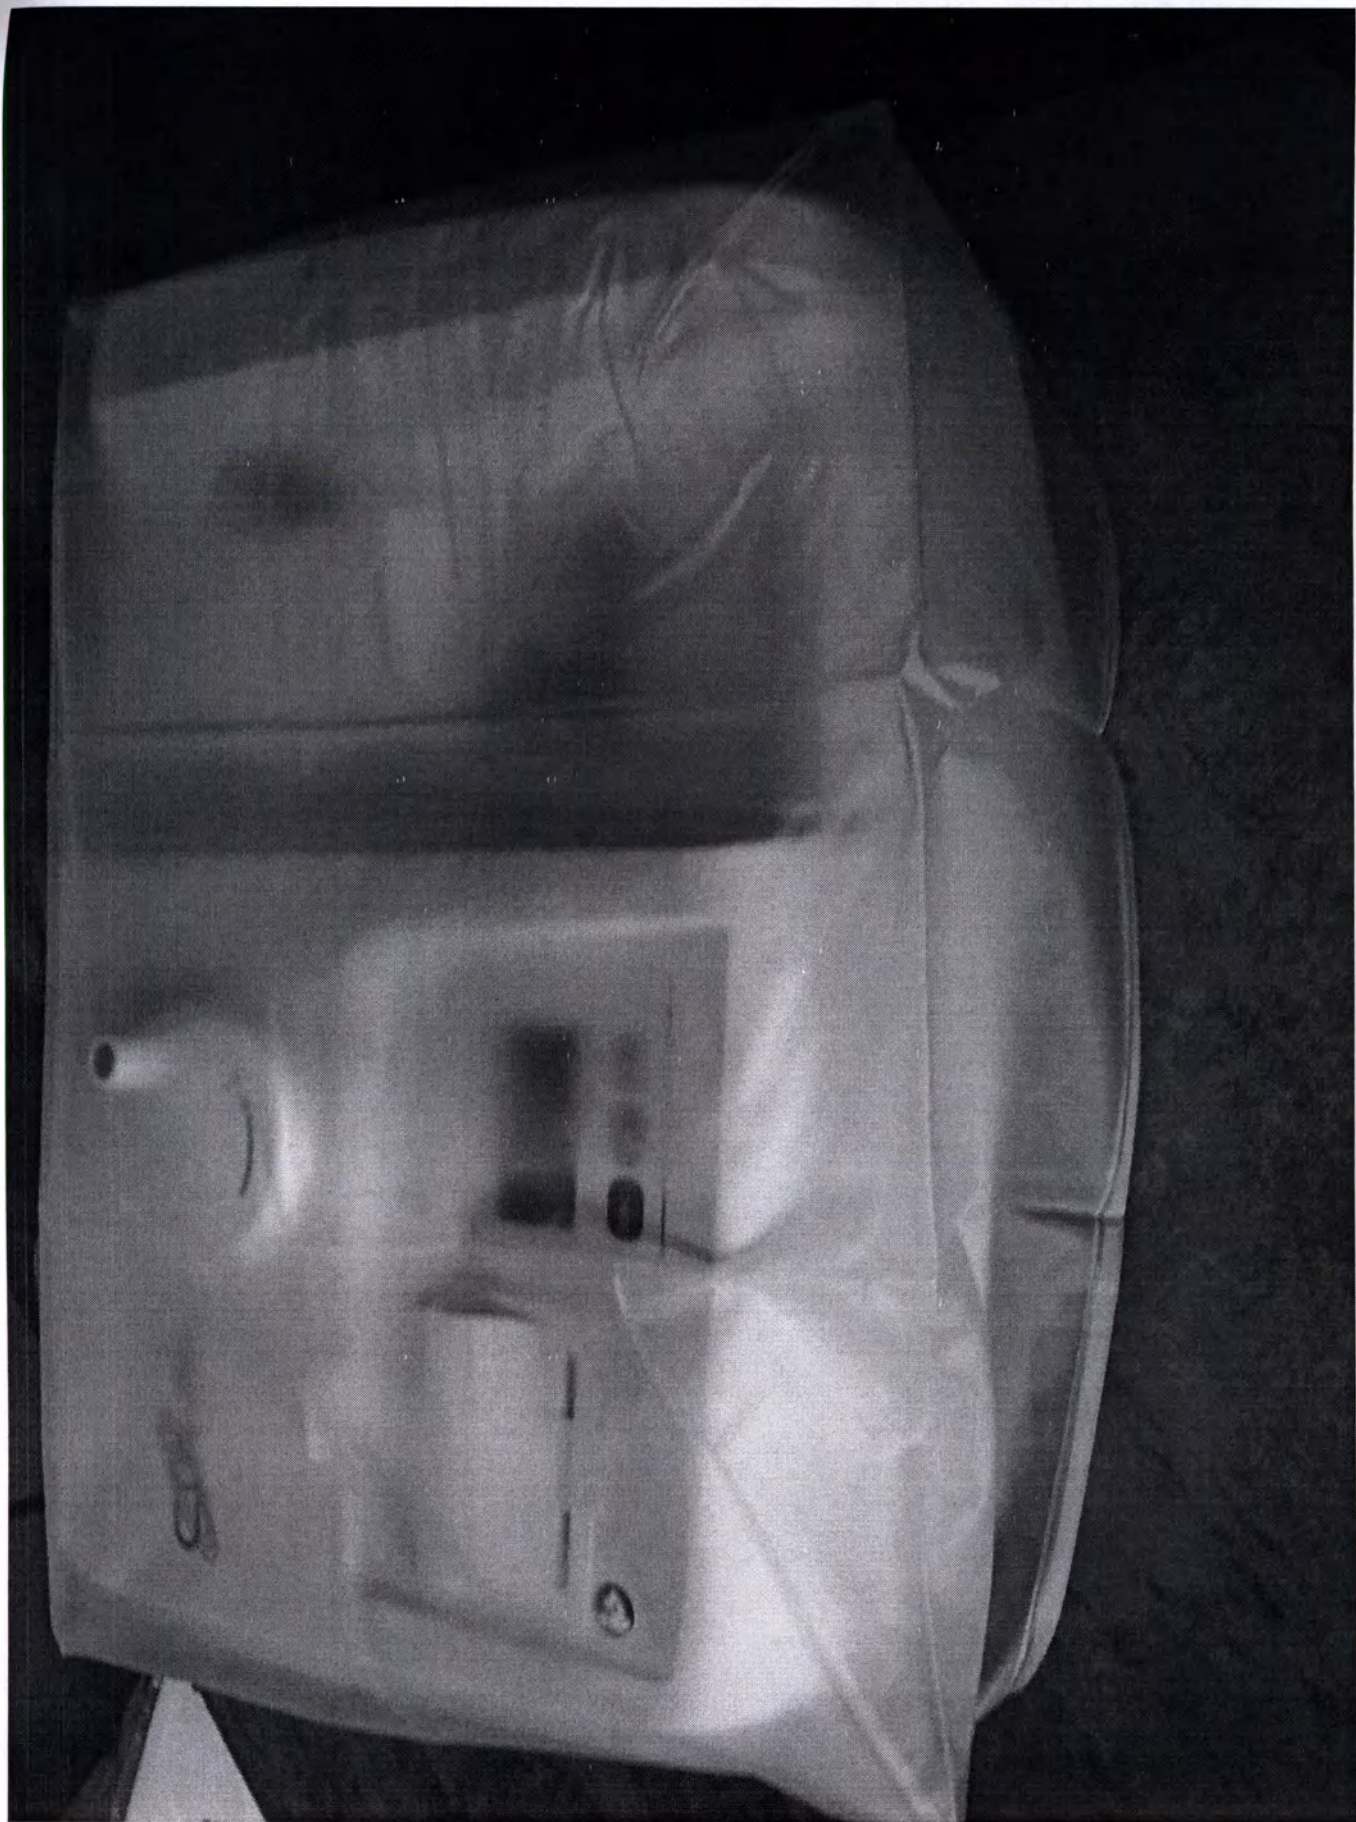


Фото 4. Чехол защитный

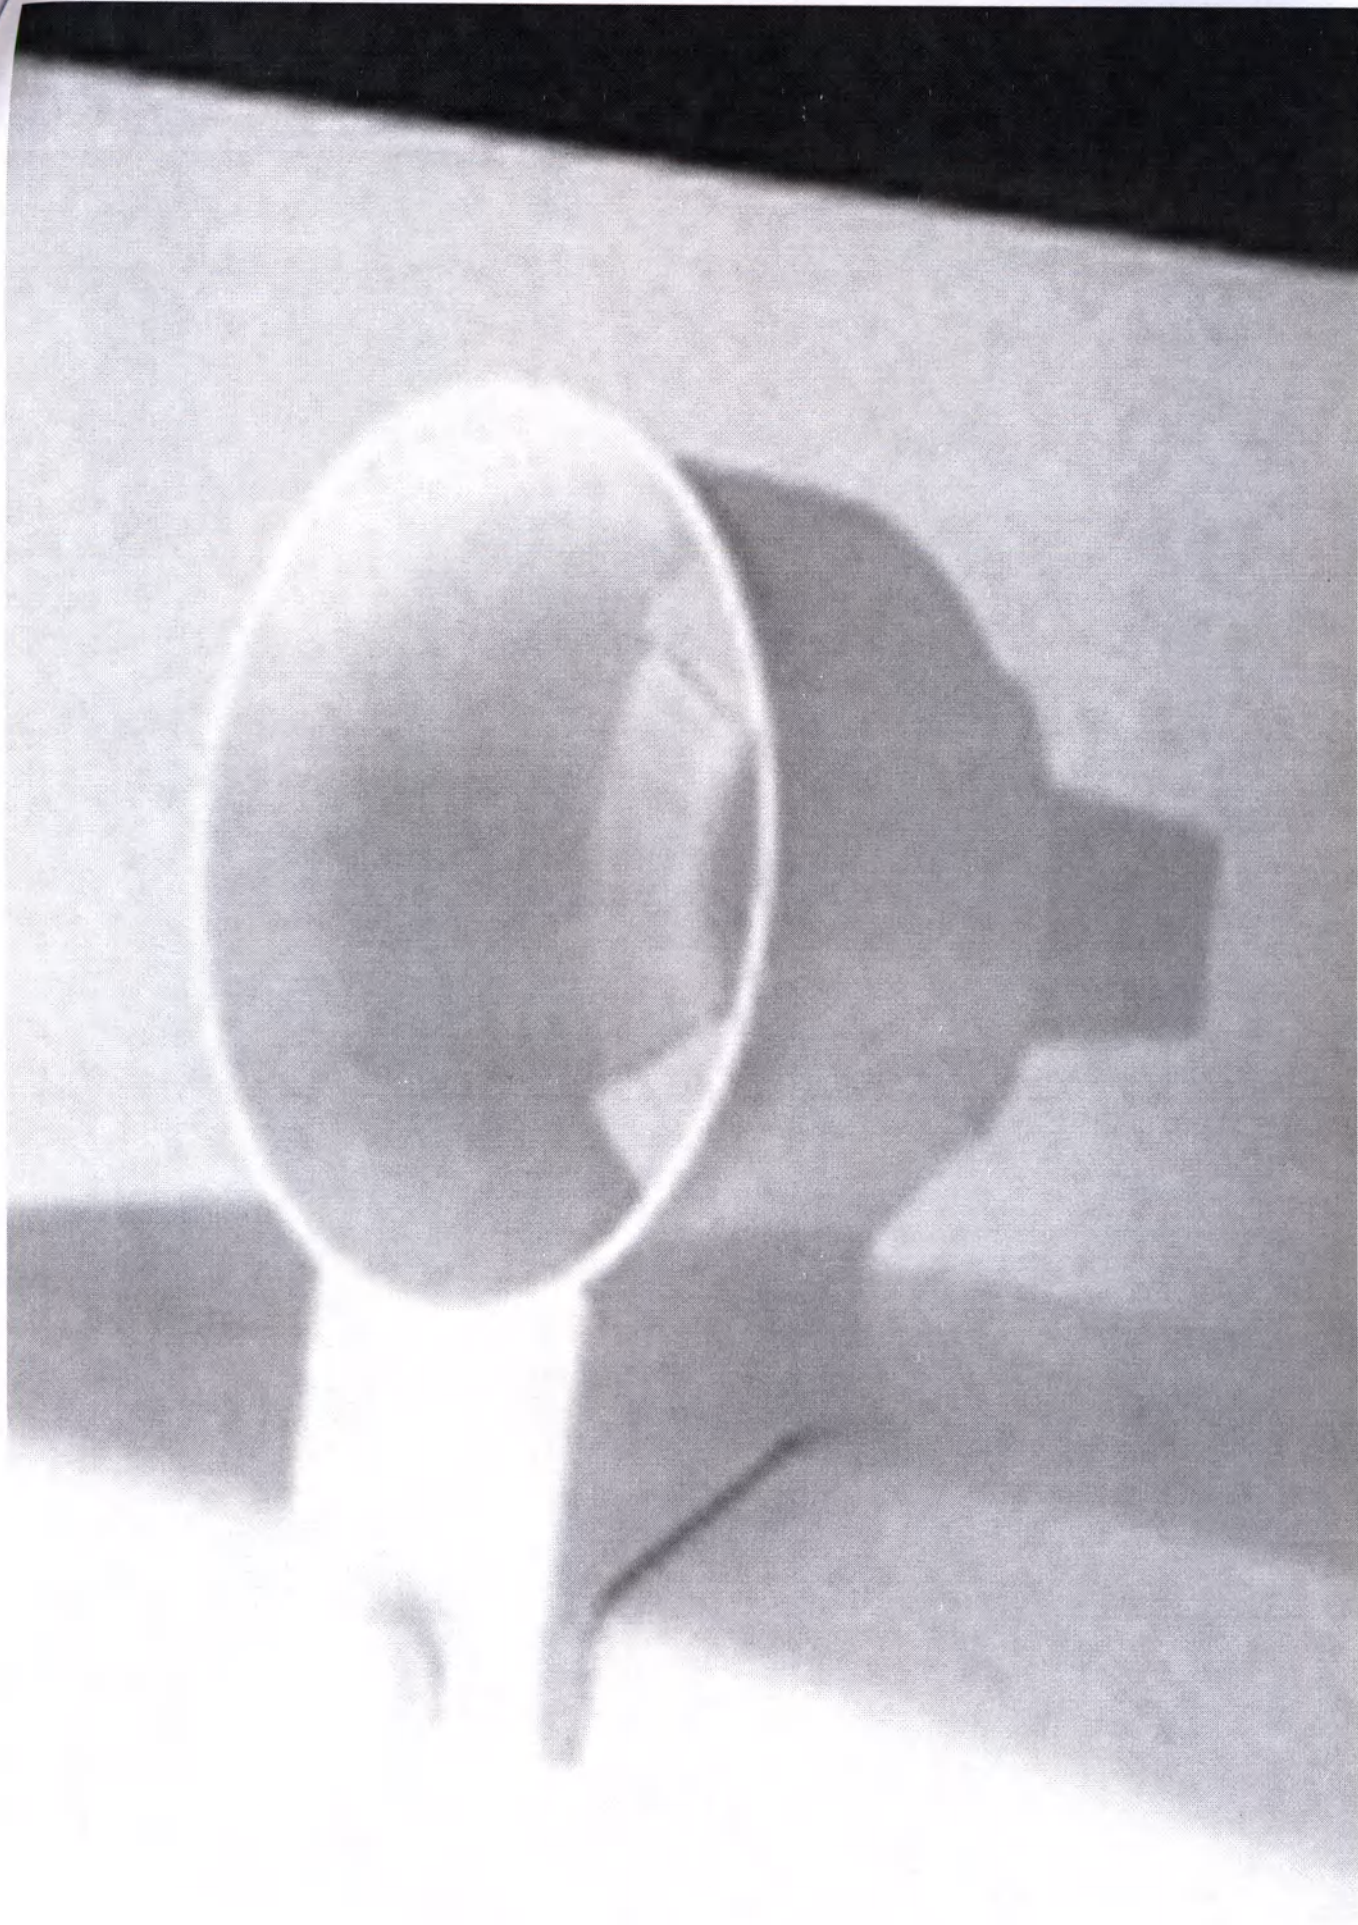


Фото 5. Держатель для геля.

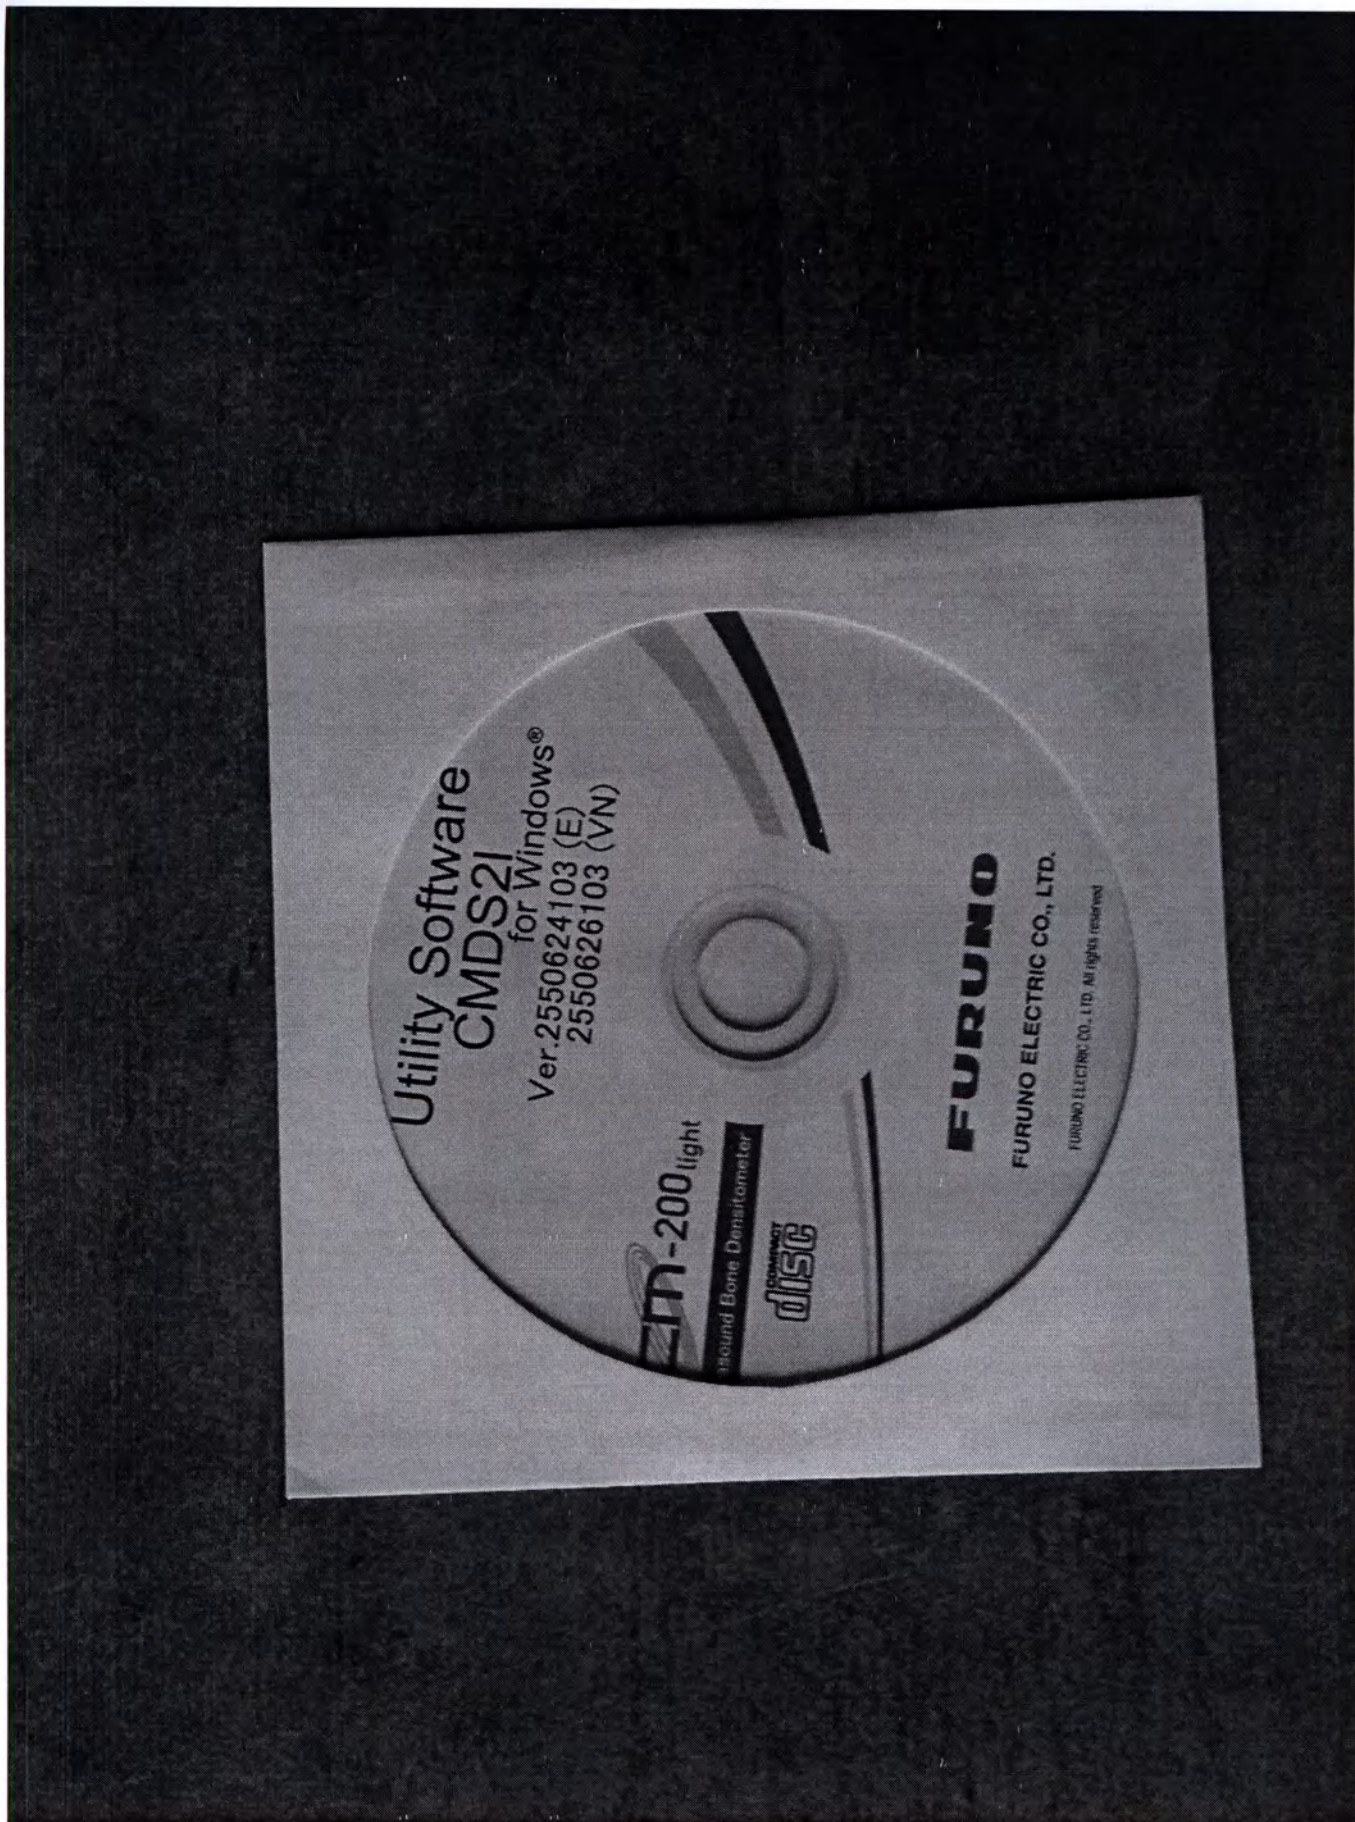


Фото 6. Утилиты установочной программы для CM-200 Лайт на CD-диске.

FURUNO

CM-200_{light}

Ultrasound Bone Densitometer

Operator's Manual



FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

CM 27244-02

Фото 7. Инструкция оператора.

Фото 8. Инструкция краткая.


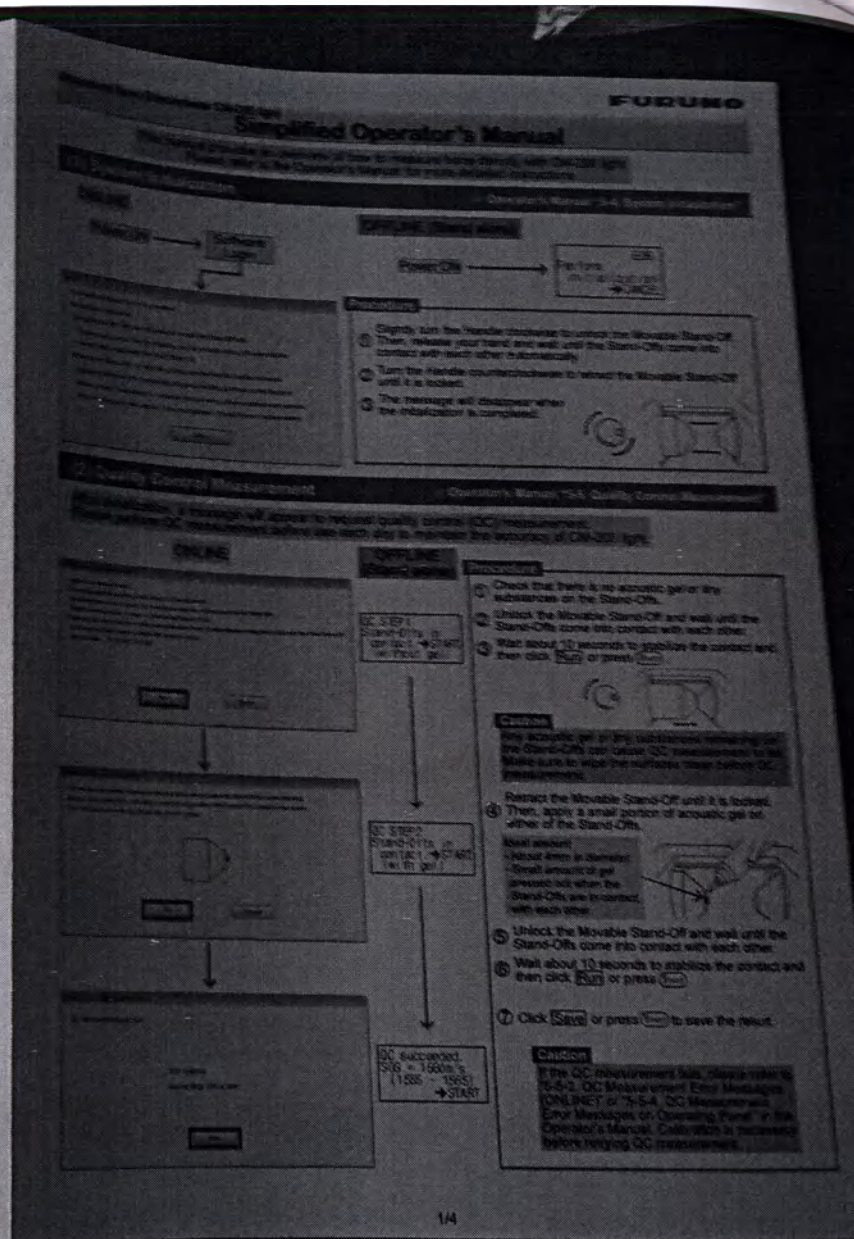




Фото 9. Рулон бумаги для распечатки.

Пронумеровано, пронумеровано
скреплено печатью листов

Генеральный
Исходный

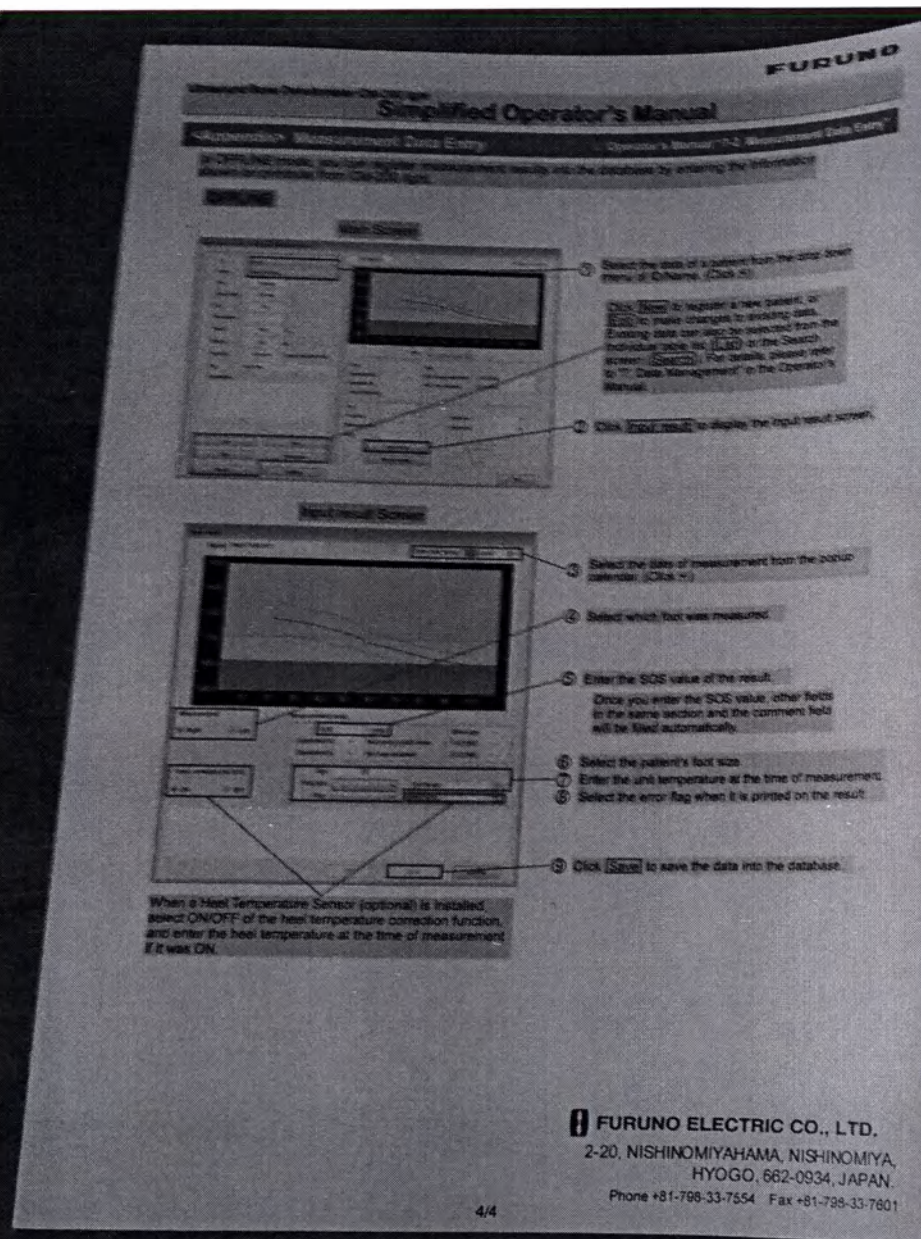