





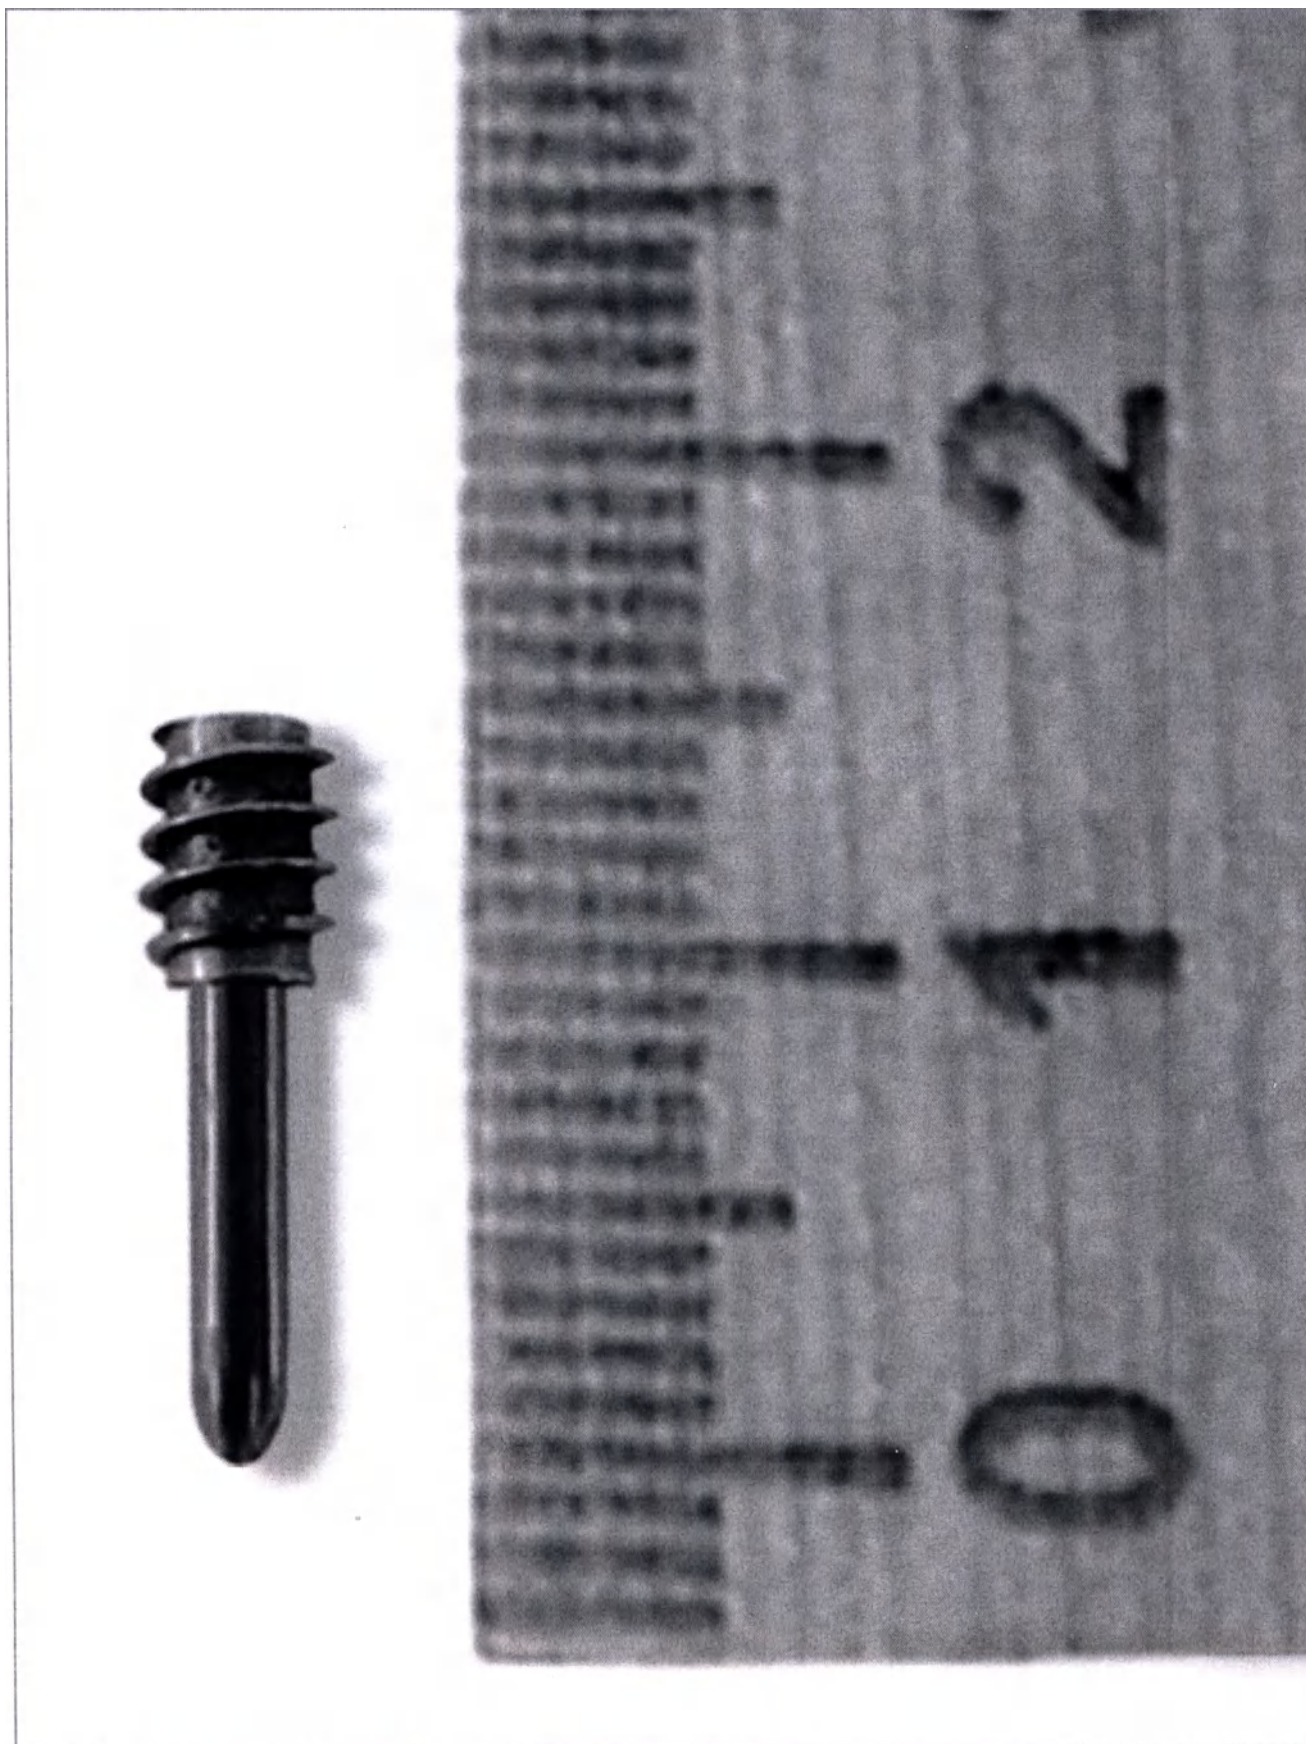

Имплантат электрeтный стимулятор остеорепарации ЭСО -2-20

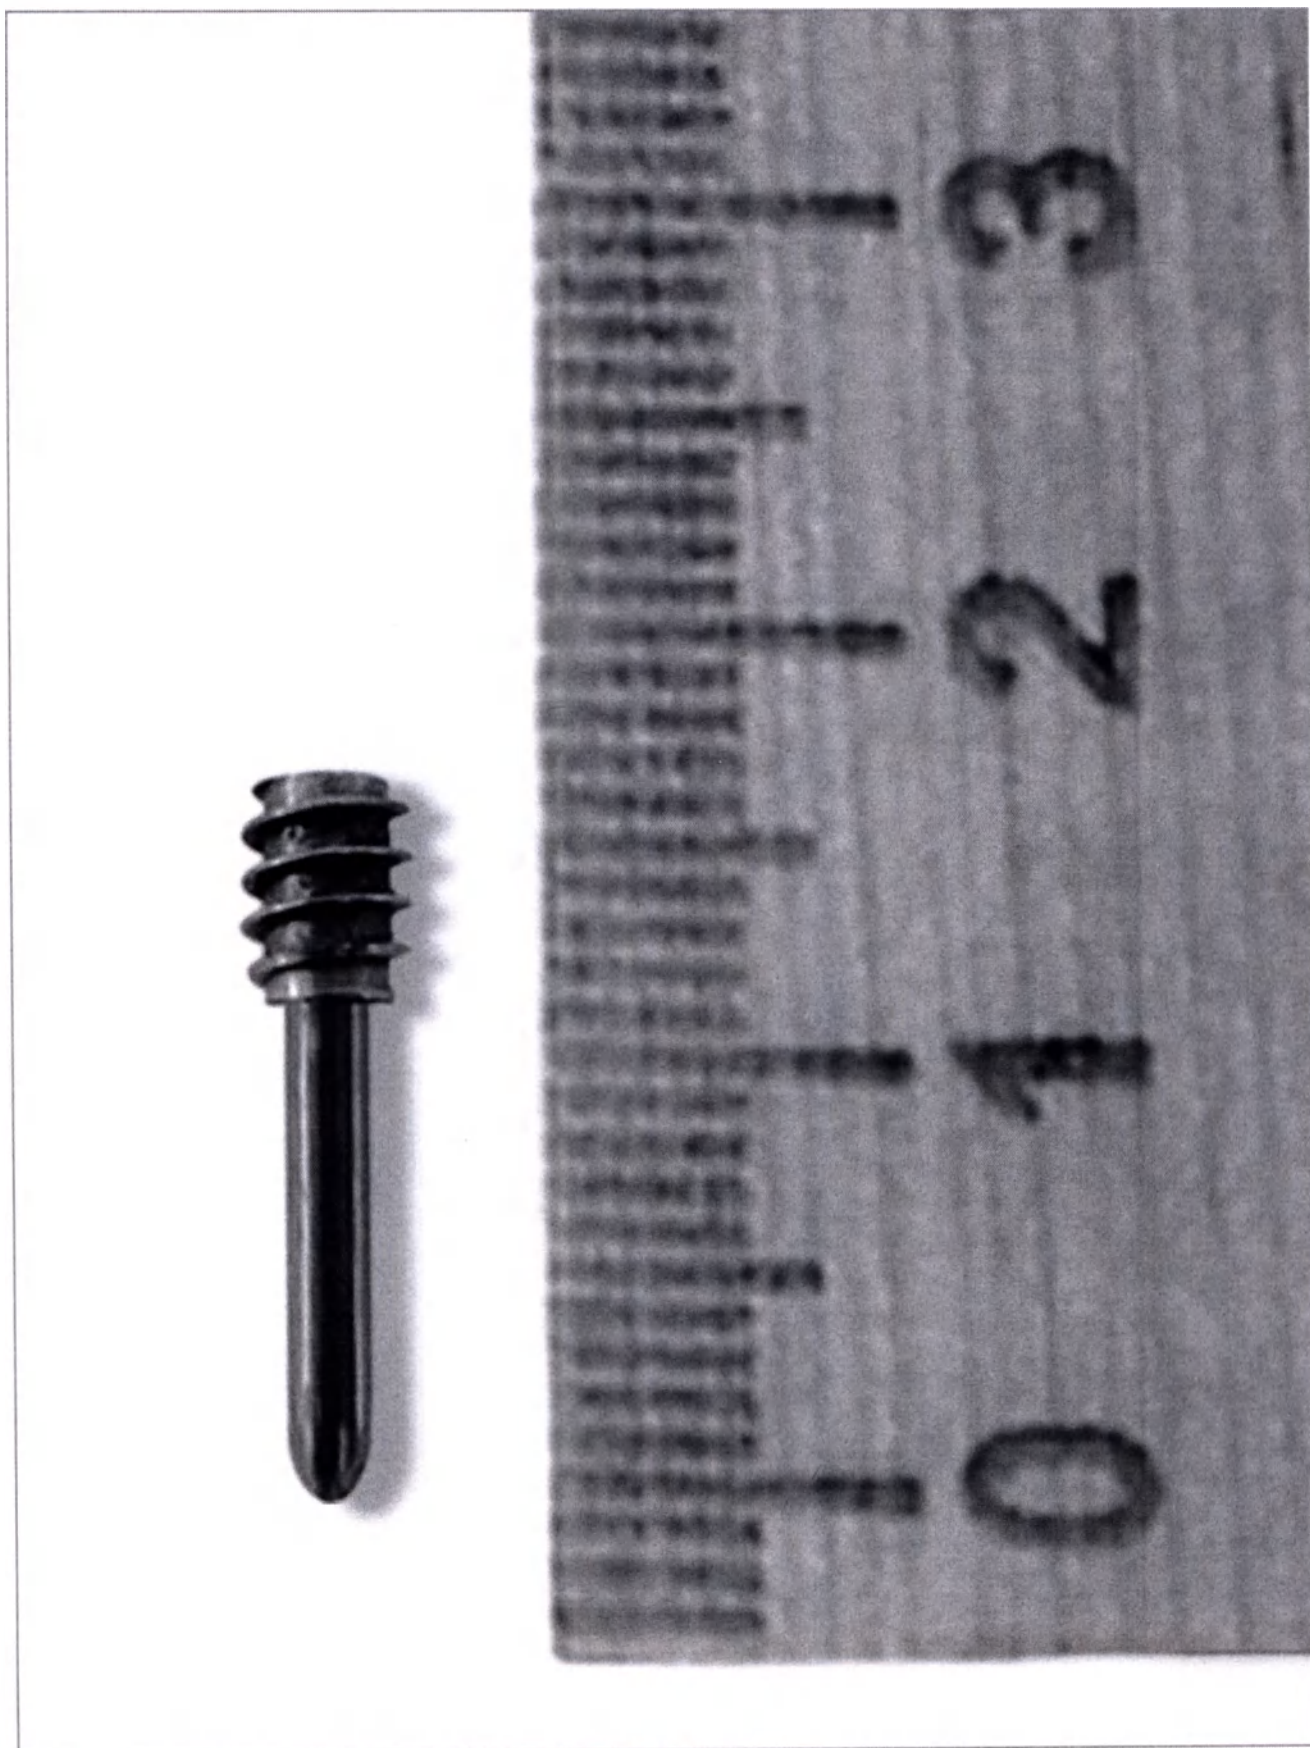

Имплантат электрeтный стимулятор остеорепарации ЭСО -3-27



Имплантат электрeтный стимулятор остеорепарации ЭСО -3-32




Имплантат электрeтный стимулятор остеорепарации ЭСО -3-37




Имплантат электрeтный стимулятор остеорепарации ЭСО -3-42




Имплантат электрeтный стимулятор остеорепарации ЭСО -3-47

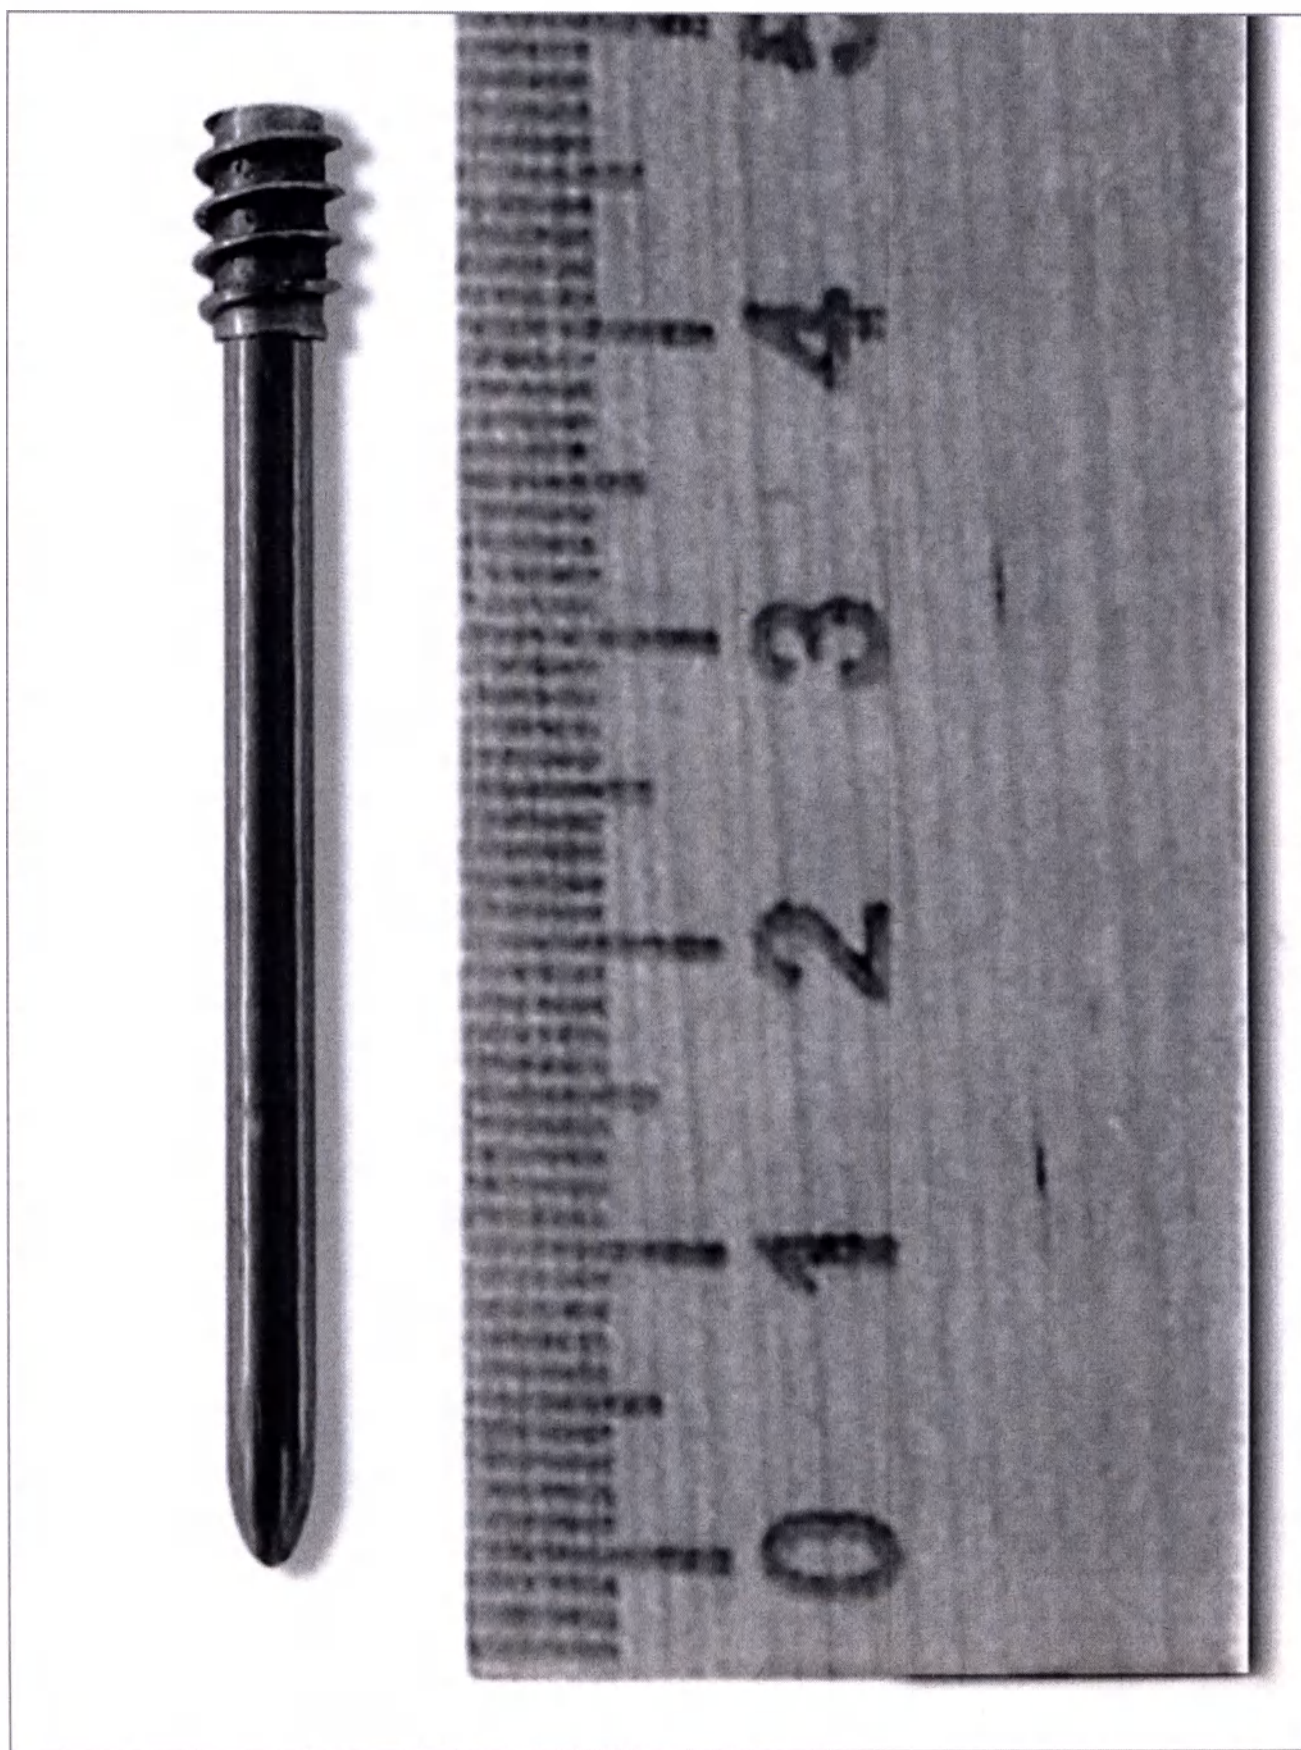


Имплантат электрeтный стимулятор остеорепарации ЭСО -3-52

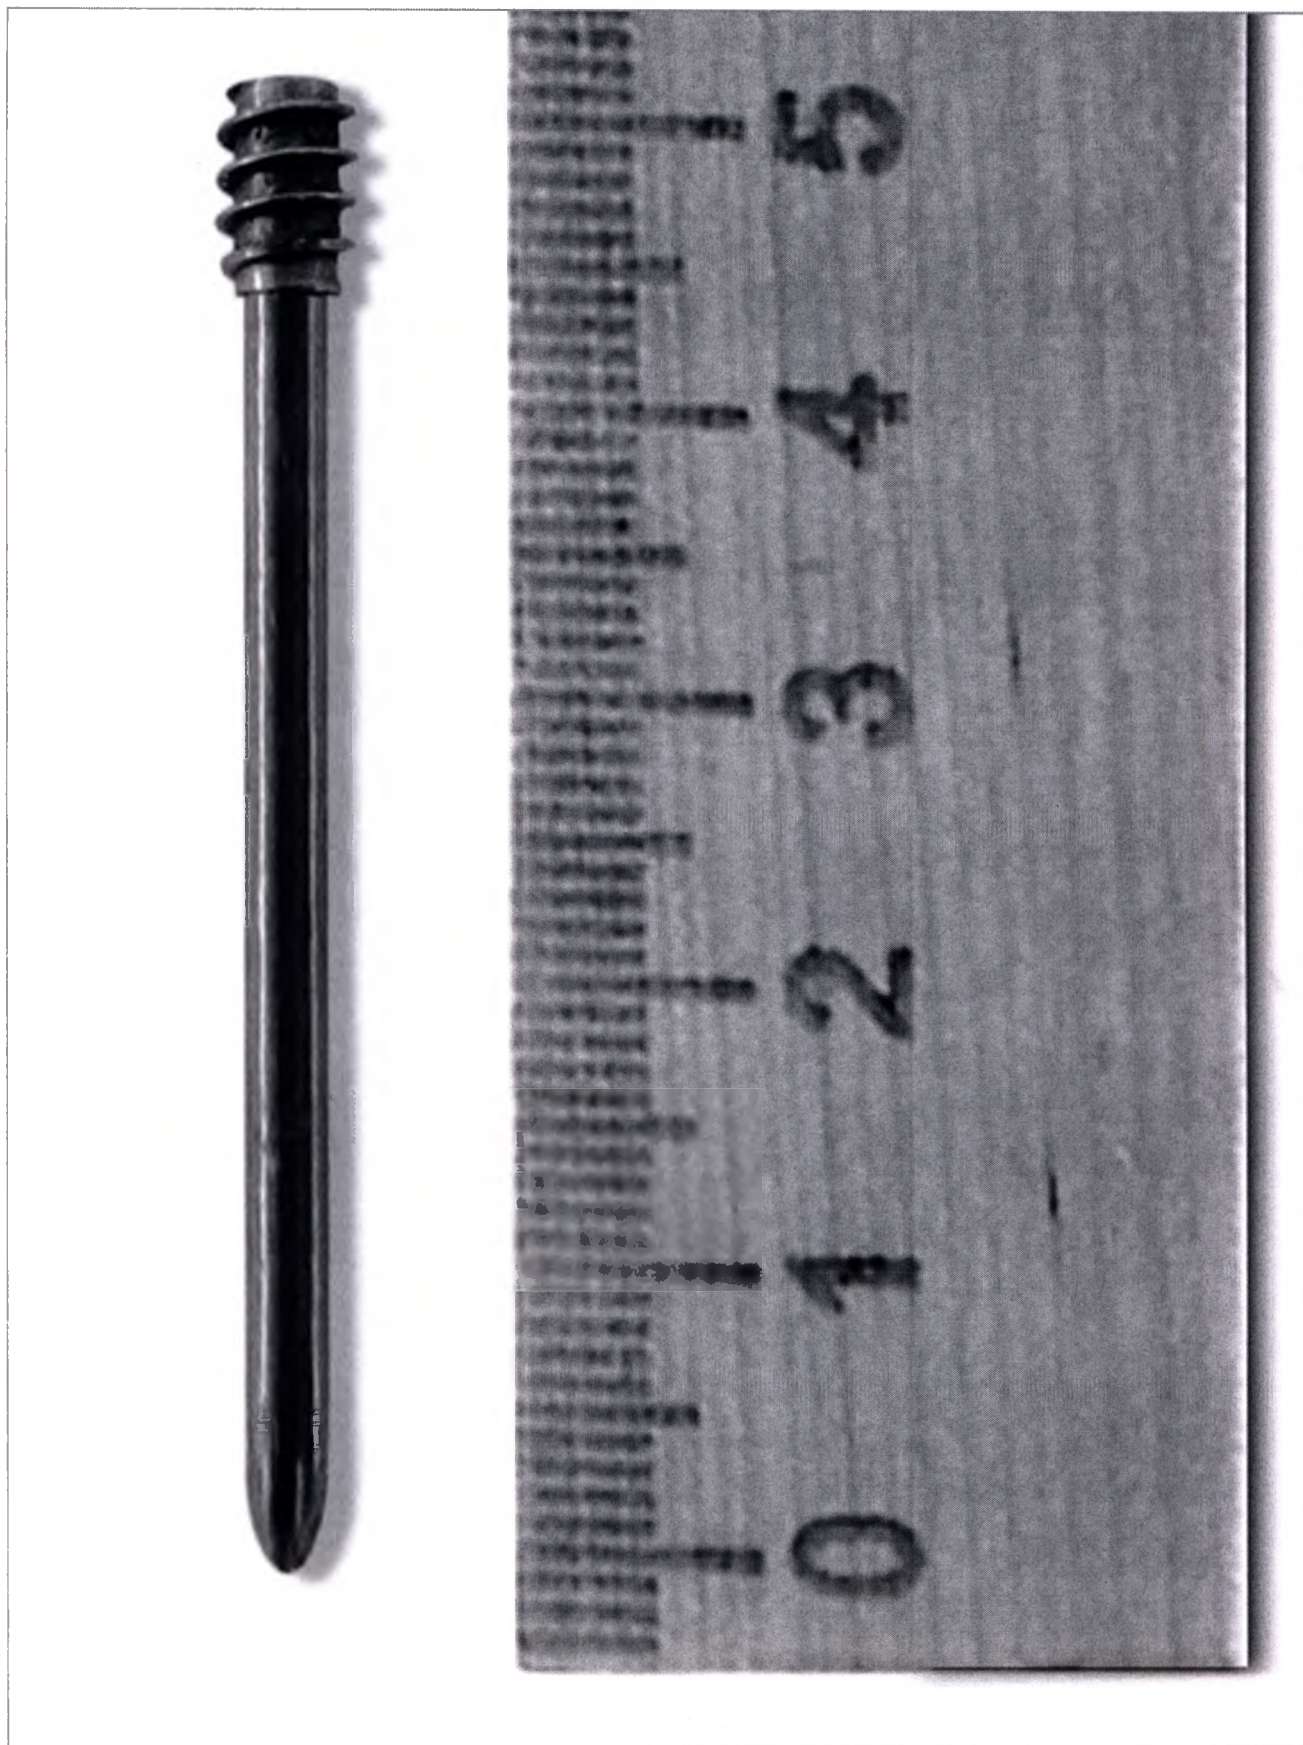


Имплантат электрeтный стимулятор остеорепарации ЭСО -4-60

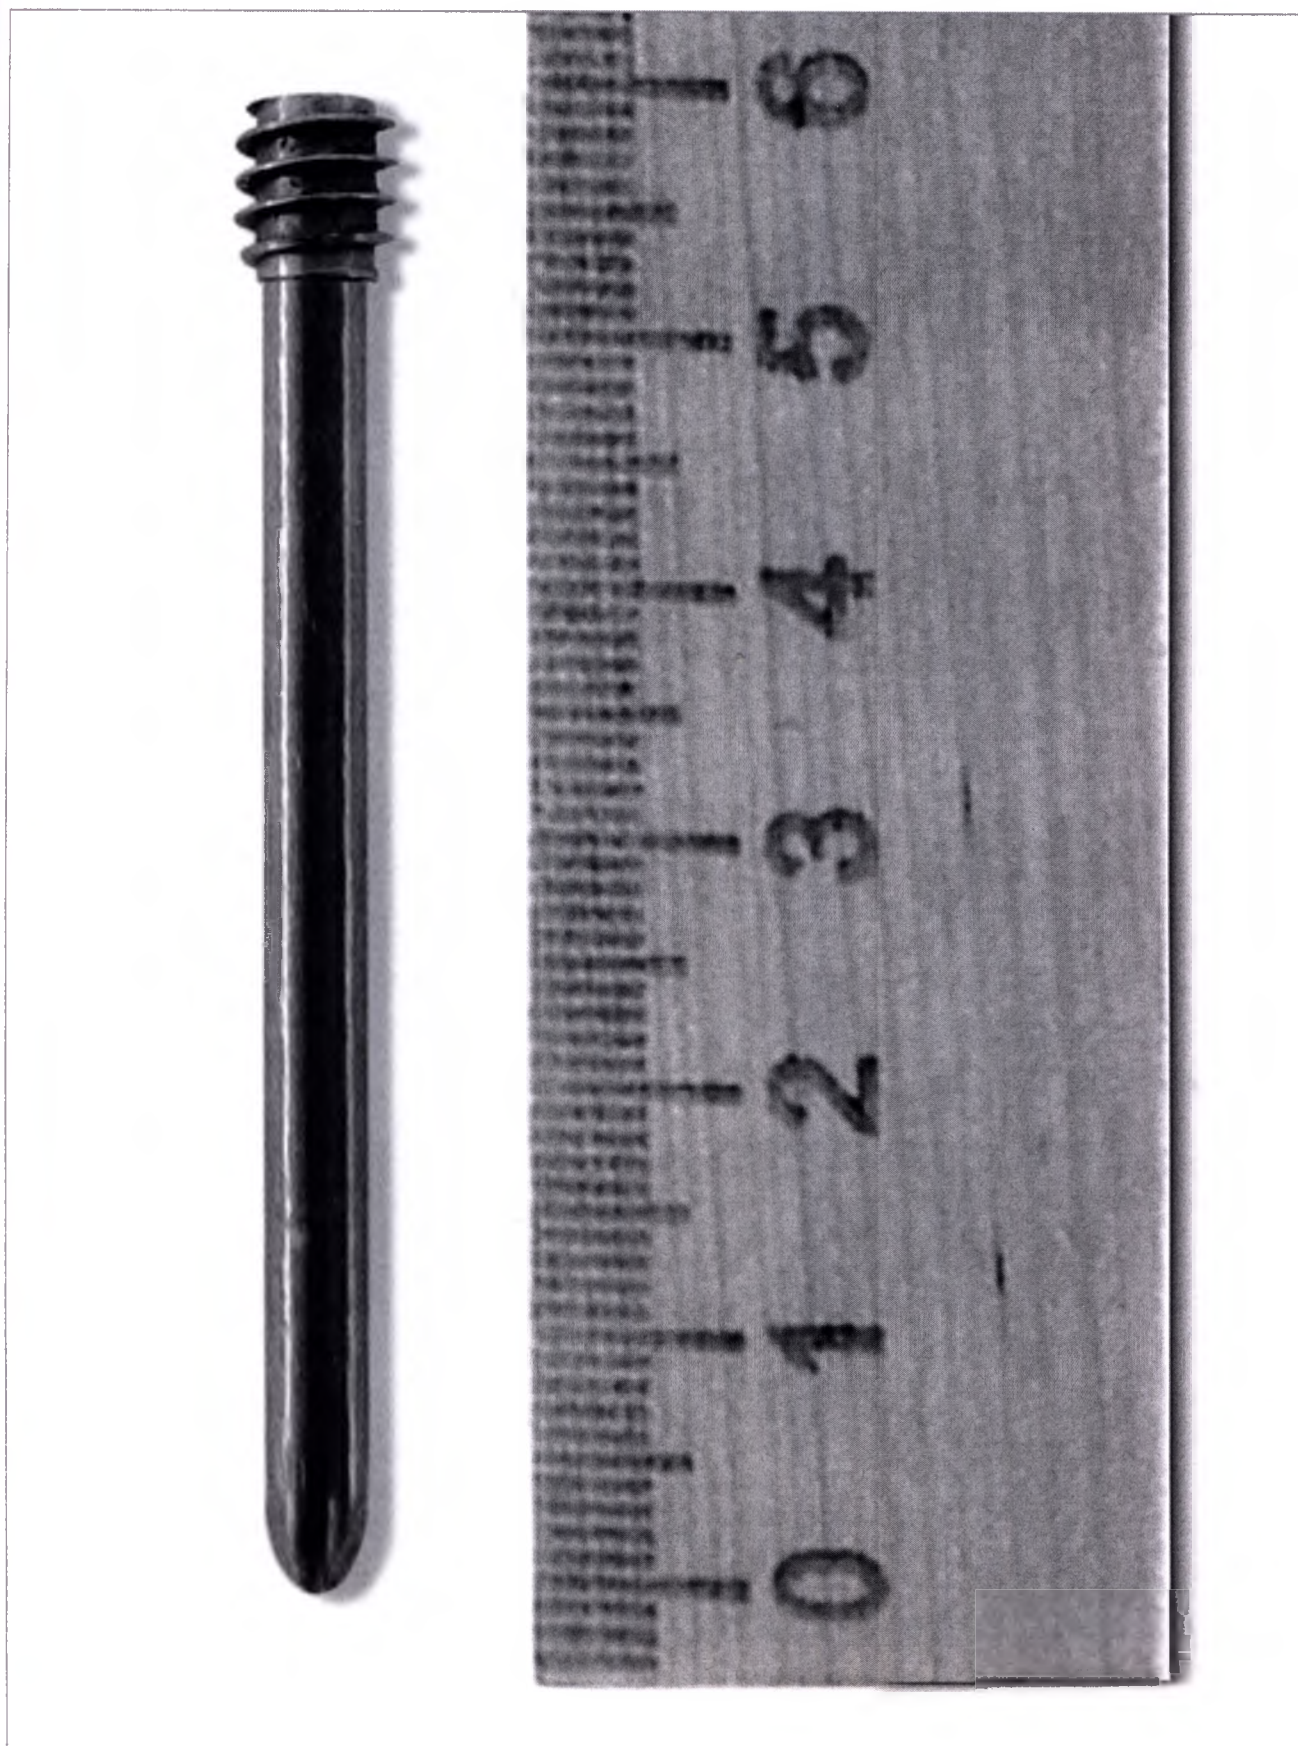


Имплантат электрeтный стимулятор остеорепарации ЭСО -4-70

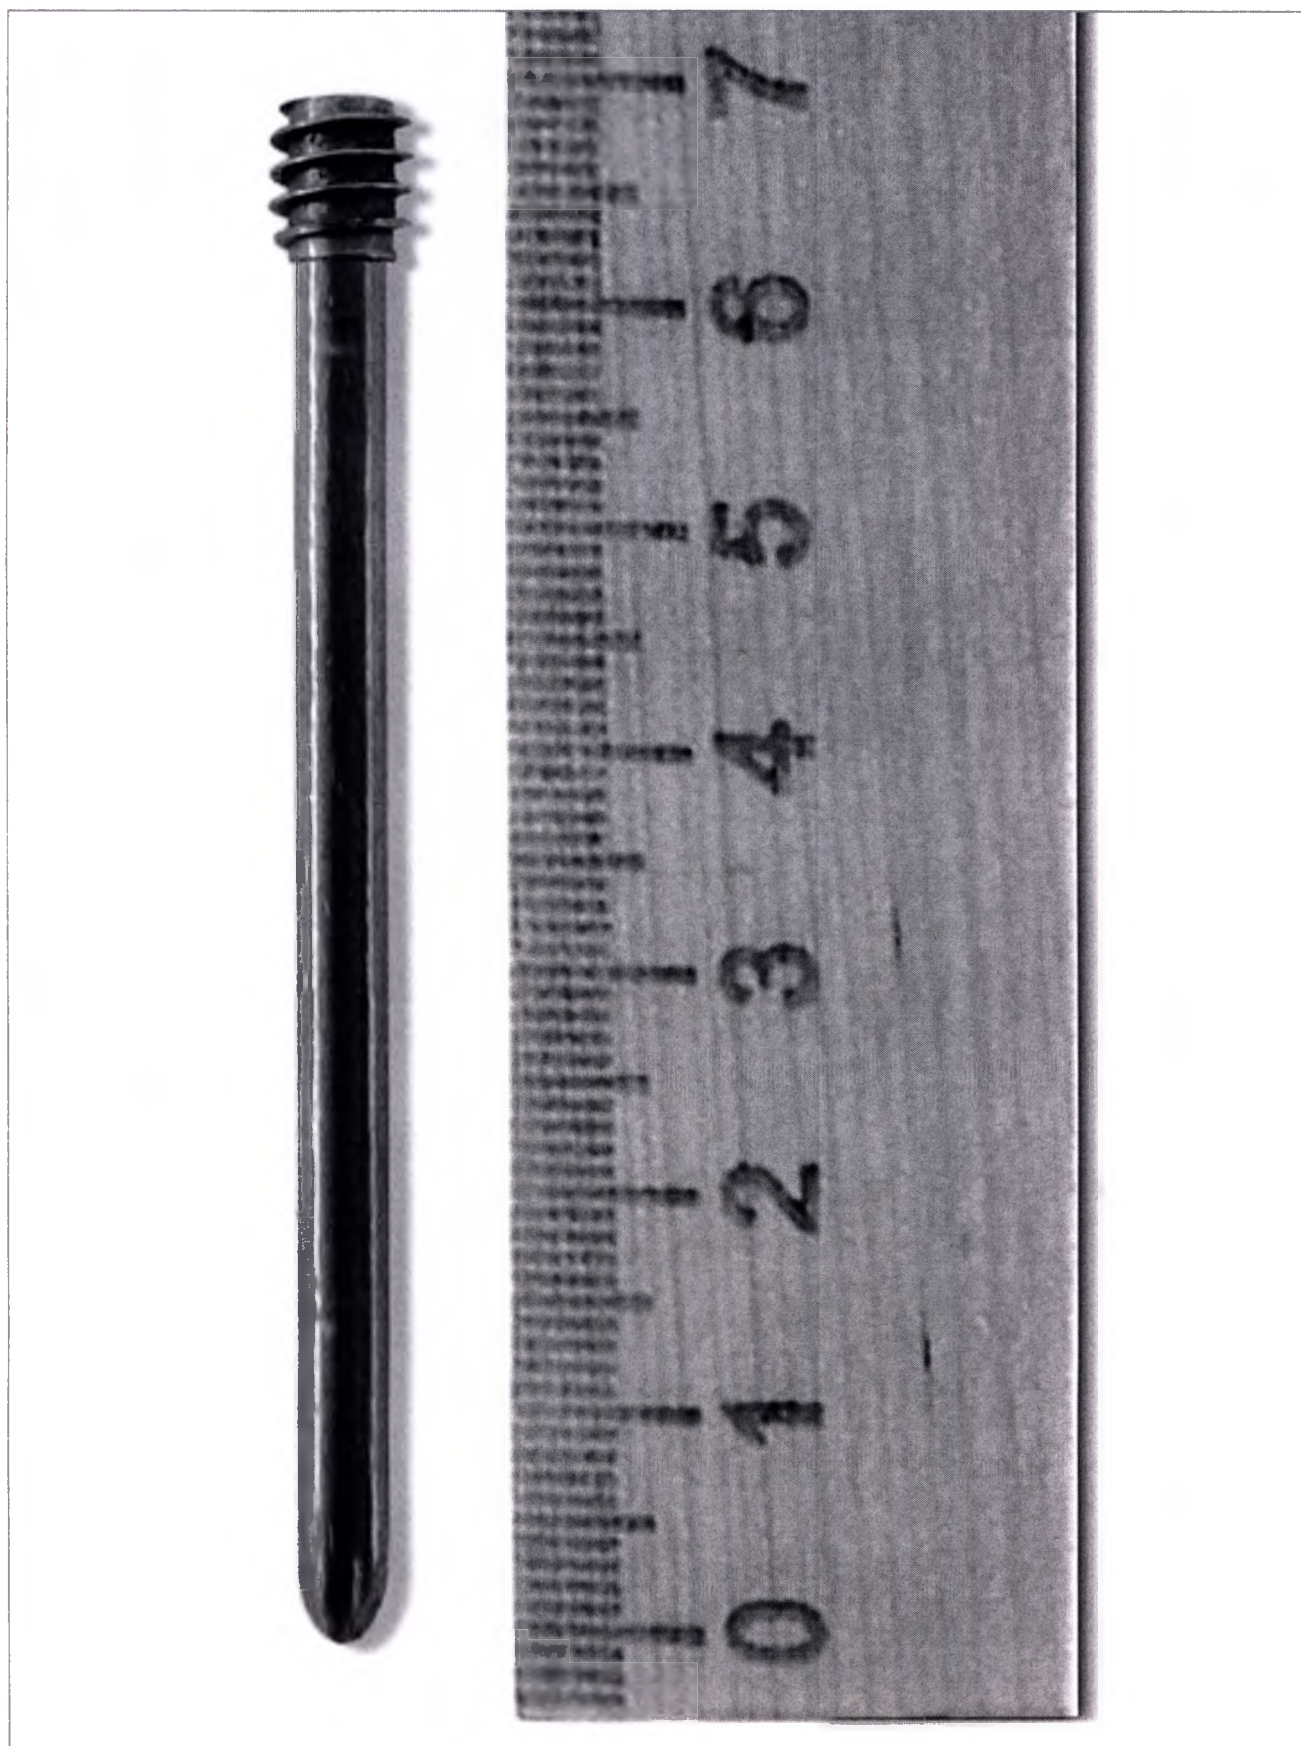


Имплантат электрeтный стимулятор остеорепарации ЭСО -4-80

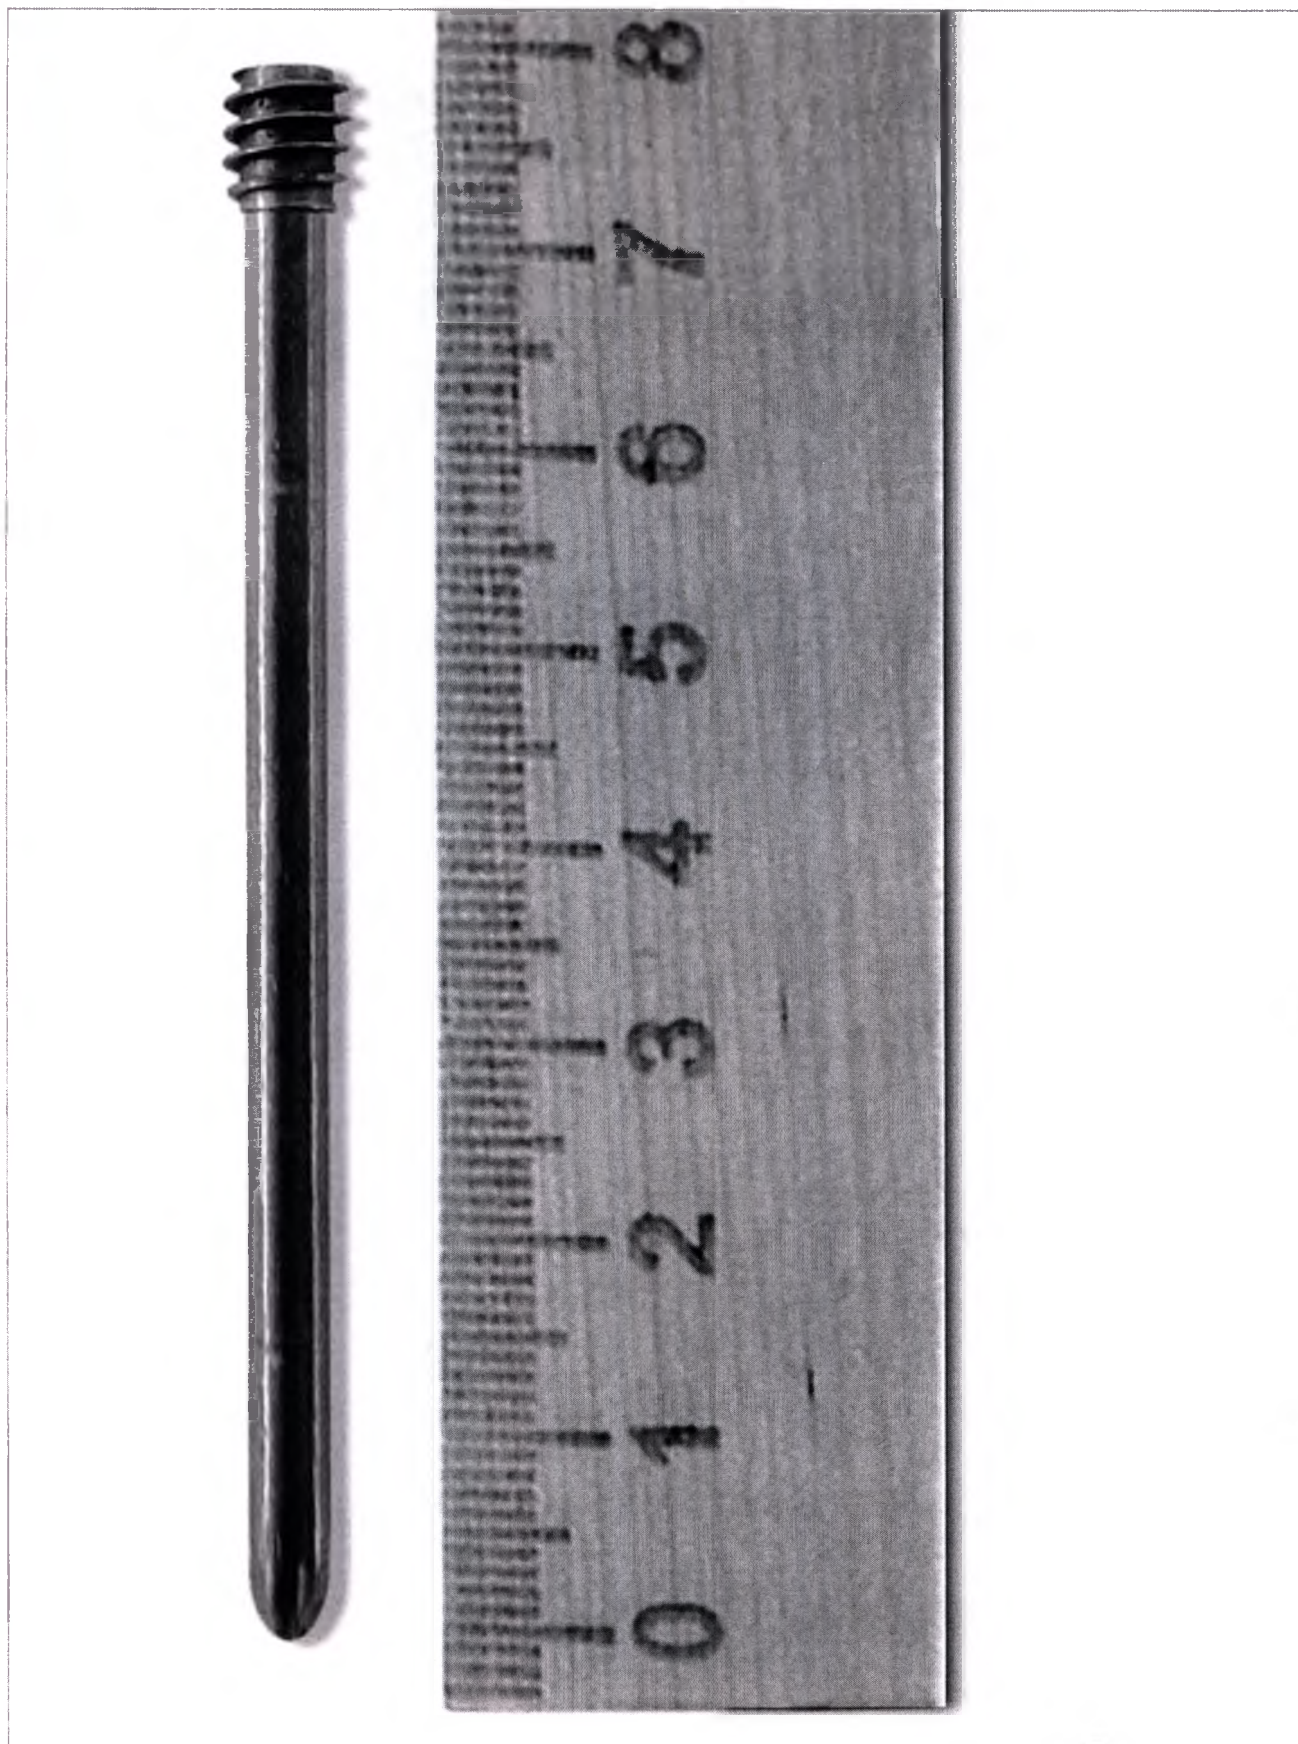


Имплантат электрeтный стимулятор остеорепарации ЭСО -4-90

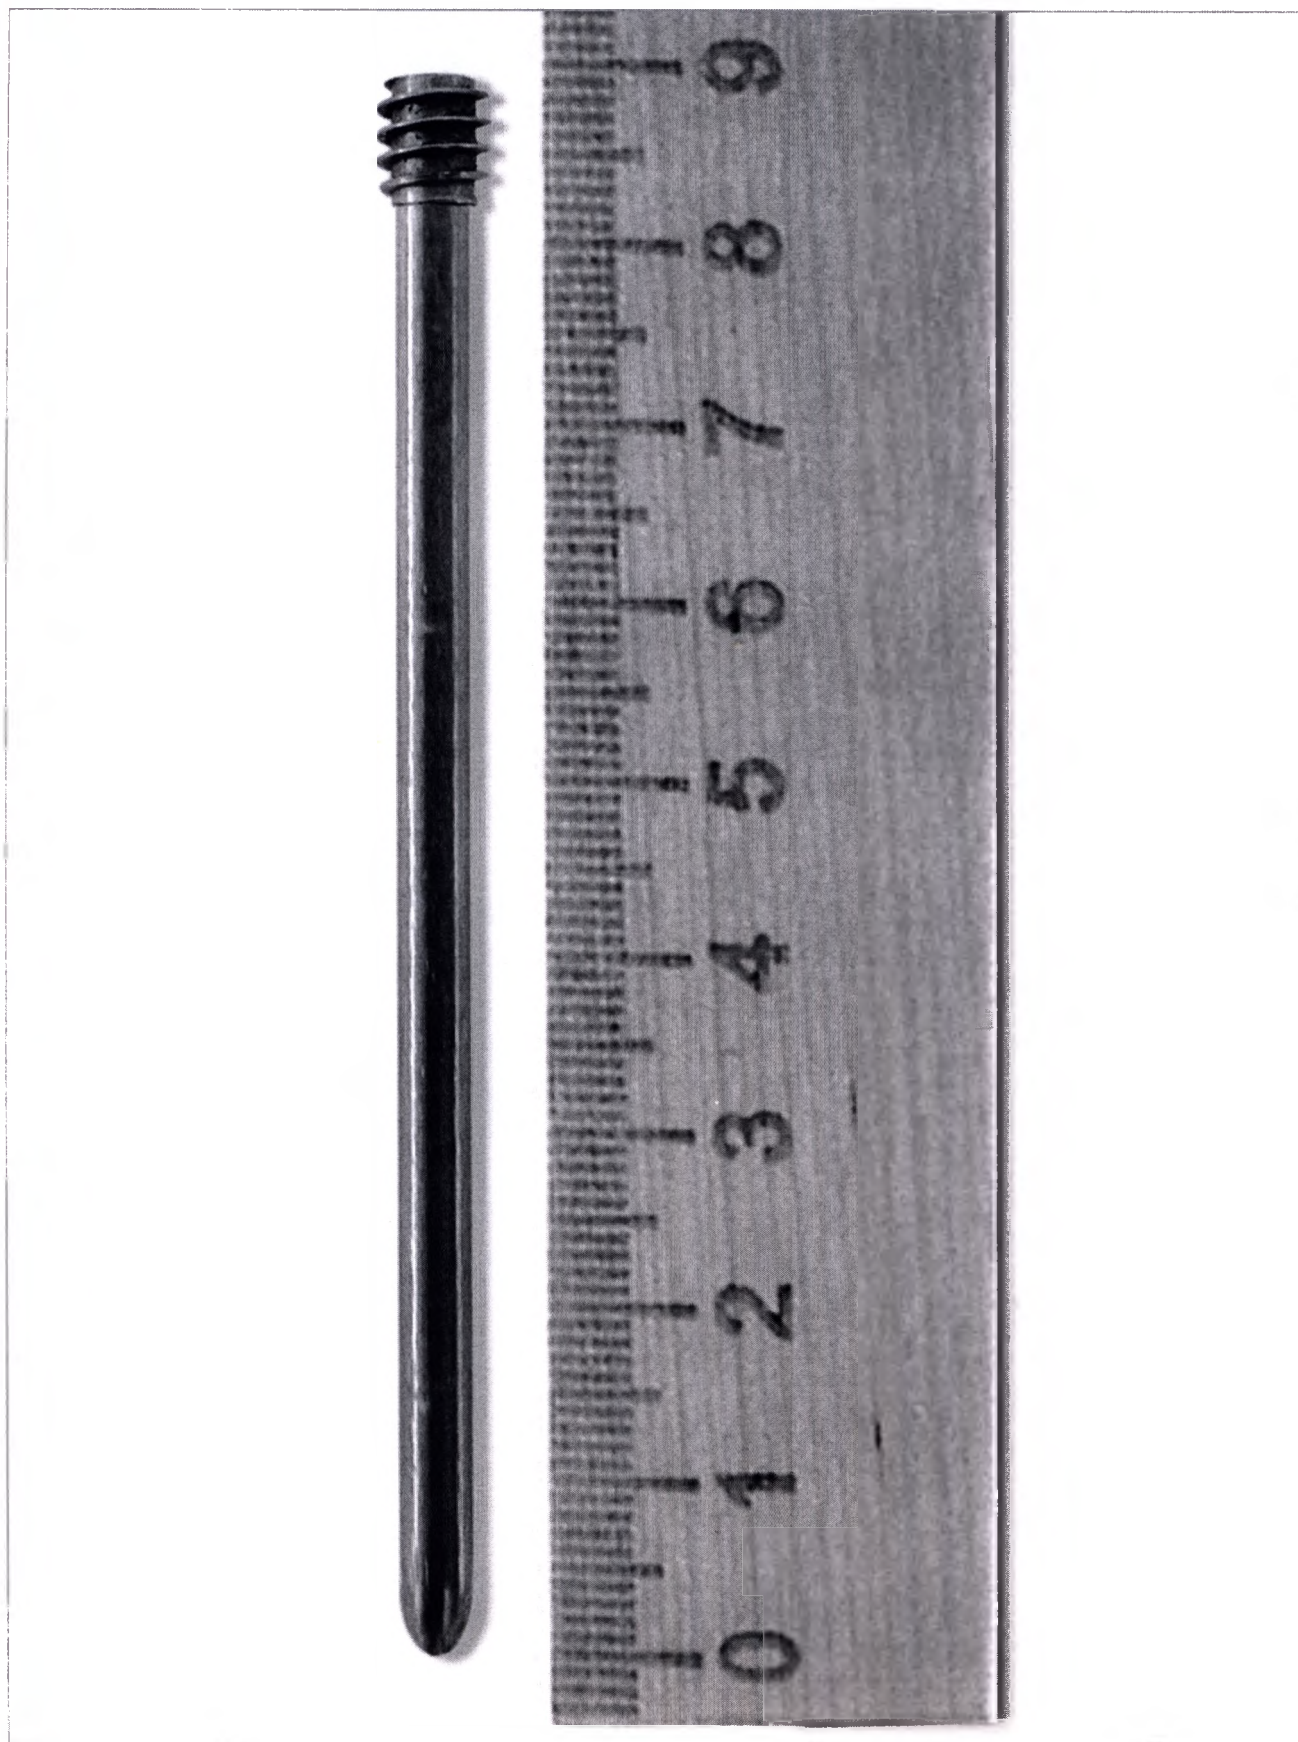


Имплантат электрeтный стимулятор остеорепарации ЭСО -4-100

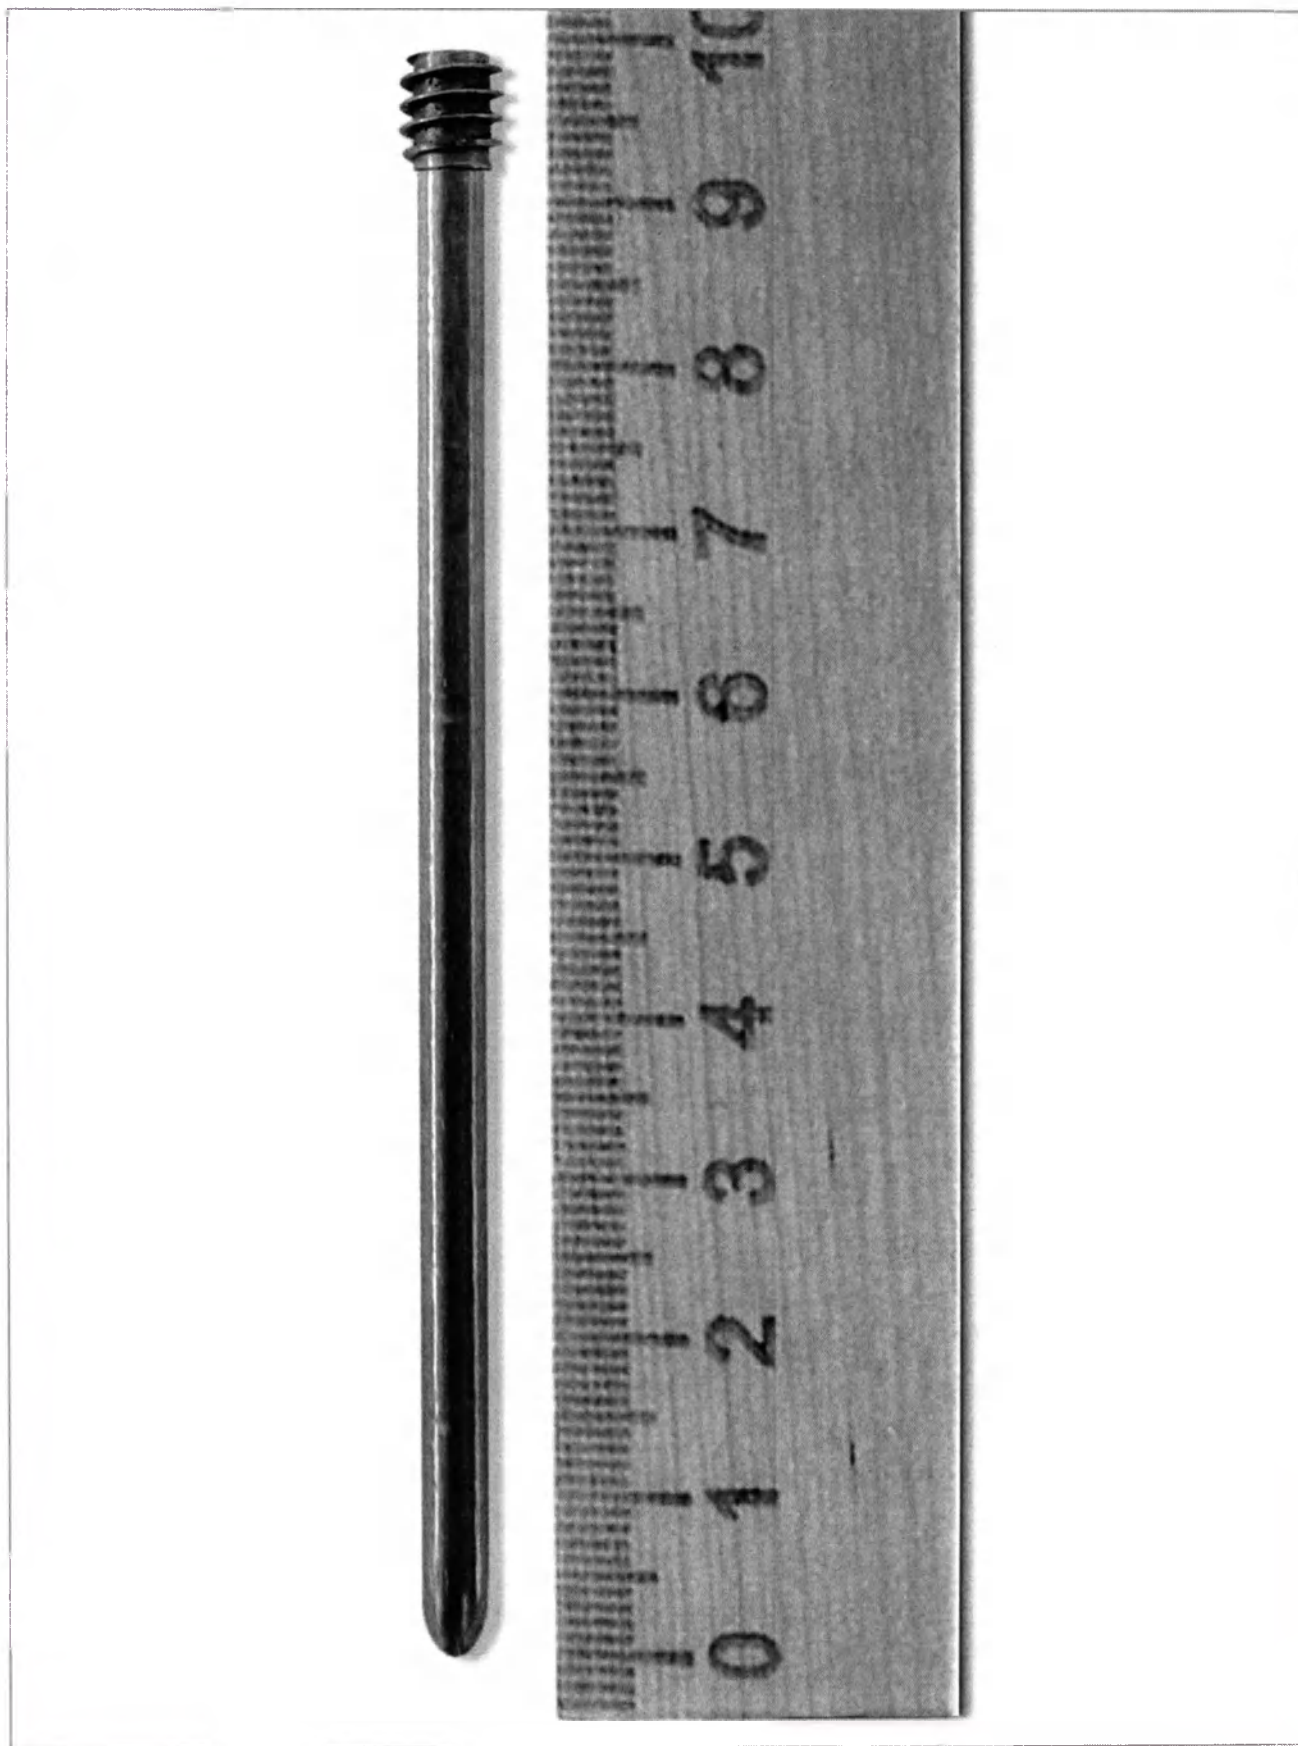

Имплантат электранный стимулятор остеорепаации ЭСО -4-110

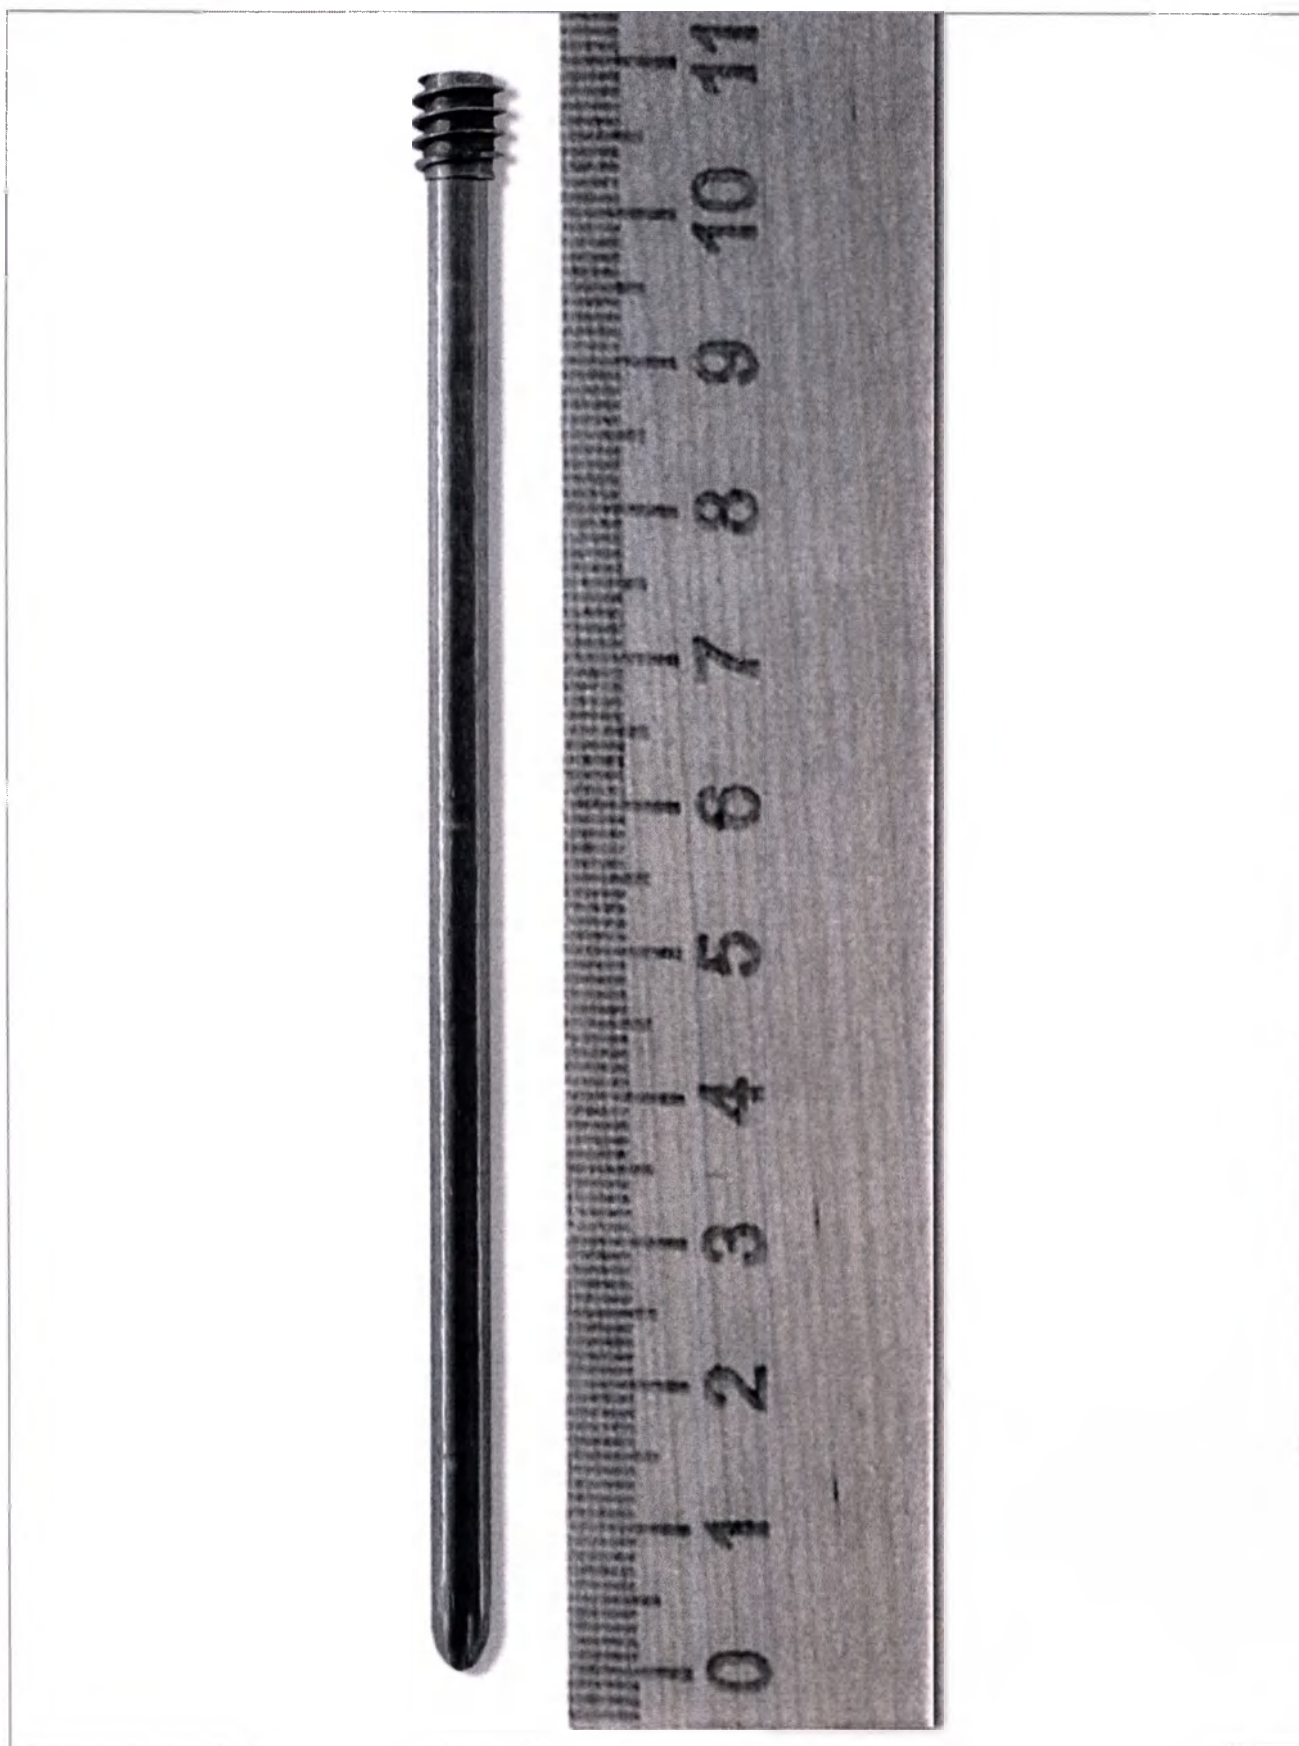

Имплантат электрeтный стимулятор остеорепарации ЭСО -4-120

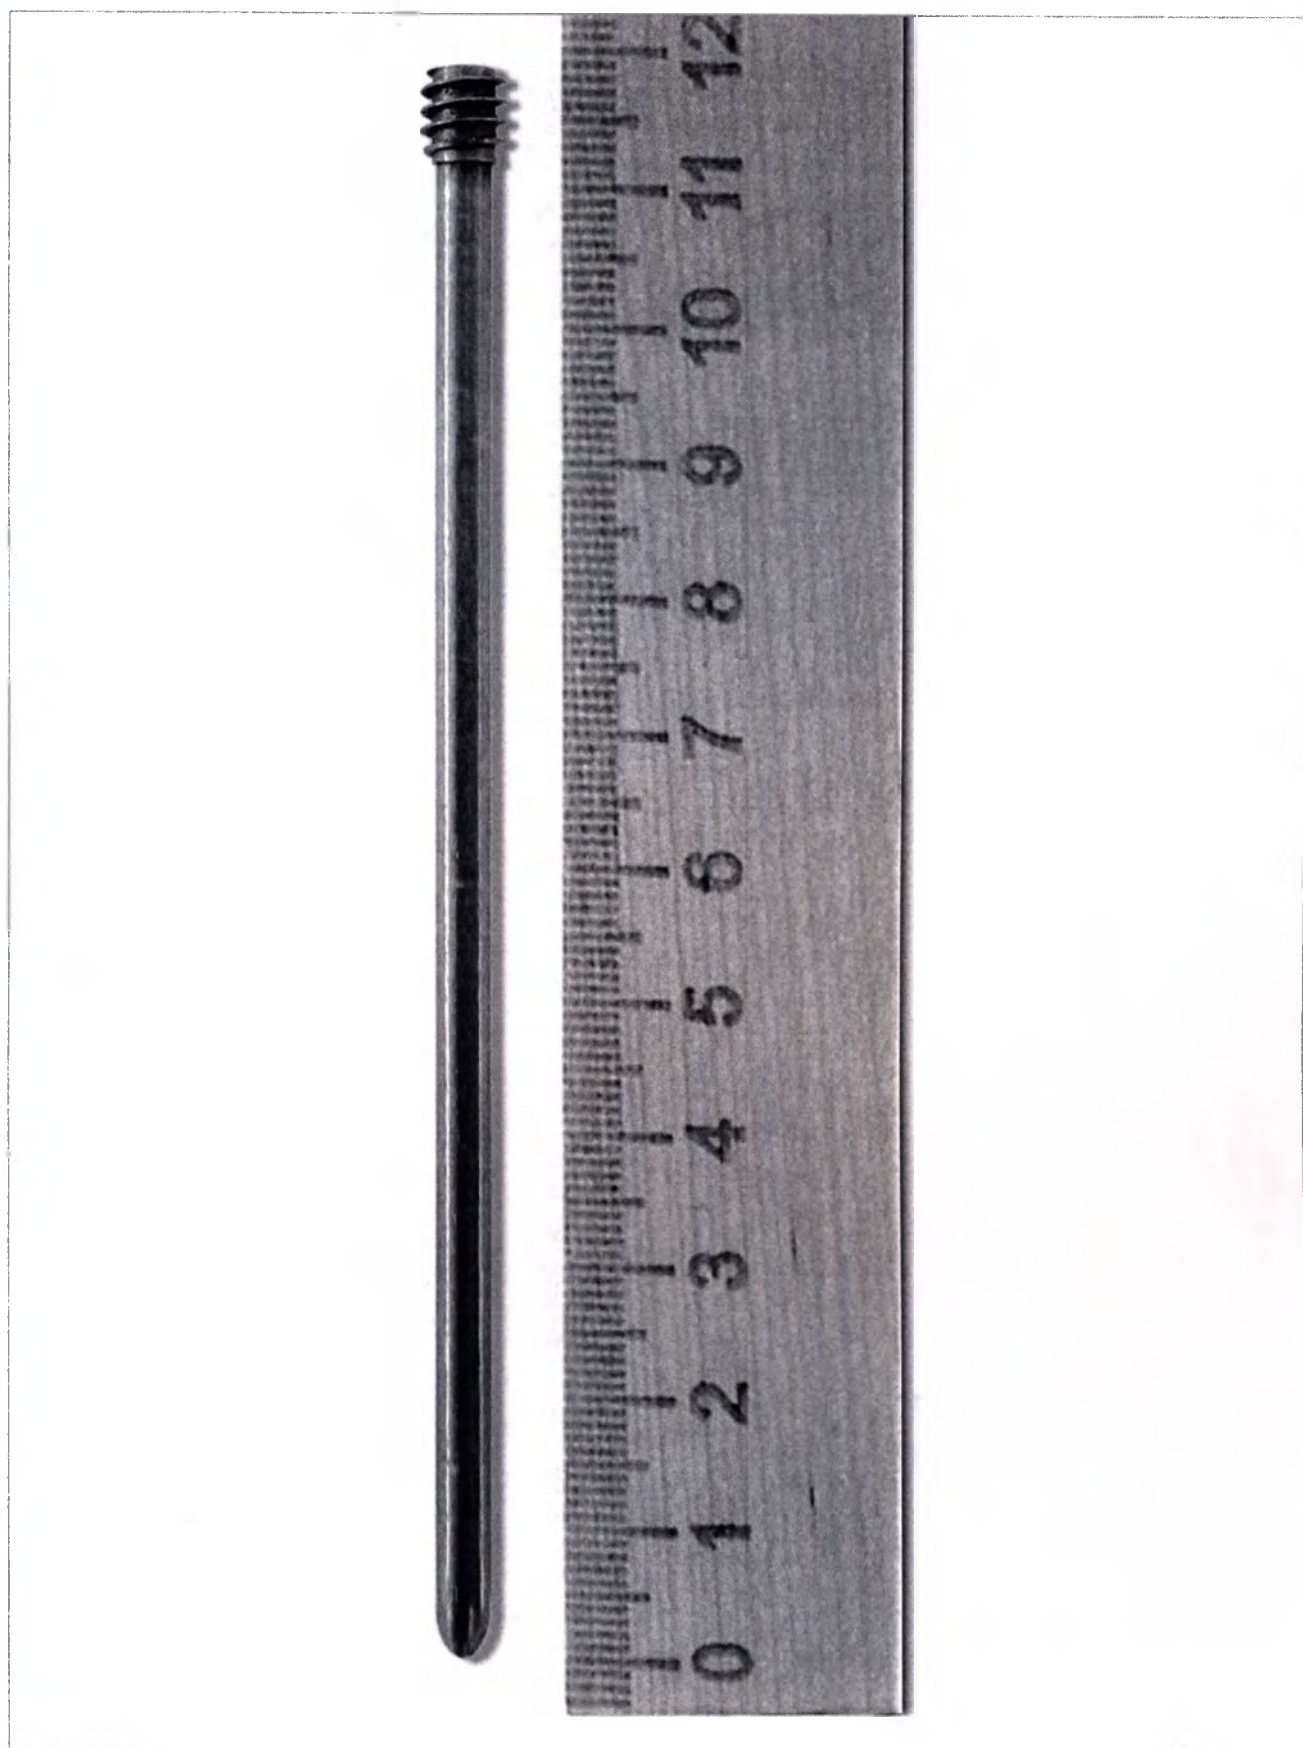

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 16 лист(ов)

Руководитель организации

