

"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по управлению процессами
регистрации и сертификации России и СНГ
ООО «ДжиИ Хэлскеа»



Н.С.Анхимова
_____ 2015г

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

" Аппарат рентгеновский Precision RXi с принадлежностями "

1. АППАРАТ РЕНТГЕНОВСКИЙ PRECISION RXi

1. Стол рентгеновской системы с дистанционным управлением.




2. Рентгеновский высоковольтный генератор




3. Рентгеновский излучатель (не более 2 шт.)




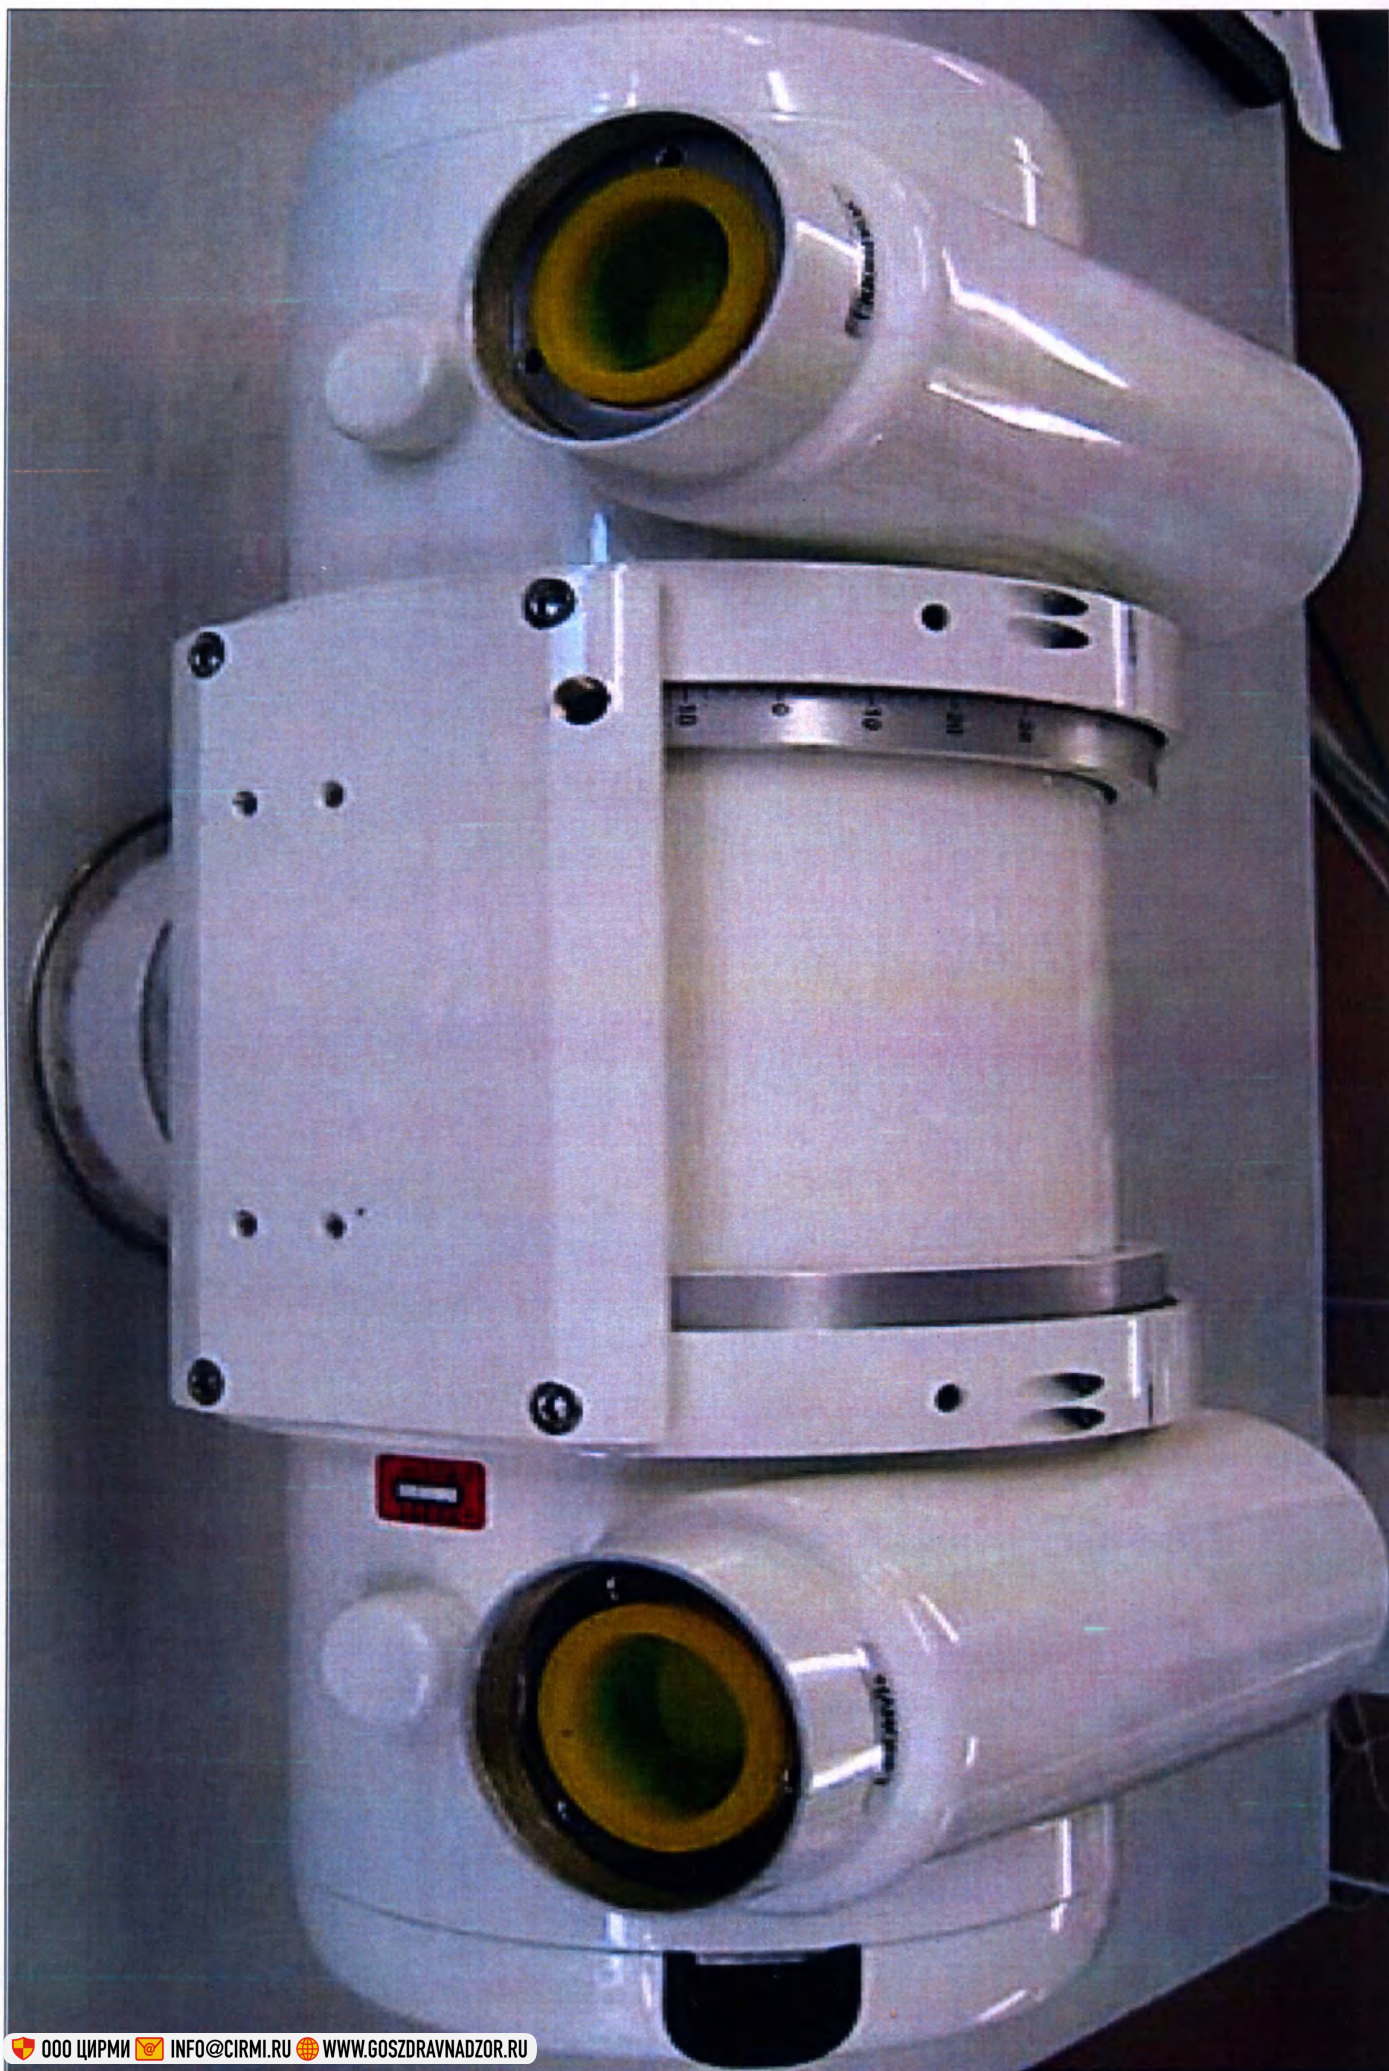


II. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

1. Коллиматор.

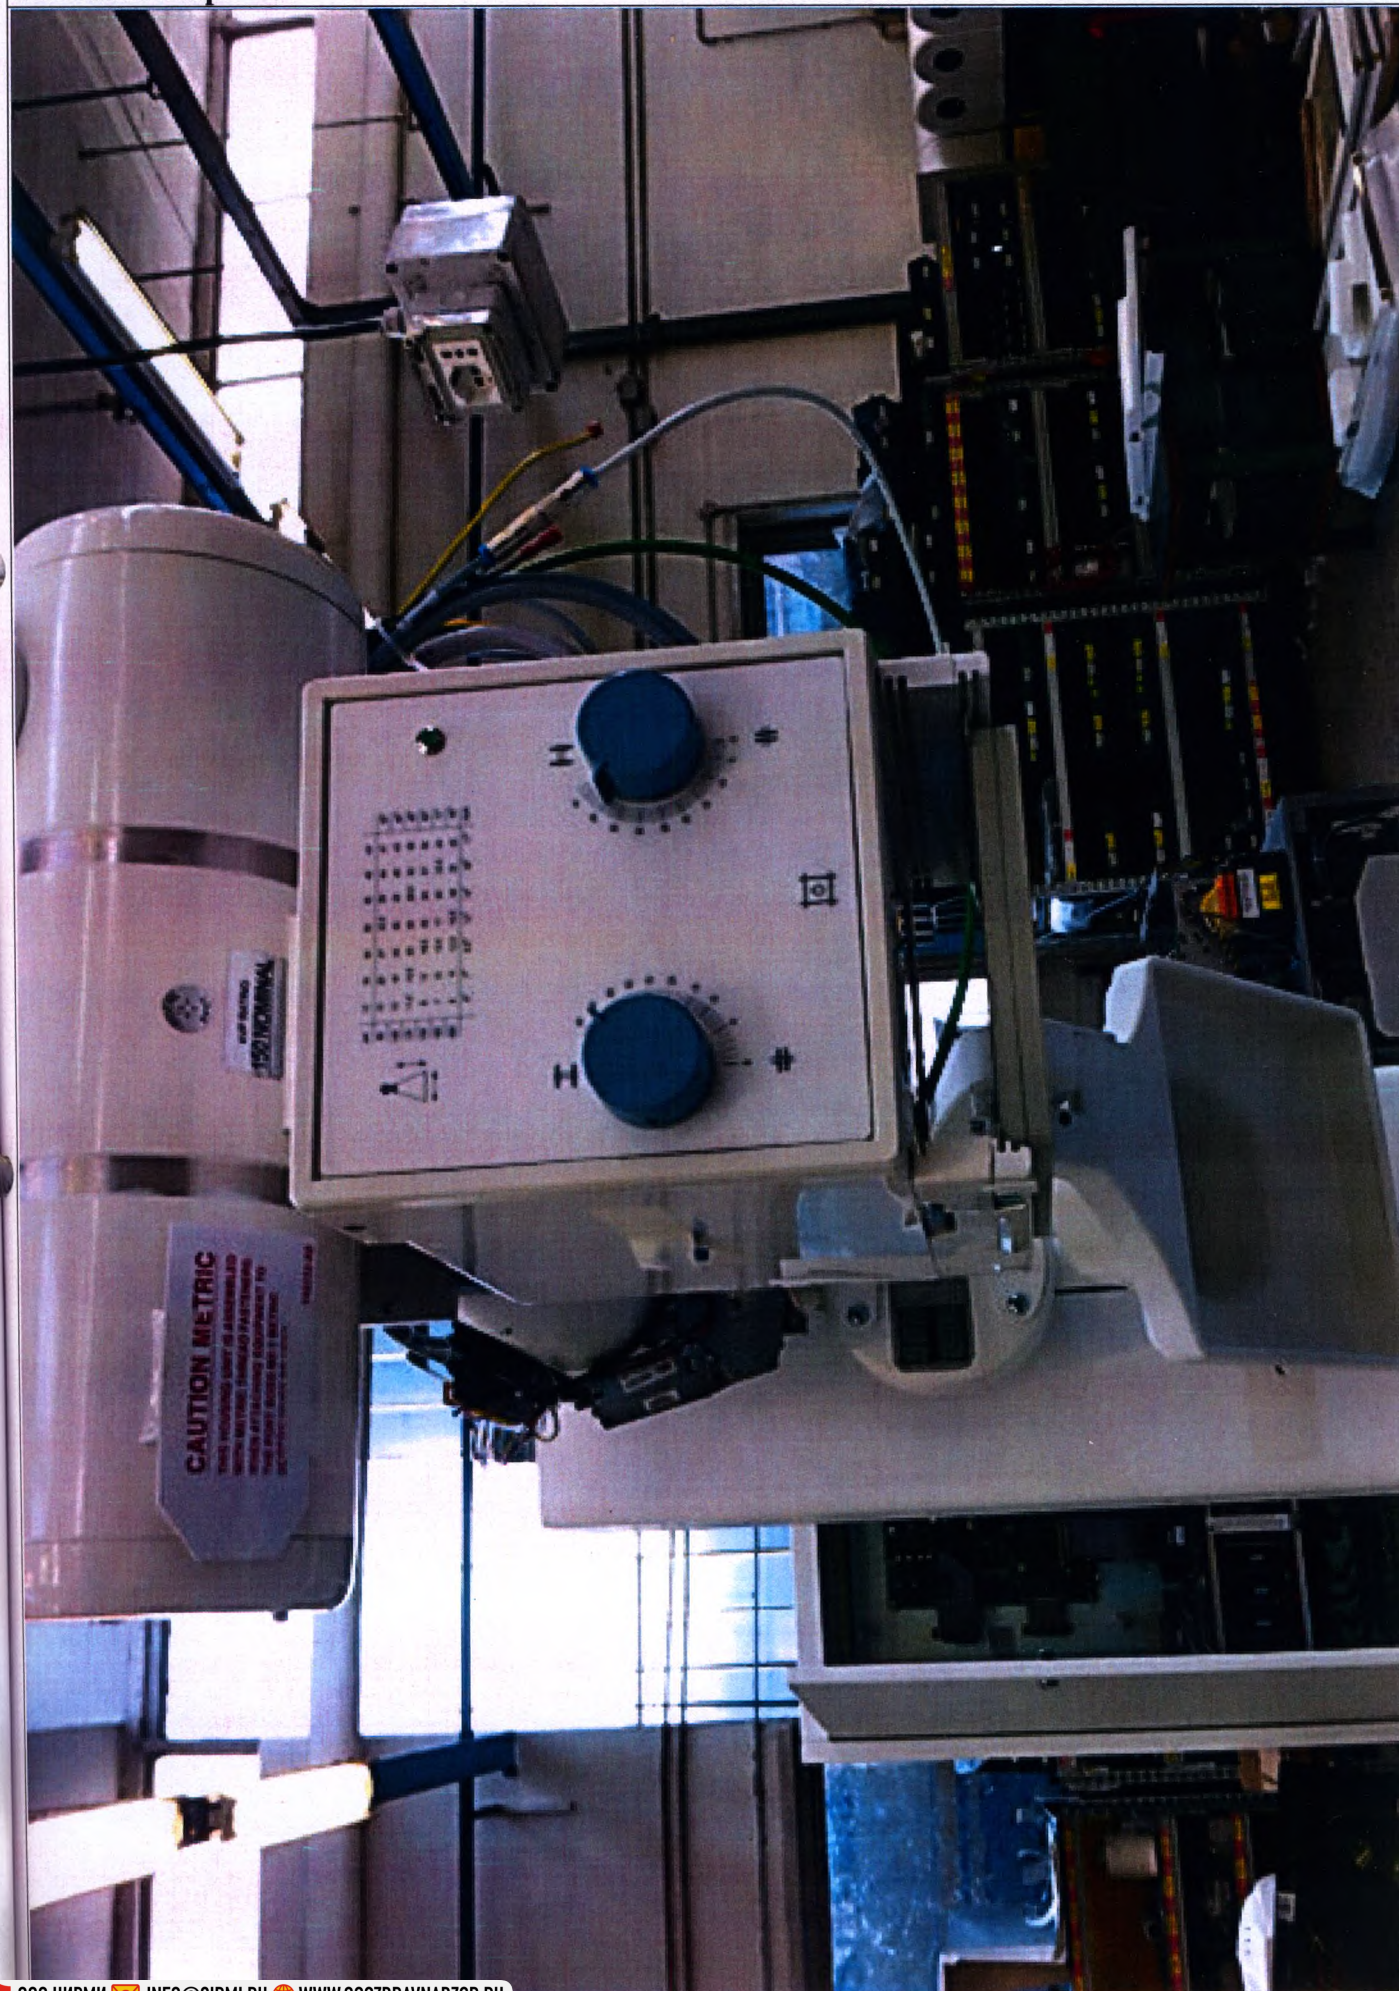

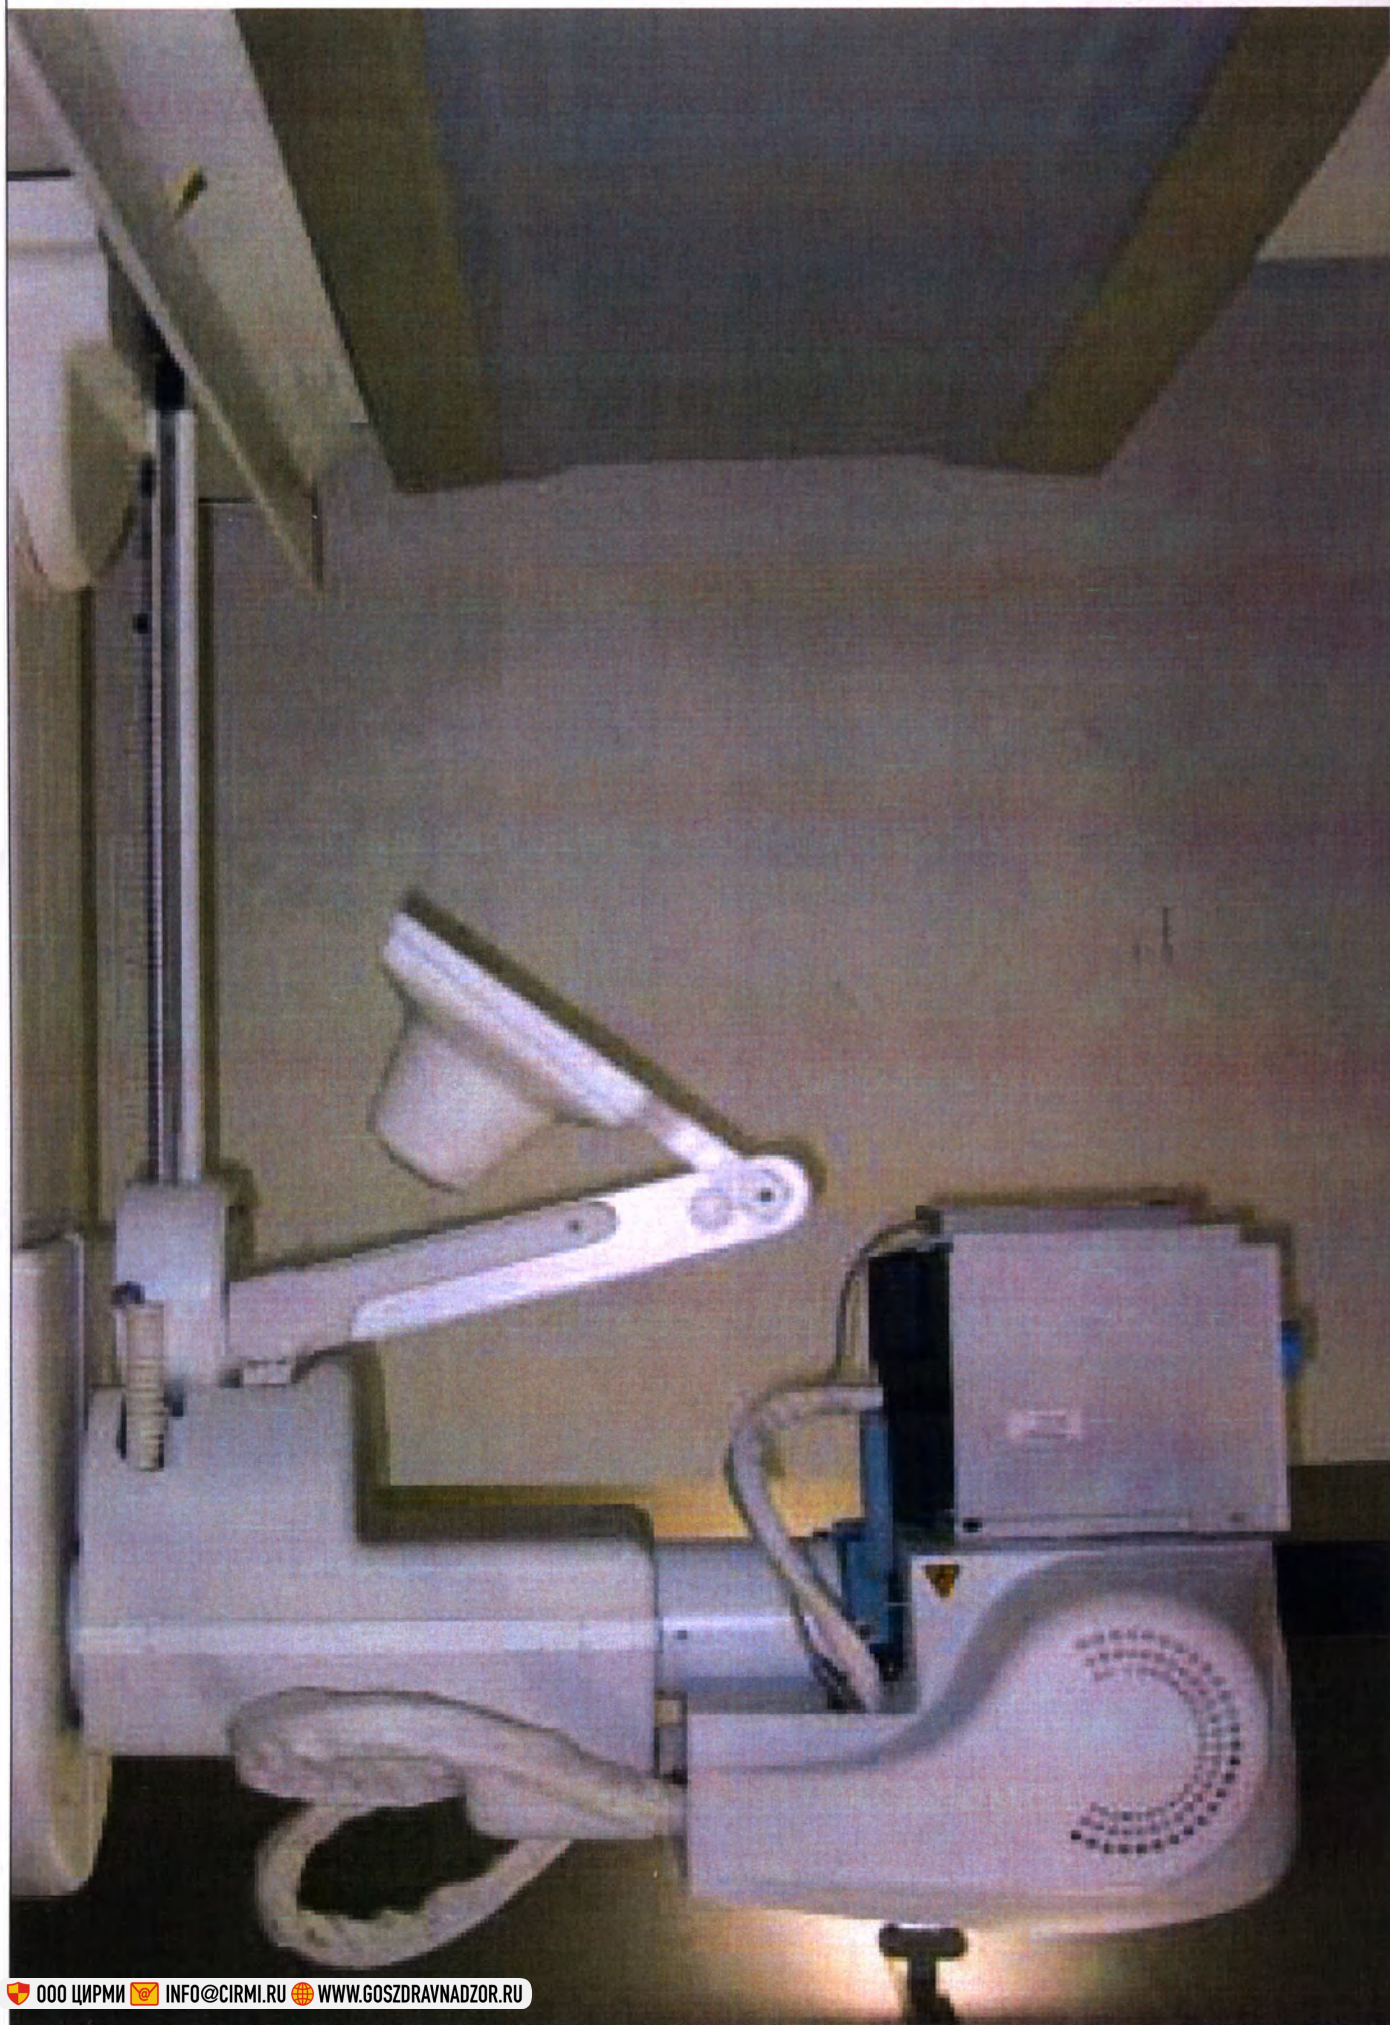


2. Электронно-оптический преобразователь.

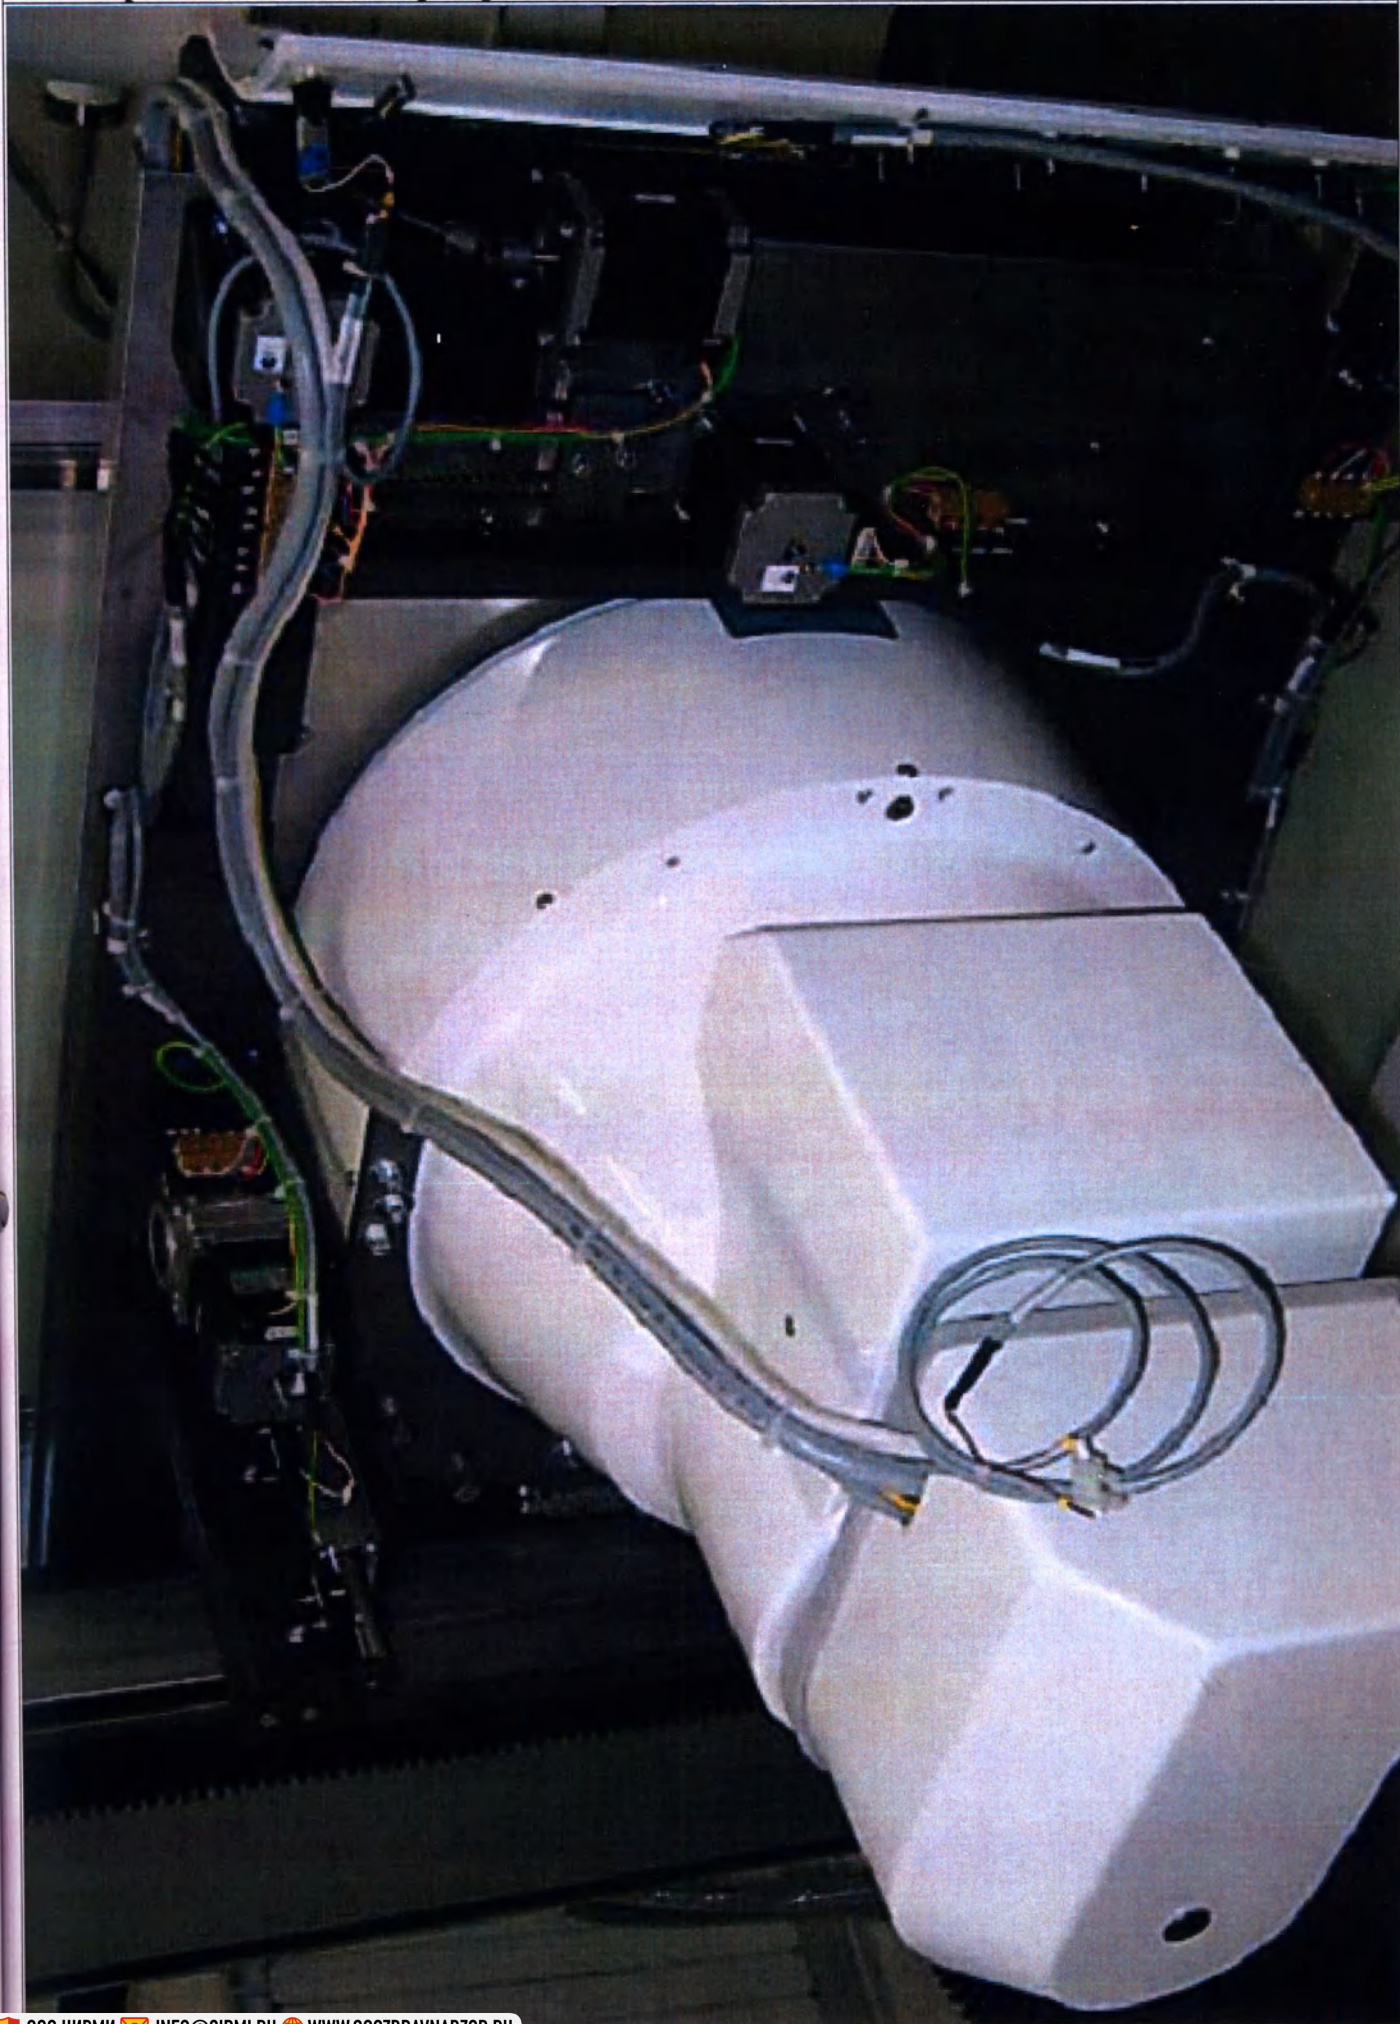


3. Мониторы жидкокристаллические (не более 4 шт.)



4. Пульт дистанционного управления столом.

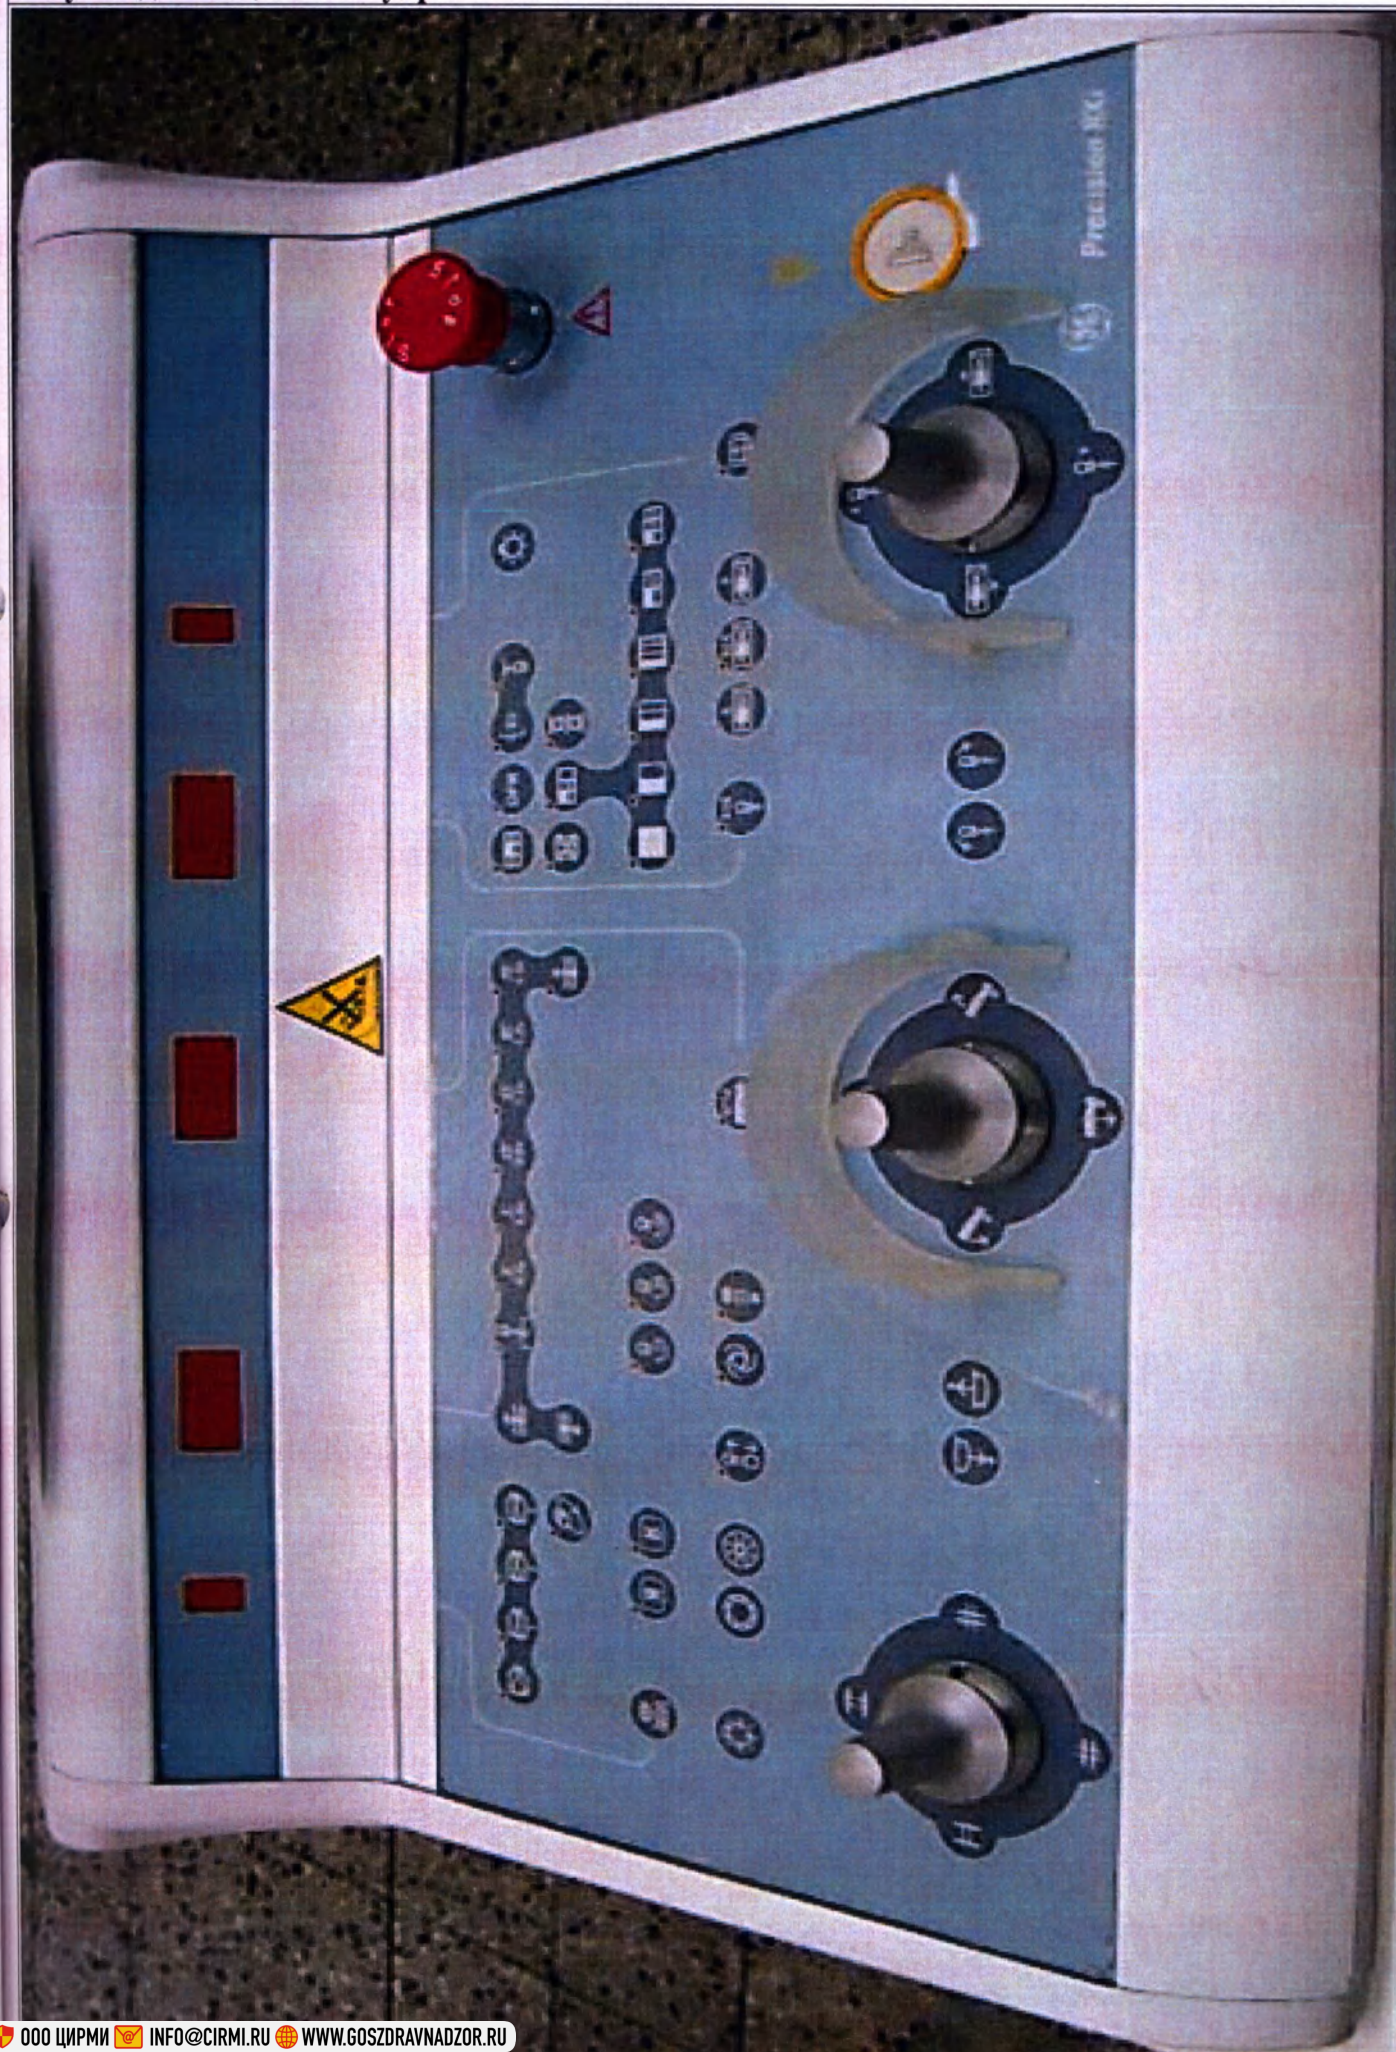

5. Дозиметры (не более 2 шт.)

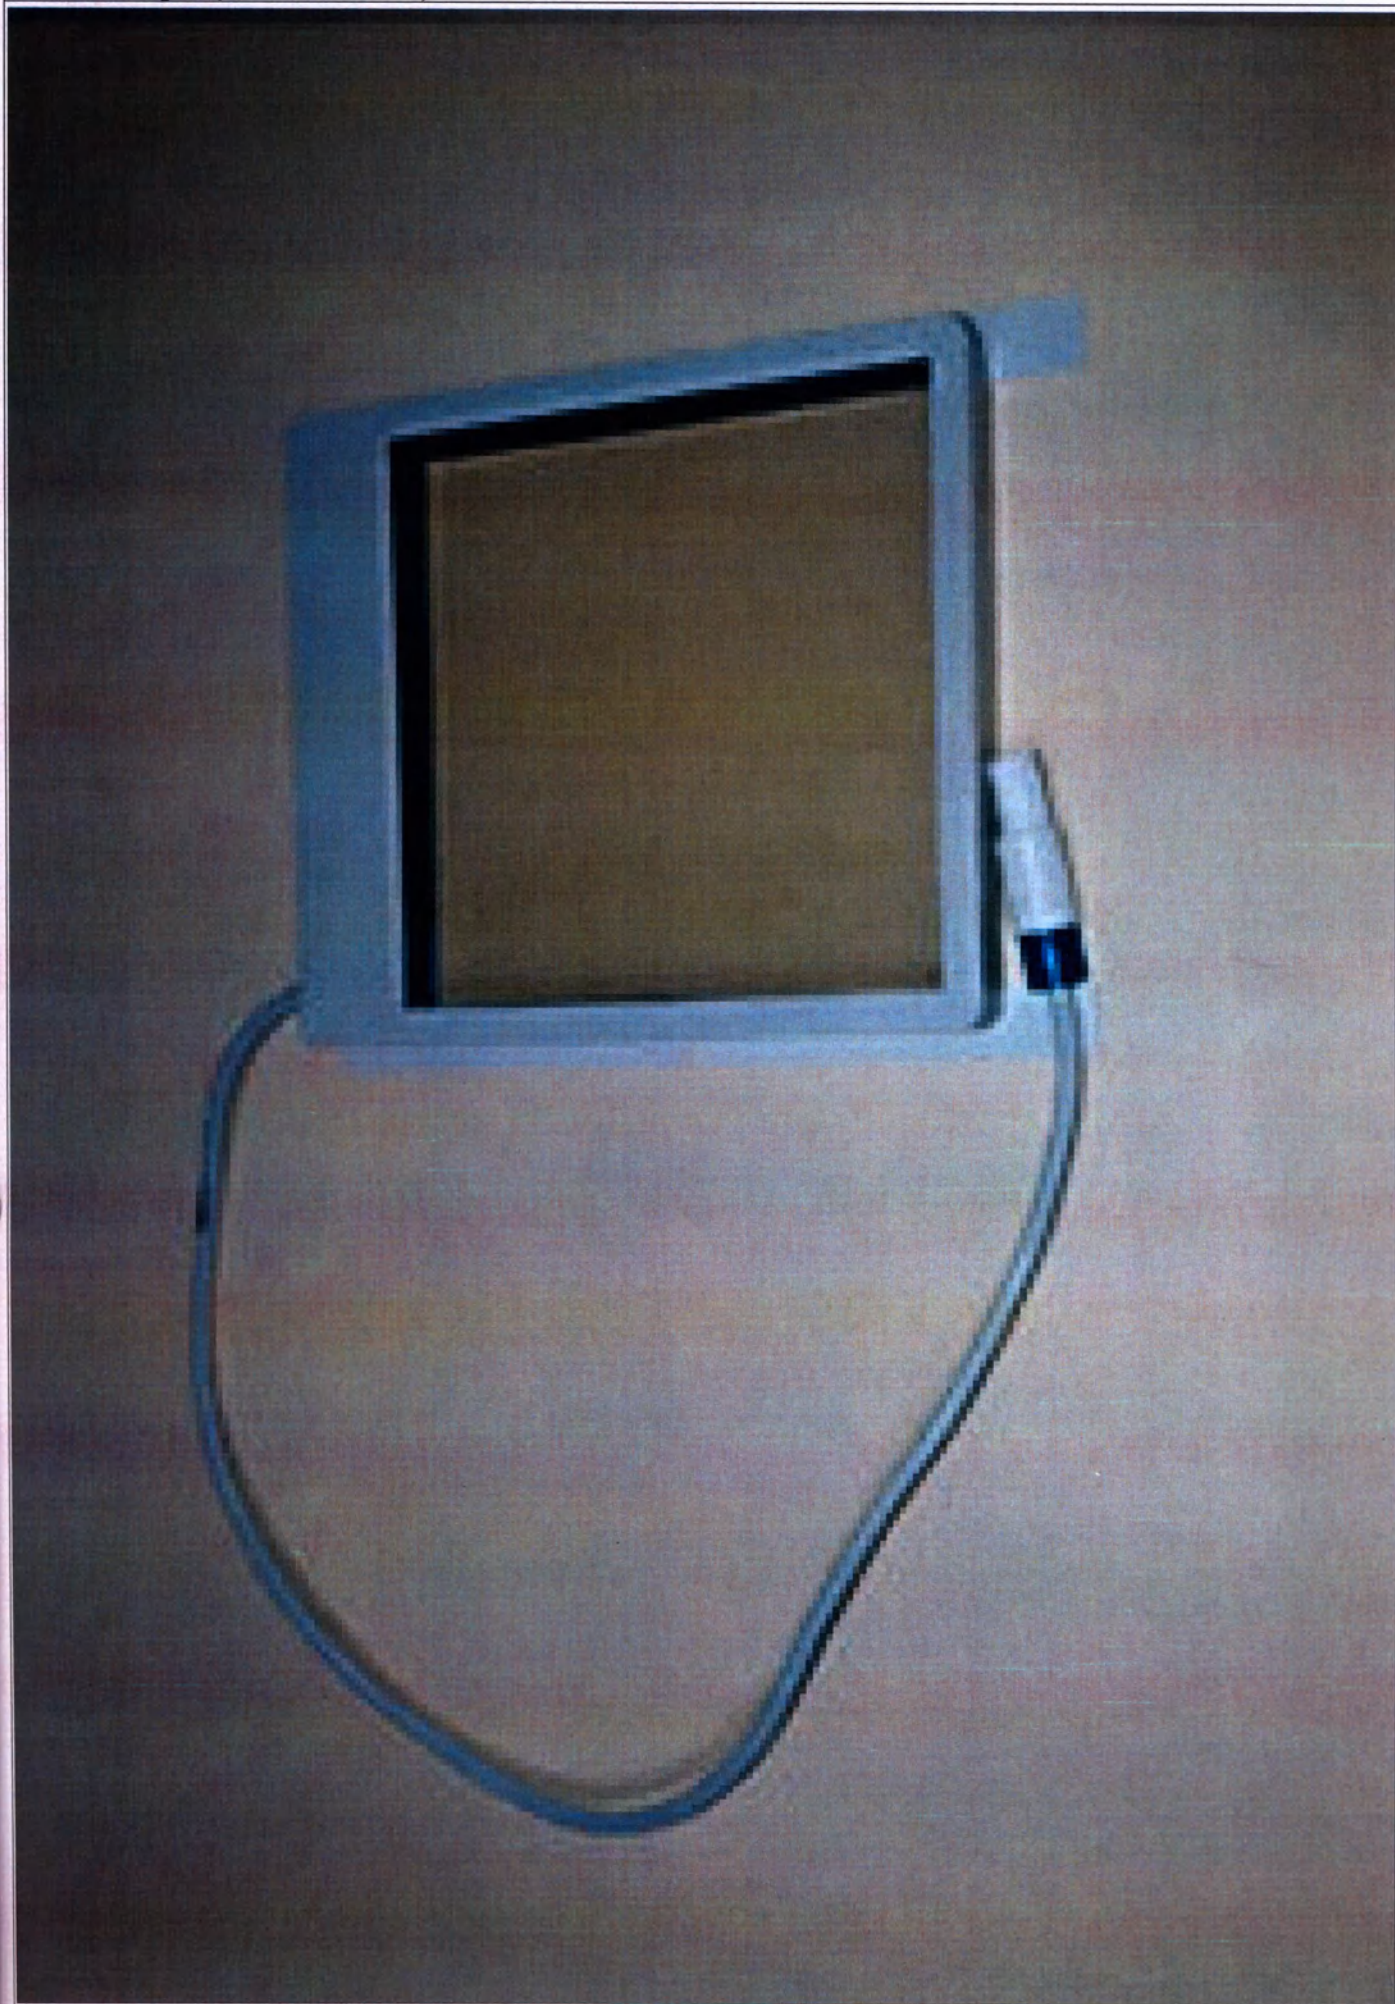


6. Принтер для дозиметра.




7. Тележка для мониторов.



8. Потолочная подвеска для мониторов.

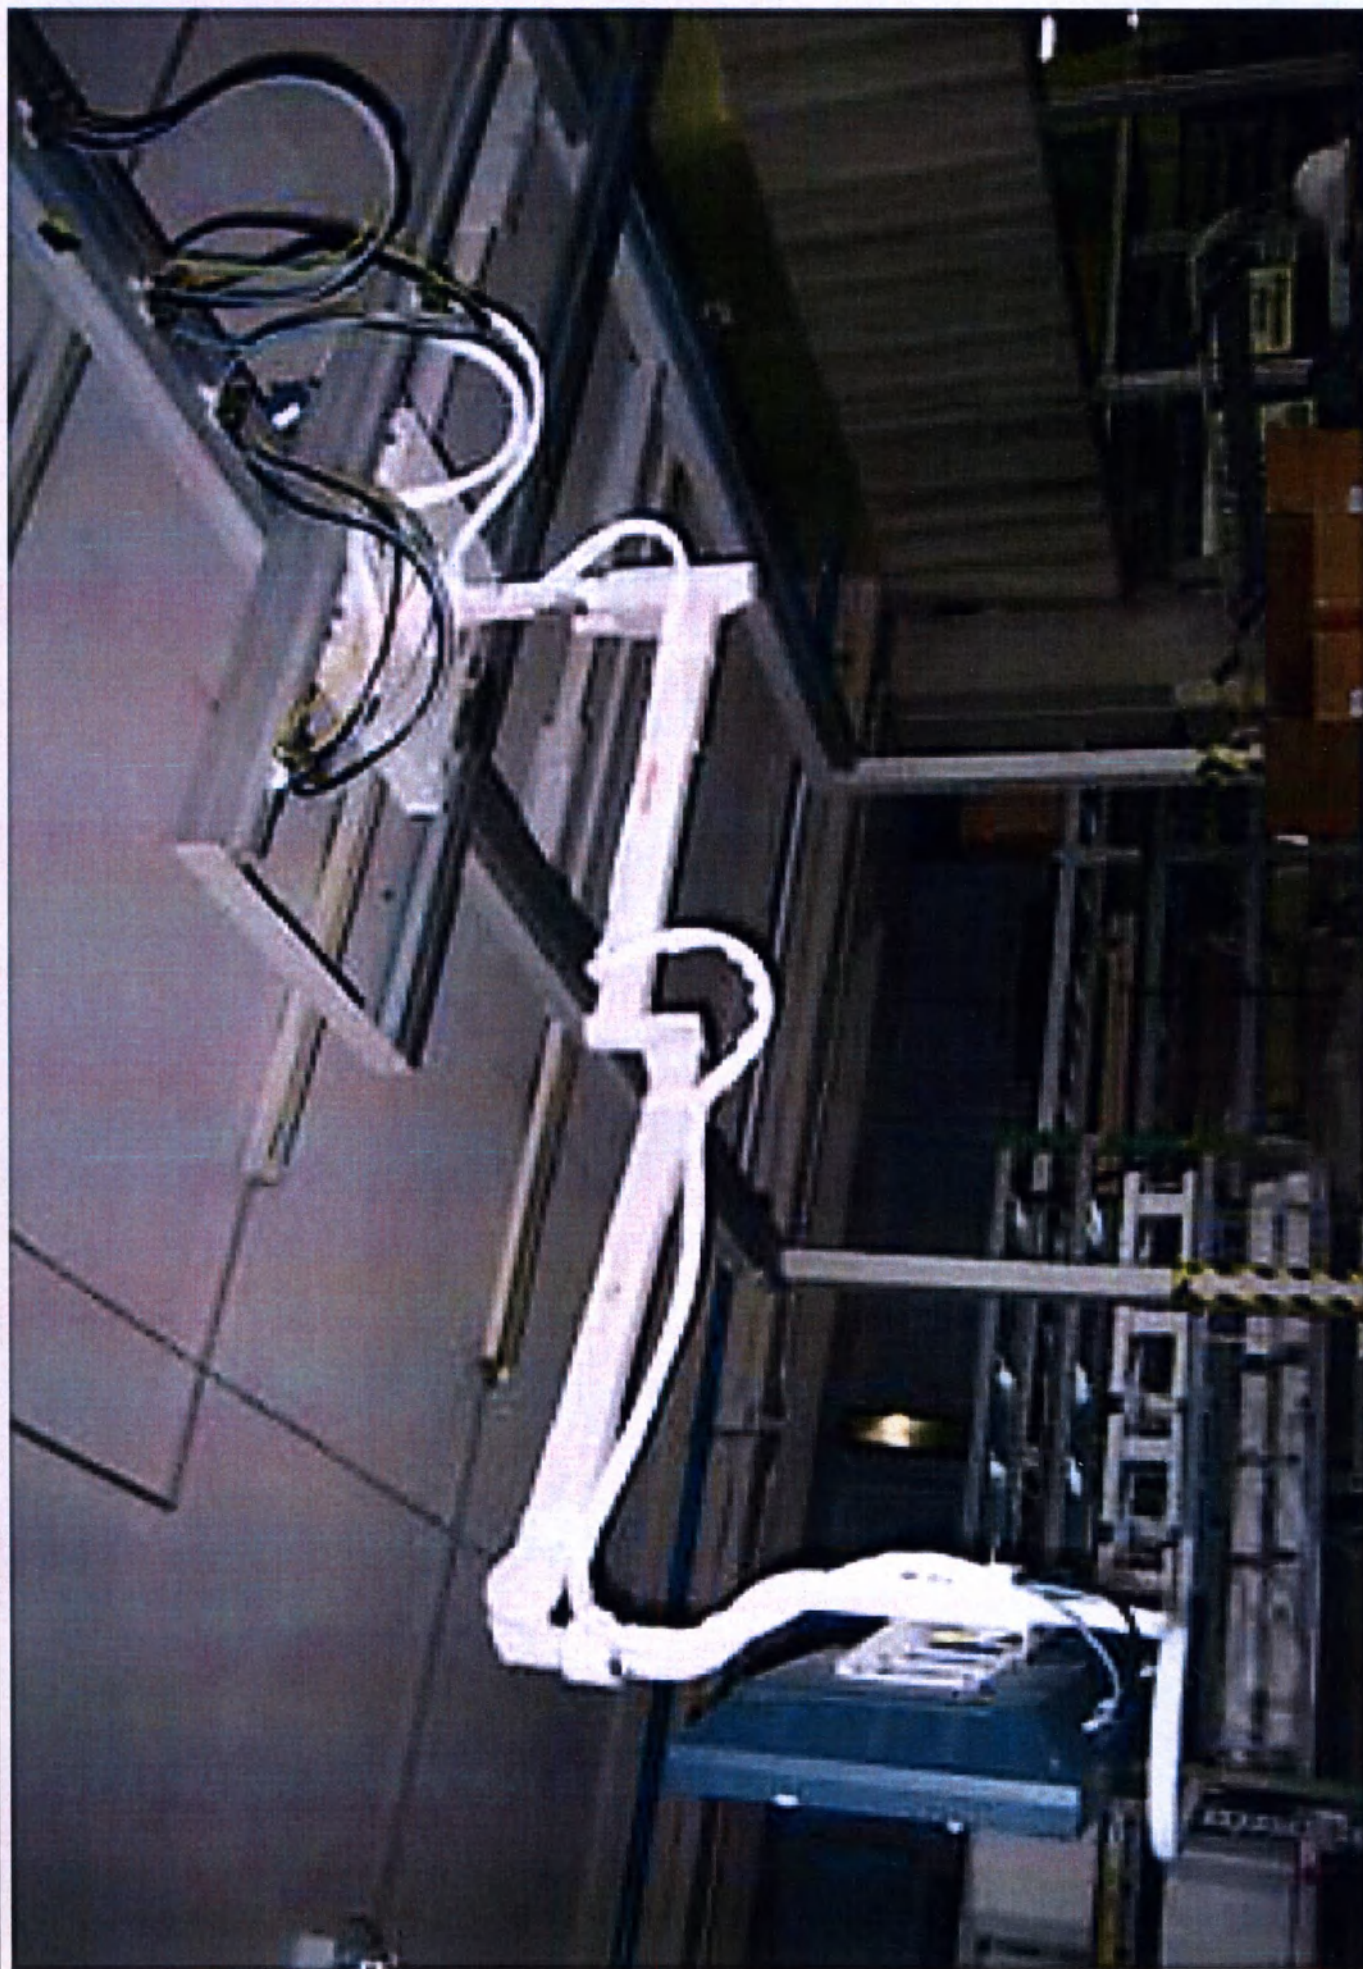


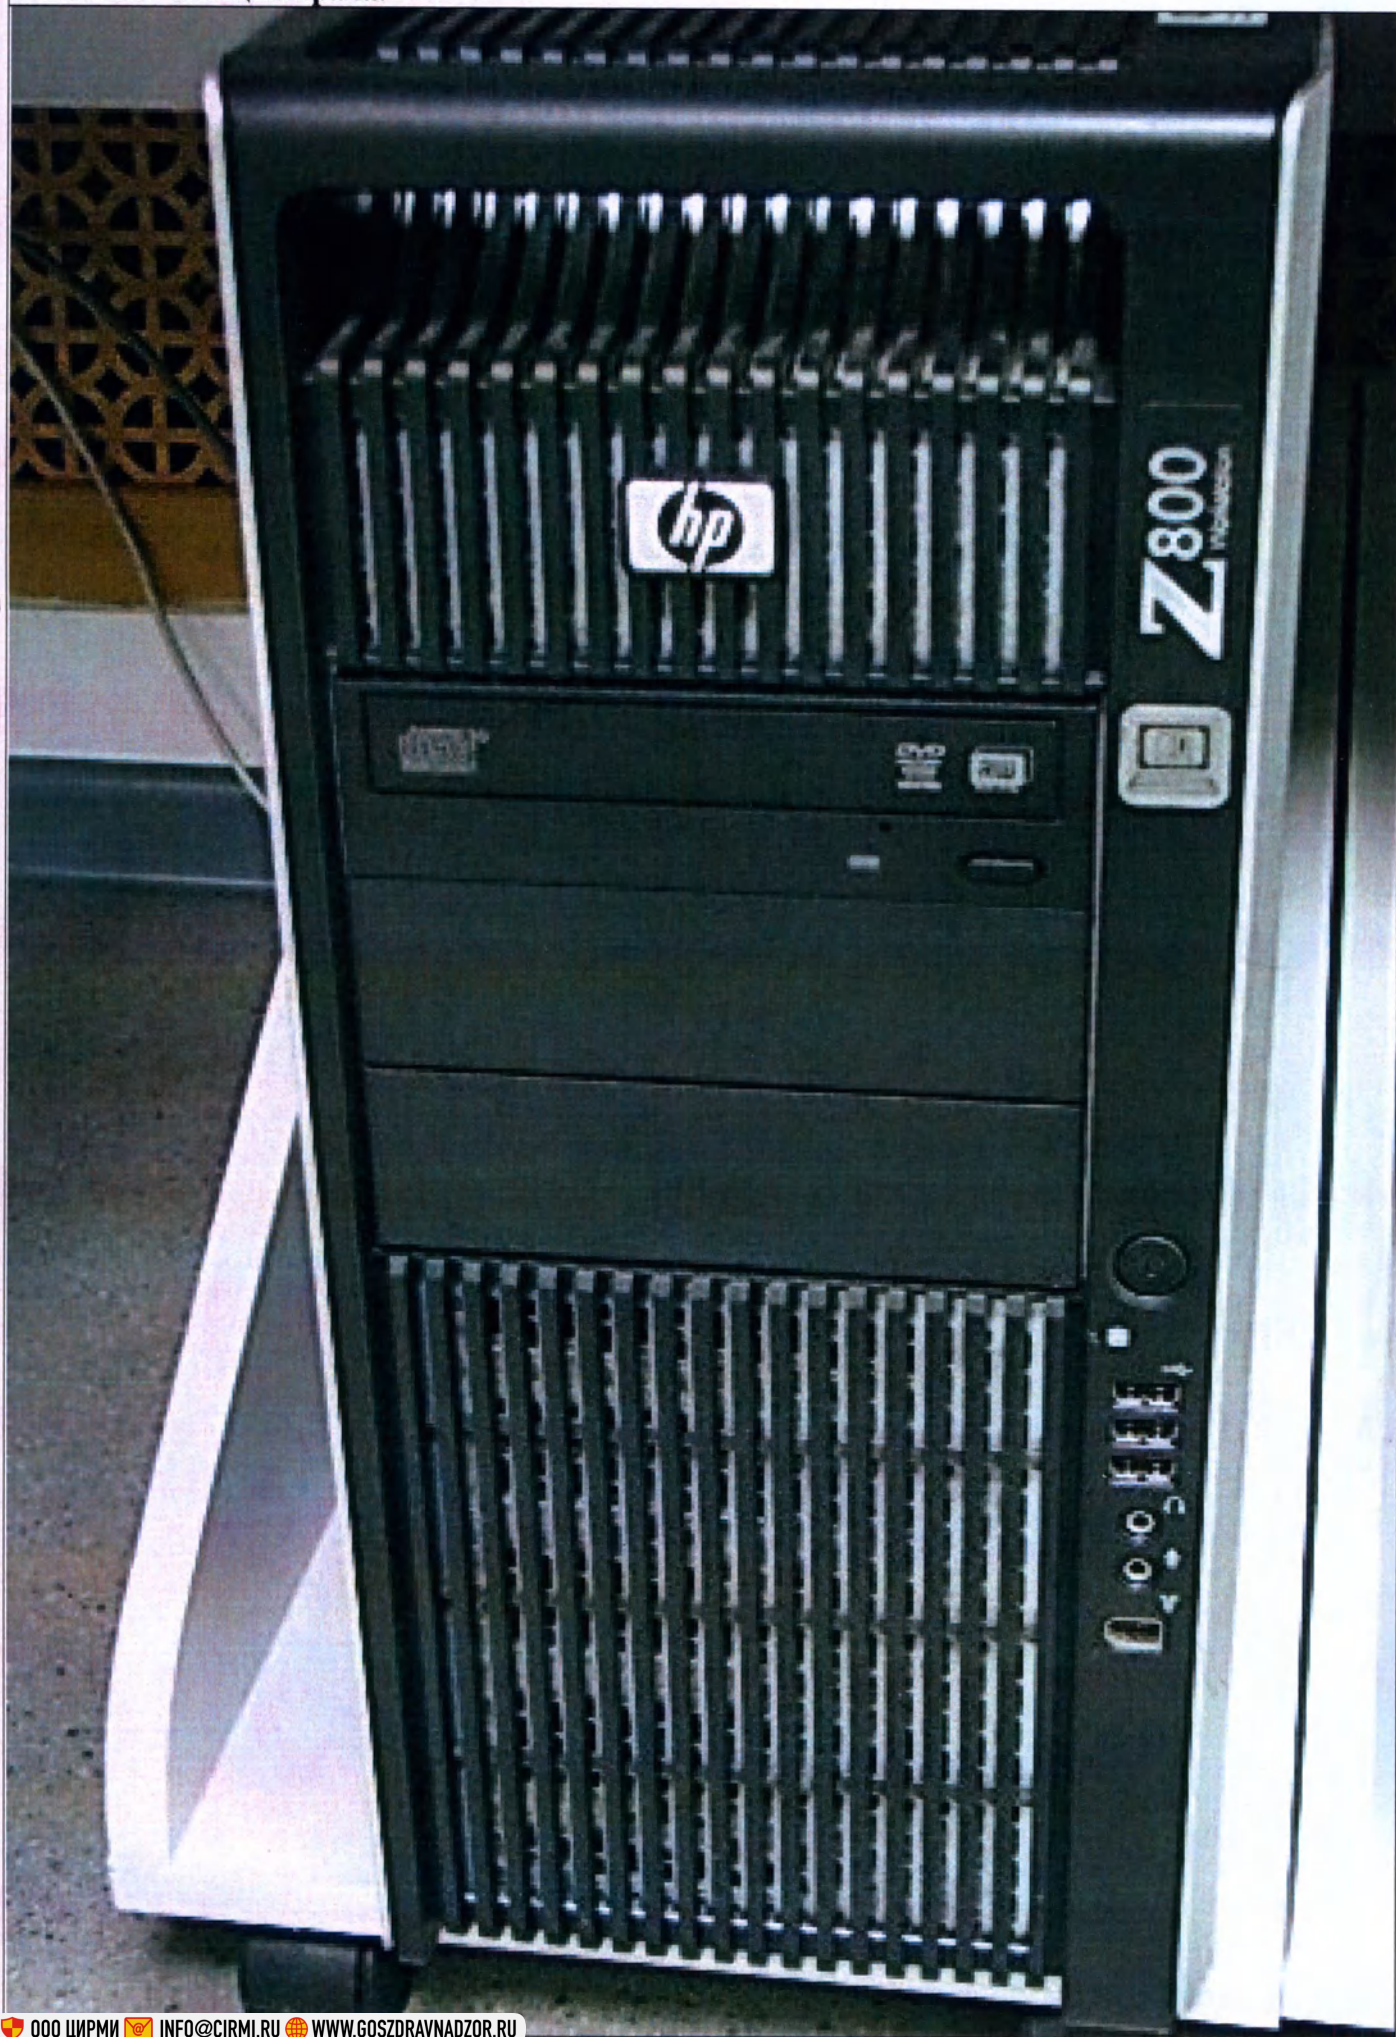


10. Стекло рентгенозащитное с рамой.




11. Стойка для снимков.

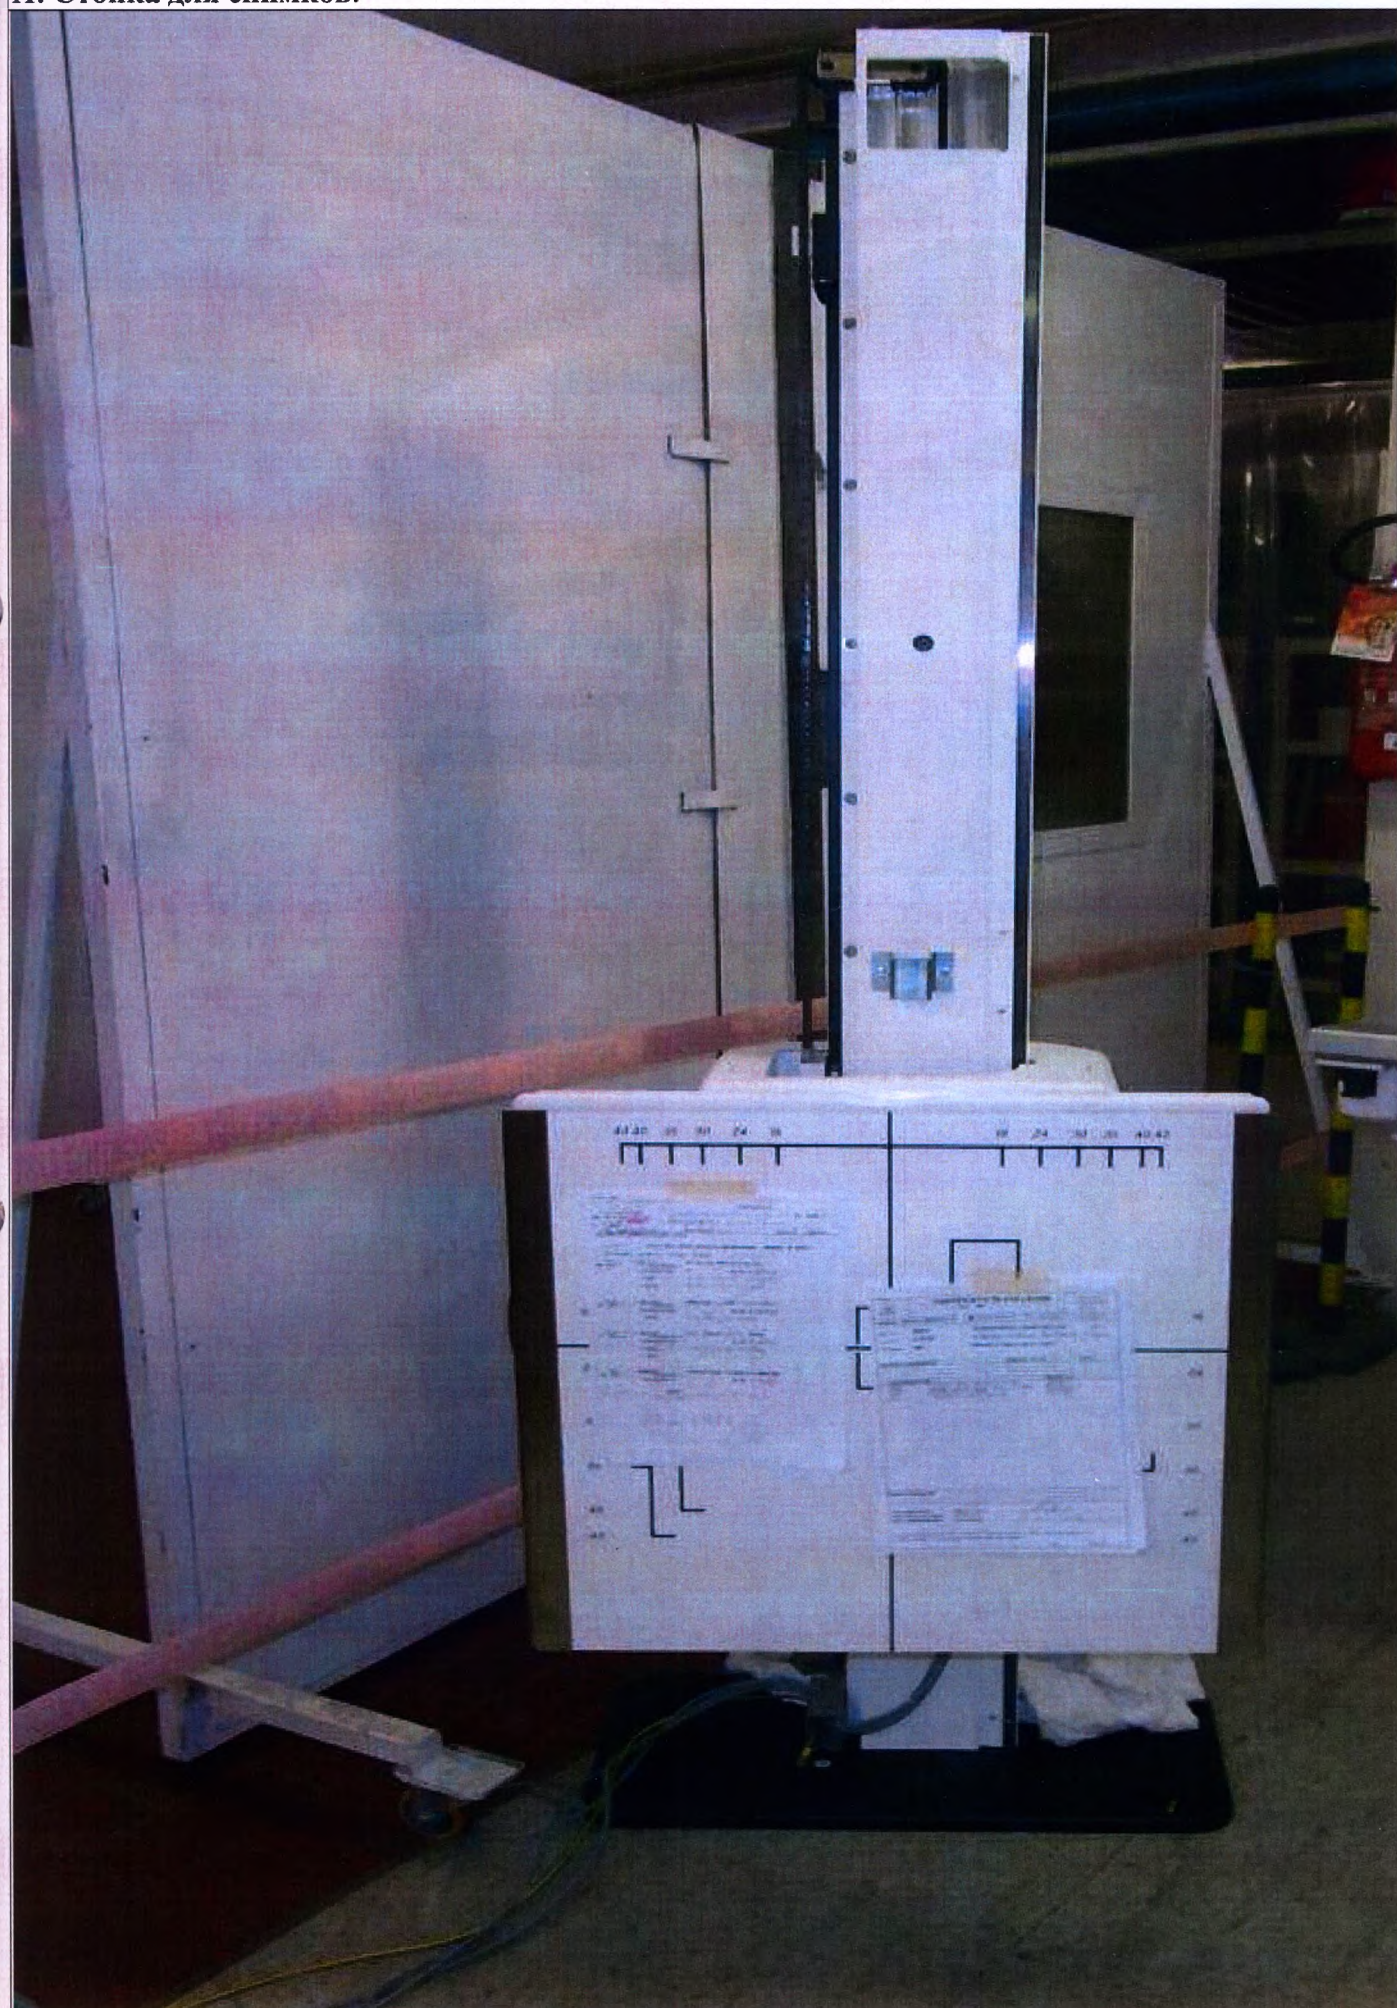

12. Держатель стойки для снимков.

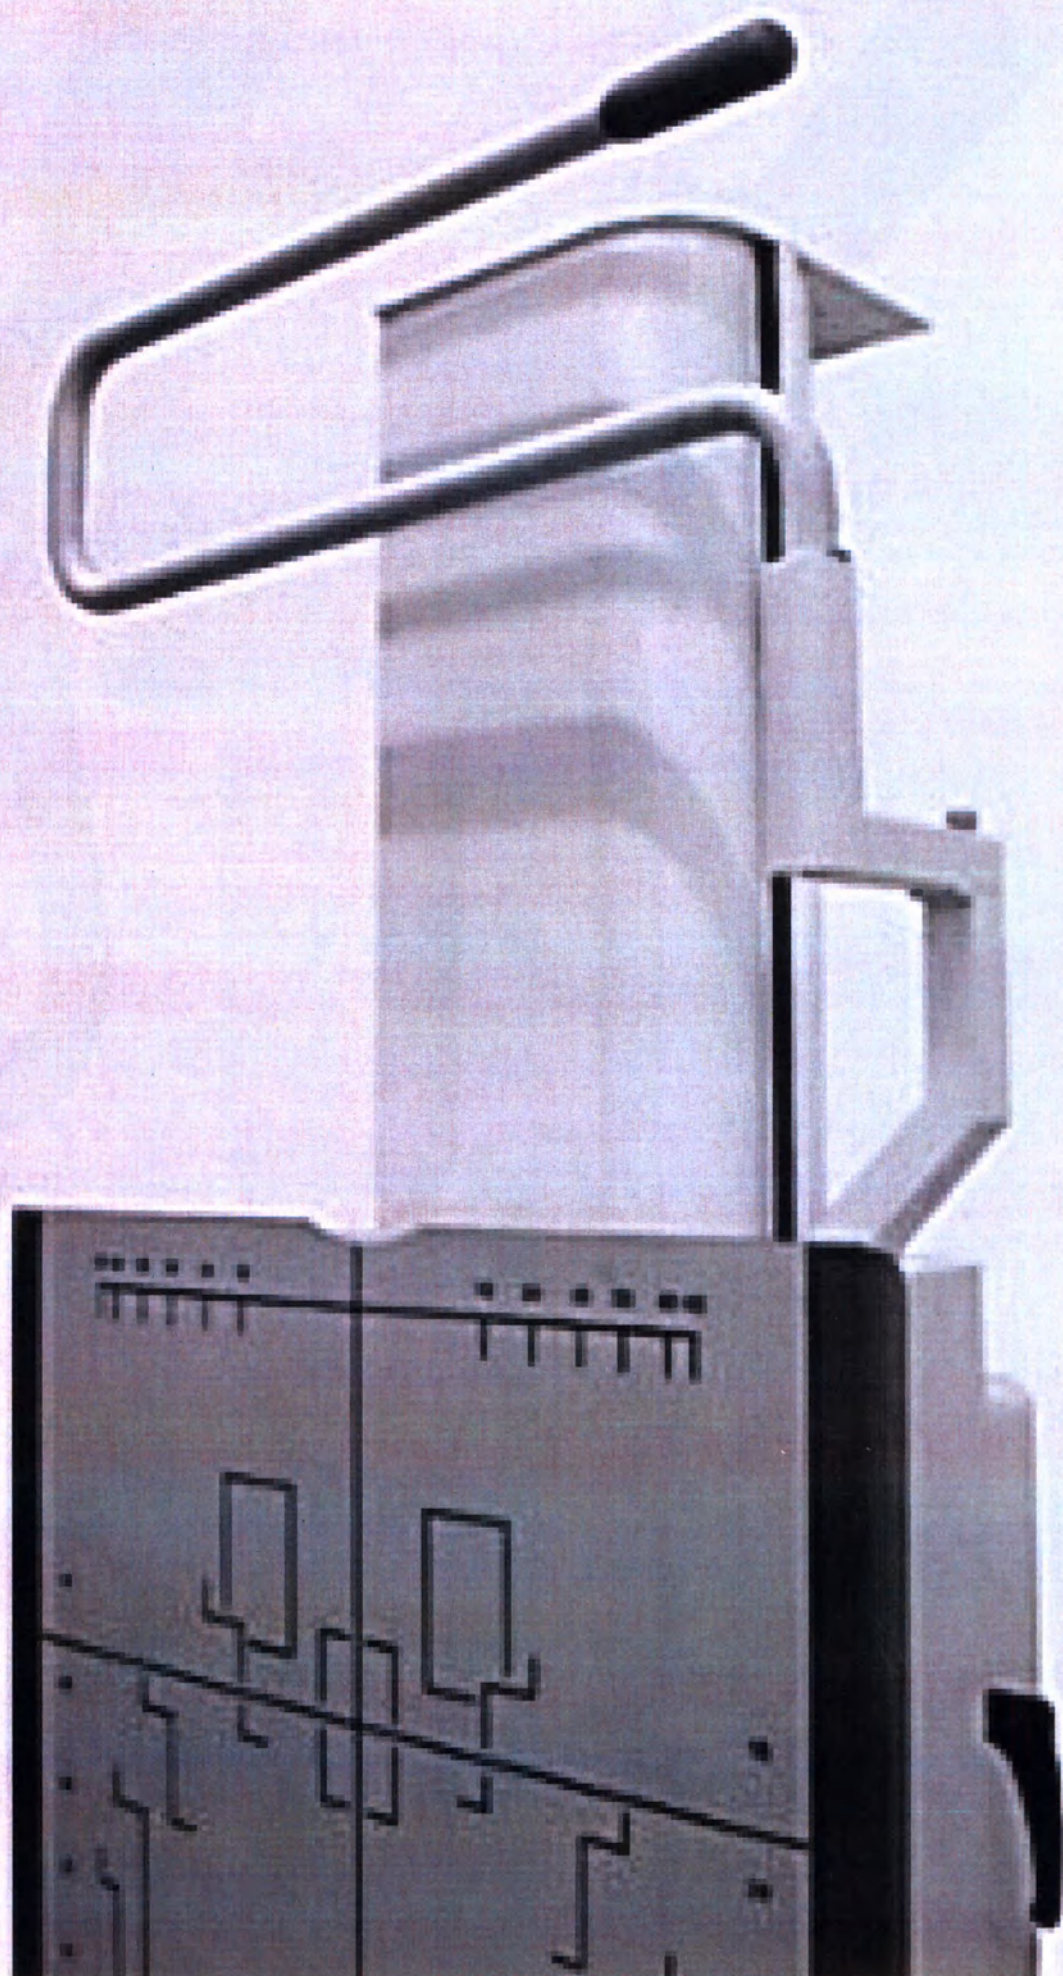



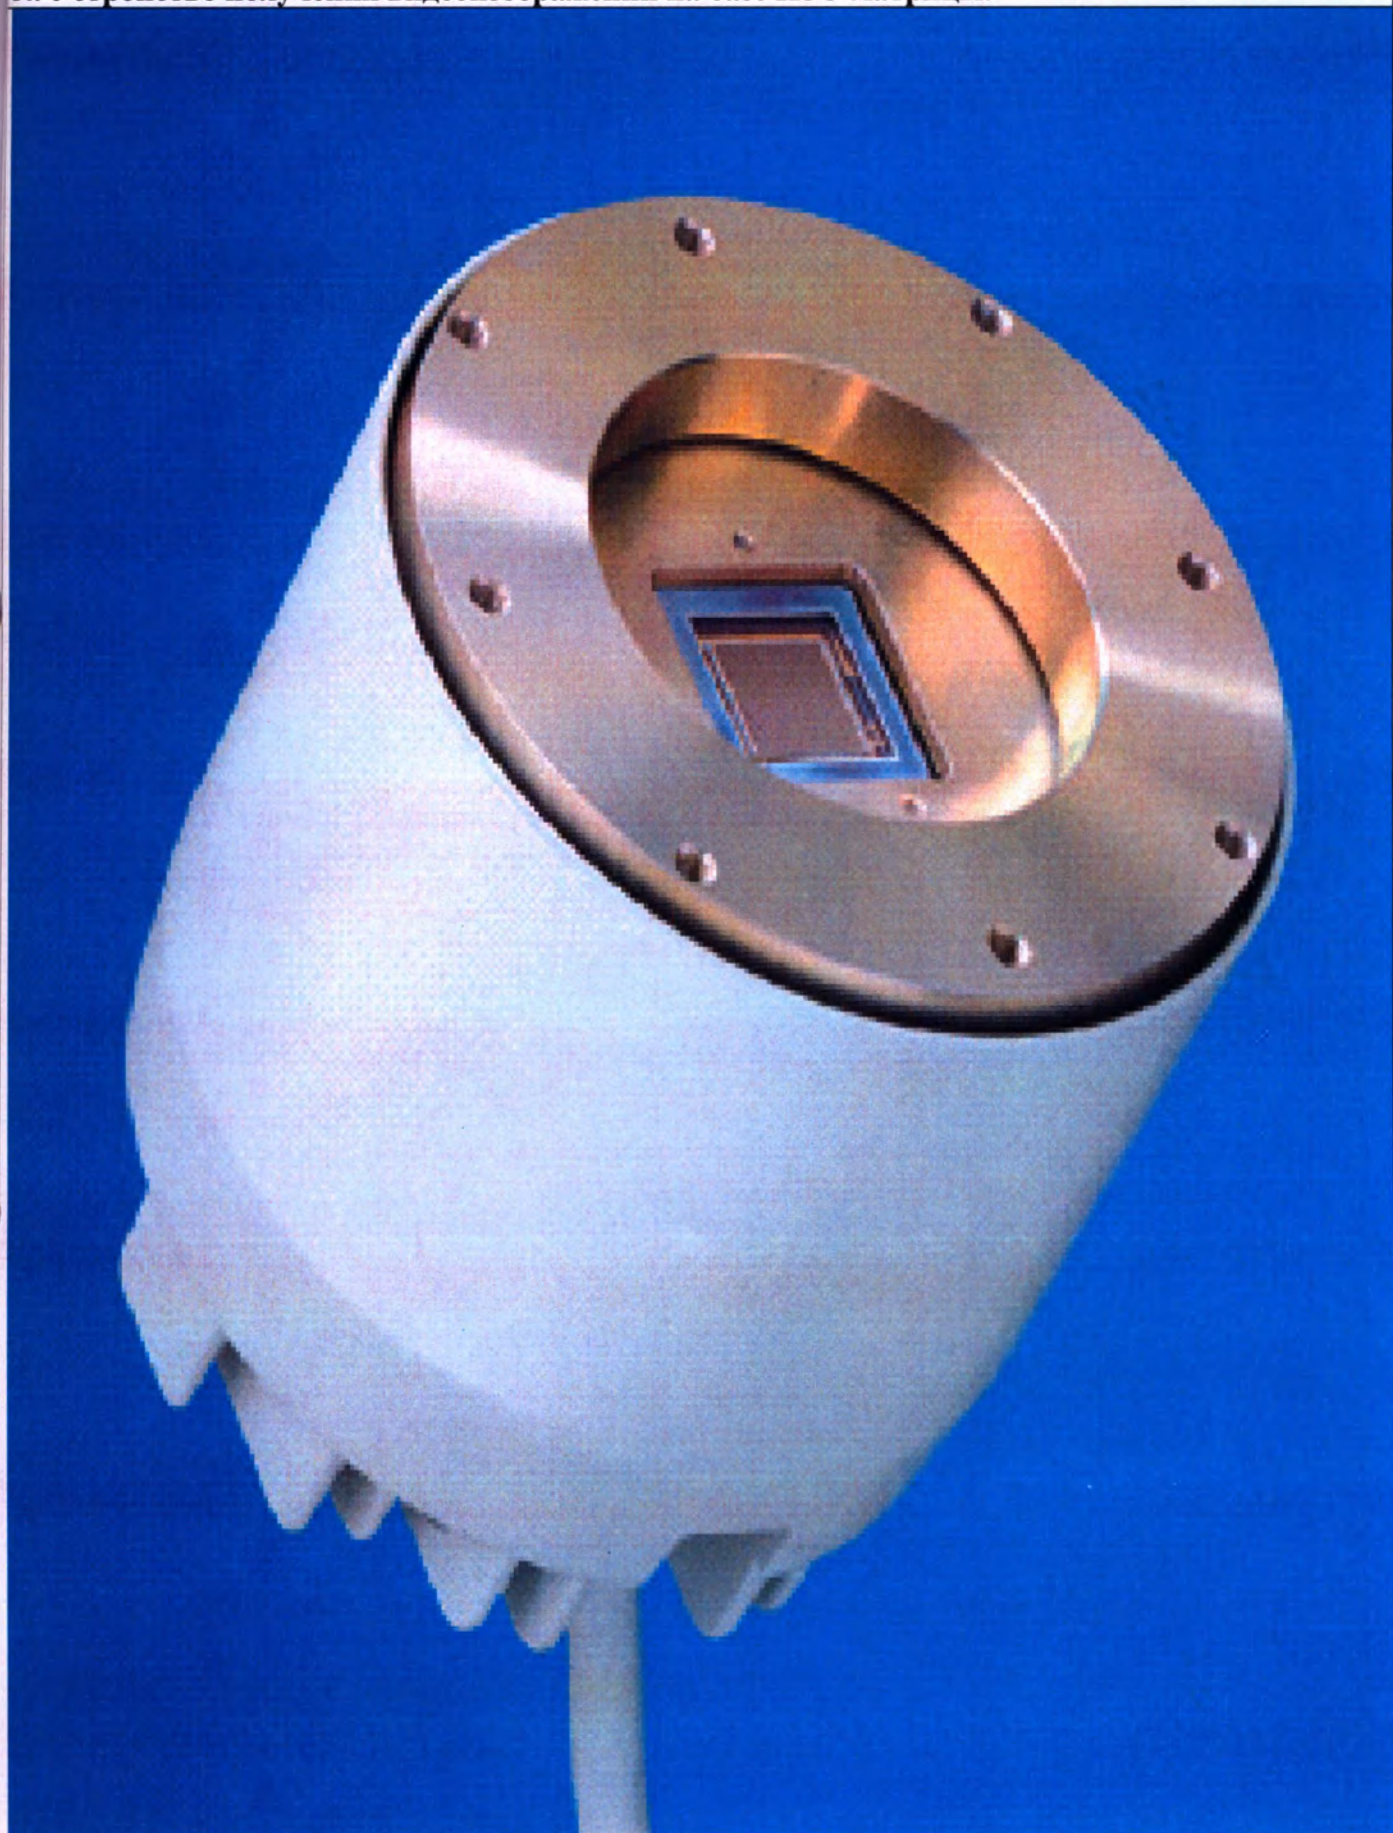




16. Крепление для стакана с барием.





17. Педаль для управления скопией.



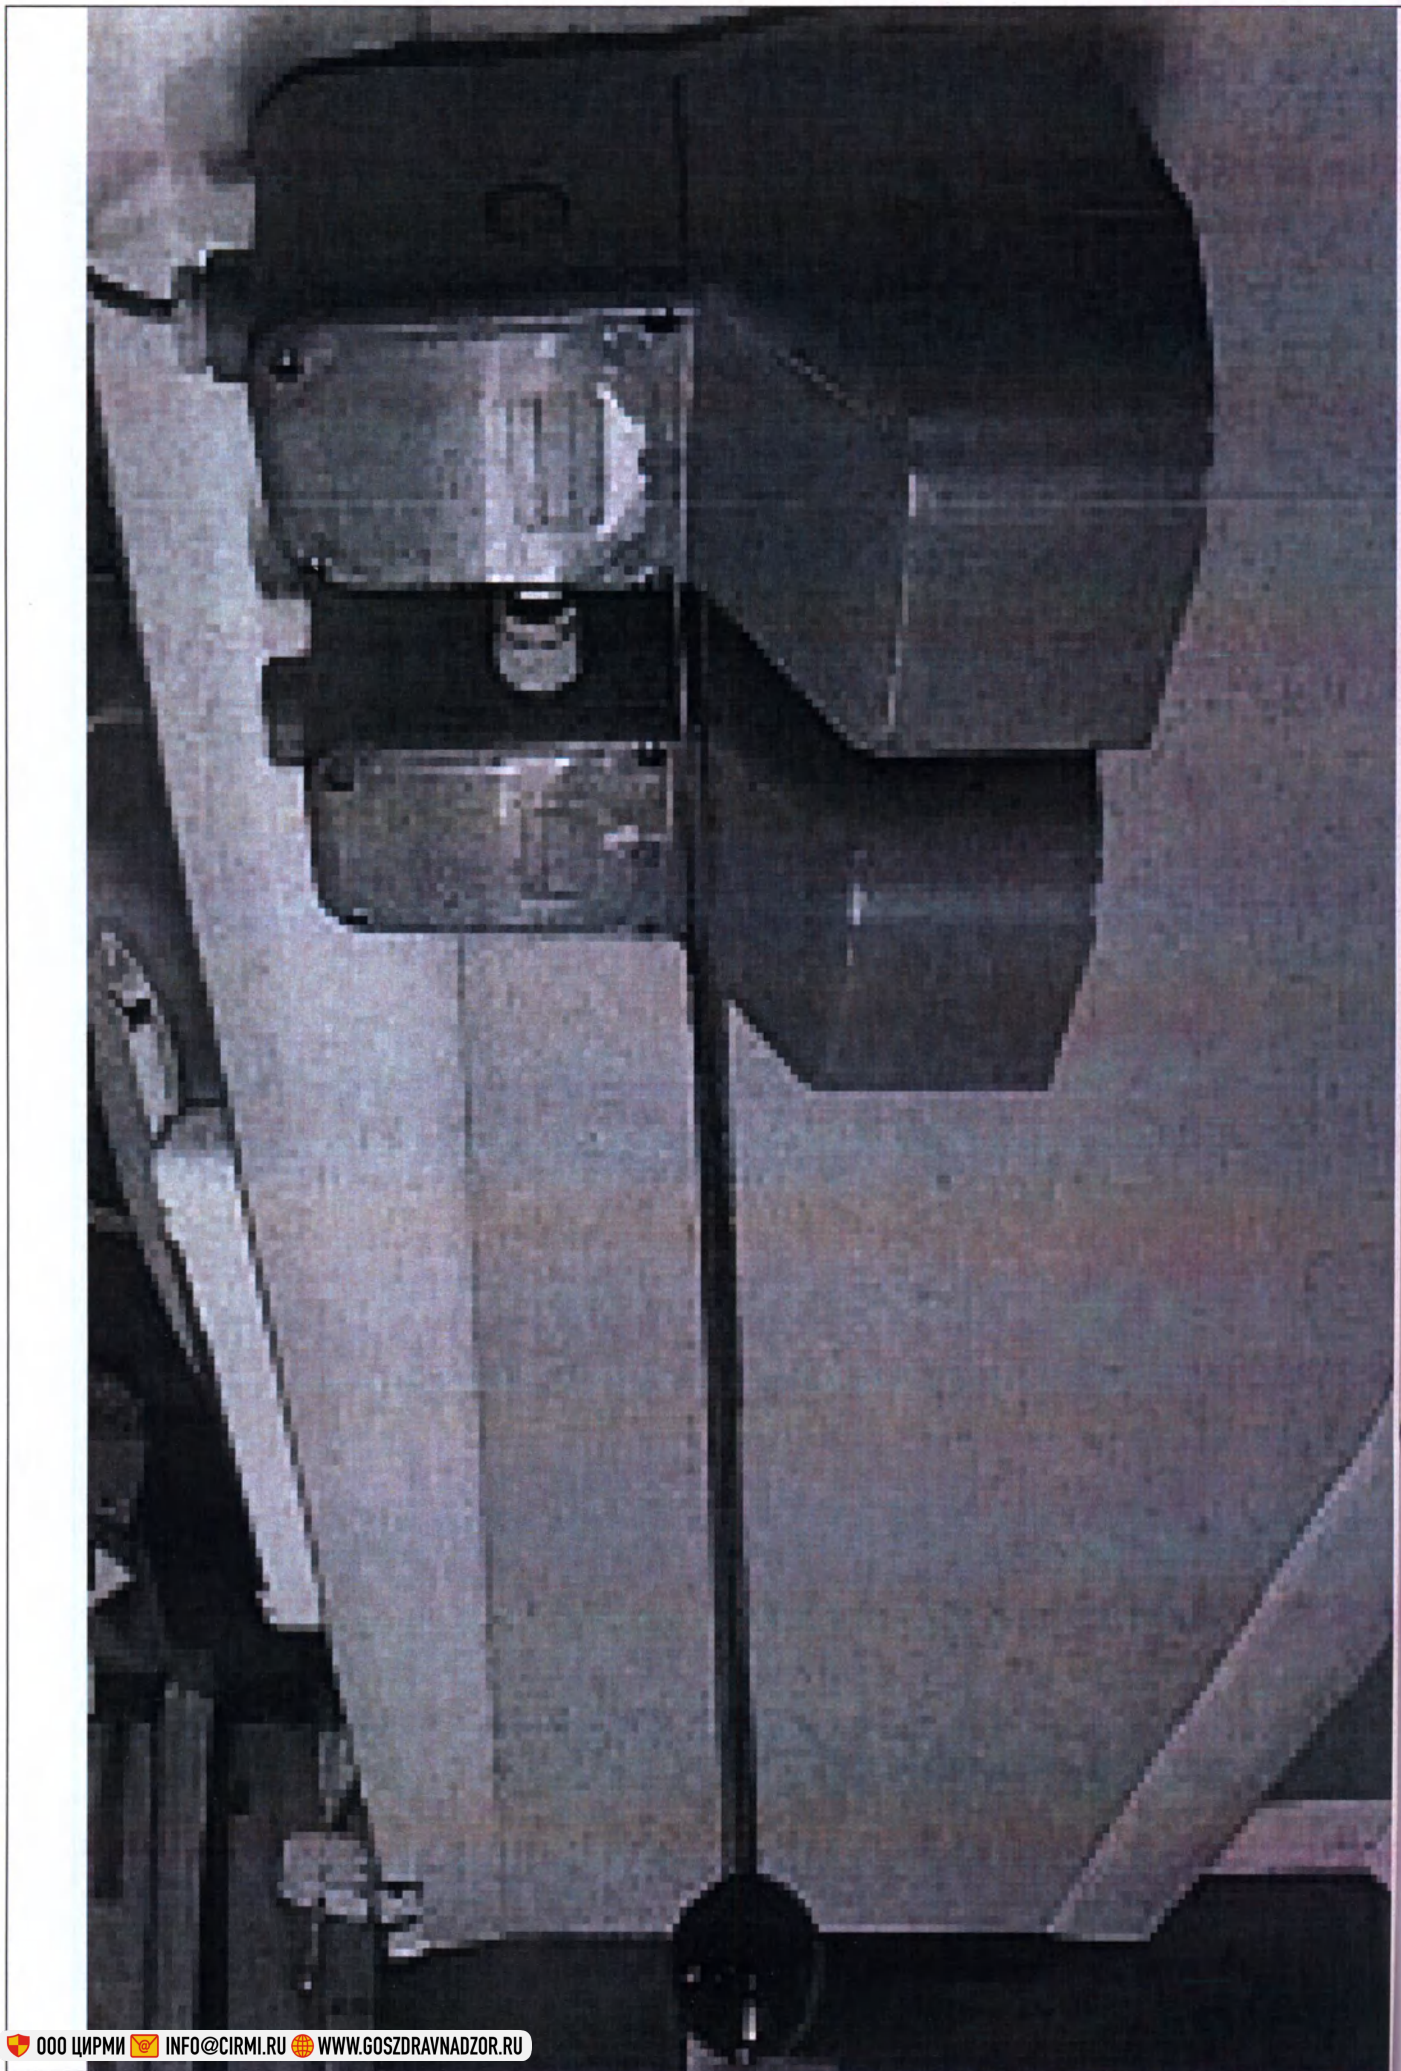


18. Ремень компрессионный.

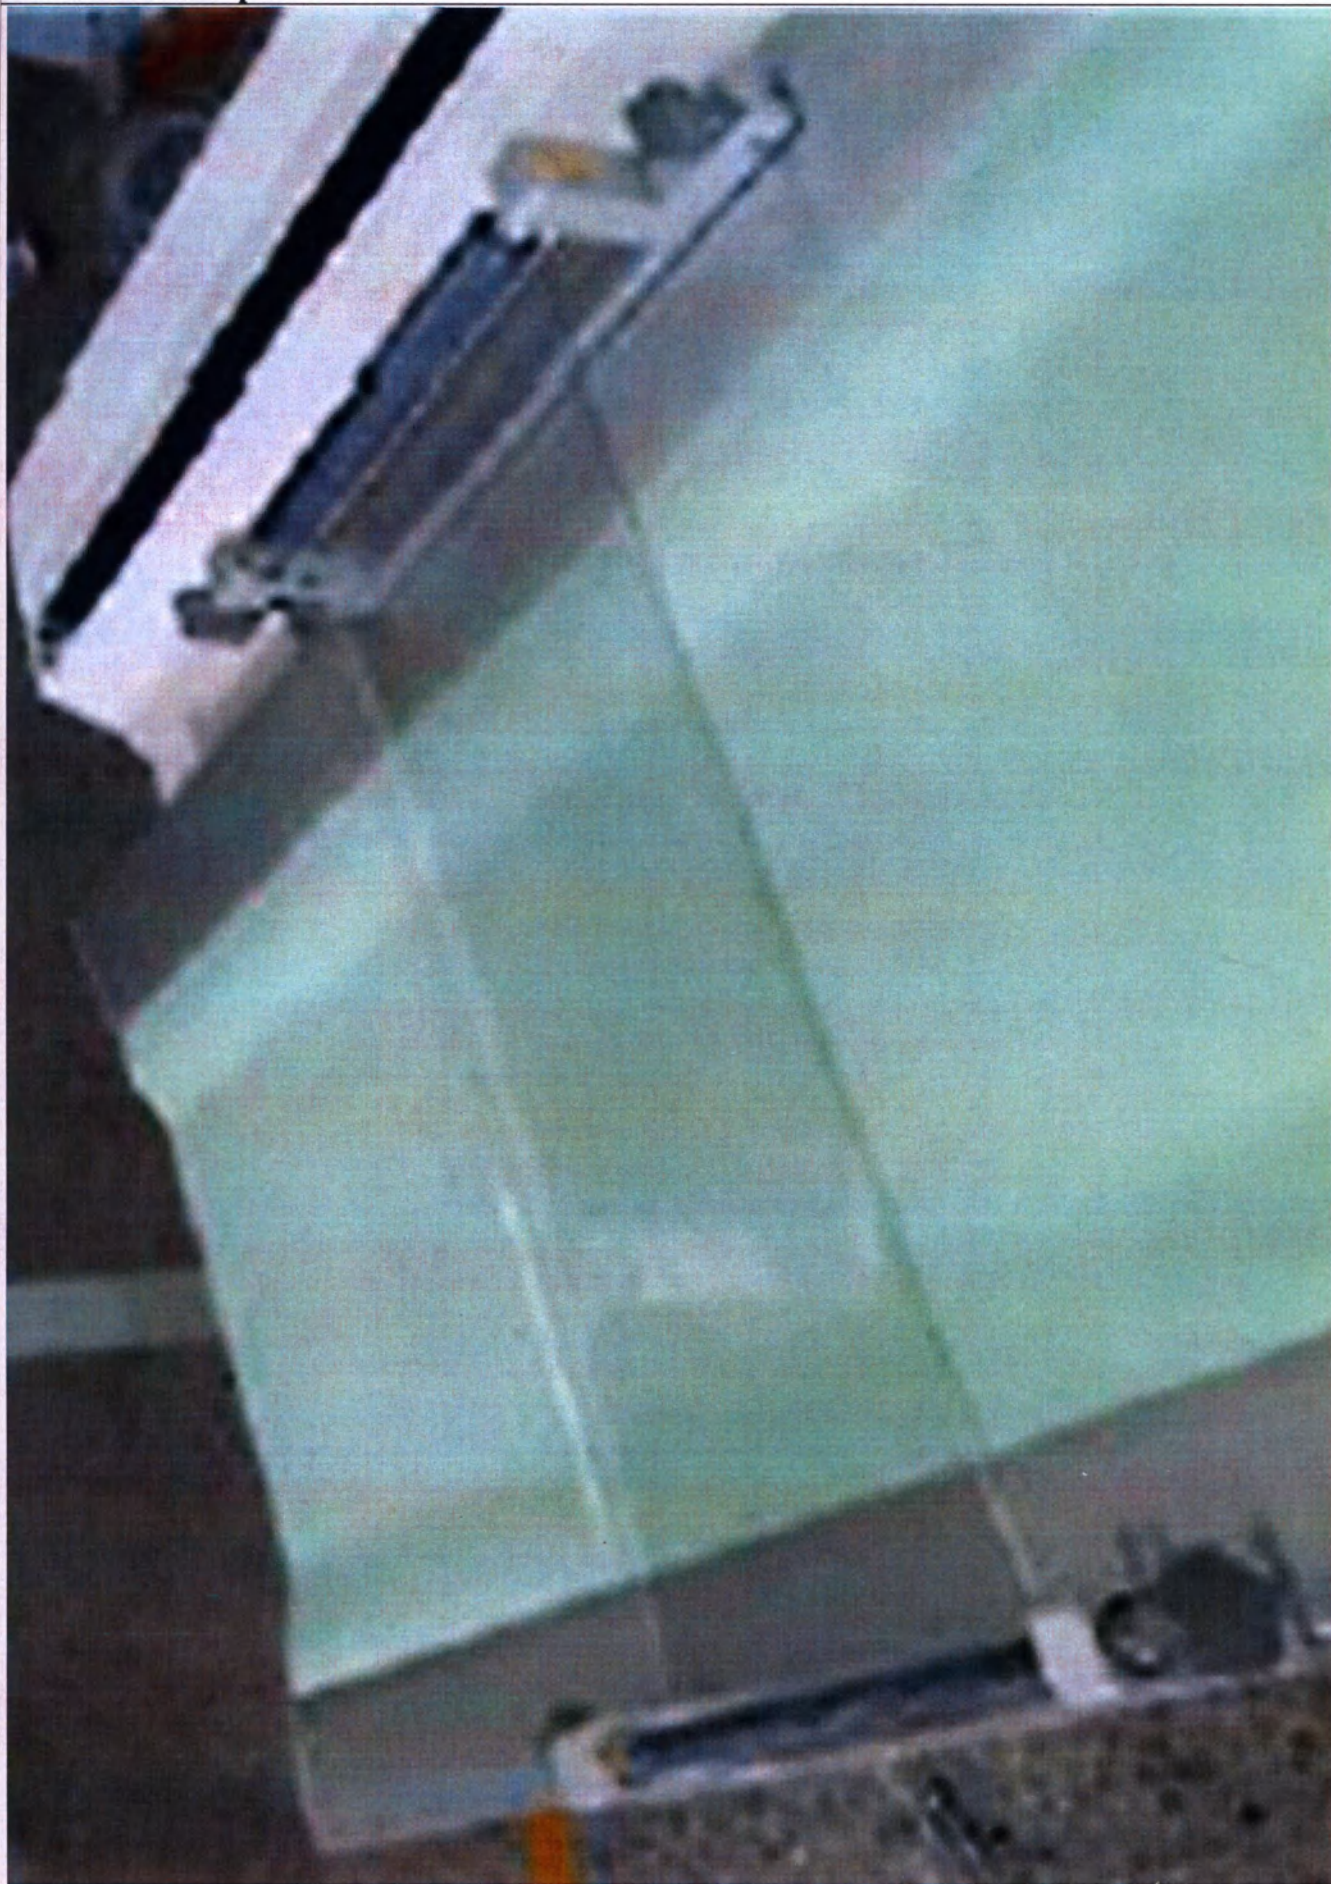

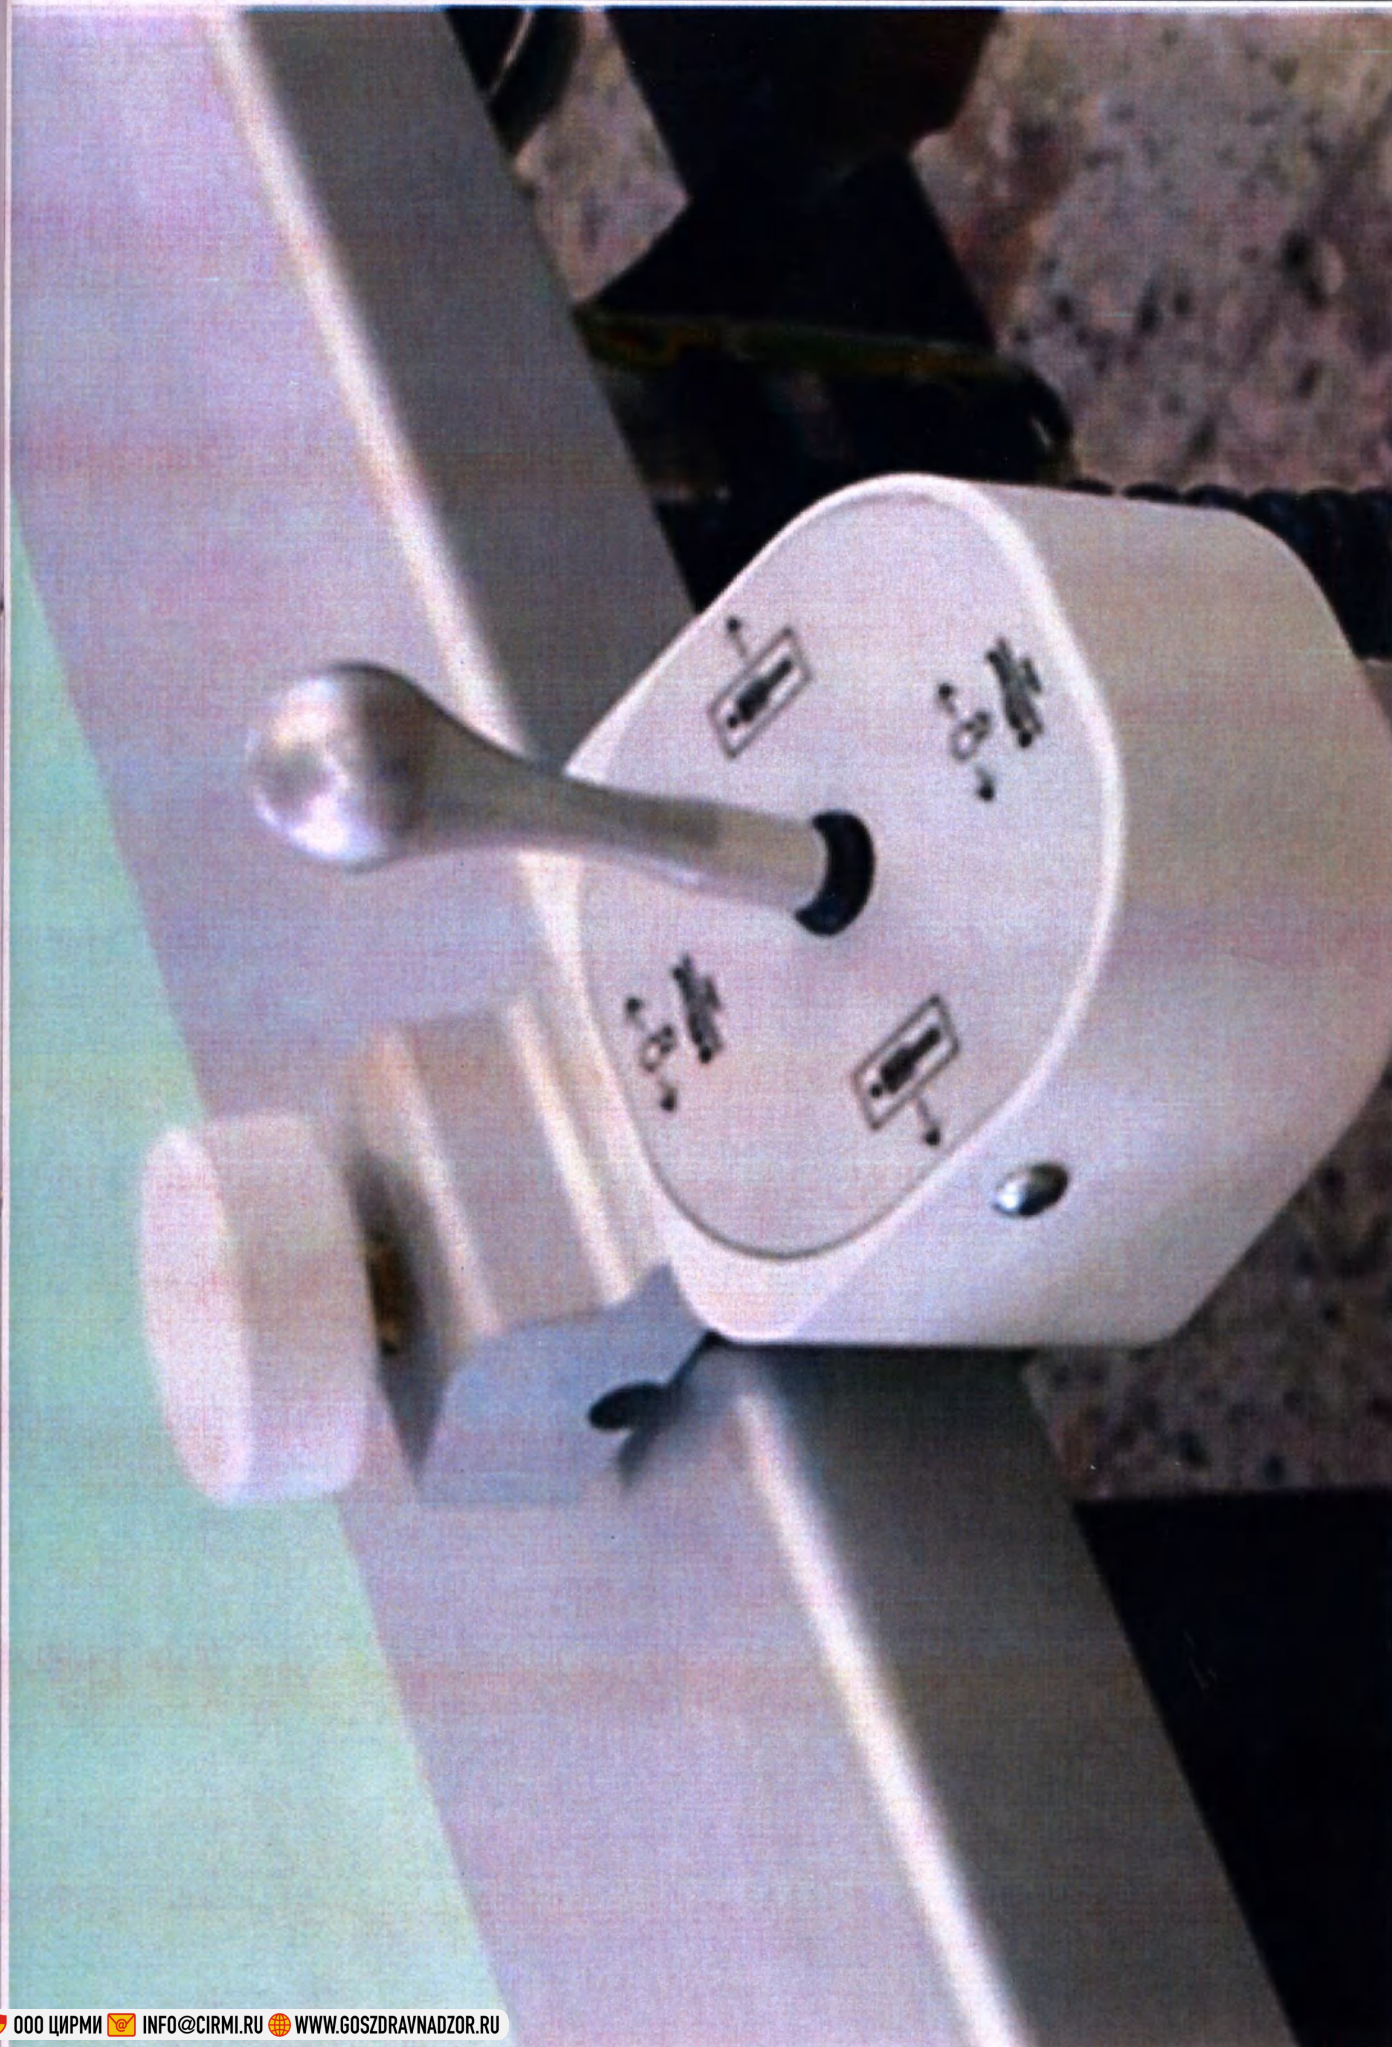



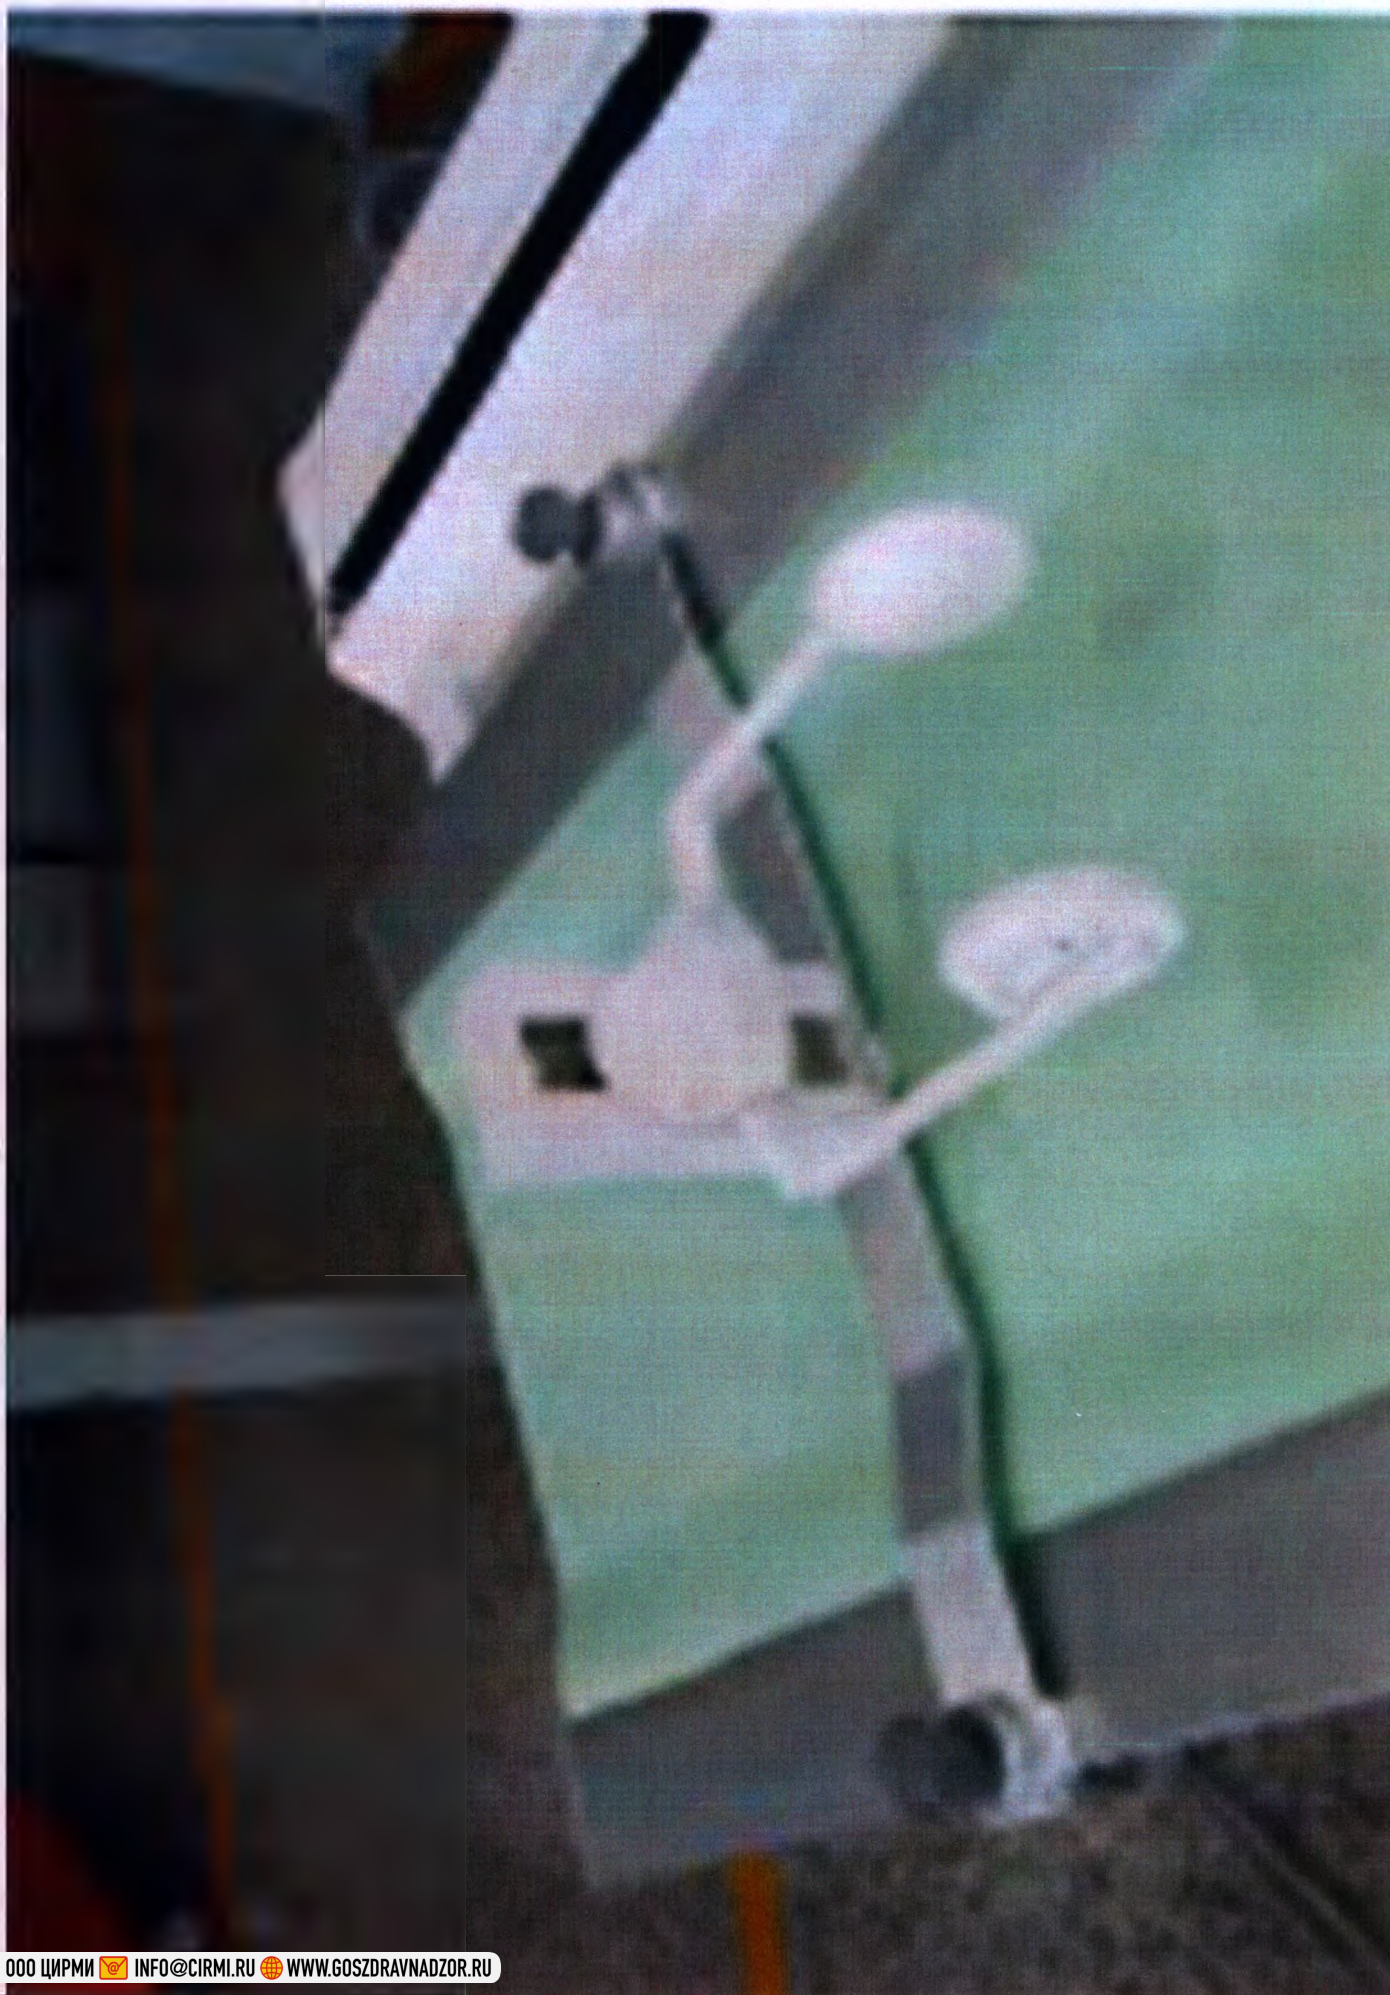






24. Ступенька для пациента.



25. Устройство для позиционирования детей (не более 2 шт.)

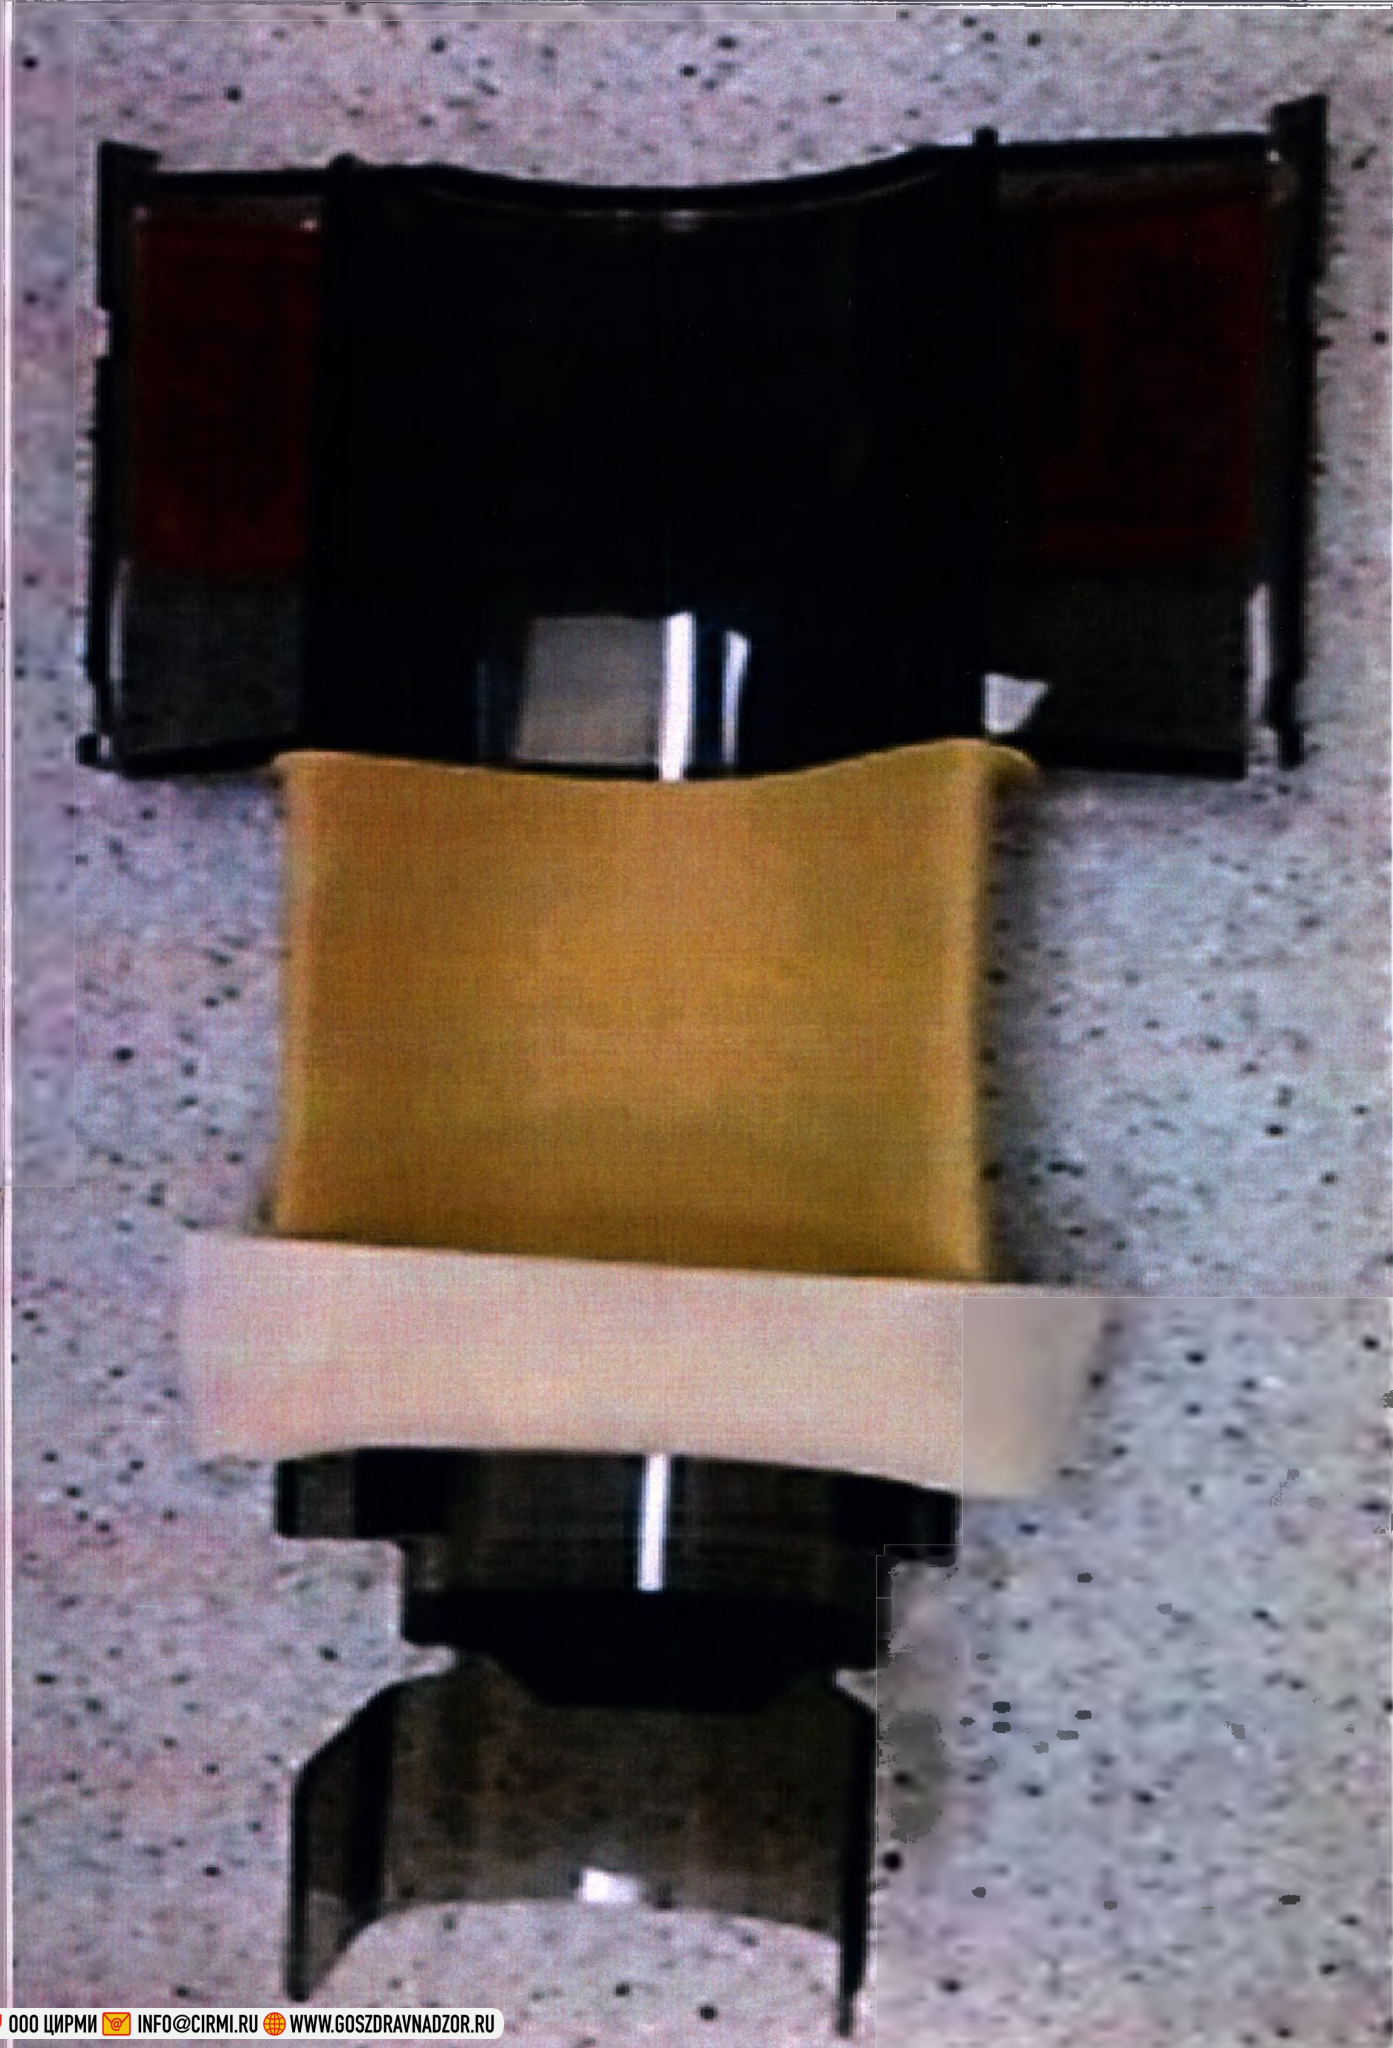



27. Клавиатура (не более 2 шт.).





GE Medical Systems

Техническая Публикация



Директива 5121725-145

Ред. 10


Руководство Оператора Система Precision RXi




41956A

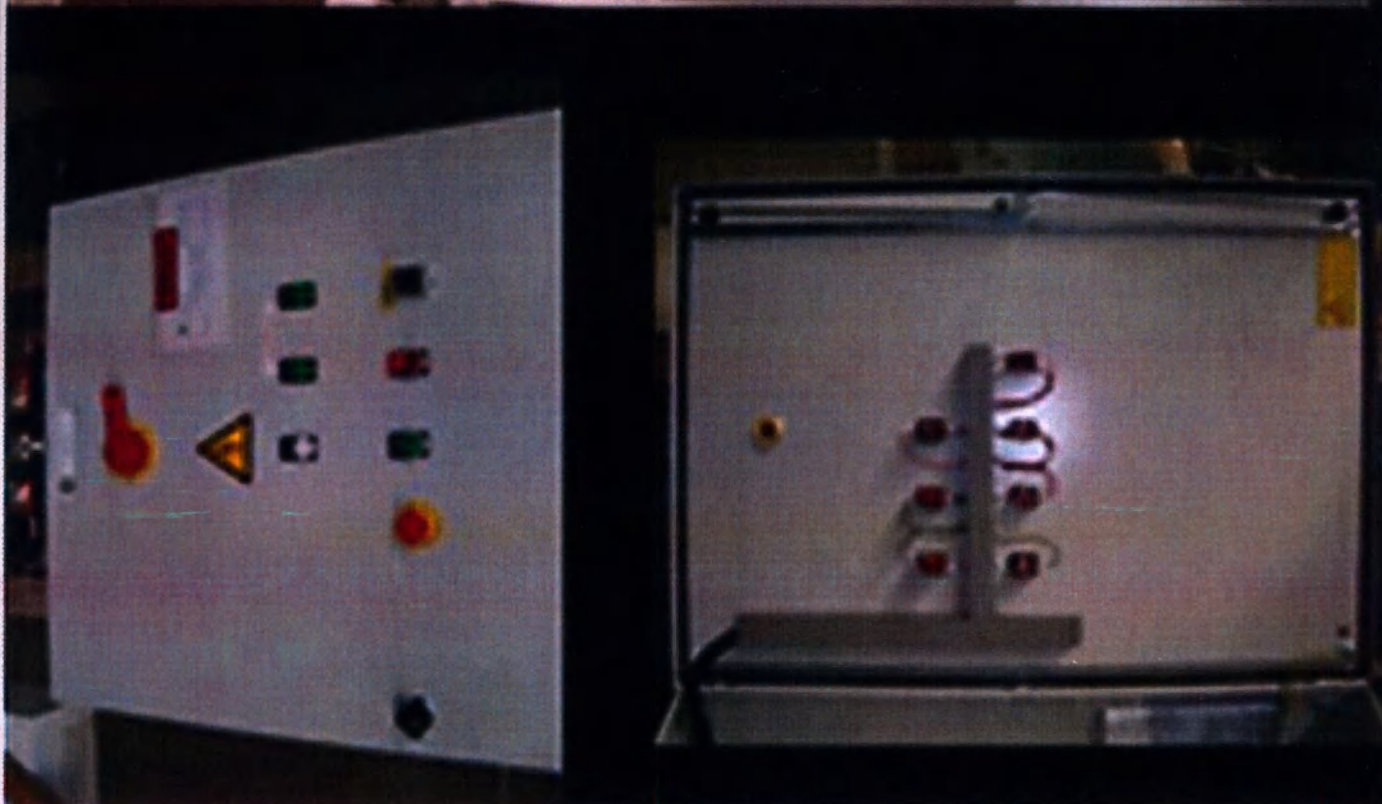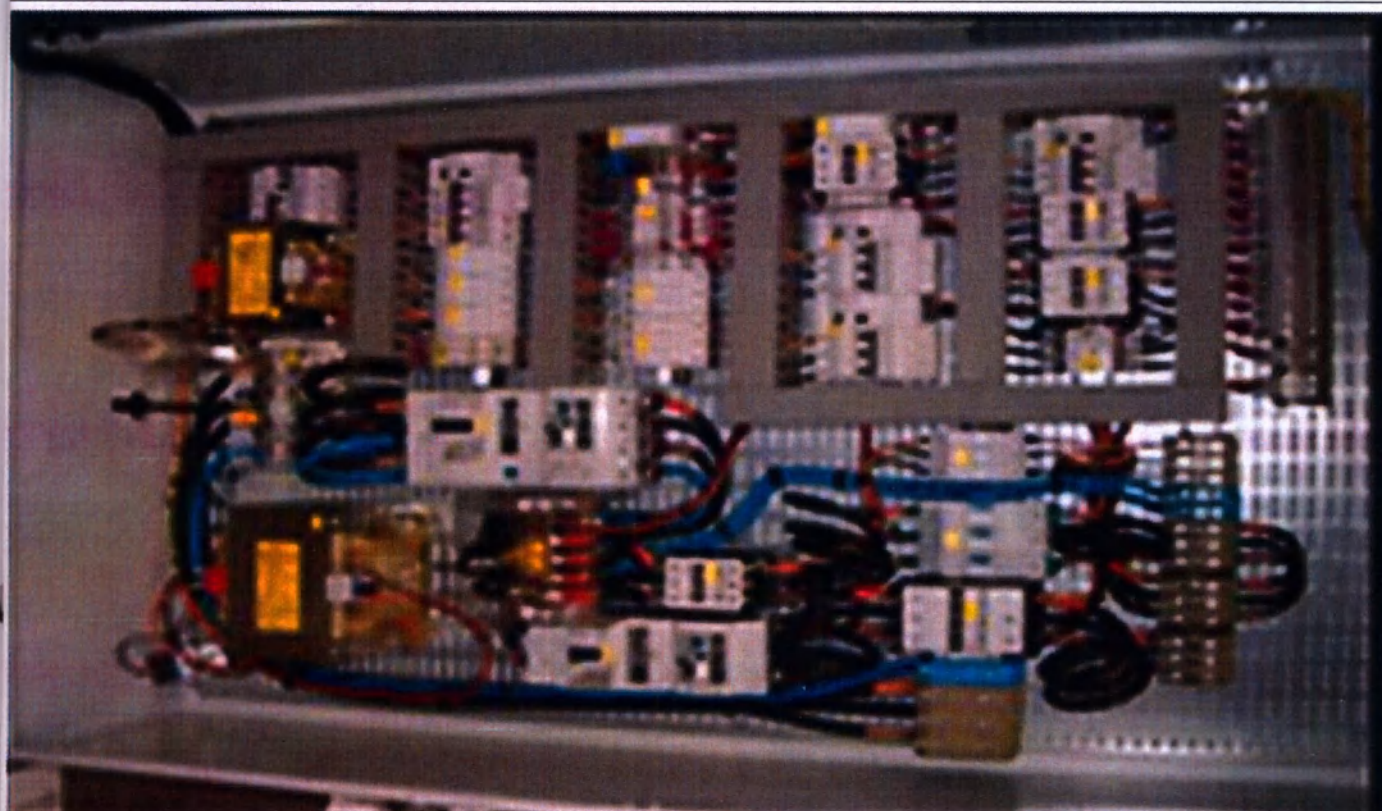

Кабели соединительные (не более 10 шт.).

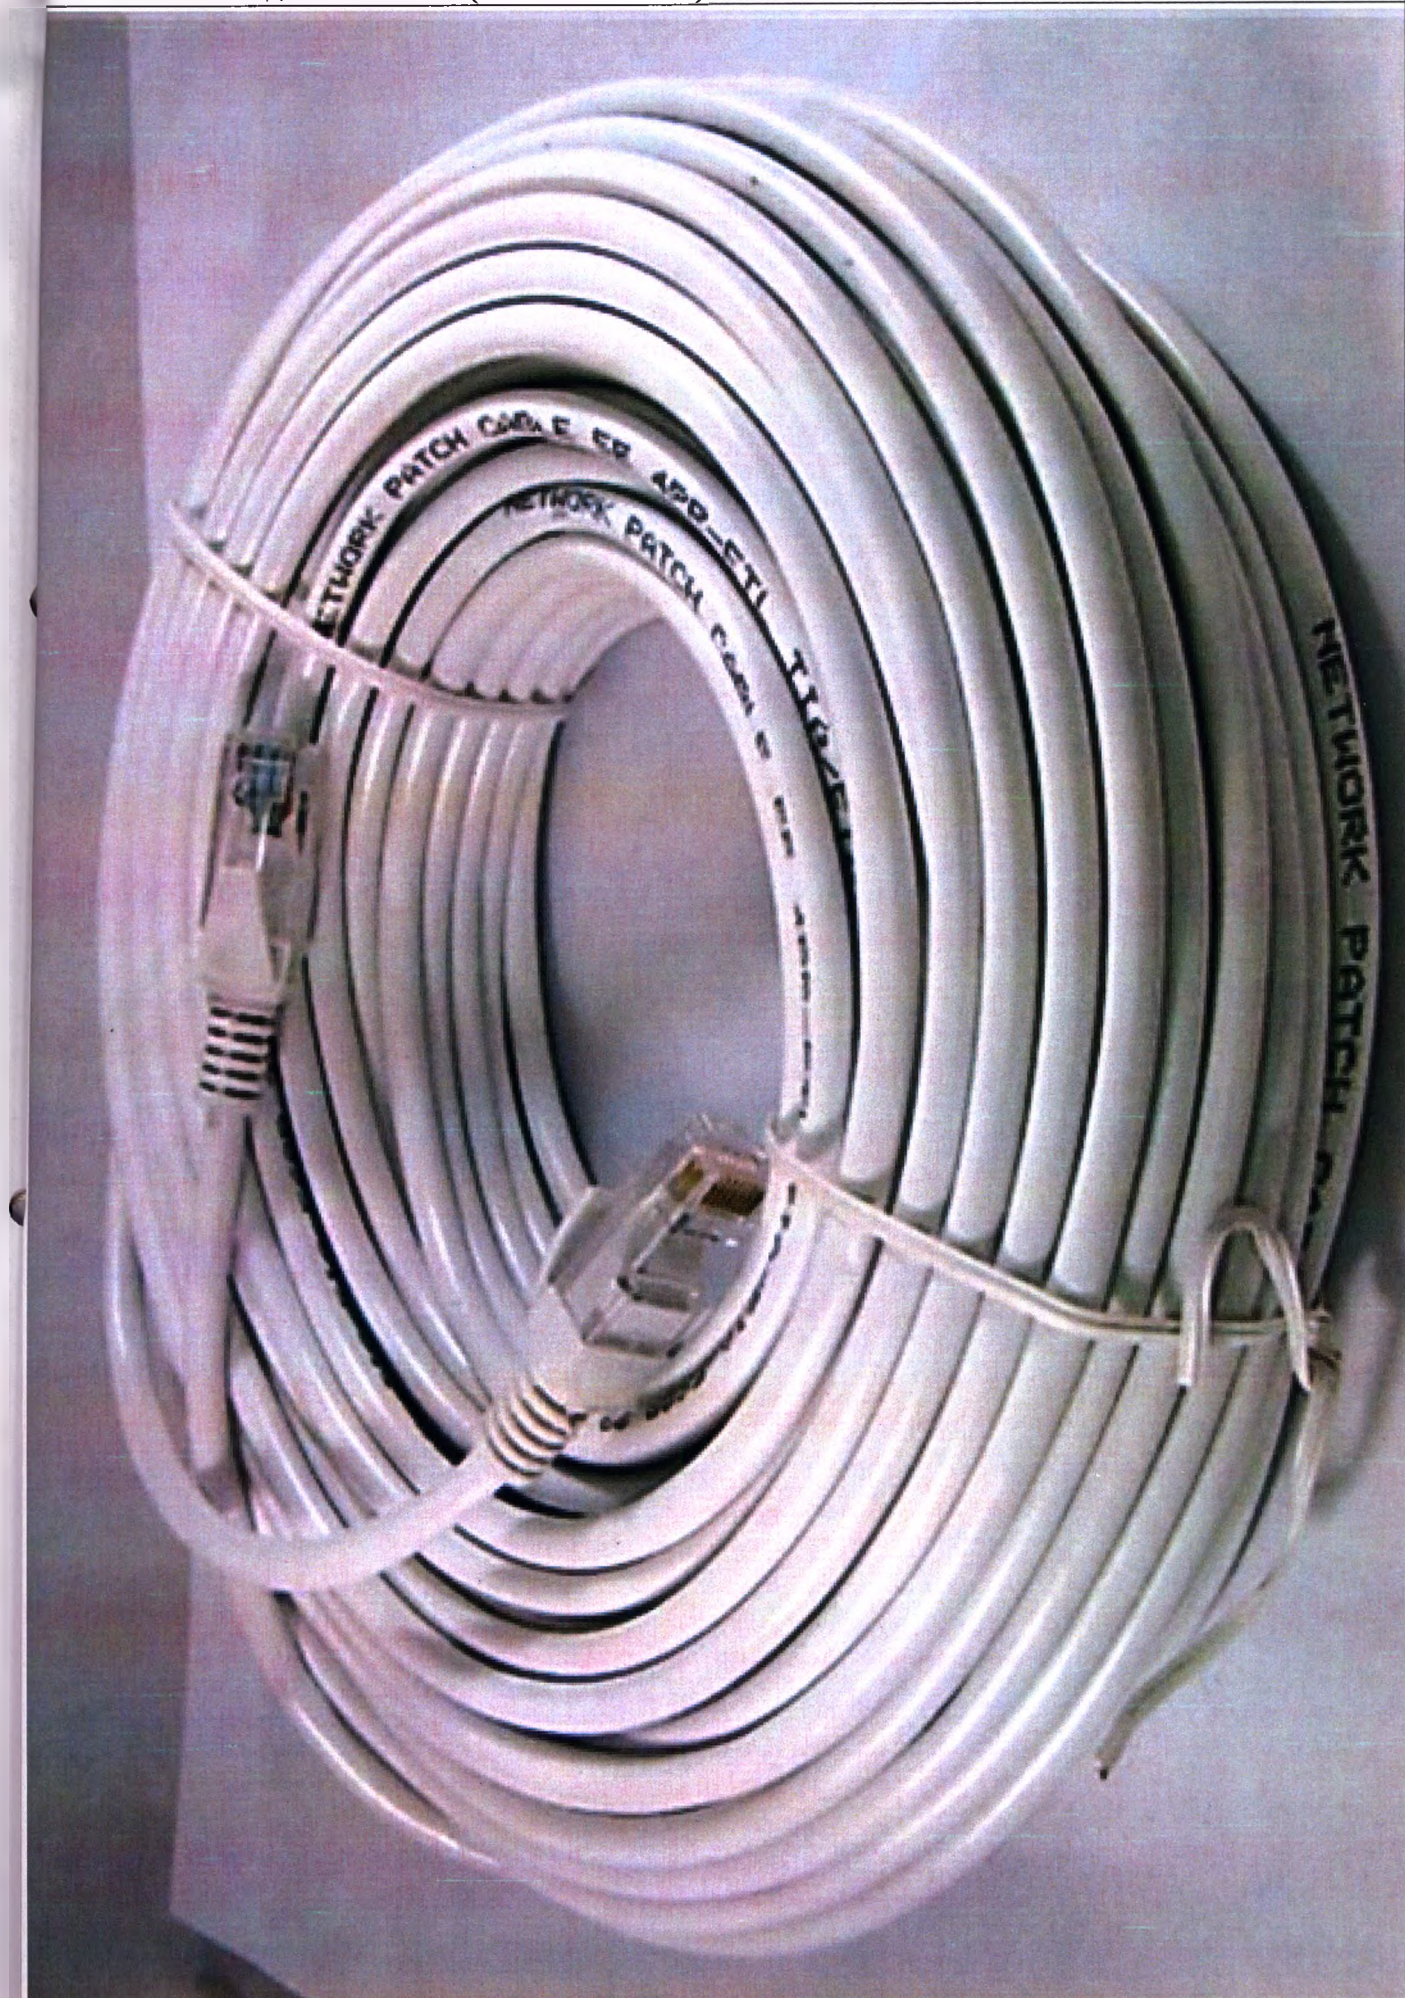

1. Кабели управляющие (не более 20 шт.).

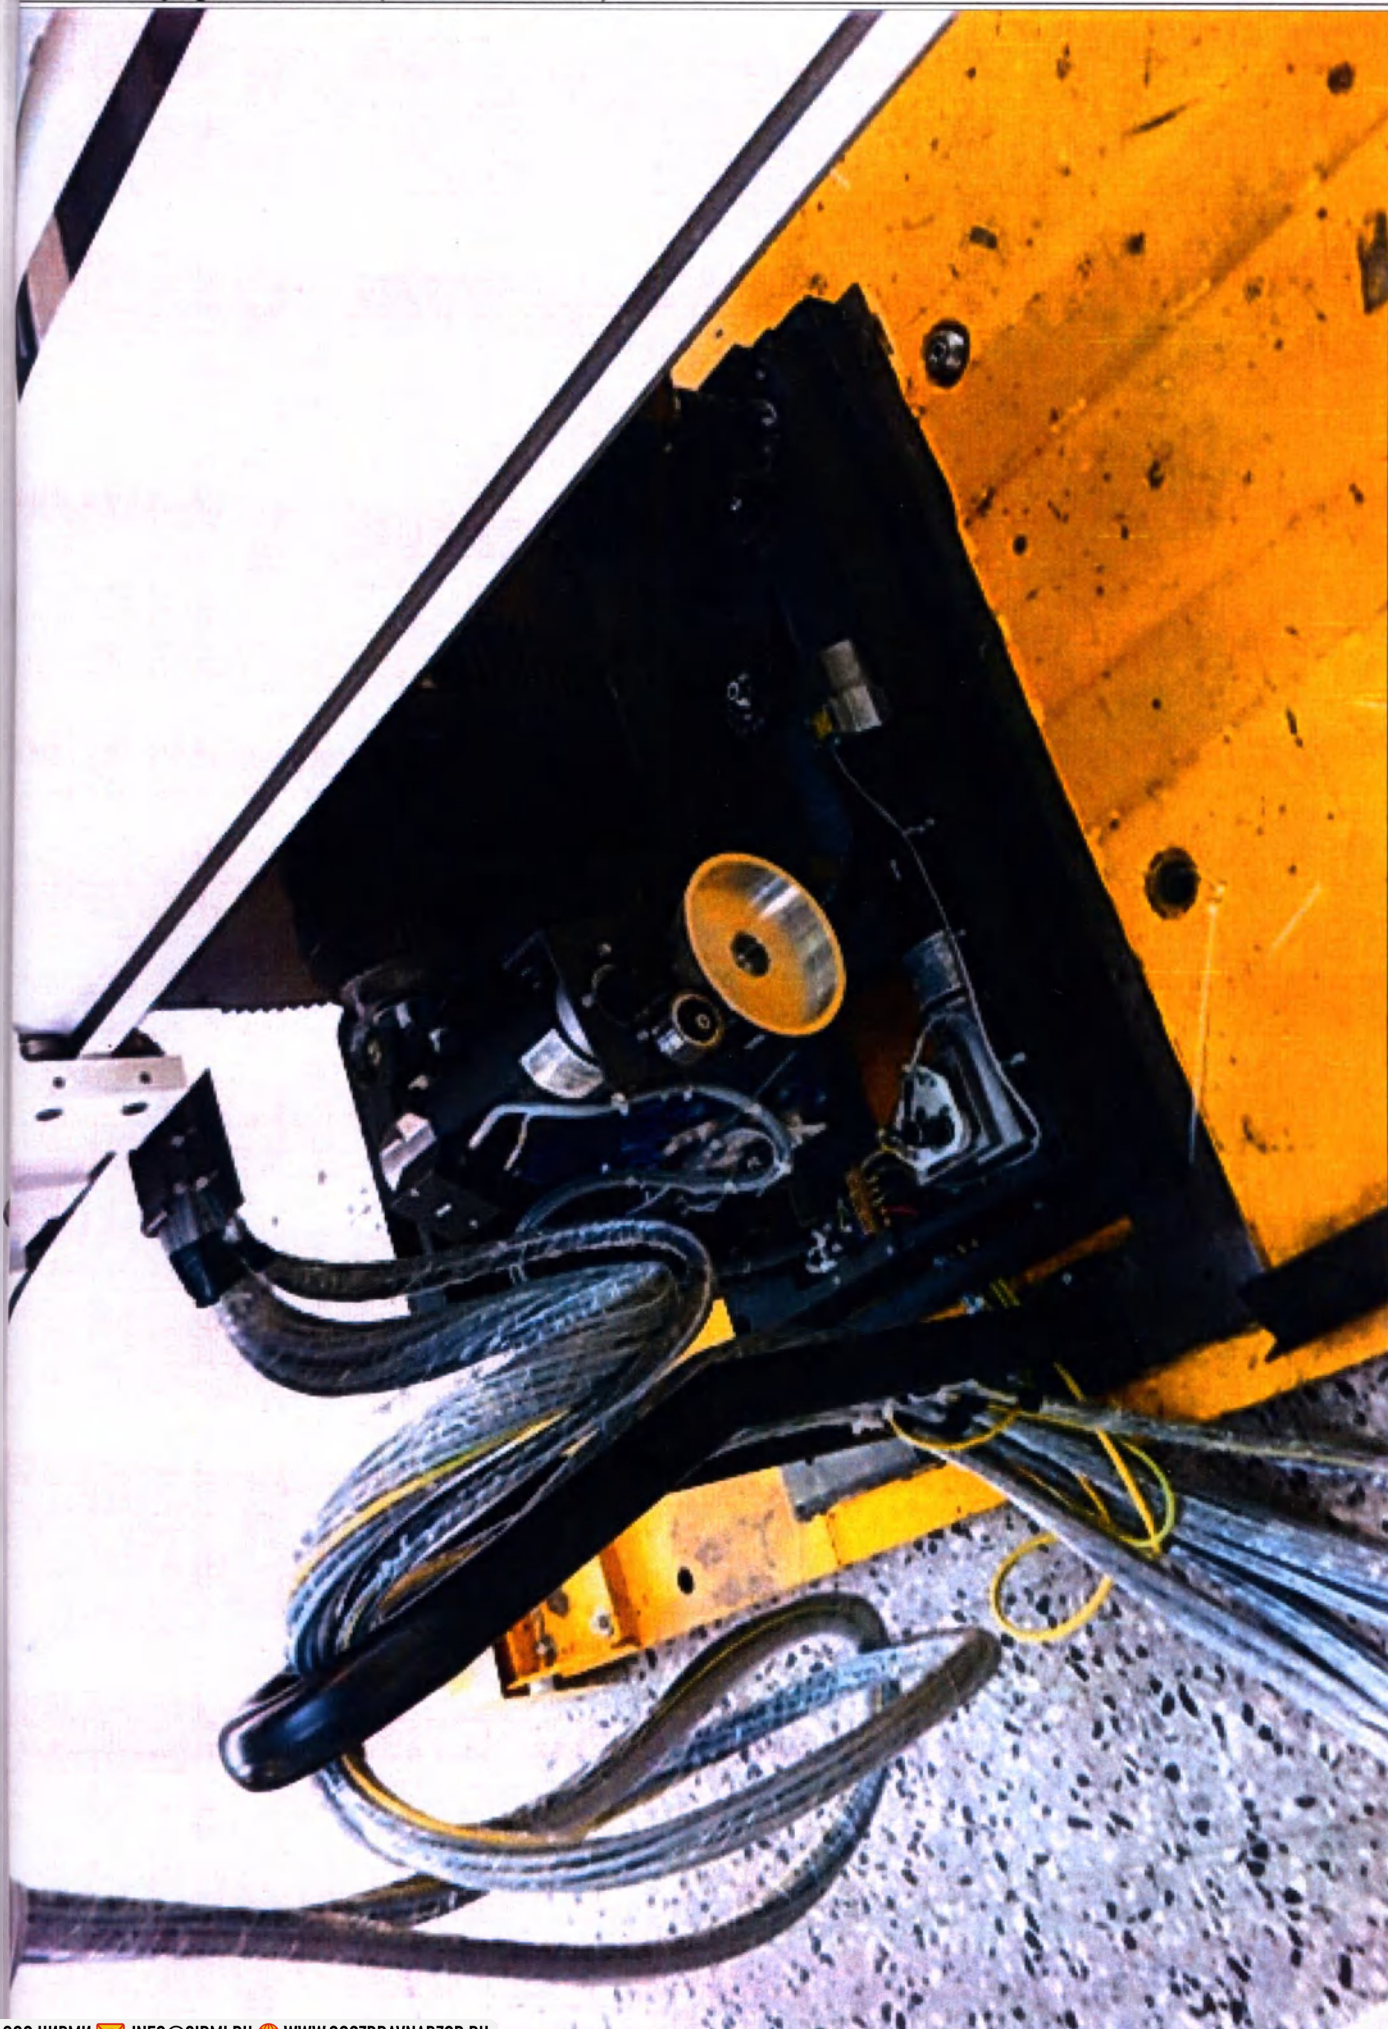

Кабели питания (не более 10 шт.).



Кабели для подключения (не более 100 шт.).



ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО
ПРОШНУРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
ЛИСТА (ОВ)

40 (сорок)

