

Фотографическое изображение медицинского изделия

«Агар хромогенный для обнаружения и подсчета колоний уropатогенных микроорганизмов (агар UTI)», по ТУ 9385-013-11161893-2015

Варианты исполнения:

- Агар хромогенный для обнаружения и подсчета колоний уropатогенных бактерий (агар UTI)
- Агар хромогенный для обнаружения и подсчета колоний уropатогенных бактерий прозрачный (агар UTI прозрачный).


Информация о производителе:

1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Средофф» (ООО «Средофф»)
2. Адрес: 199106 г. Санкт-Петербург, Шкиперский проток, дом 14, корпус 39, литера Н
3. тел./факс: (812) 426 12 48, (812) 356 04 34/(812) 305 06 06
4. e-mail: info@sredoff.ru

1. «Агар хромогенный для обнаружения и подсчета колоний уропатогенных микроорганизмов (агар UTI)», по ТУ 9385-013-11161893-2015

Варианты исполнения:

«Агар хромогенный для обнаружения и подсчета колоний уропатогенных бактерий (агар UTI)»

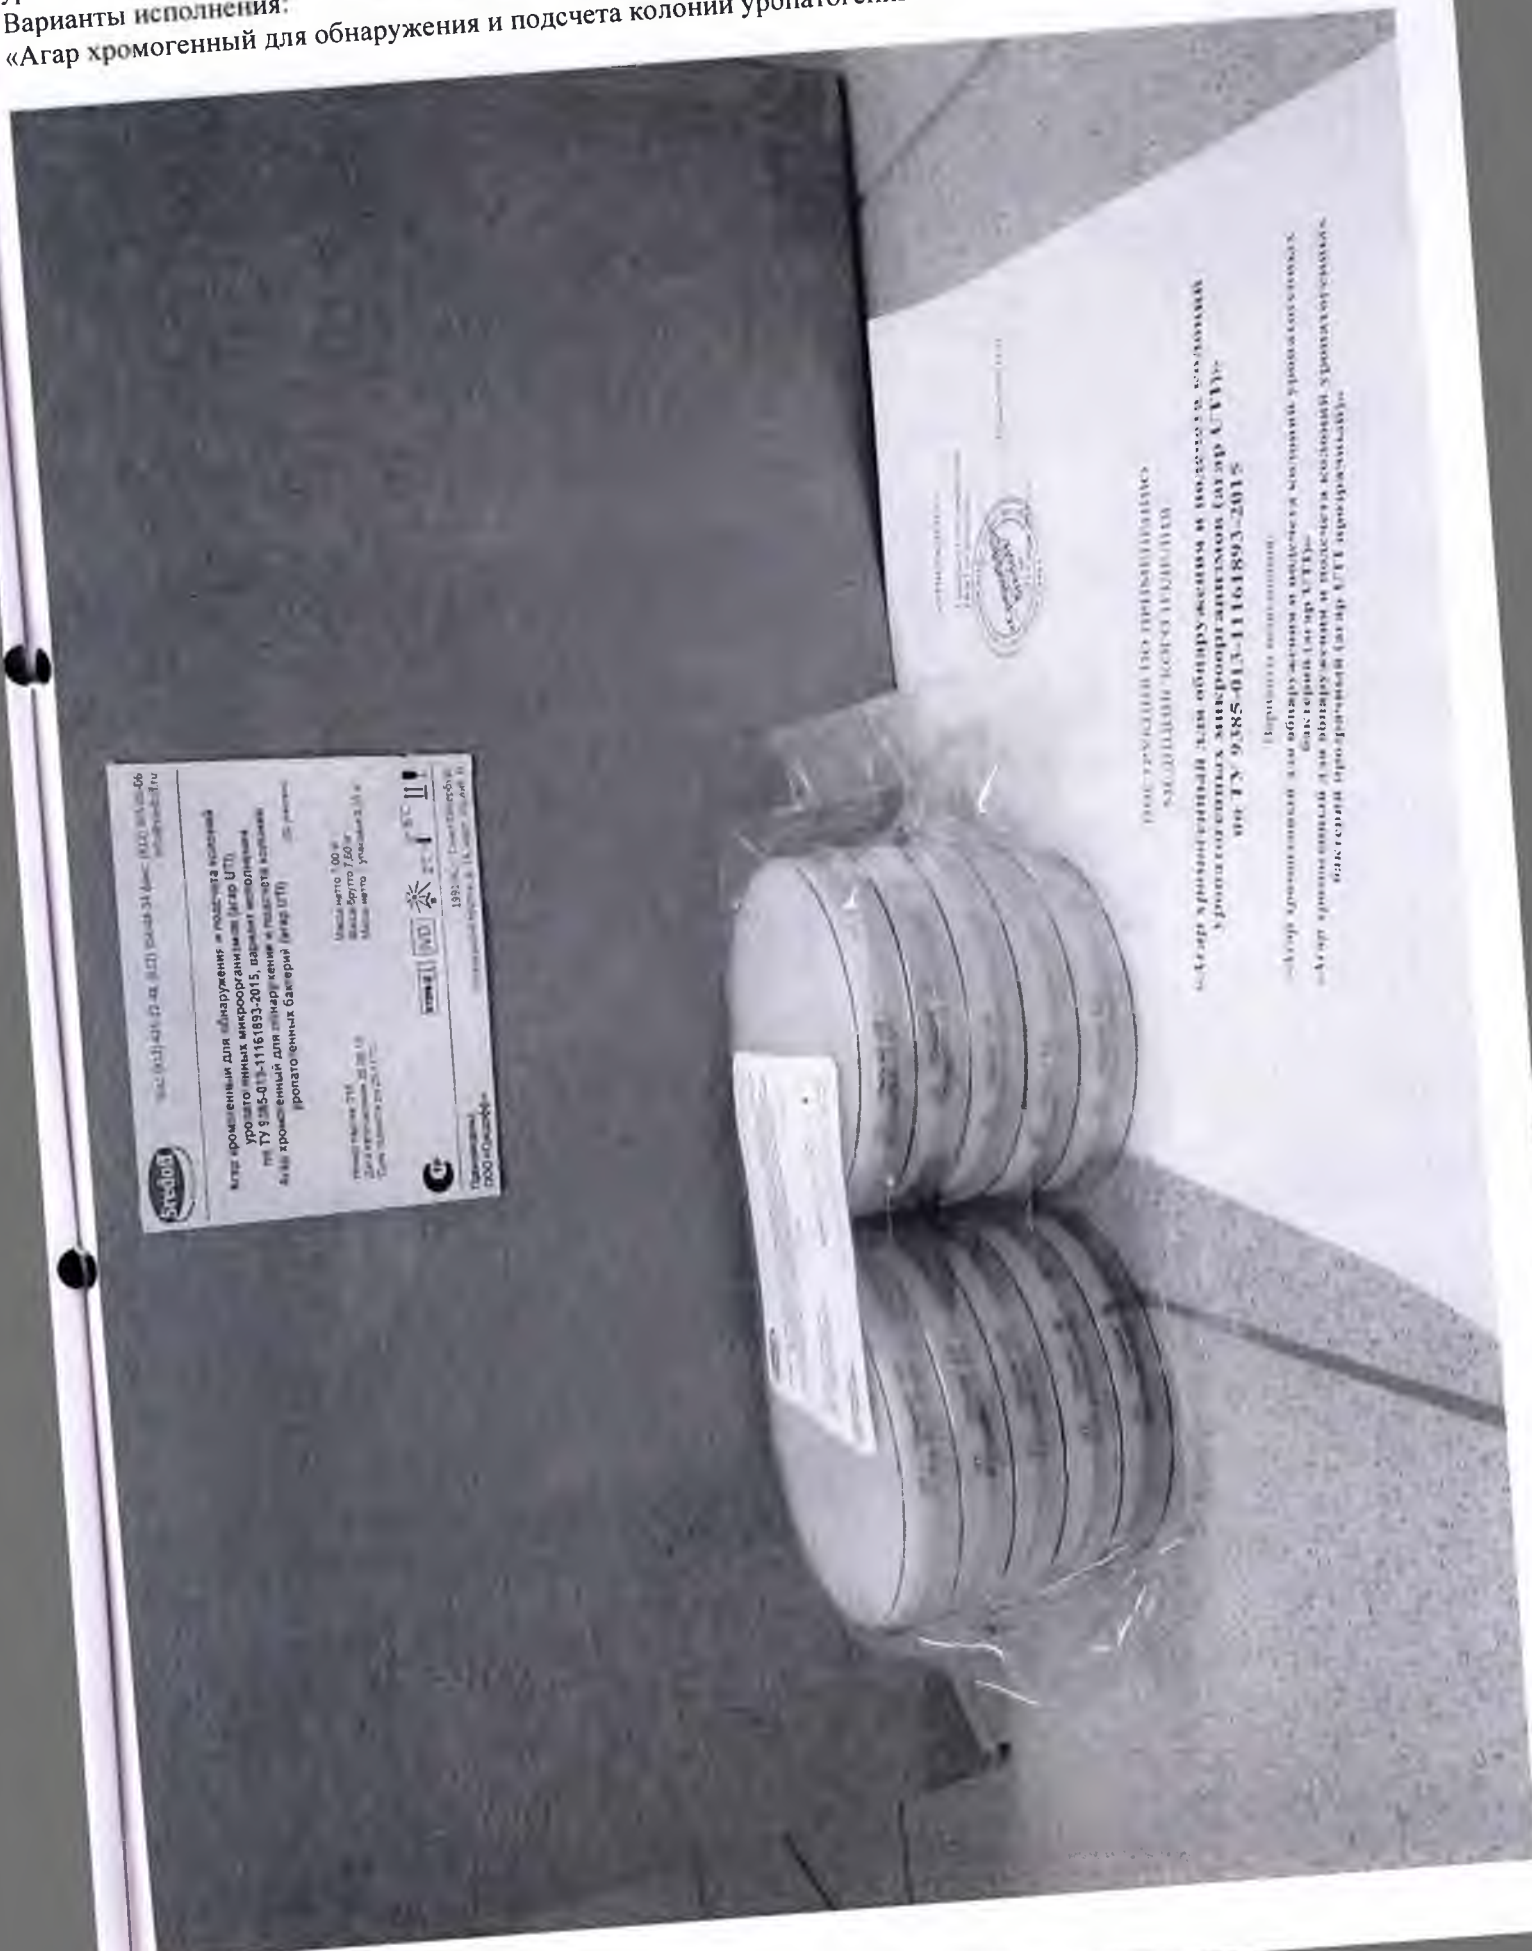

Агар хромогенный для обнаружения и подсчета колоний уропатогенных микроорганизмов (агар UTI)
ТУ 9385-013-11161893-2015, вариант исполнения
Агар хромогенный для обнаружения и подсчета колоний уропатогенных бактерий (агар UTI)
Вариант исполнения
Масса нетто 100 г
Масса брутто 150 г
Дата изготовления 20.08.18
Срок годности 24 месяца

Агар хромогенный для обнаружения и подсчета колоний уропатогенных микроорганизмов (агар UTI)
ТУ 9385-013-11161893-2015
Варианты исполнения:
Агар хромогенный для обнаружения и подсчета колоний уропатогенных бактерий (агар UTI)
Агар хромогенный для обнаружения и подсчета колоний уропатогенных грибов (агар UTI)



тел. (812) 426-11-48, факс (812) 426-04-34, e-mail: info@sredoff.ru

Агар хромогенный для обнаружения и подсчета колоний
уропатогенных микроорганизмов (агар UTI)
по ТУ 9385-013-11161893-2015, вариант исполнения
Агар хромогенный для обнаружения и подсчета колоний
уропатогенных бактерий (агар UTI)

РУ №

(10 чашек)

Артикул: CM0949-1-SF
Номер партии: 218
Дата изготовления 28.09.15
Срок годности до 25.11.15

STERILE

IVD



2°C

8°C

Произведено:
ООО «Средофф»


199106, г. Санкт-Петербург
Шкиперский проток, д. 14, корп. 39, лит. А

УТИ 000 "СРЕАОФ" 1410
105 № 02.08.15 +2+8

2. «Агар хромогенный для обнаружения и подсчета колоний уропатогенных микроорганизмов (агар UTI)», по ТУ 9385-013-11161893-2015

Варианты исполнения:

«Агар хромогенный для обнаружения и подсчета колоний уропатогенных бактерий прозрачный (агар UTI прозрачный)»

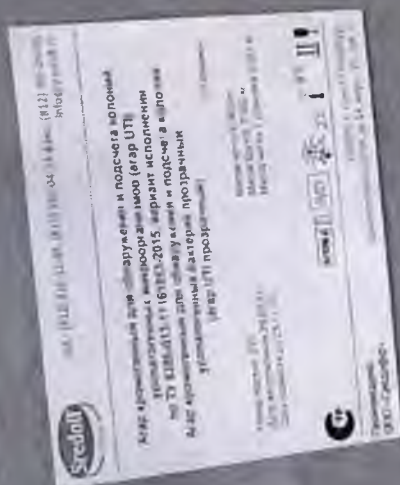

ПРОДУКЦИЯ ИЗ ПРОДУКЦИИ
ТУ 9385-013-11161893-2015

«Агар хромогенный для обнаружения и подсчета колоний уропатогенных микроорганизмов (агар UTI)»
ТУ 9385-013-11161893-2015

Вариант исполнения:
«Агар хромогенный для обнаружения и подсчета колоний уропатогенных бактерий прозрачный (агар UTI прозрачный)»



тел.: (812) 426-12-48, (812) 356-04-34 факс: (812) 305-06-06
info@sredoff.ru

Агар хромогенный для обнаружения и подсчета колоний
уропатогенных микроорганизмов (агар UTI)
по ТУ 9385-013-11161893-2015, вариант исполнения
Агар хромогенный для обнаружения и подсчета колоний
уропатогенных бактерий прозрачный
(агар UTI прозрачный)

РУ №

(10 чашек)

Артикул: SM1106-1-SF
Номер партии: 219
Дата изготовления 26.09.15
Срок годности до 25.11.15

STERILE


IVD



2°C 8°C

Произведено:
ООО «Средофф»

199106, г. Санкт-Петербург
Шкиперский проток, д. 14, корп. 39, лит. Н

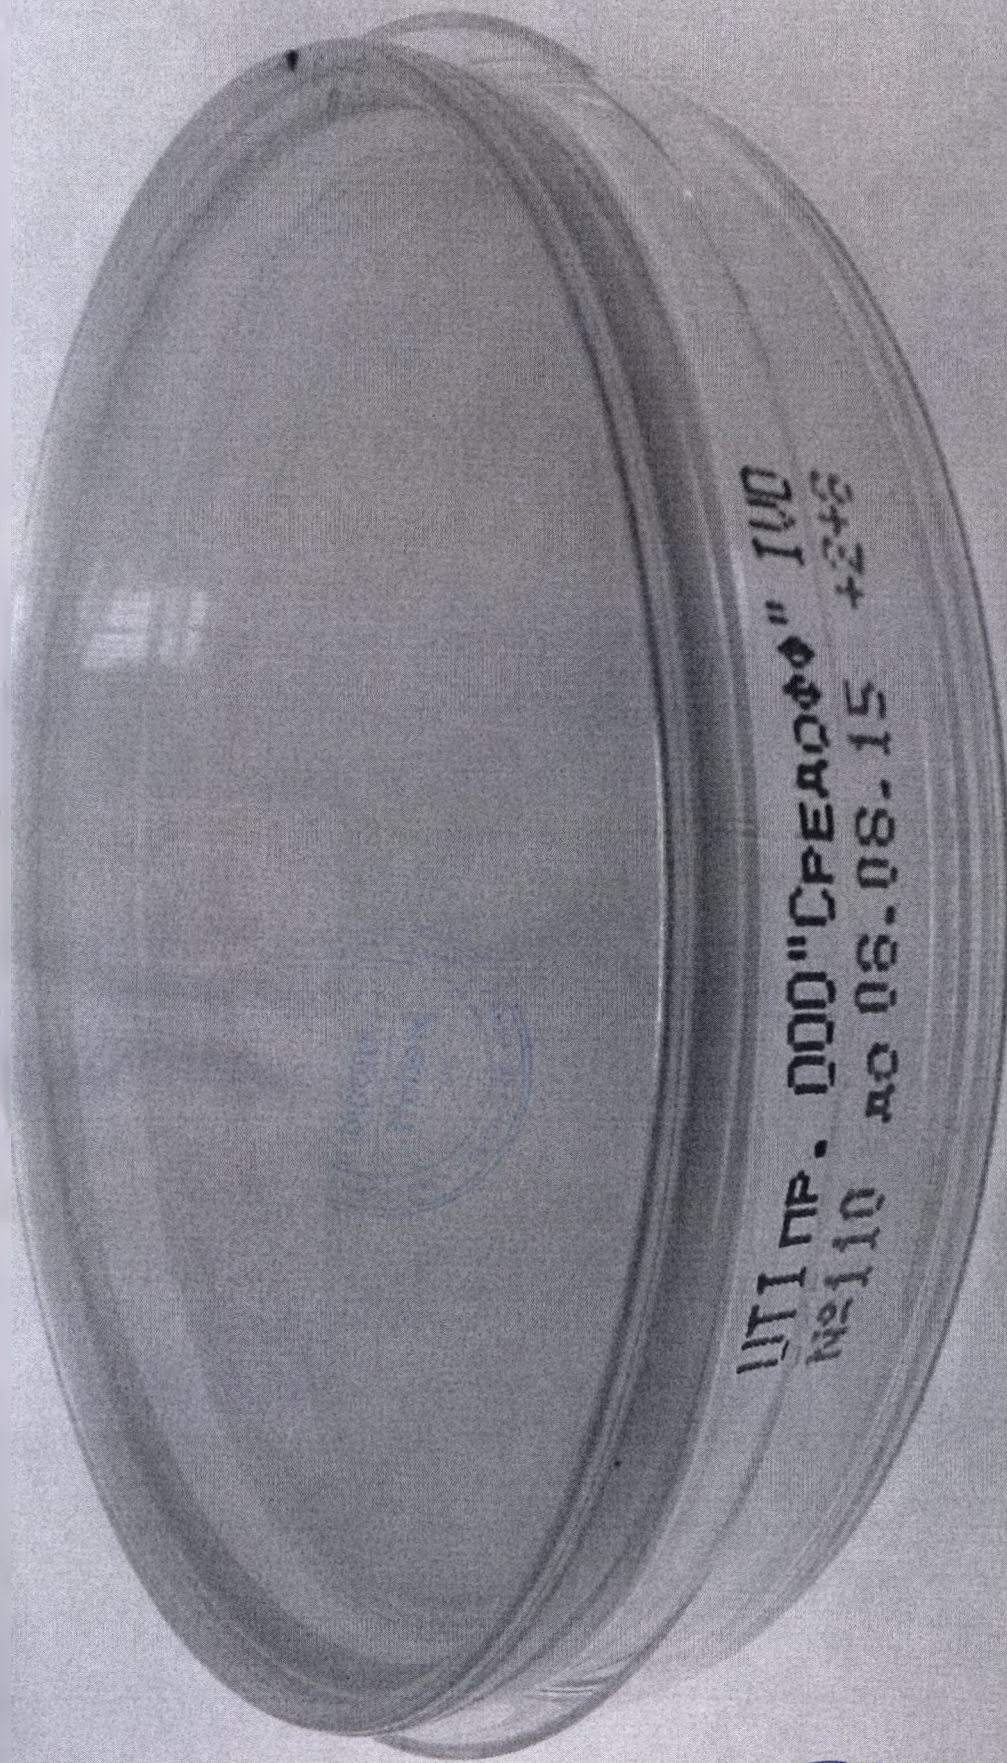

ШТИПР. ООО "СРЕДОФФ" 100
№110 до 08.08.15 +248

Генеральный директор
ООО «Средофф»

« » 2015г.



Н.Л.Ковивчак

ПРОШИТО
В КОЛИЧЕСТВЕ 2 ЛИСТОВ
« 10 » 25 20 15 год
Генеральный директор
ООО «Средофф»
Ковивчак И.П.

