


Внешний вид


Набора реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови (АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДиаС)

Комплектация 1

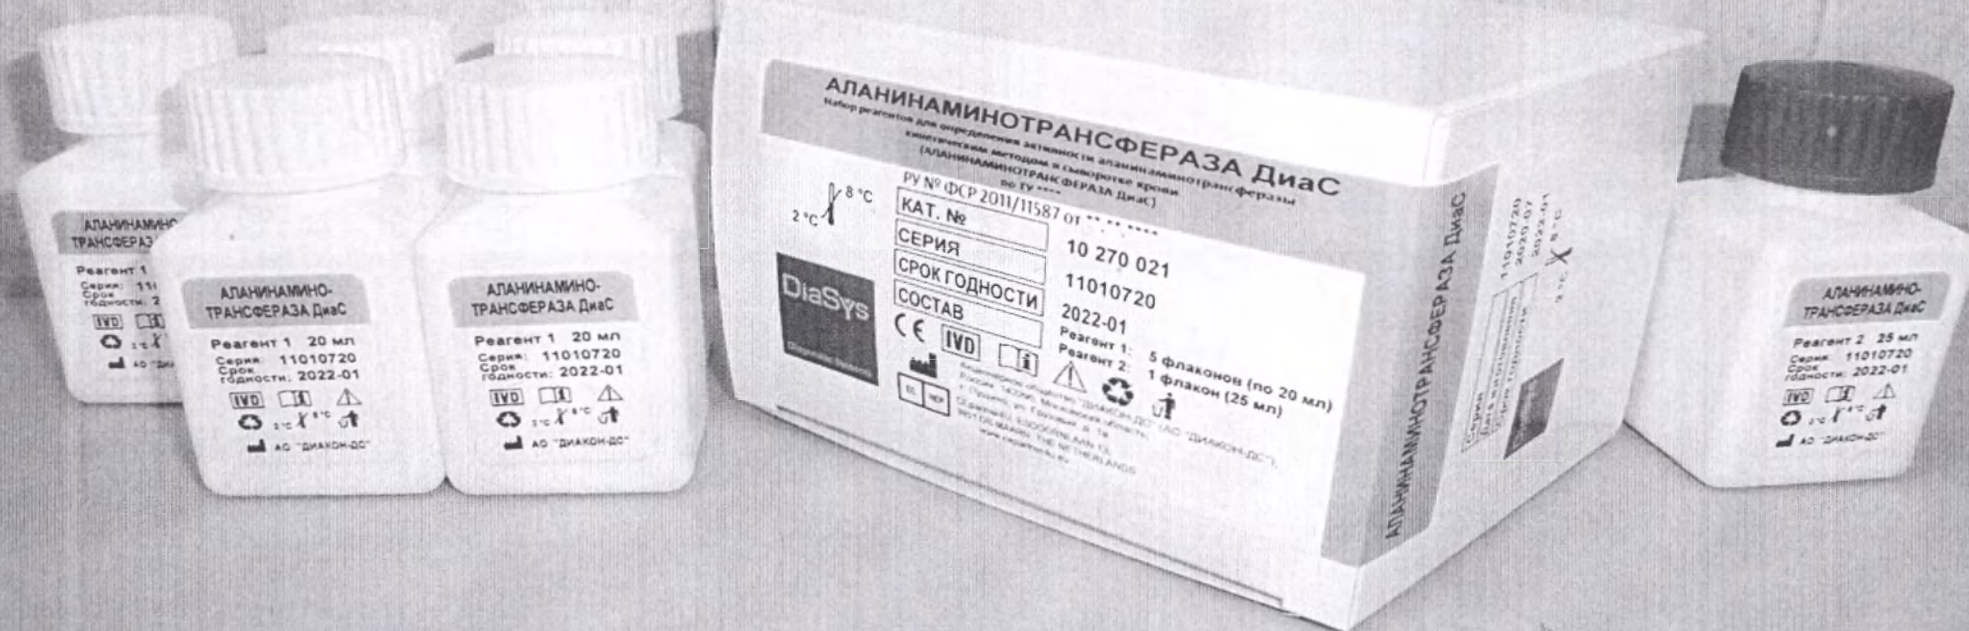

Внешний вид
Набора реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДиаС)

Стация 2

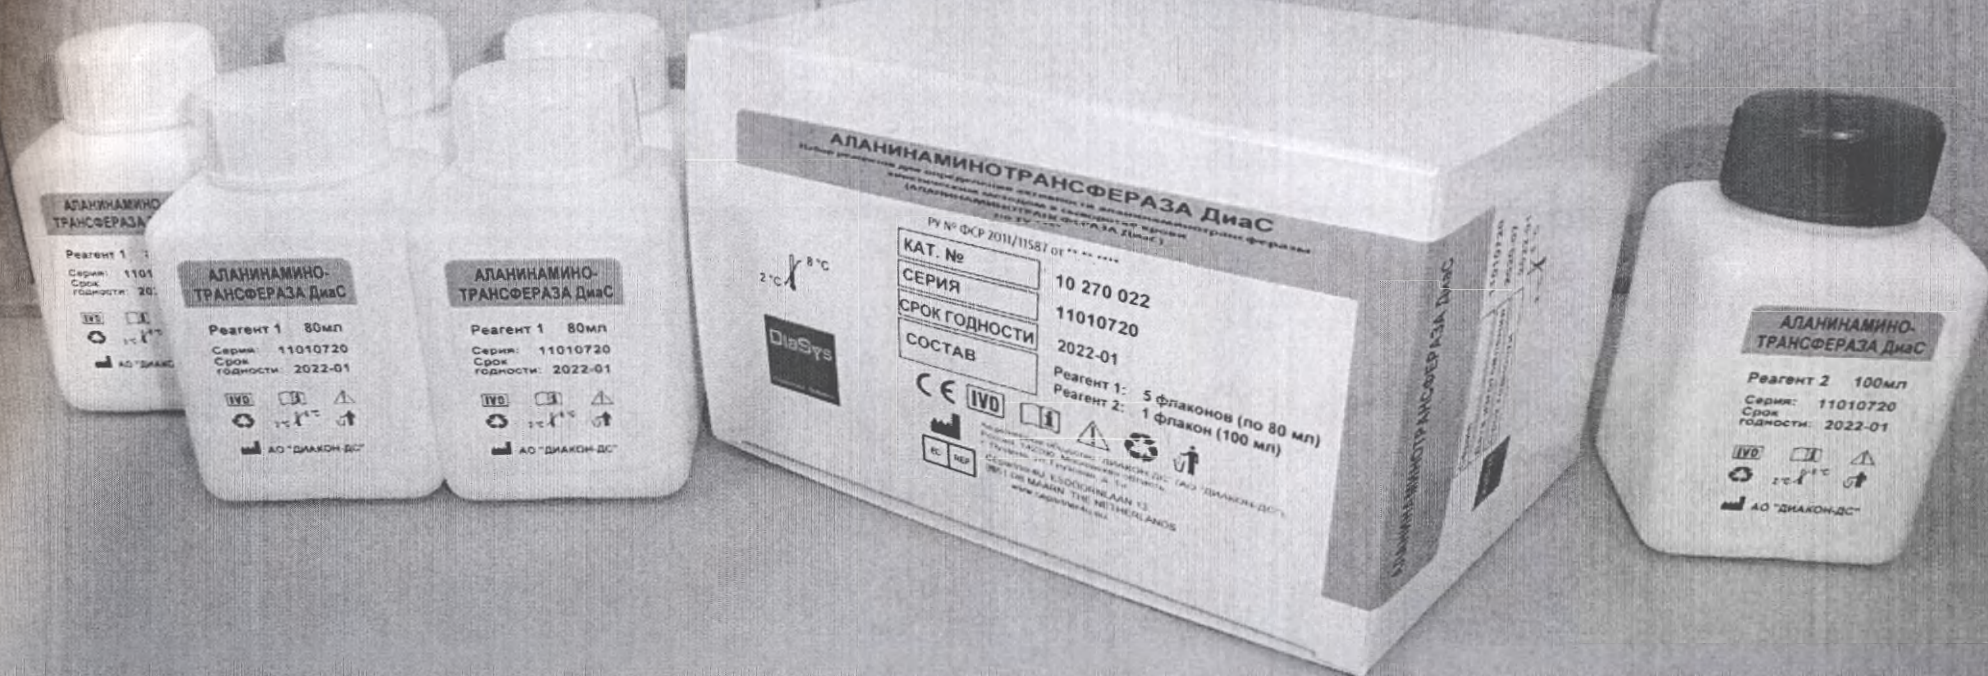

Внешний вид

Набора реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови (АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДиаС)


плектация 3



Внешний вид

Набора реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДиаС)

лекция 4

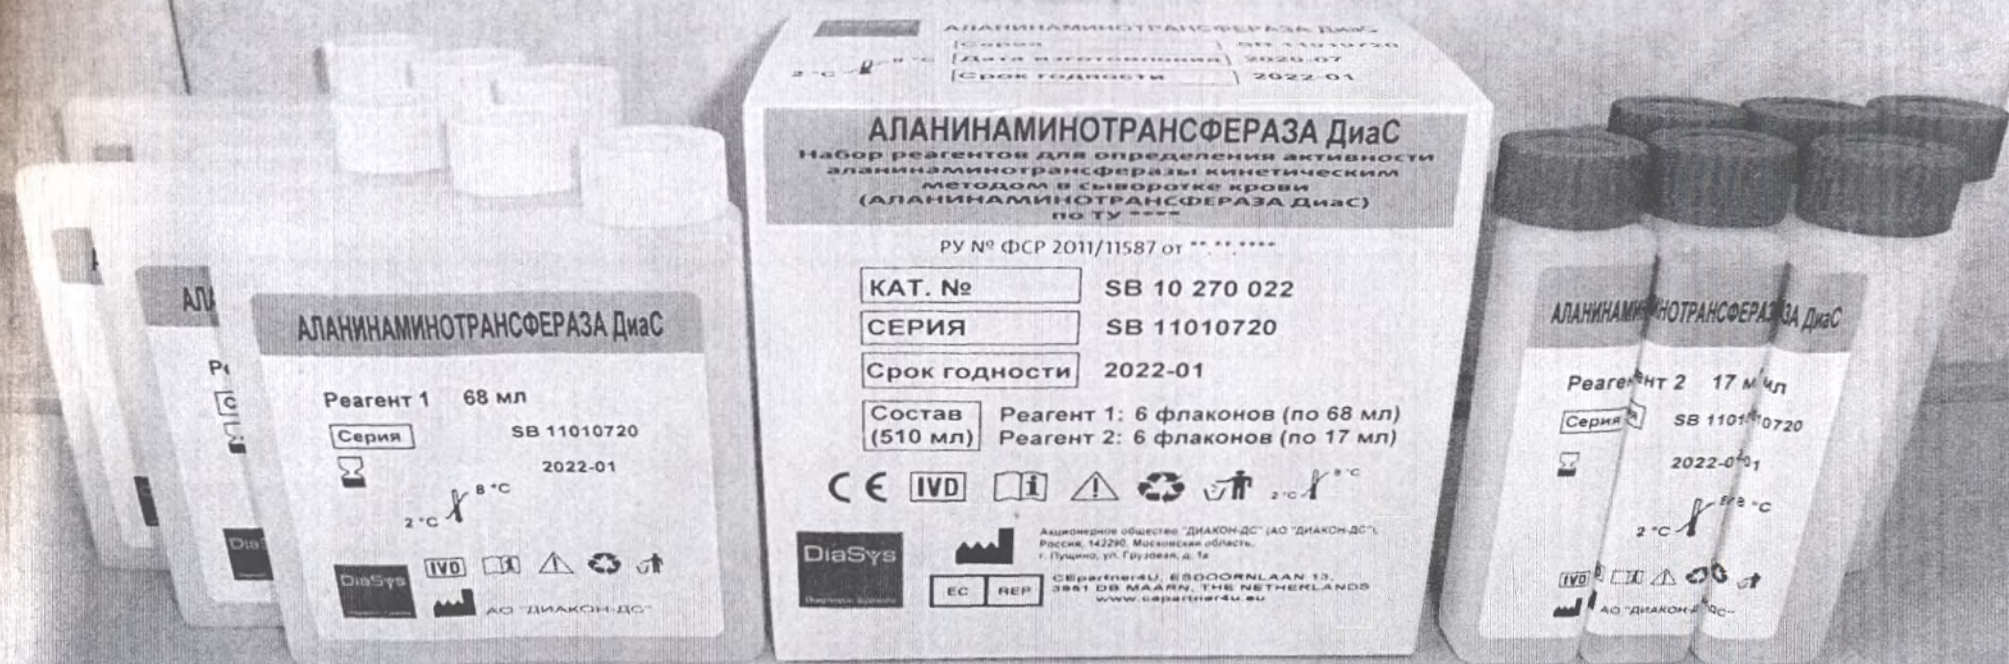

Внешний вид
Набора реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДиаС)

лектация 5



Внешний вид

Набора реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДиаС)

Инструкция 6 (1)



Внешний вид
Набора реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДиаС)


лекция 6 (2)



Внешний вид

Набора реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДиаС)

плектация 7

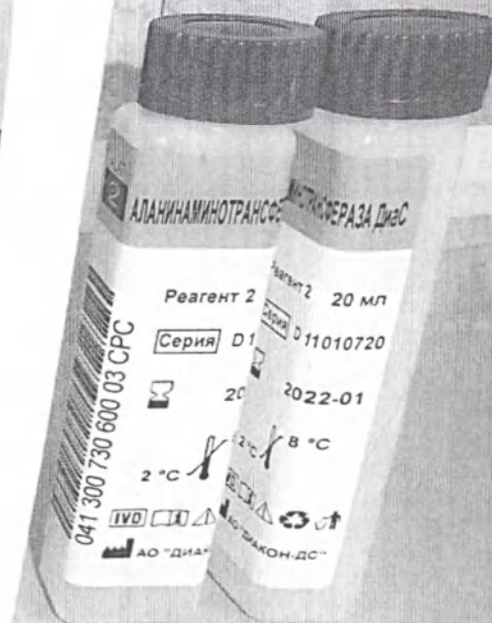

**Набора реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДиаС)**

АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДИАС

DIRUI CS-T240/CS-600B

АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДИАС

Набор реагентов для определения активности
аланинаминотрансферазы кинетическим
методом в сыворотке крови
(АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДИАС)
по МУ ----

DIRUI CS-T240/CS-600B

РУ № ФСР 2011/11587 от **.*.****

Количество тестов

КАТ. №

СЕРИЯ

Срок годности

Состав
(510 мл)

**** / ****

D 10 270 022

D 11010720

2022-01

Реагент 1: 6 флаконов (по 65 мл)

Реагент 2: 6 флаконов (по 20 мл)









2-С / °С



Акционерное общество "ДИАКОН-ДС" (АО "ДИАКОН-ДС"),
Россия, 142290, Московская область,
г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 19




Diagnostic Systems

EC

REP

CEpartner4U, ESDOORHAAAN 13,
3961 DB MAARN, THE NETHERLANDS
www.cepartner4u.eu

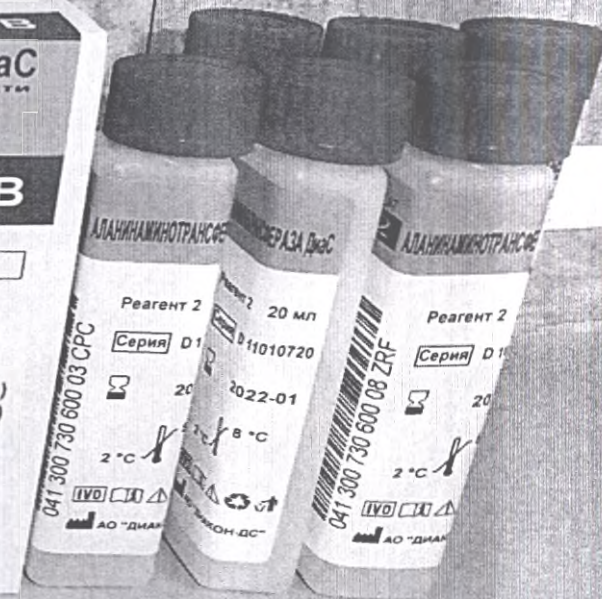

Внешний вид
Набора реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДиаС)


Мплектация 9



Внешний вид

Набора реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДиаС)


дисконтация 10

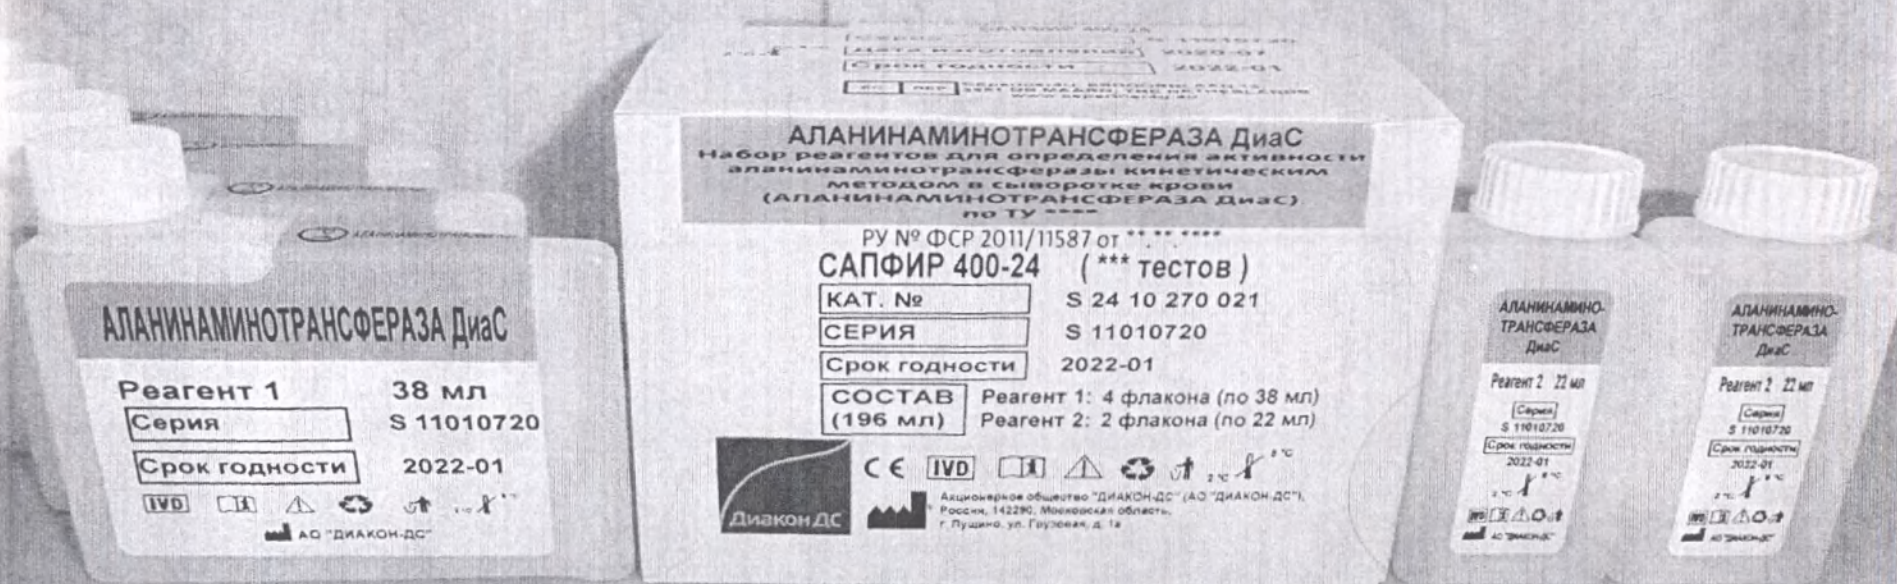

Внешний вид

Набора реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови (АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДиаС)

комплектация 11

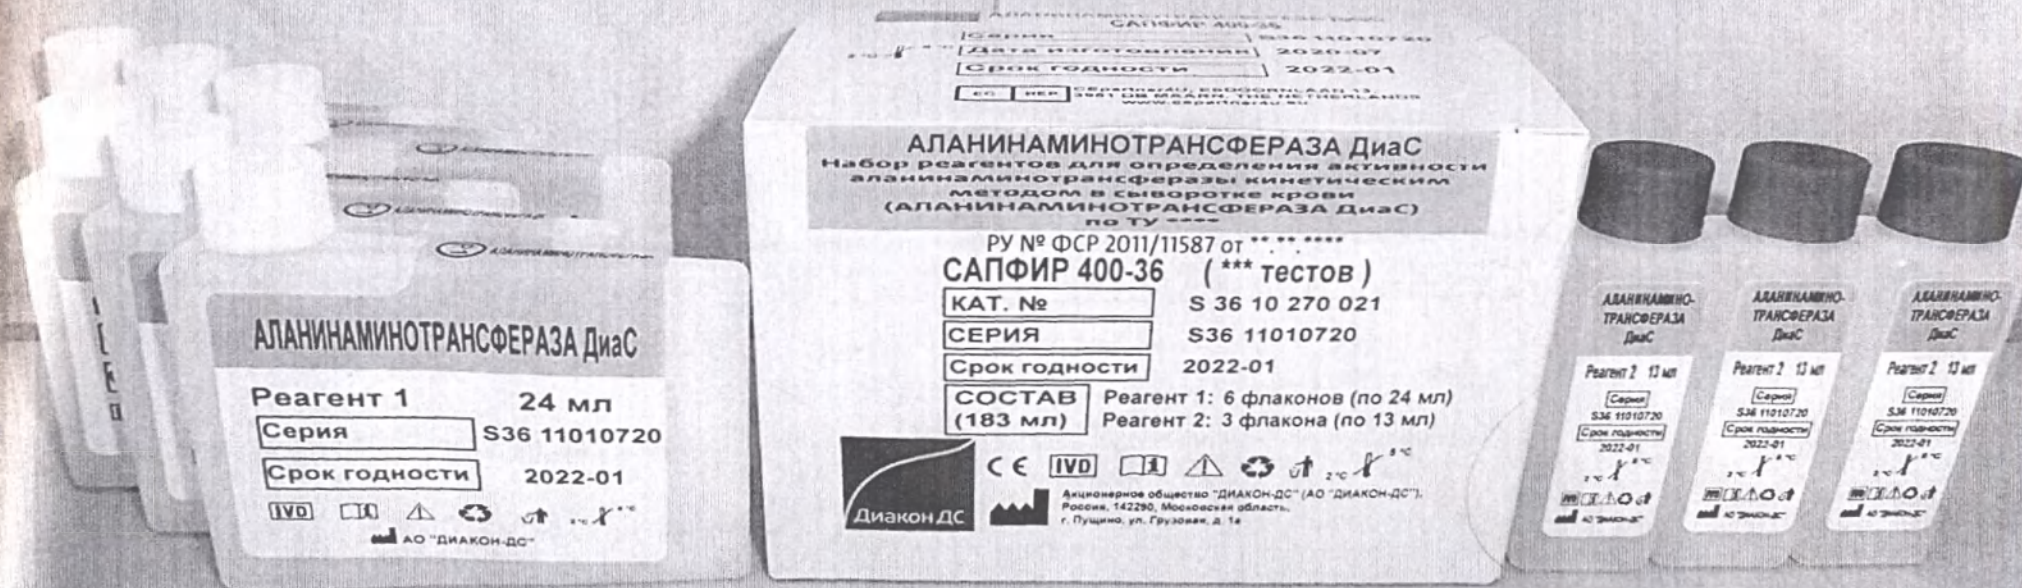

Внешний вид

Набора реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови (АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДиаС)

Комплектация 12



Внешний вид


Набора реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови (АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДиаС)



Внешний вид


Набора реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови (АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДиаС)

Милектация 14

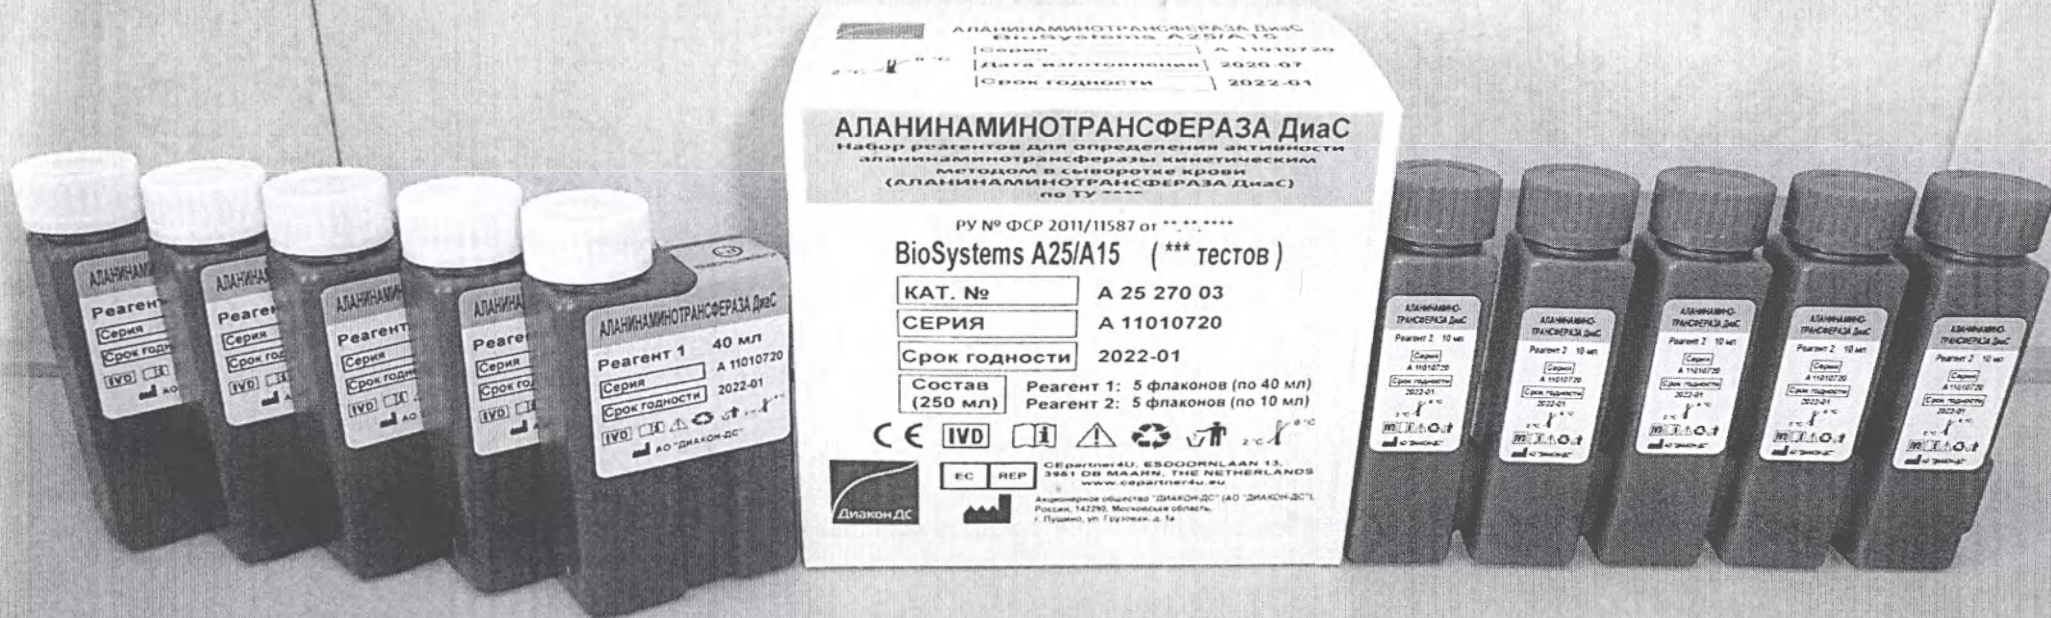

Внешний вид
Набора реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДиаС)

лекция 15

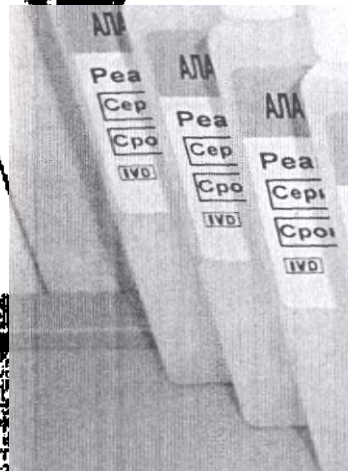

АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДиаС

Реагент 1 40 мл
Серия M200 11010720
Срок годности 2022-01

IVD CE L A G S R

AO "ДИАГНОС-00"

АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДиаС

Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови (АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДиаС)

по ТУ

Mindray BS-120/200/200E

РУ № ФСР 2011/1158 / от " "

Количество тестов ***

КАТ. №	M 200 10 270 024
СЕРИЯ	M 200 11010720
Срок годности	2022-01

СОСТАВ (200 мл) Реагент 1: 4 флакона (по 40 мл)
 Реагент 2: 2 флакона (по 20 мл)

CE IVD CE L A G S R

Средств для диагностики "ДиаС" АО "ДИАГНОС-00"
 Россия, 142902, Московская область,
 г. Пушкино, ул. Троицкая, д. 1а

CE REP CE PARTNAPU, ESDOORNLAAN 13,
 3861 GB BALKEN, THE NETHERLANDS
 www.cepartnaru.eu



АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДиаС



Реагент 2 20 мл
Серия M200 11010720
Срок годности 2022-01

IVD CE L A G S R

АО "ДИАГНОС-00"


Внешний вид
Набора реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДиаС)

Милектация 16

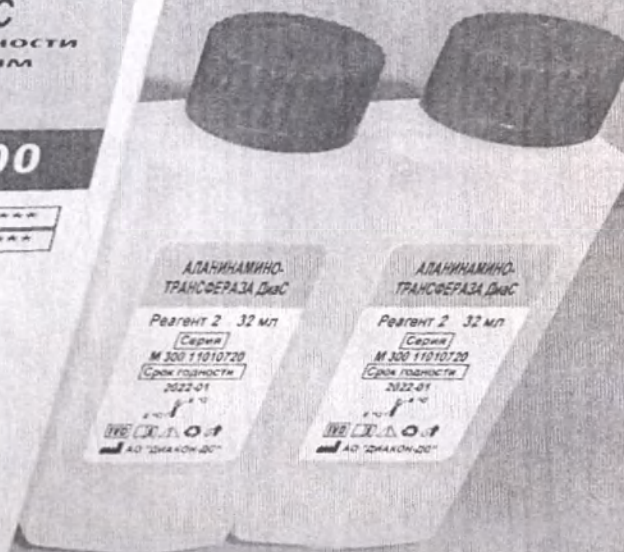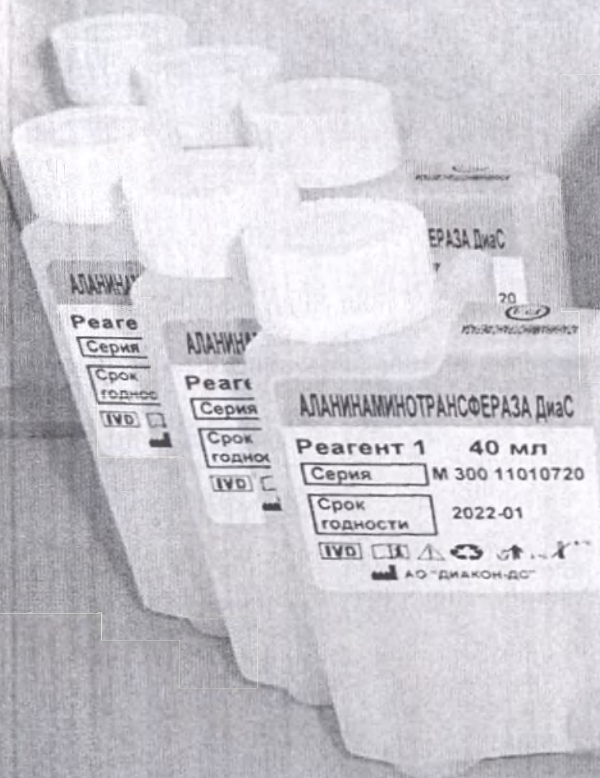

Внешний вид
Набора реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДиаС)


Материал 17

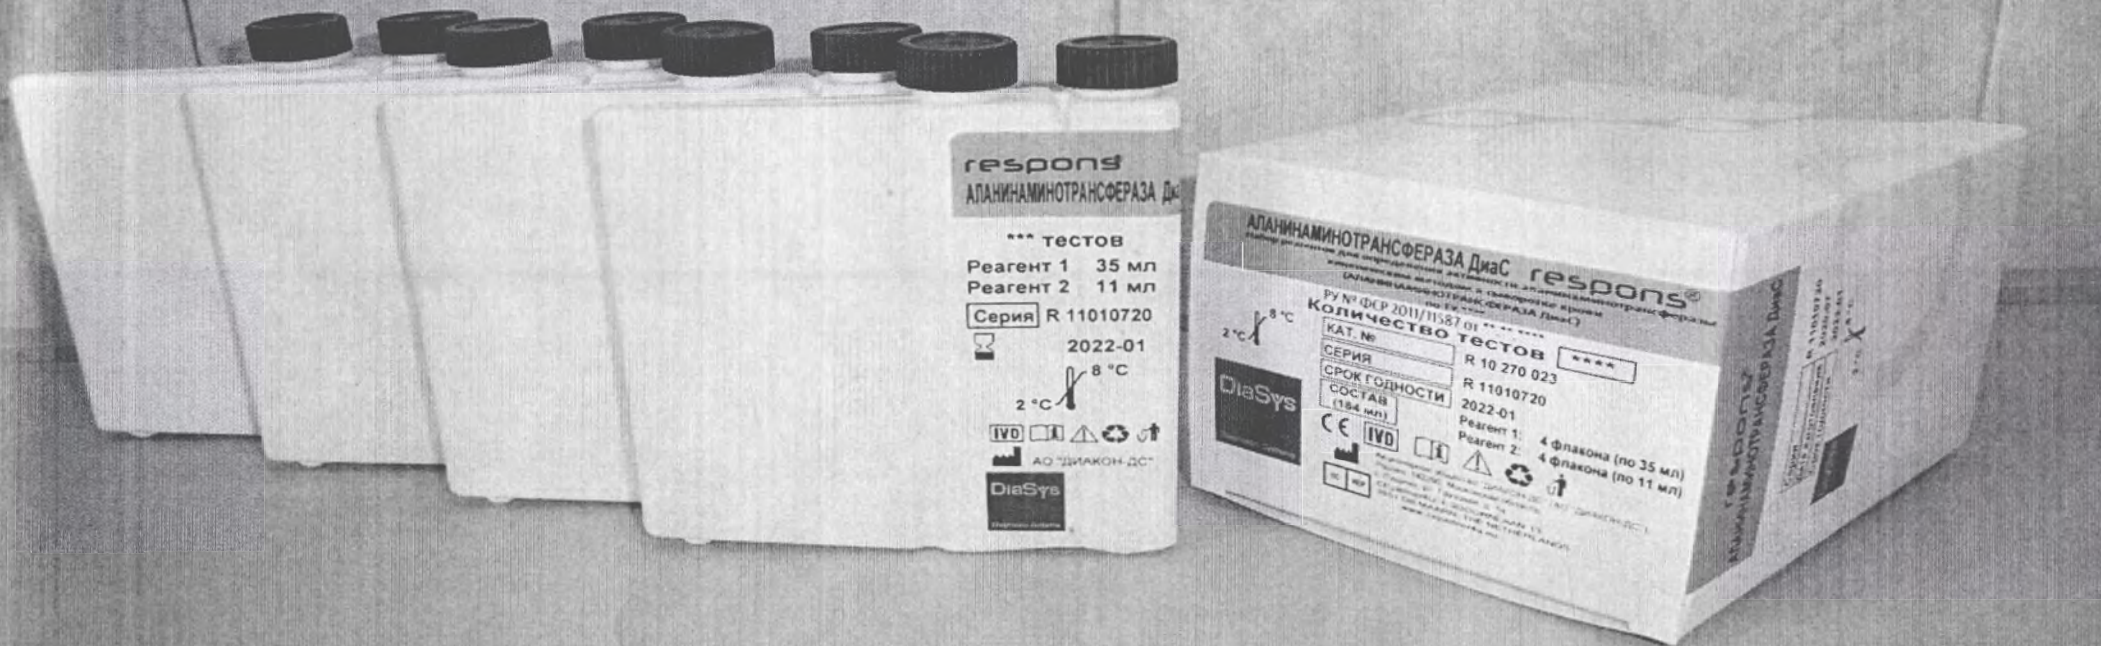

Внешний вид

Набора реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови (АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДиаС)

Комплектация 18

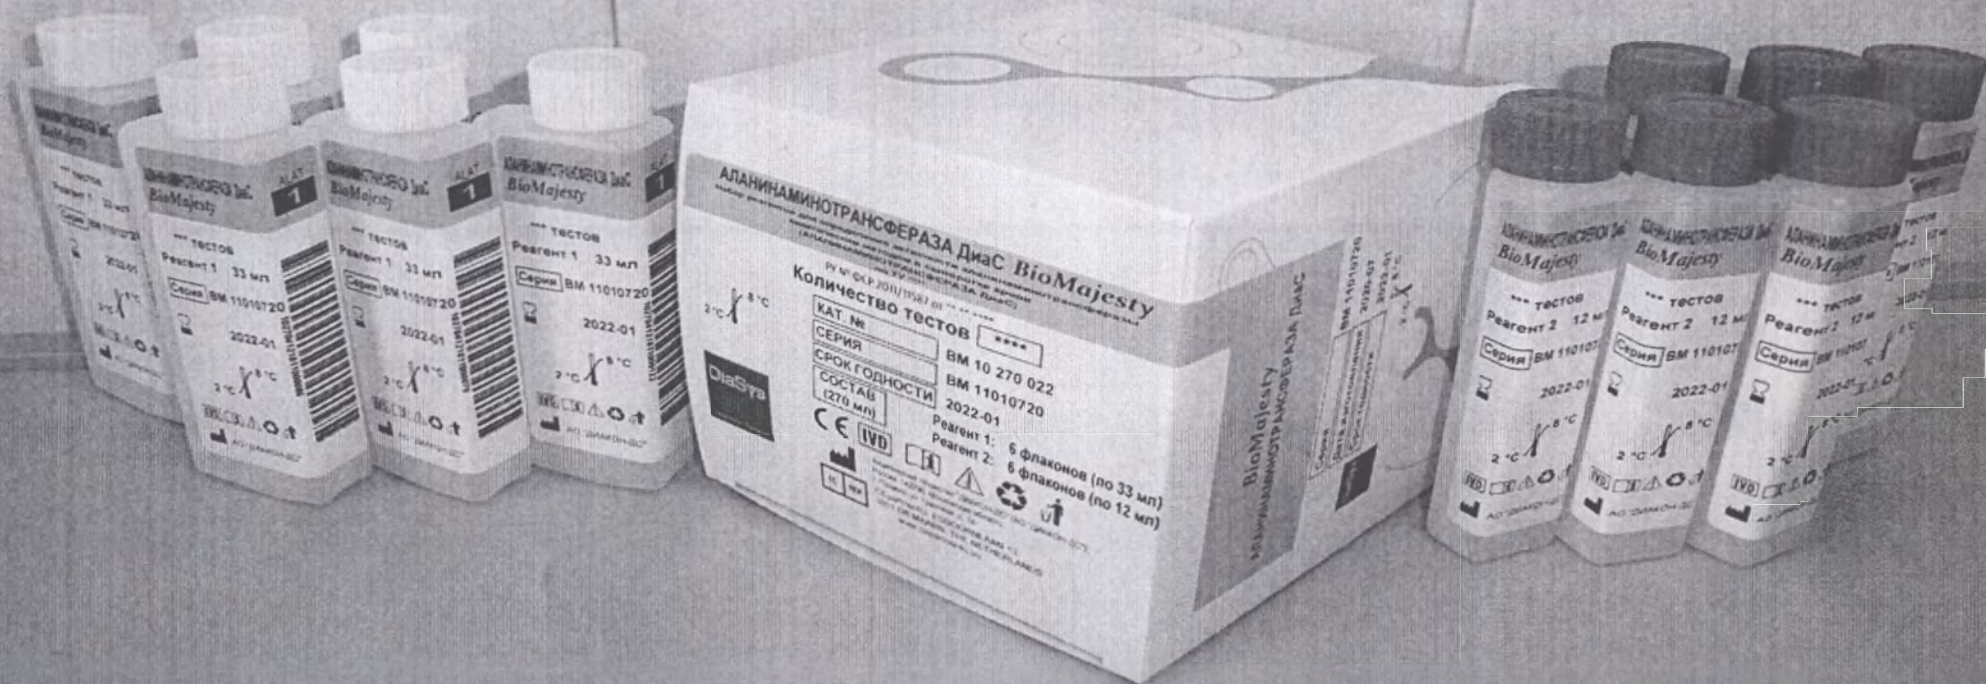


мплектация 19



Внешний вид

Набора реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови (АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДиаС)

коллекция 20

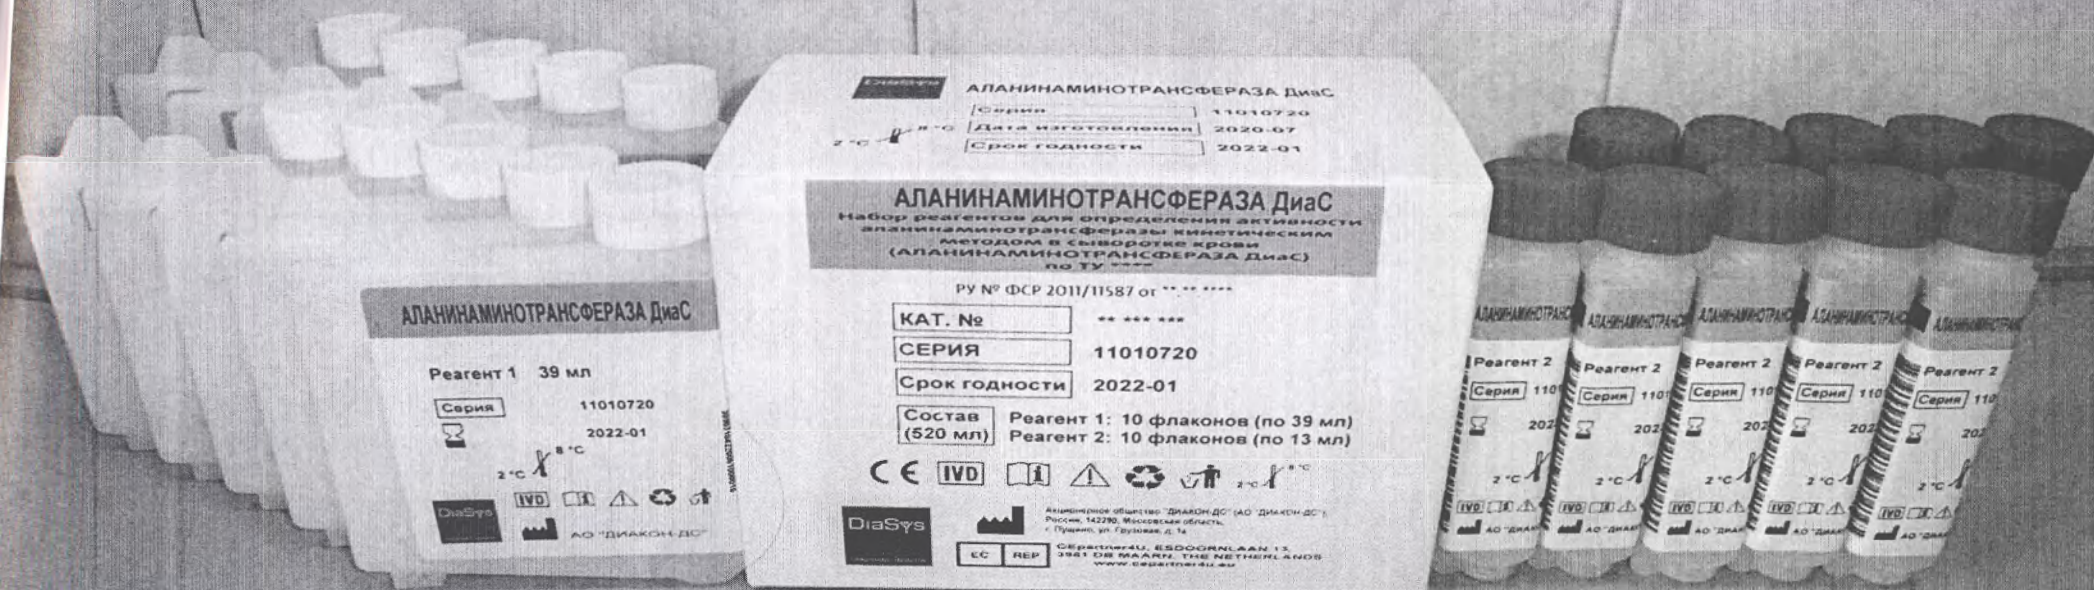

Внешний вид

Набора реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови (АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДиаС)

Мплектация 21



**Набора реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДиаС)**


Комплектация 22 (2)



Внешний вид

Набора реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови (АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДиаС)

Комплектация 23

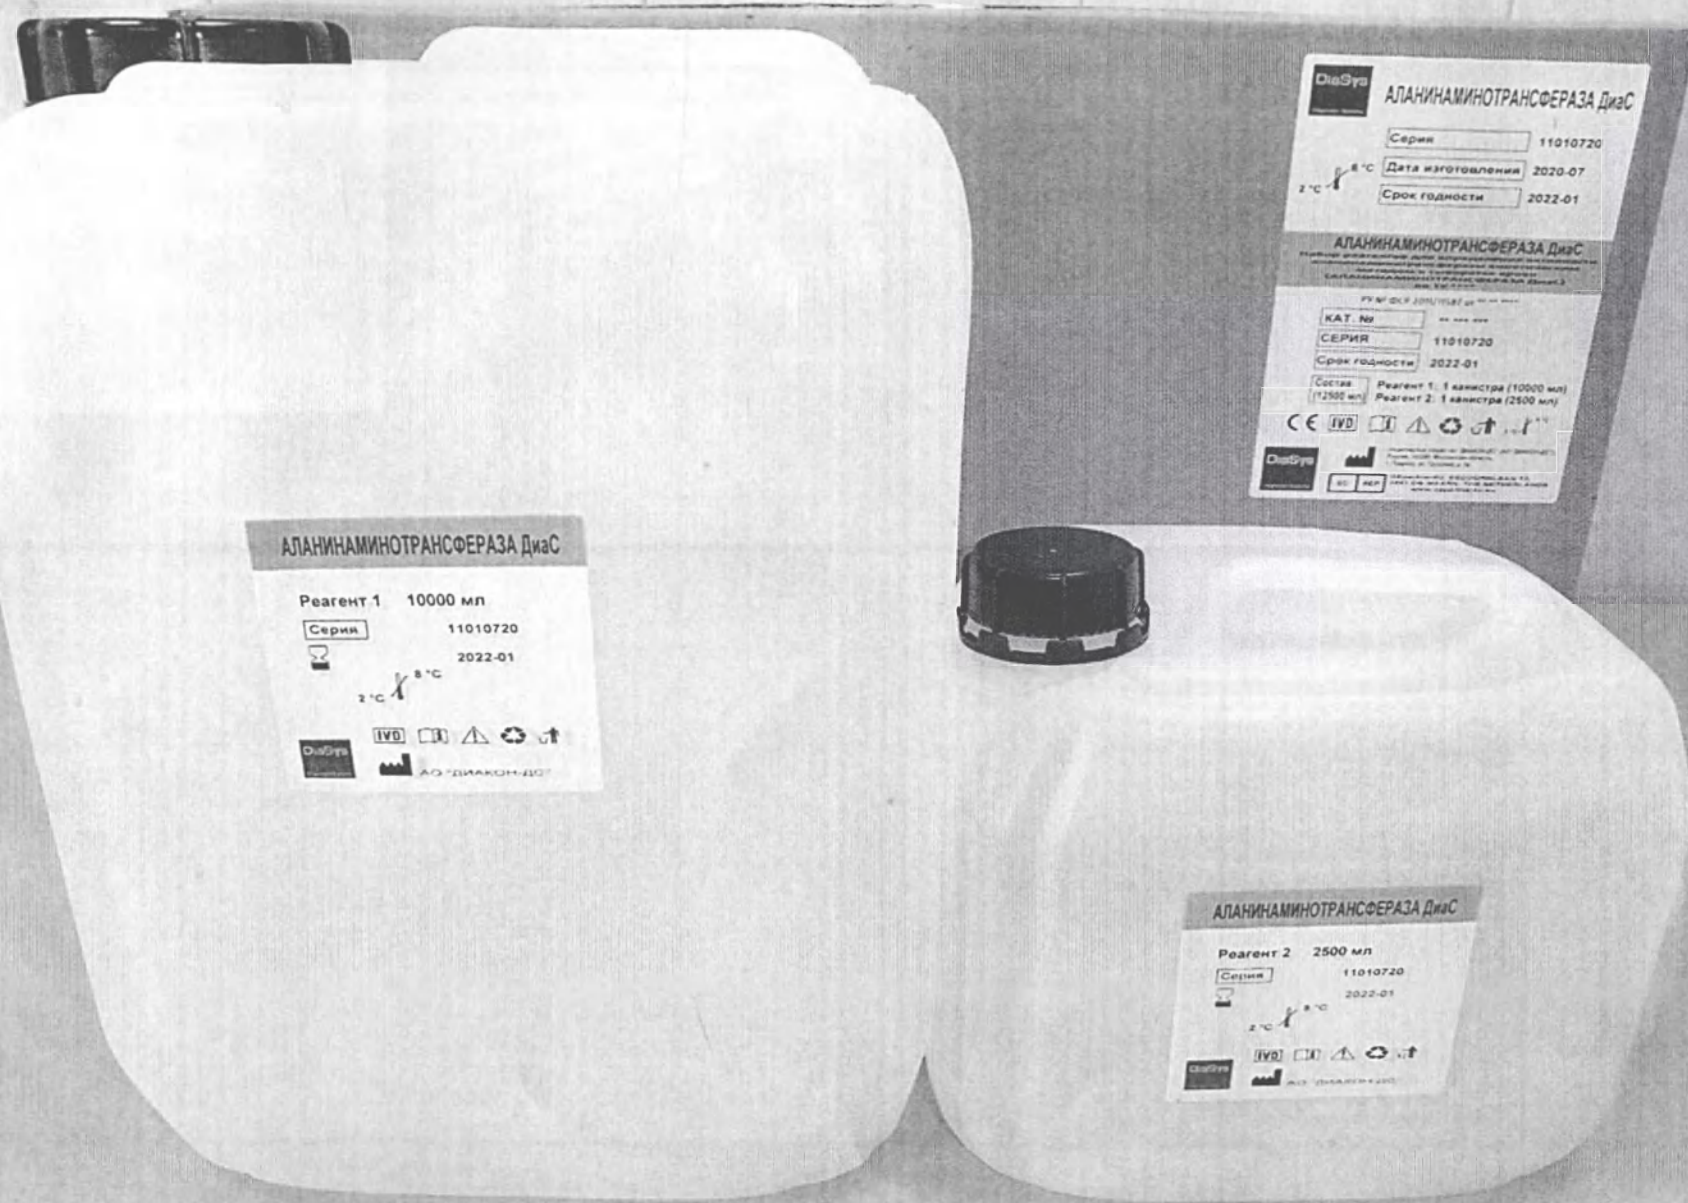



Прочито, пронумеровано и
скреплено печатью 25
Генеральный директор
АО «ДИАКОН-ДС»

Т.Ю. Корзун

Внешний вид Набора реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови (АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА Диас)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

