


Внешний вид
Набора реагентов для количественного определения кальция методом с арсеназо III в сыворотке крови и моче
(КАЛЬЦИЙ АС ДиаС)



Внешний вид
Набора реагентов для количественного определения кальция методом с арсеназо III в сыворотке крови и моче
(КАЛЬЦИЙ АС ДиаС)

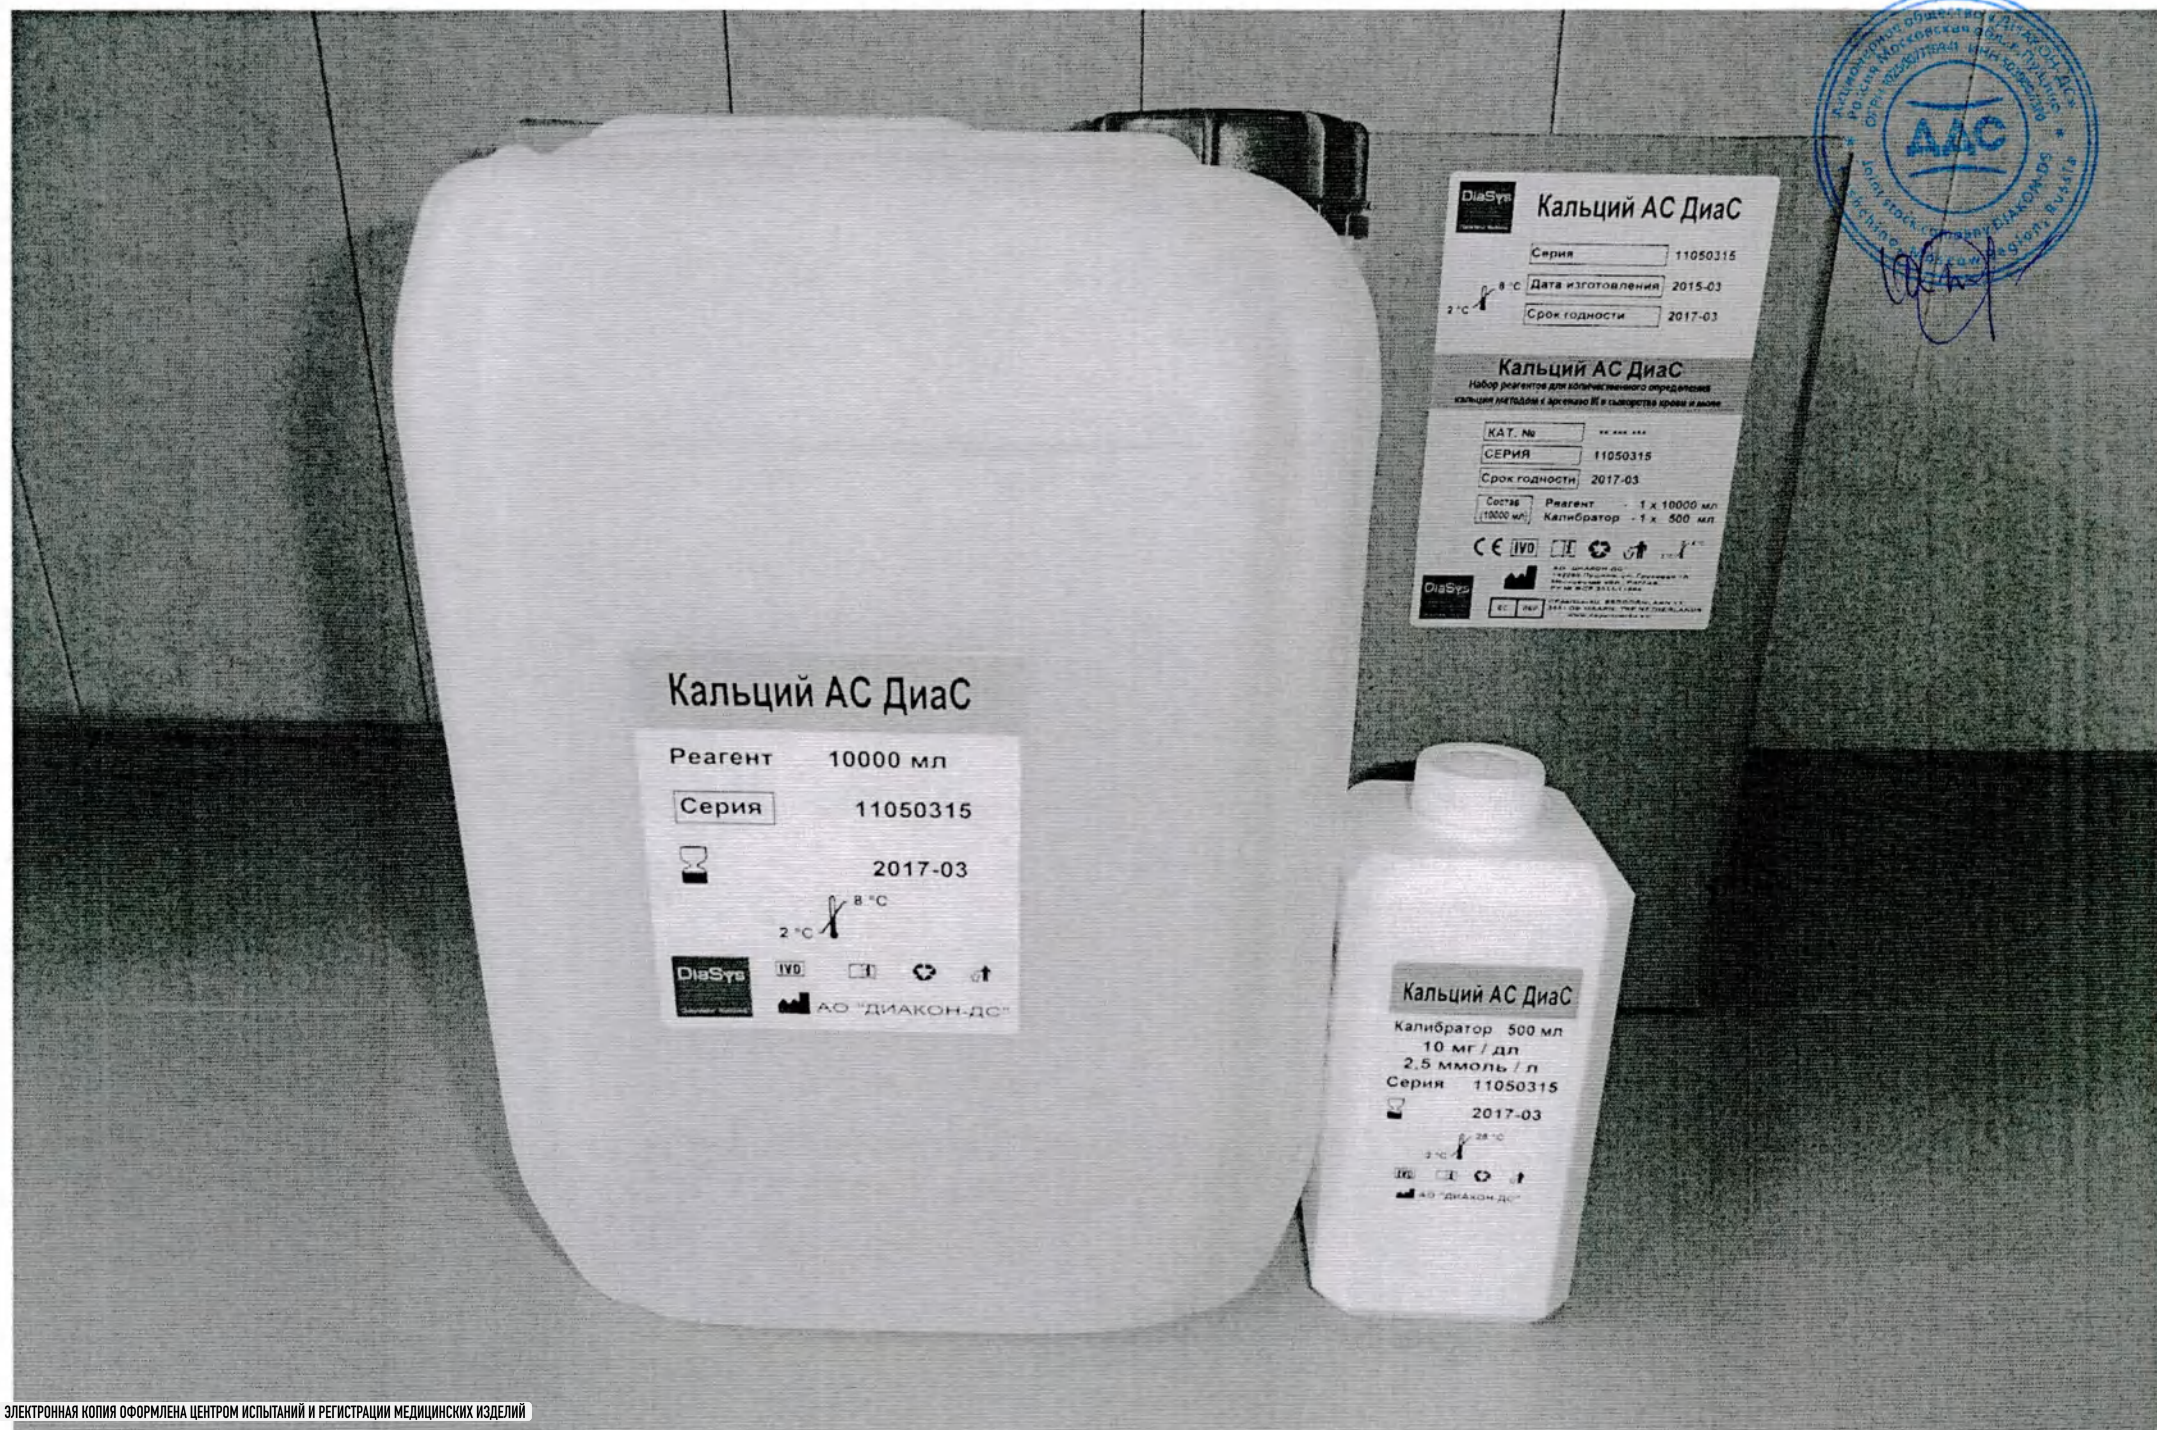

Внешний вид
Набора реагентов для количественного определения кальция методом с арсеназо III в сыворотке крови и моче
(КАЛЬЦИЙ АС ДиаС)



Внешний вид
Набора реагентов для количественного определения кальция методом с арсеназо III в сыворотке крови и моче
(КАЛЬЦИЙ АС ДиаС)



Внешний вид
Набора реагентов для количественного определения кальция методом с арсеназо III в сыворотке крови и моче
(КАЛЬЦИЙ АС ДиаС)




Внешний вид
Набора реагентов для количественного определения кальция методом с арсеназо III в сыворотке крови и моче
(КАЛЬЦИЙ АС ДиаС)



Внешний вид
Набора реагентов для количественного определения кальция методом с арсеназо III в сыворотке крови и моче
(КАЛЬЦИЙ АС ДиаС)



Внешний вид
Набора реагентов для количественного определения кальция методом с арсеназо III в сыворотке крови и моче
(КАЛЬЦИЙ АС ДиаС)

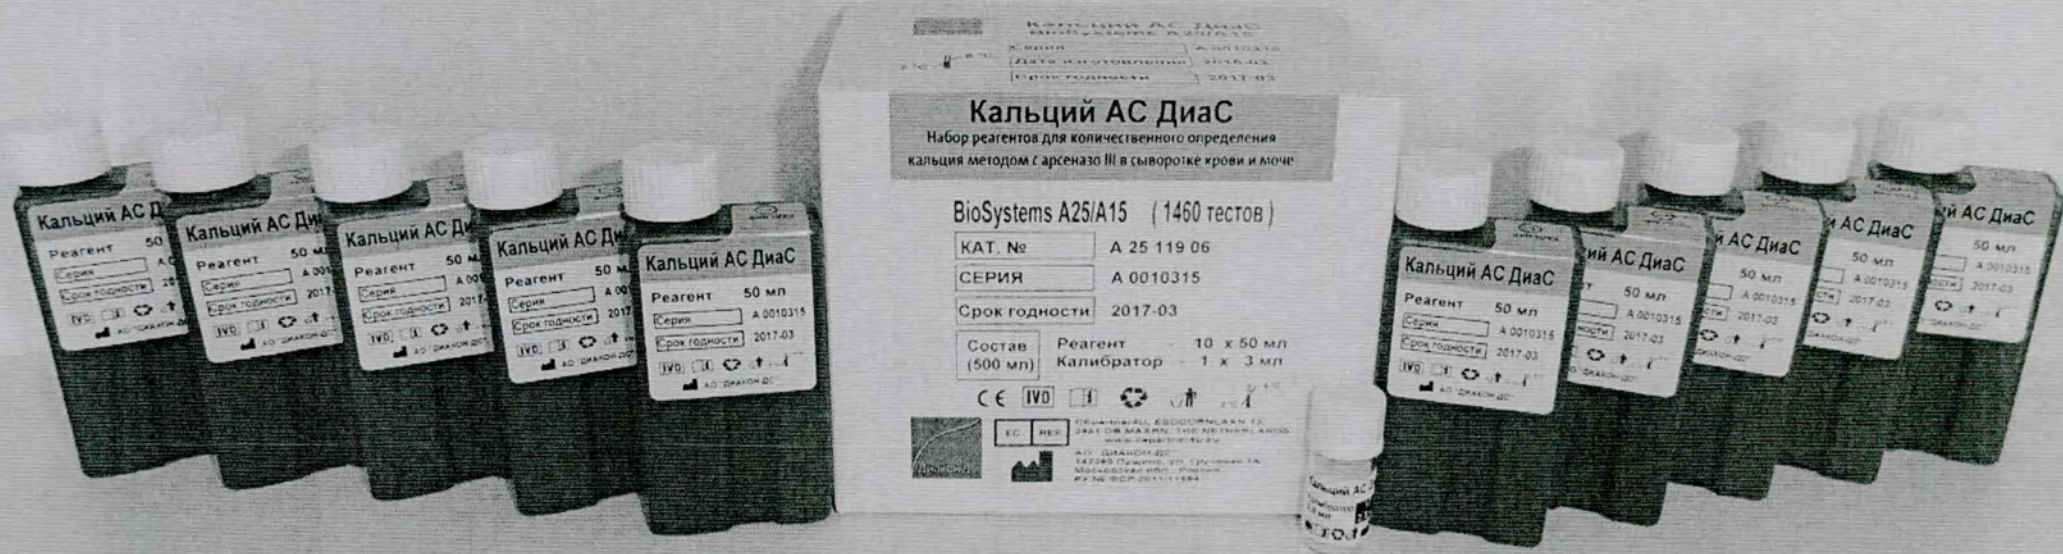


Внешний вид
Набора реагентов для количественного определения кальция методом с арсеназо III в сыворотке крови и моче
(КАЛЬЦИЙ АС ДиаС)



Внешний вид
Набора реагентов для количественного определения кальция методом с арсеназо III в сыворотке крови и моче
(КАЛЬЦИЙ АС ДиаС)



Внешний вид
Набора реагентов для количественного определения кальция методом с арсеназо III в сыворотке крови и моче
(КАЛЬЦИЙ АС ДиаС)

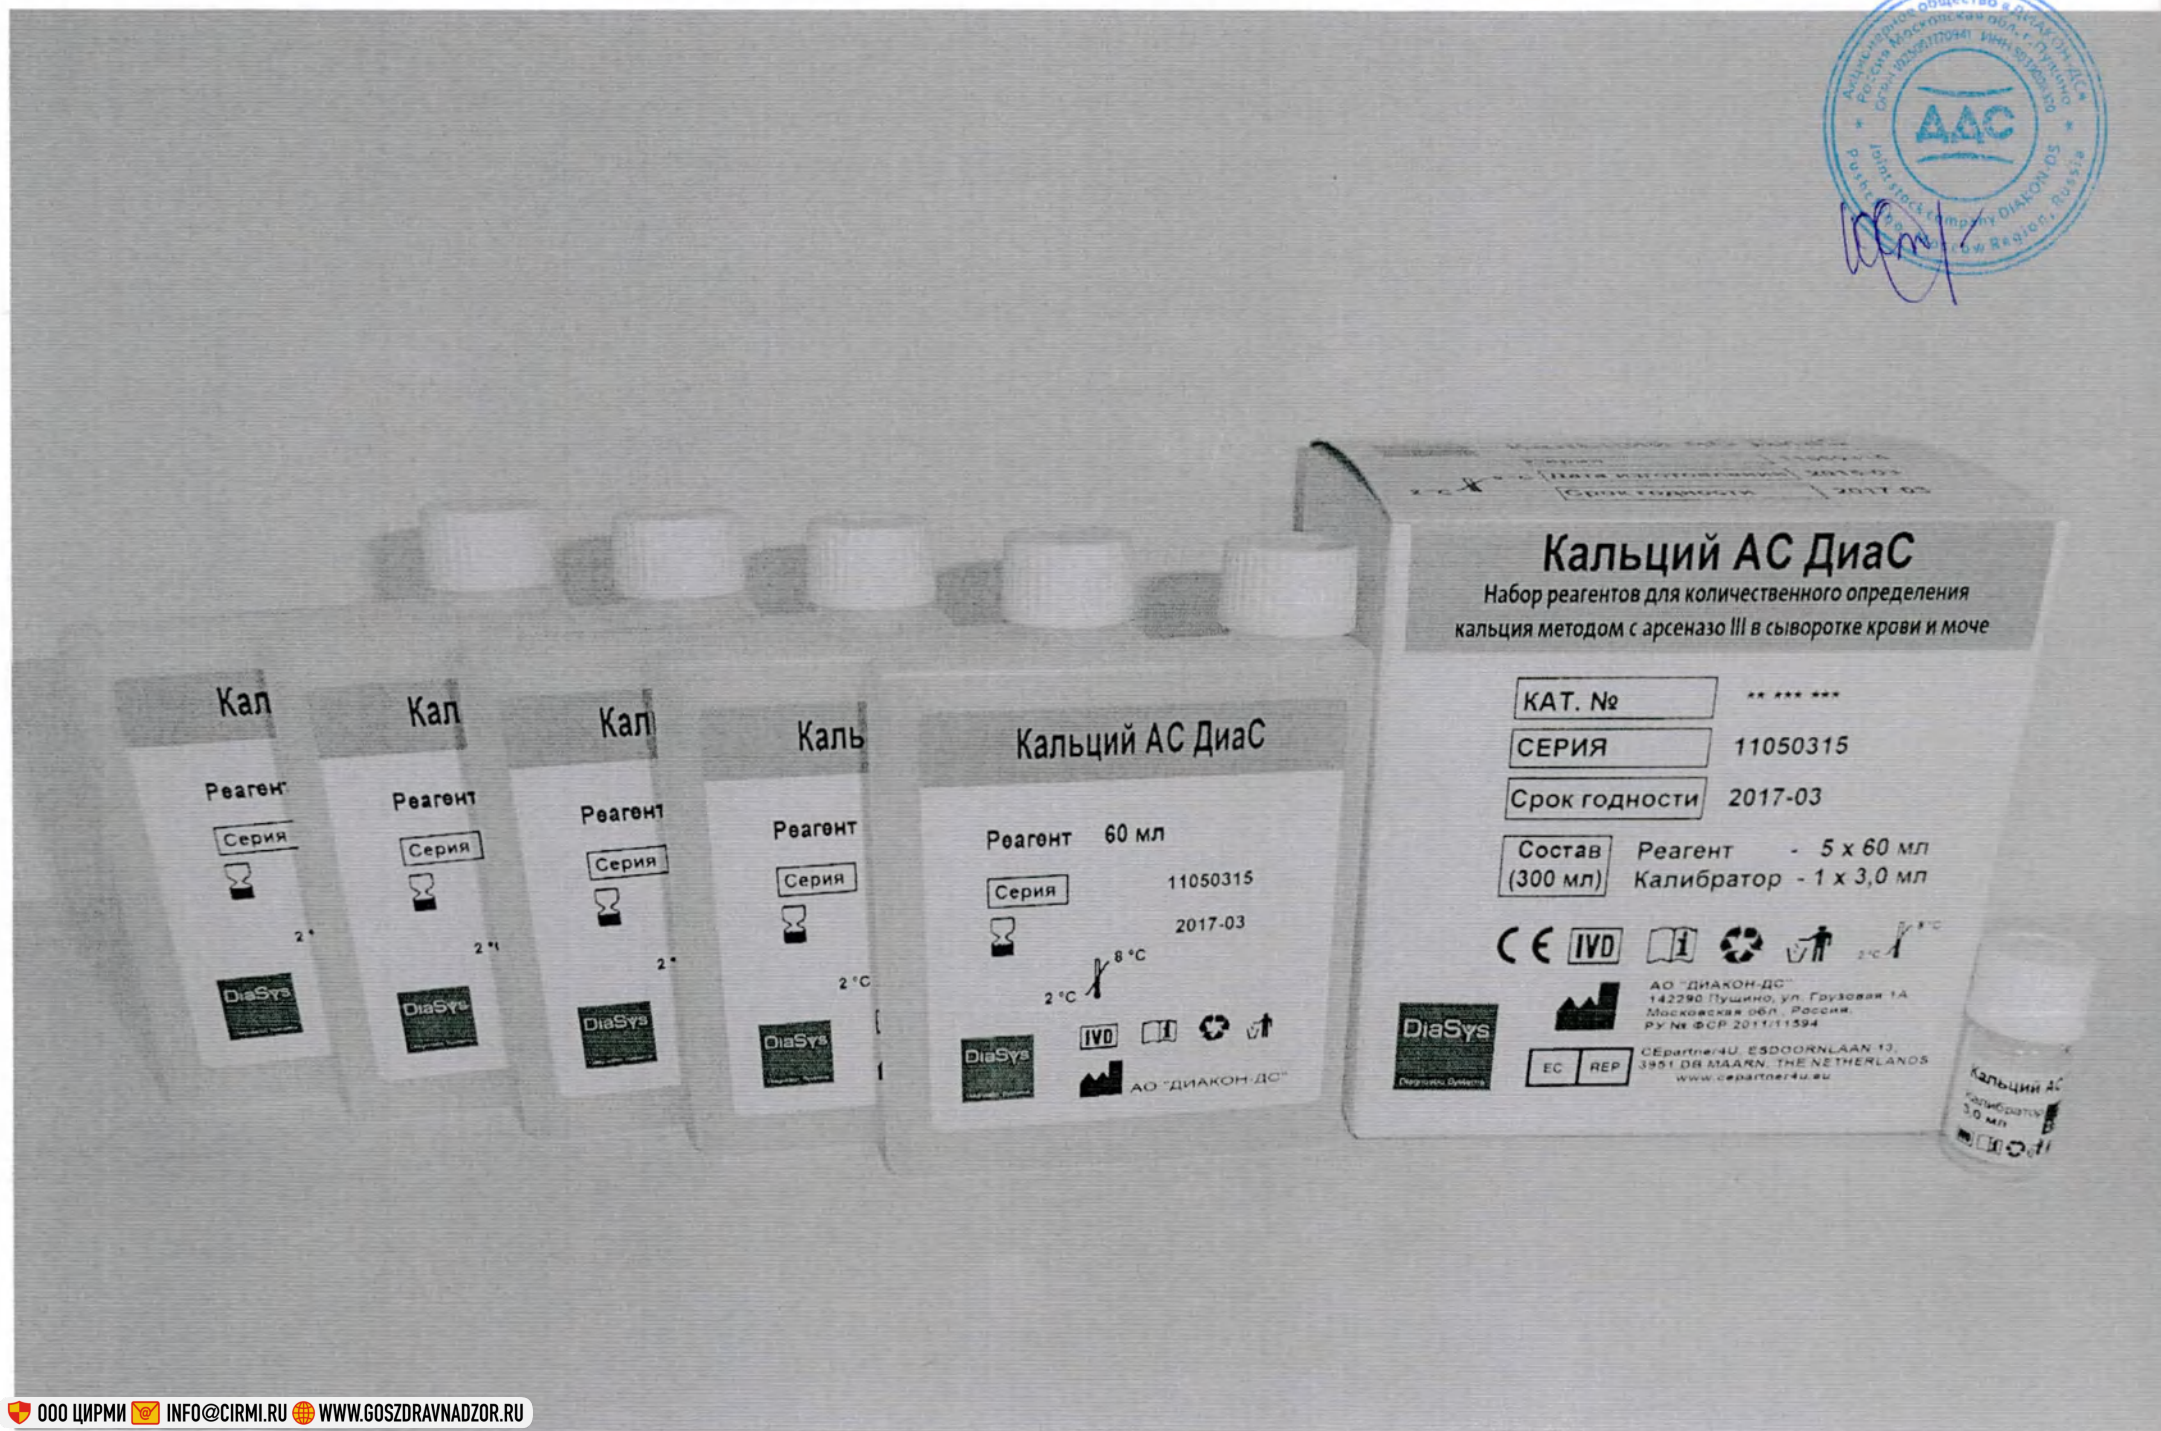

Кальций АС ДиаС



Набор реагентов для количественного определения
кальция методом с арсеназо III в сыворотке крови и моче

КАТ. № *****


СЕРИЯ 11050315

Срок годности 2017-03


Состав Реагент - 5 x 60 мл
(300 мл) Калибратор - 1 x 3,0 мл



АО "ДИАКОН-ДС"
142290 Пушкино, ул. Грузовая 1А
Московская обл., Россия.
Р/Н № ФСР 2011/11594
CEpartner/4U, ESDOORNLAAN 13,
3951 DB MAARN, THE NETHERLANDS
www.cepartner4u.eu



Внешний вид
Набора реагентов для количественного определения кальция методом с арсеназо III в сыворотке крови и моче
(КАЛЬЦИЙ АС ДиаС)

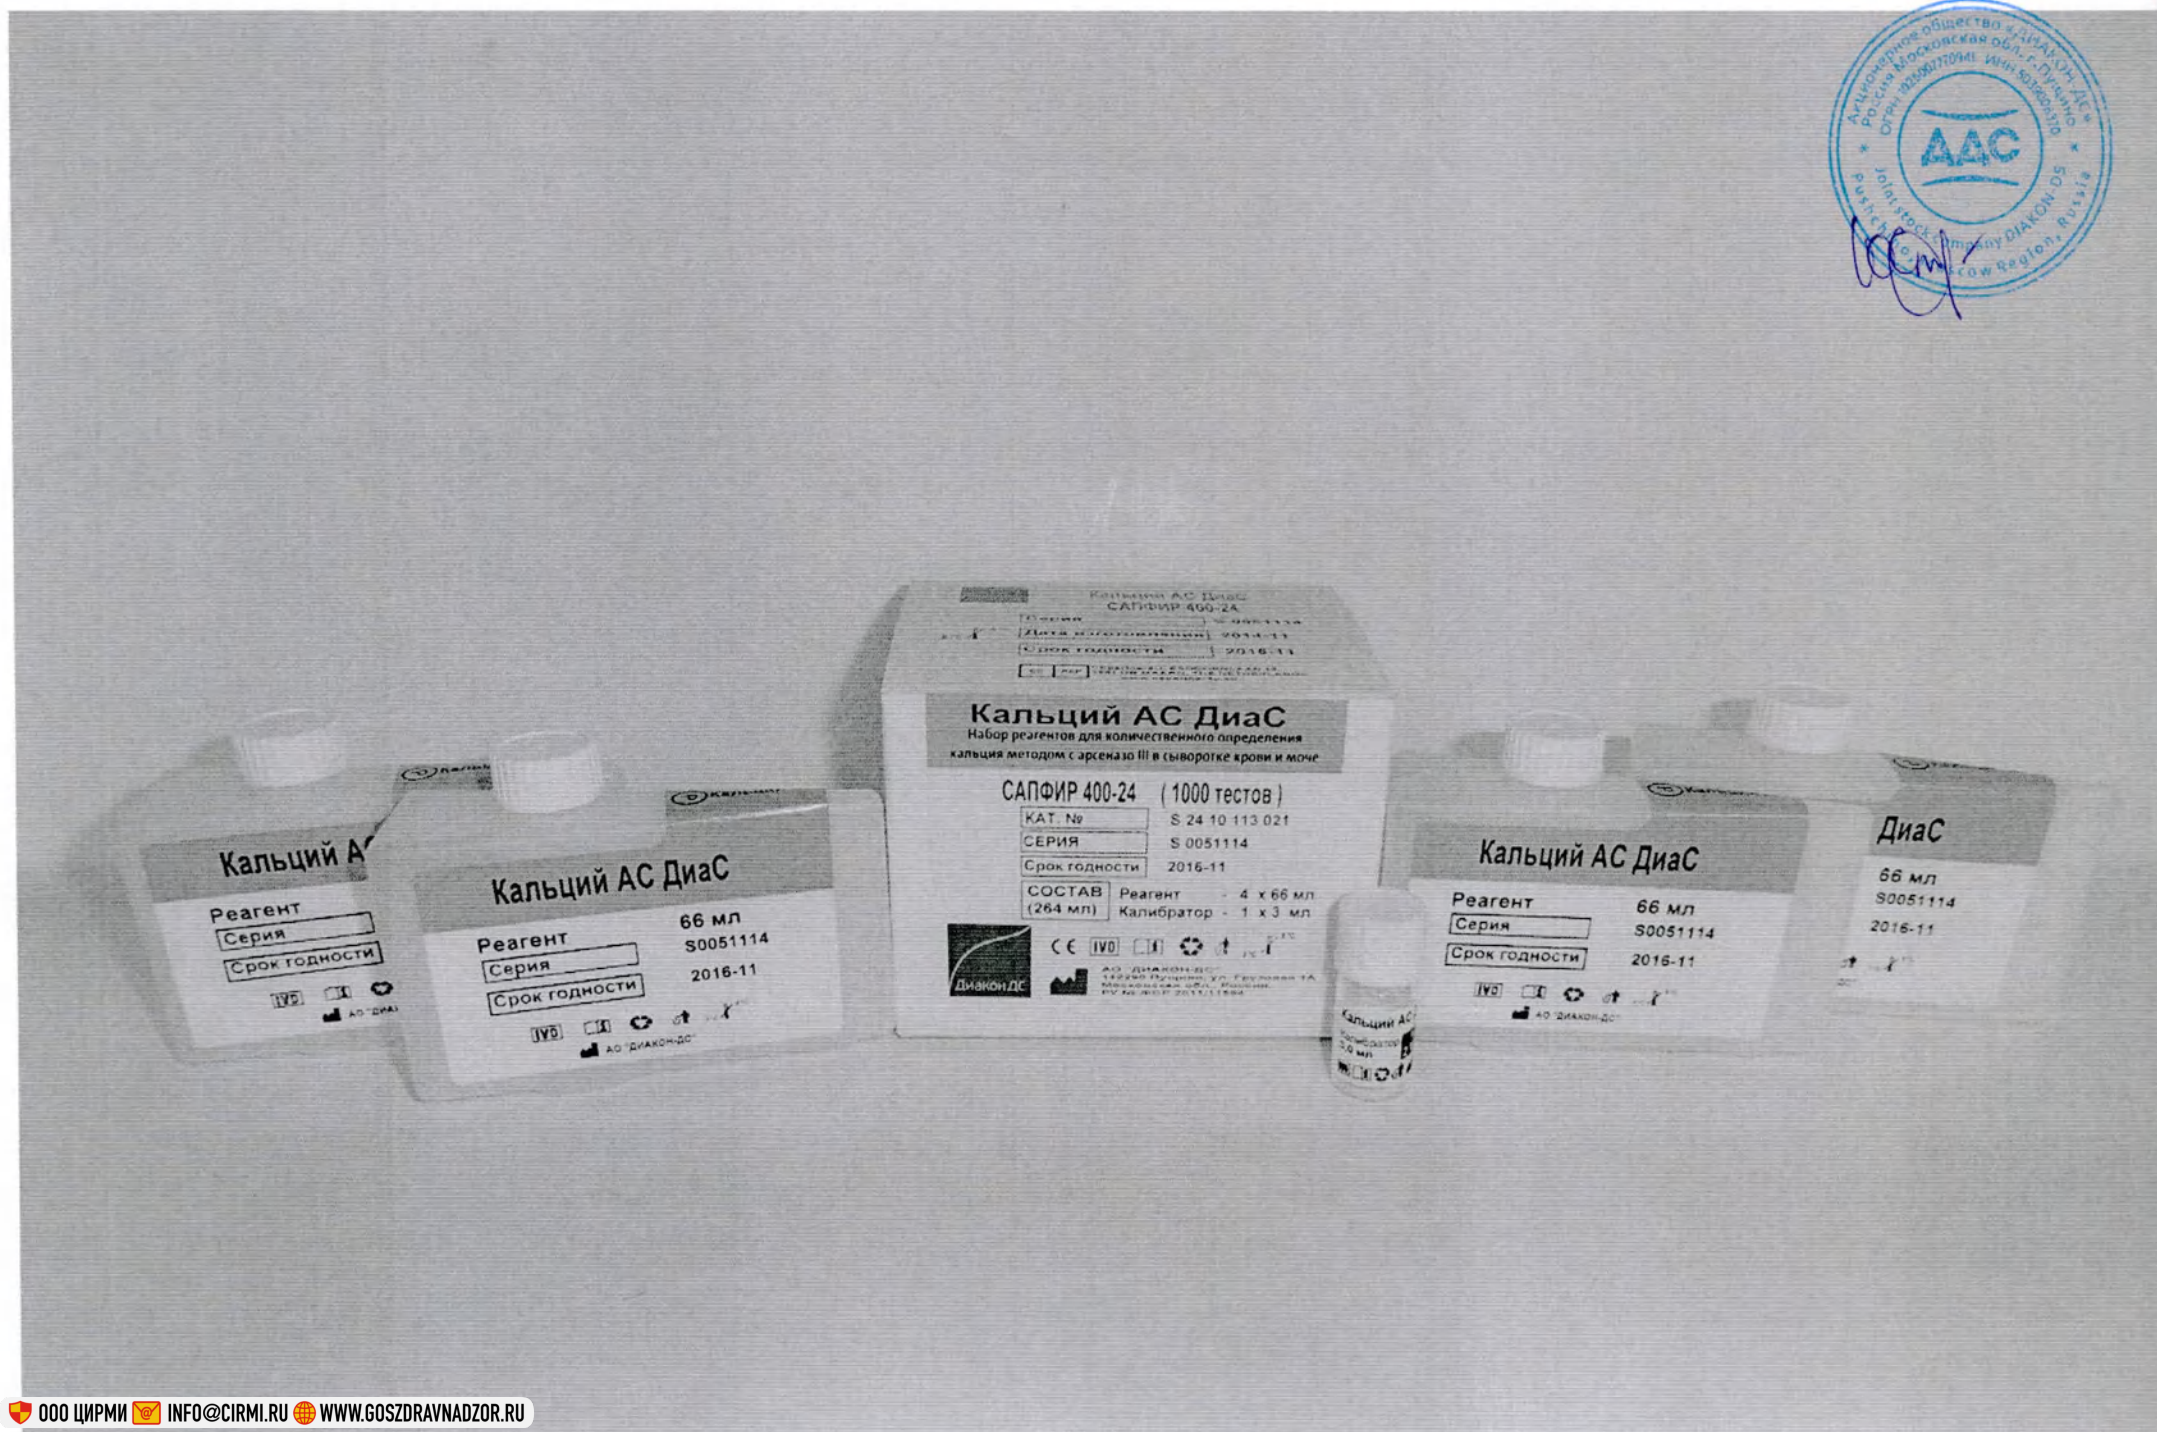

Внешний вид
Набора реагентов для количественного определения кальция методом с арсеназо III в сыворотке крови и моче
(КАЛЬЦИЙ АС ДиаС)






Кальций АС ДиаС
 Набор реагентов для количественного определения
 кальция методом с арсеназо III в сыворотке крови и моче


Mindray BS-300/380/400

Количество тестов **900**

КАТ. №	M 300 10 113 023
СЕРИЯ	M 300 11010315
Срок годности	2017-03
Состав (240 мл)	Реагент - 4 x 60 мл Калибратор - 1 x 3 мл

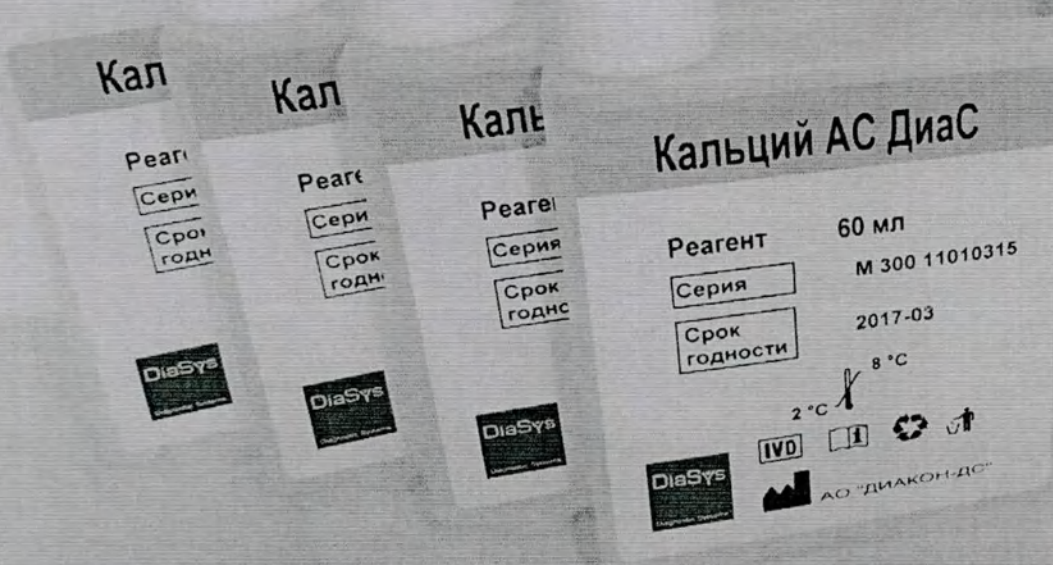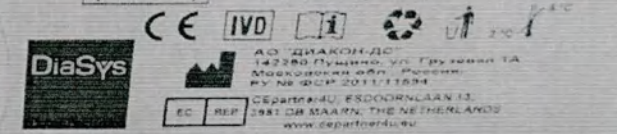





Внешний вид
Набора реагентов для количественного определения кальция методом с арсеназо III в сыворотке крови и моче
(КАЛЬЦИЙ АС ДиаС)

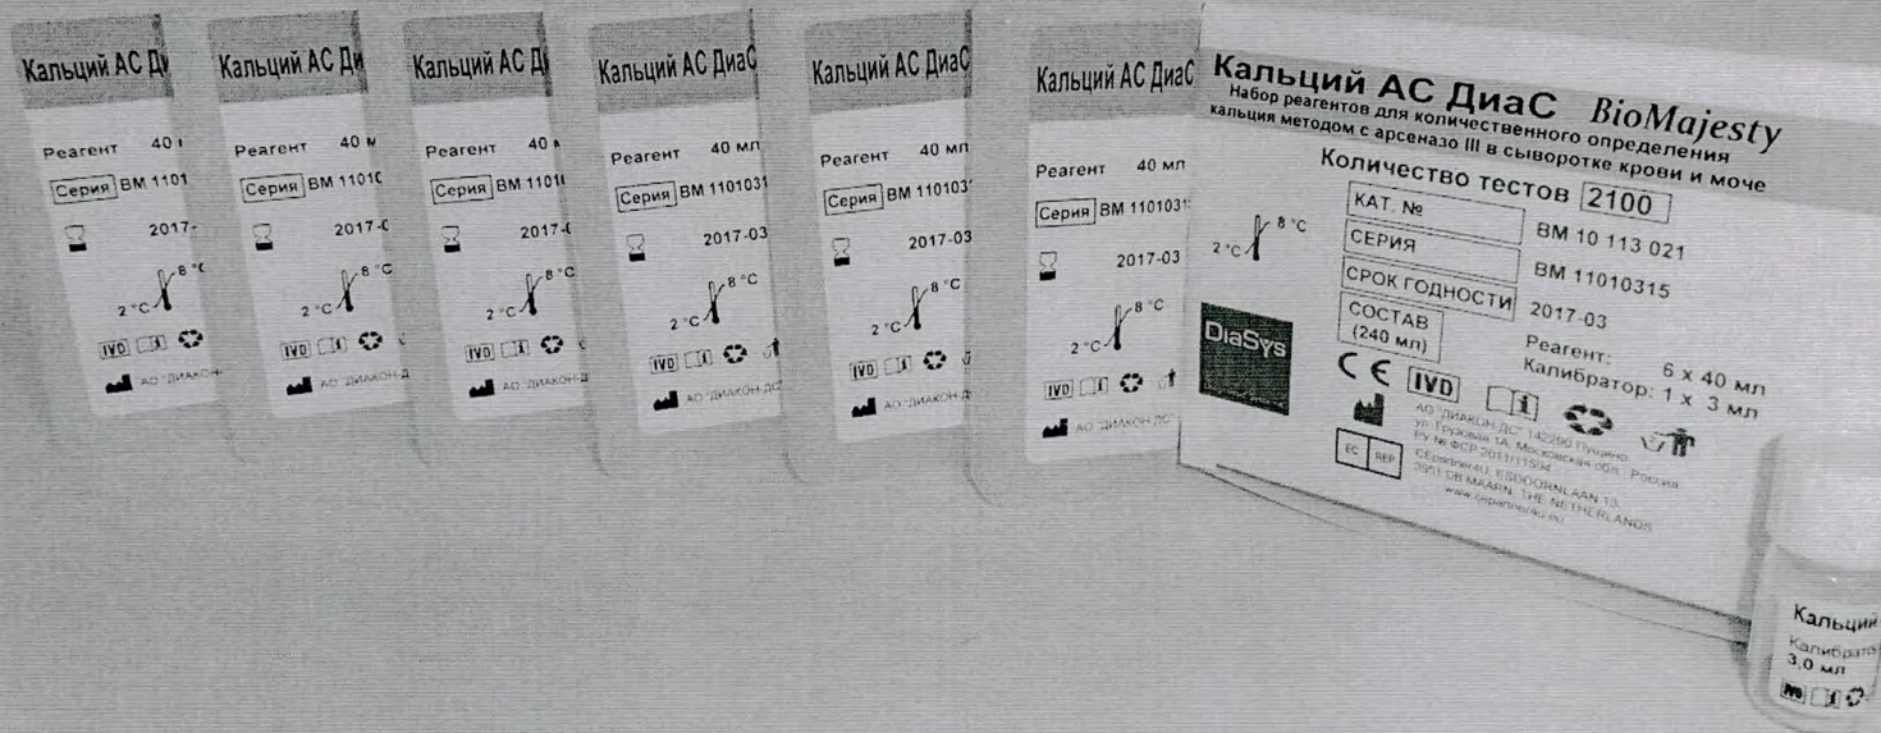


Внешний вид
Набора реагентов для количественного определения кальция методом с арсеназо III в сыворотке крови и моче
(КАЛЬЦИЙ АС ДиаС)






Внешний вид
Набора реагентов для количественного определения кальция методом с арсеназо III в сыворотке крови и моче
(КАЛЬЦИЙ АС ДиаС)

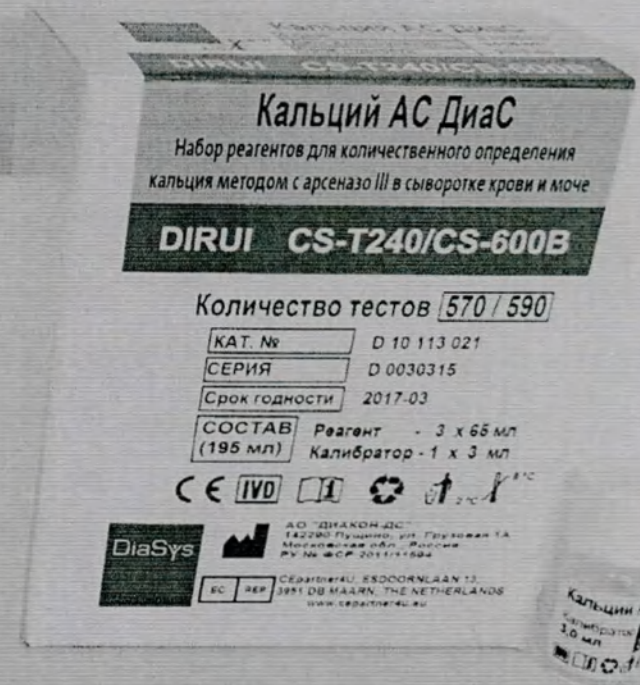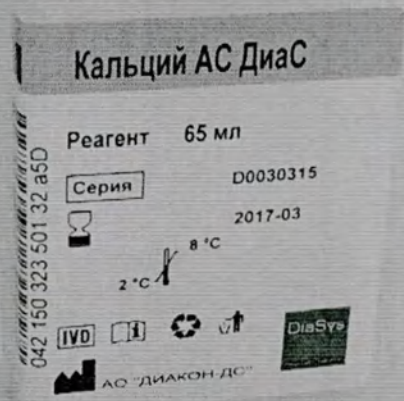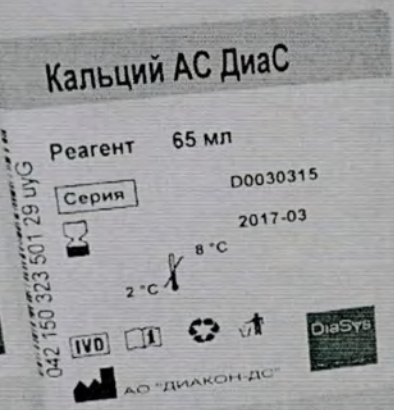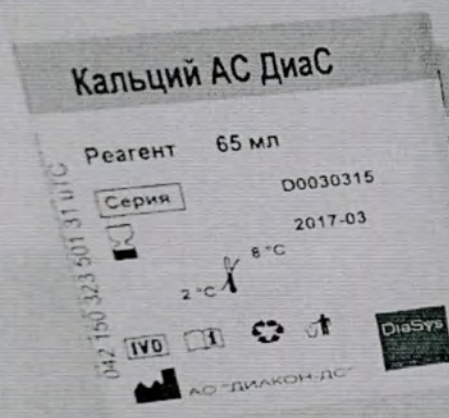



Внешний вид
Набора реагентов для количественного определения кальция методом с арсеназо III в сыворотке крови и моче
(КАЛЬЦИЙ АС ДиаС)

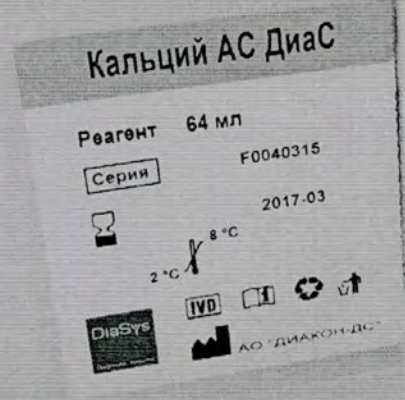

КАТ. №	F 10 113 021
СЕРИЯ	F 0040315
Срок годности	2017-03
СОСТАВ (192 мл)	Реагент - 3 x 64 мл Калибратор - 1 x 3 мл

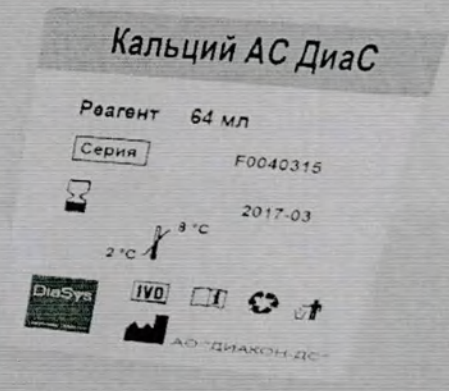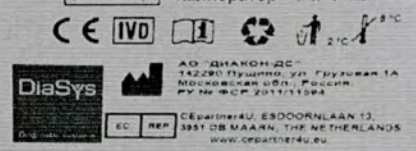

Внешний вид
Набора реагентов для количественного определения кальция методом с арсеназо III в сыворотке крови и моче
(КАЛЬЦИЙ АС ДиаС)

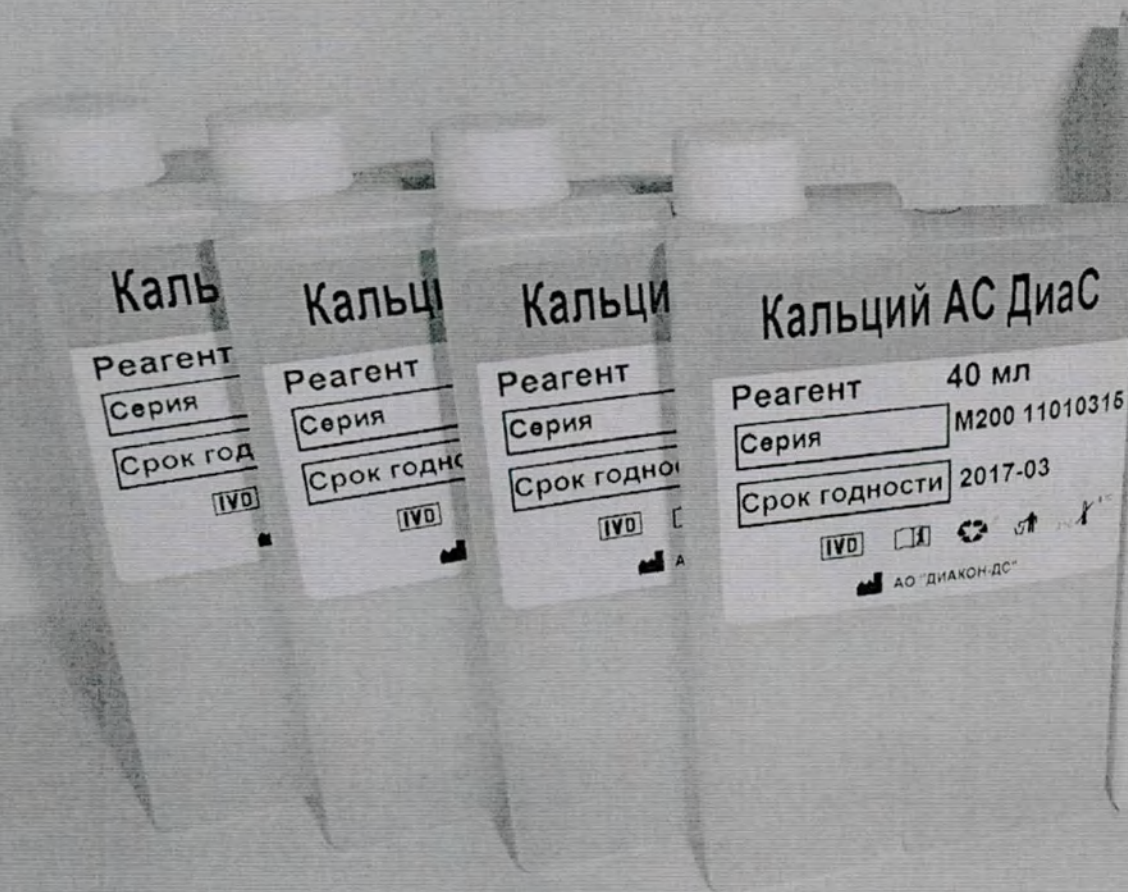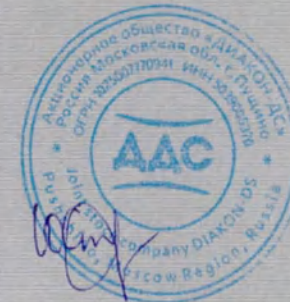



Кальций АС ДиаС
Набор реагентов для количественного определения
кальция методом с арсеназо III в сыворотке крови и моче

Mindray BS-120/200/200E

Количество тестов **600**

КАТ. №	M 200 10 113 023
СЕРИЯ	M 200 11010315
Срок годности	2017-03


СОСТАВ	Реагент - 4 x 40 мл (160 мл) Калибратор - 1 x 3 мл
--------	---



АО «ДИАКОН-ДС»
142290 Пушкино, ул. Грузовая 1А
Московская обл., Россия
Р/У № ФСР 2011-11694



CEpartner4U, BSCDOORNLAAN 12
3961 DB MAAK, THE NETHERLANDS
www.cepartner4u.eu



Внешний вид
Набора реагентов для количественного определения кальция методом с арсеназо III в сыворотке крови и моче
(КАЛЬЦИЙ АС ДиаС)




Внешний вид
Набора реагентов для количественного определения кальция методом с арсеназо III в сыворотке крови и моче
(КАЛЬЦИЙ АС ДиаС)




Кальций АС ДиаС
Набор реагентов для количественного определения
кальция методом с арсеназо III в сыворотке крови и моче

BioSystems A25/A15 (430 тестов)


КАТ. №	A 25 119 05
СЕРИЯ	A 0010315
Срок годности	2017-03
СОСТАВ (150 мл)	Реагент - 3 x 50 мл Калибратор - 1 x 3 мл





CE PER Ceparther4U, ESDOORNLAAN 12,
3951 DB MAARN, THE NETHERLANDS
www.ceparther4u.eu



АО «ДИАКОН-ДС»
142250 Пушкино, ул. Жуковского 1А,
Московская обл., Россия
Р/Н № ФСР 201111594



Внешний вид
Набора реагентов для количественного определения кальция методом с арсеназо III в сыворотке крови и моче
(КАЛЬЦИЙ АС ДиаС)

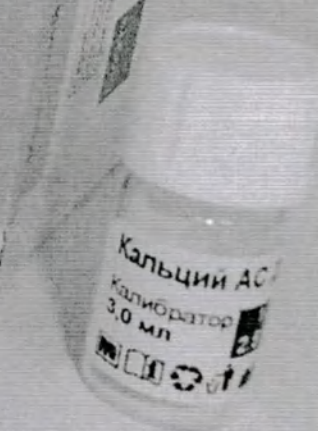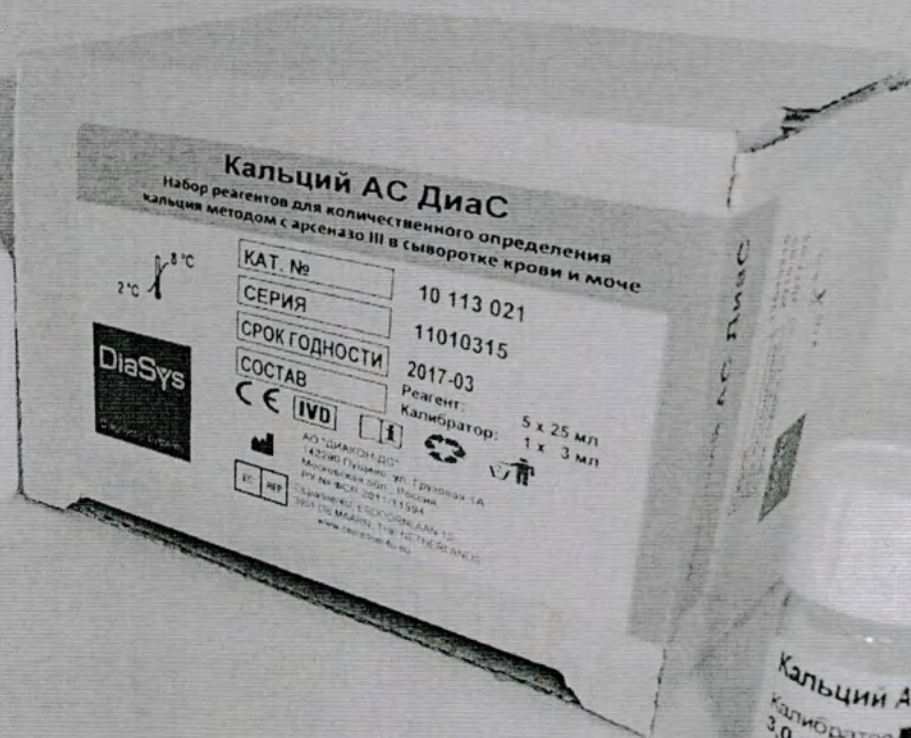

Внешний вид
Набора реагентов для количественного определения кальция методом с арсеназо III в сыворотке крови и моче
(КАЛЬЦИЙ АС ДиаС)



Кальций АС ДиаС

Реагент 62 мл



Серия

К 11010315

2017-03



2 °C 8 °C



АО «ДИАКОН-ДС»

Кальций АС ДиаС

Реагент 62 мл



Серия

К 11010315

2017-03



2 °C 8 °C



АО «ДИАКОН-ДС»

Кальций АС ДиаС

Набор реагентов для количественного определения
кальция методом с арсеназо III в сыворотке крови и моче

Konelab 20/201/30/60

Количество тестов **550**

КАТ. №

К 10 113 021

СЕРИЯ



К 11010315

Срок годности

2017-03

СОСТАВ
(124 мл)

Реагент - 2 x 62 мл
Калибратор - 1 x 3 мл



EC REP

АО «ДИАКОН-ДС»
142290 Пушкино, Ул. Грушевая 1А
Московская обл., Россия
РФ № ФСР 2011/11594

CEpartner4U, ESDOORNLAAN 13,
3951 DB MAARN, THE NETHERLANDS
www.cepartner4u.eu

Кальций АС
калибратор
3,0 мл

Внешний вид
Набора реагентов для количественного определения кальция методом с арсеназо III в сыворотке крови и моче
(КАЛЬЦИЙ АС ДиаС)

