




(ТРИГЛИЦЕРИДЫ ДиaC)




реактивов для определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови  
(ТРИГЛИЦЕРИДЫ ДиаС)

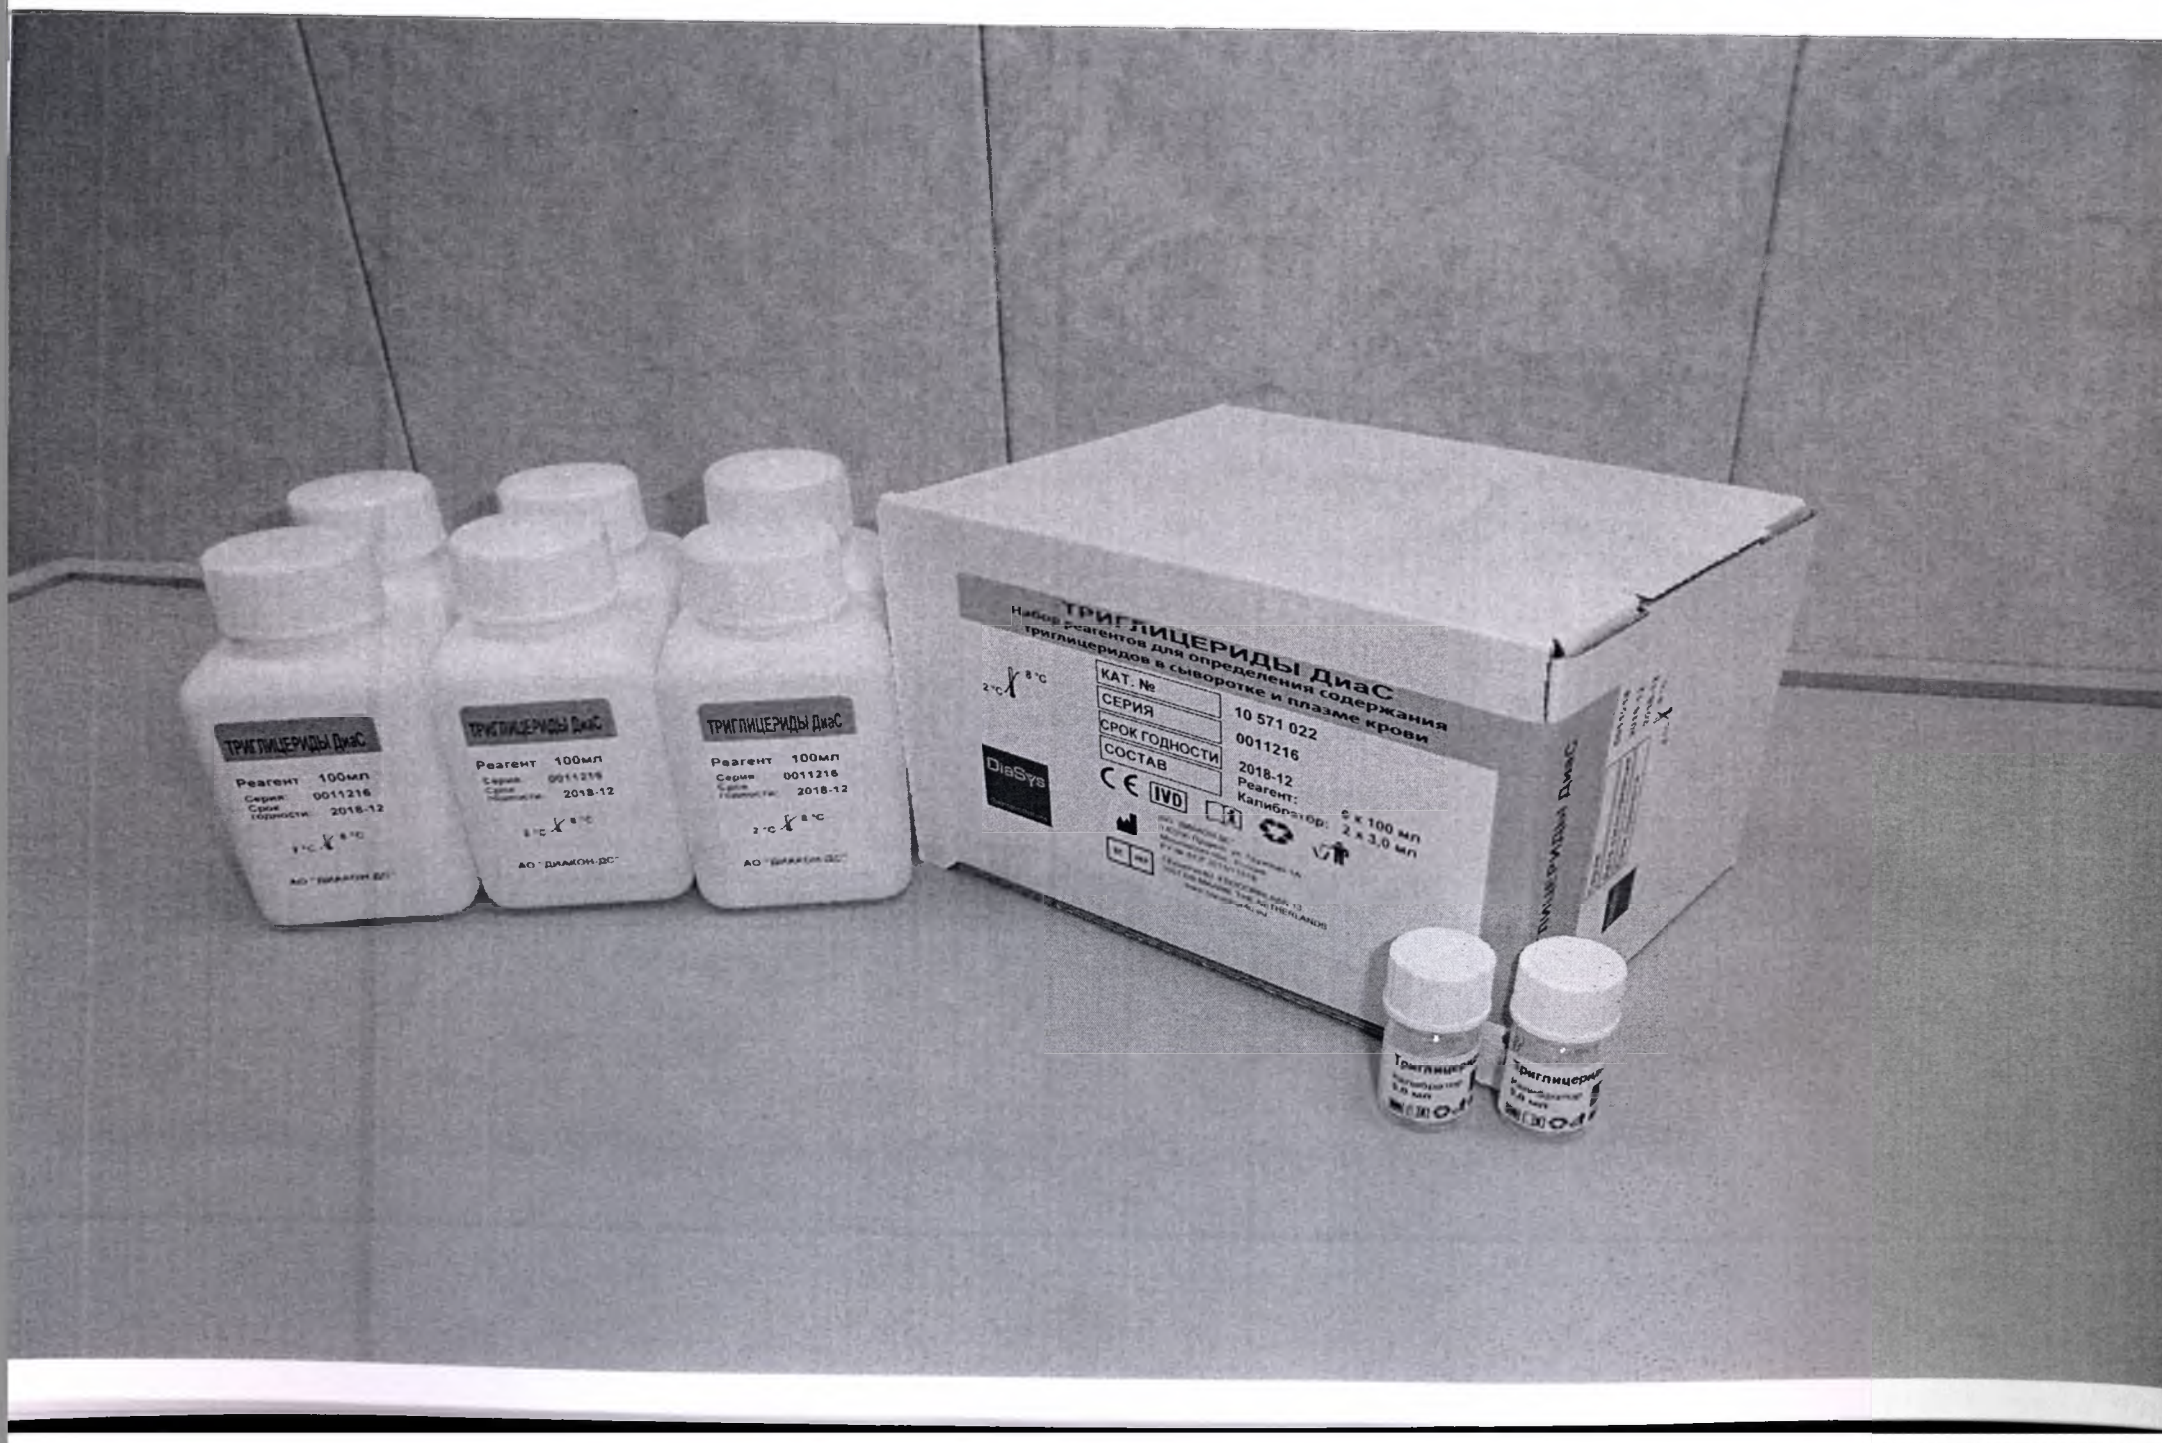

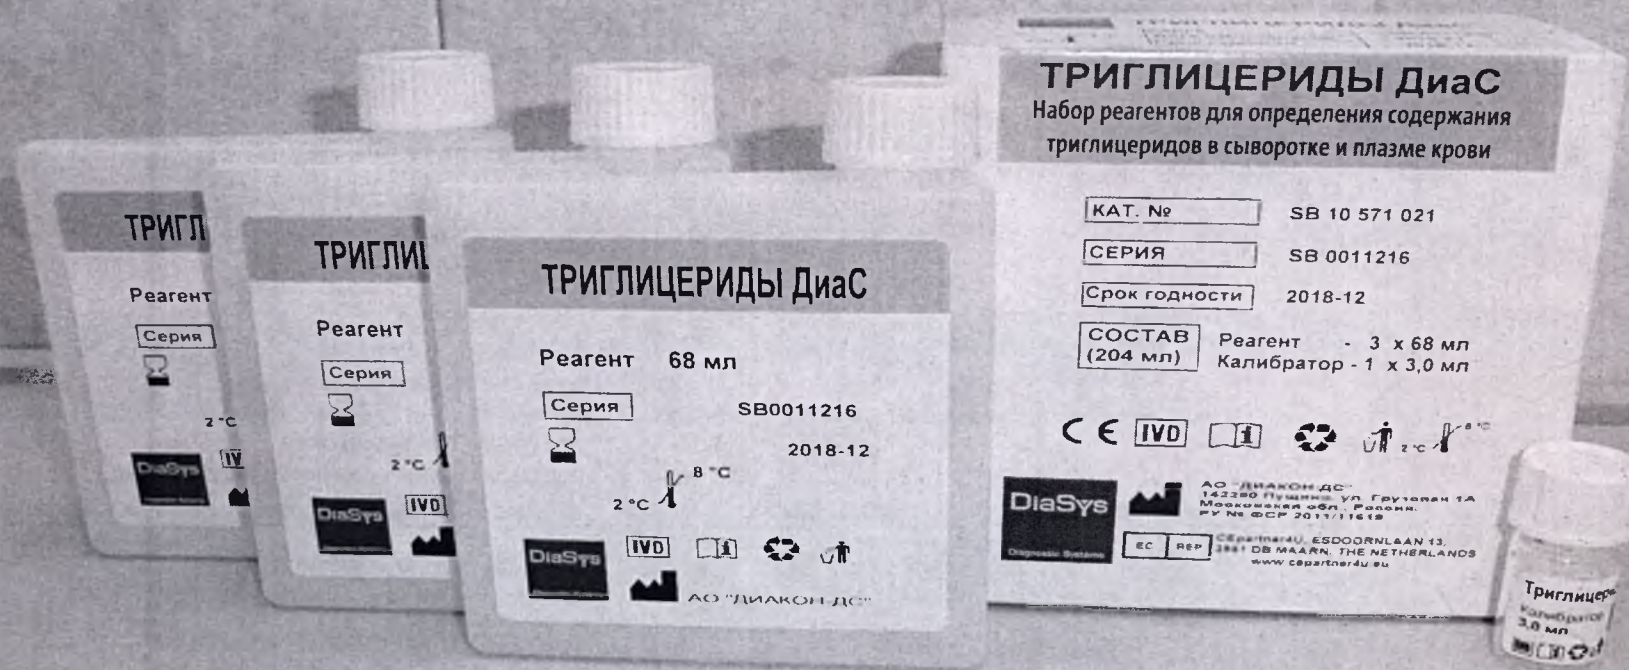


**(ТРИГЛИЦЕРИДЫ ДИАС)**

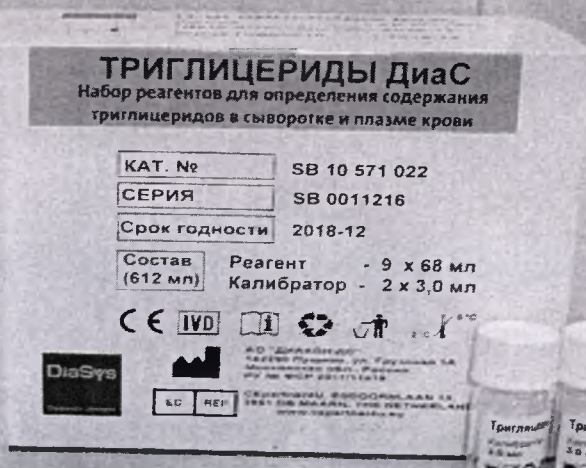



**Набора реагентов для определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови  
(ТРИГЛИЦЕРИДЫ ДиаС)**



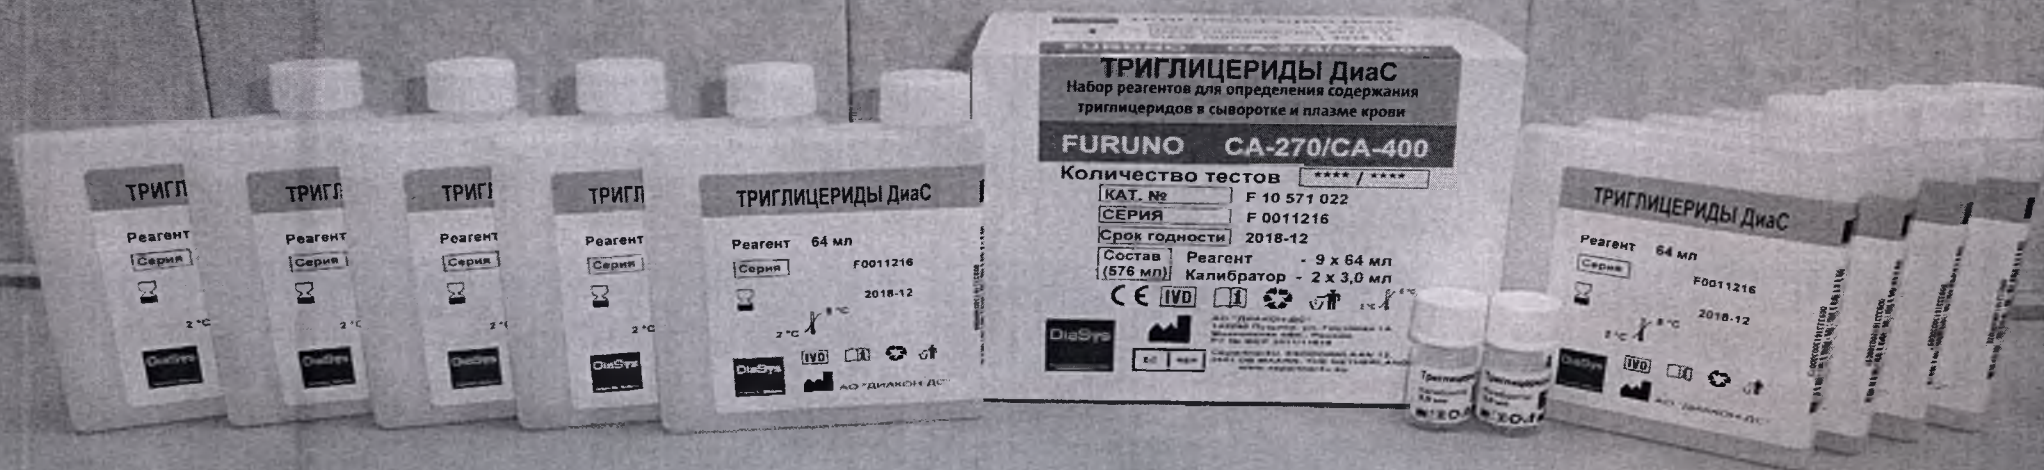



Набора реагентов для определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови  
(ТРИГЛИЦЕРИДЫ ДиаС)

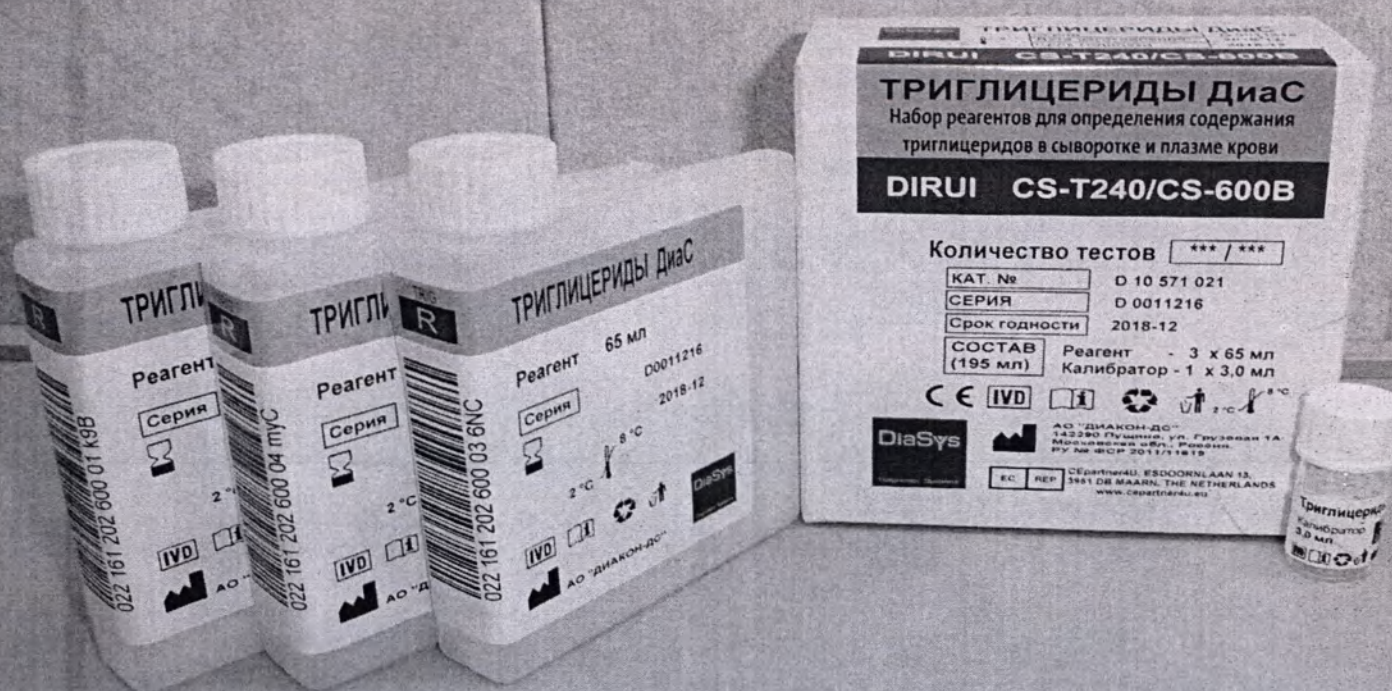

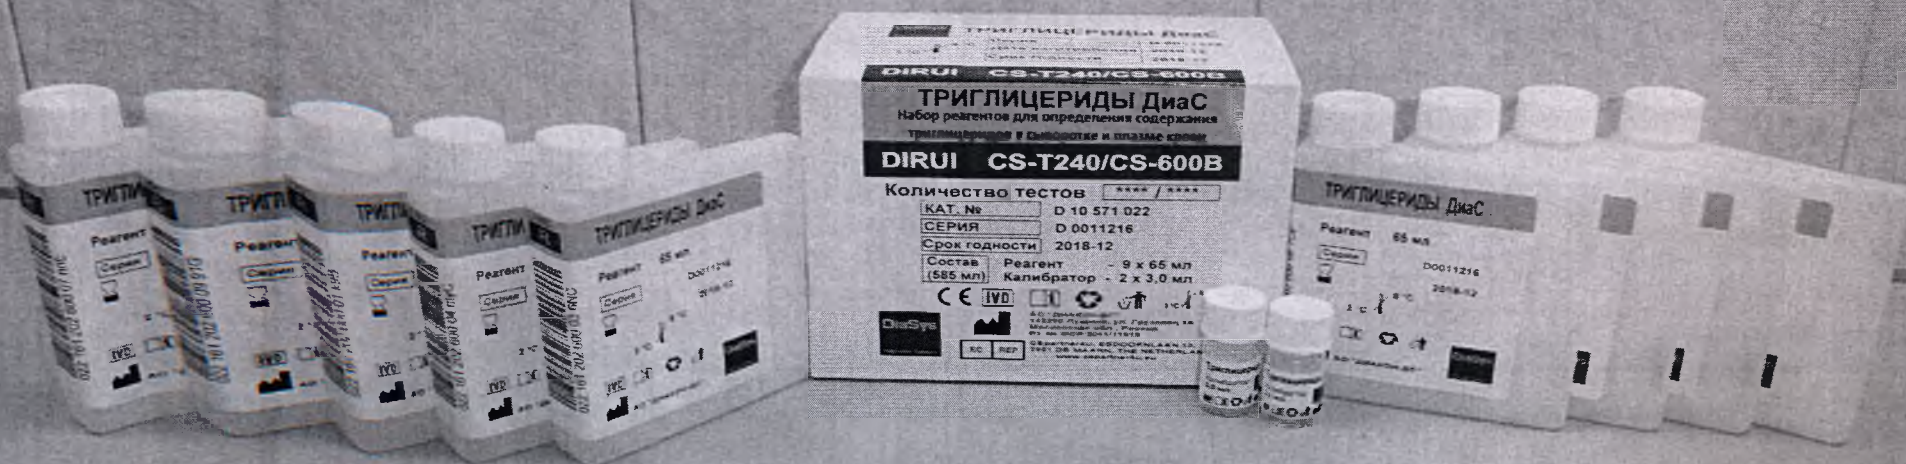

Набора реагентов для определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови  
(ТРИГЛИЦЕРИДЫ ДиаС)

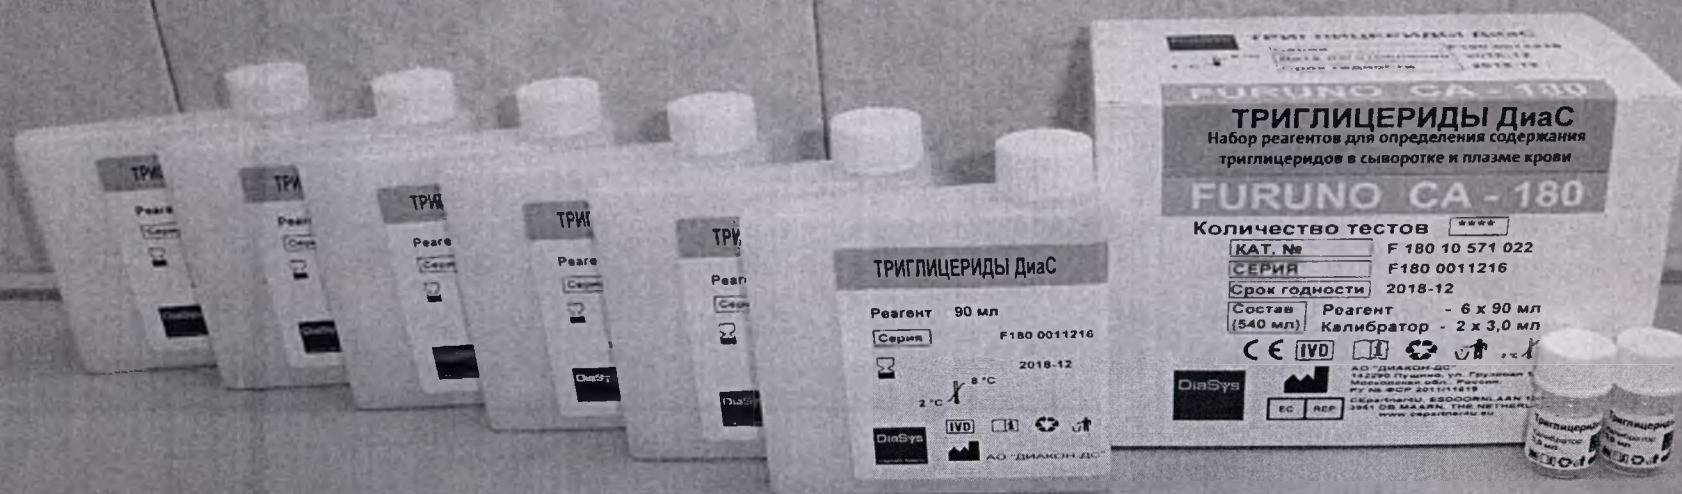


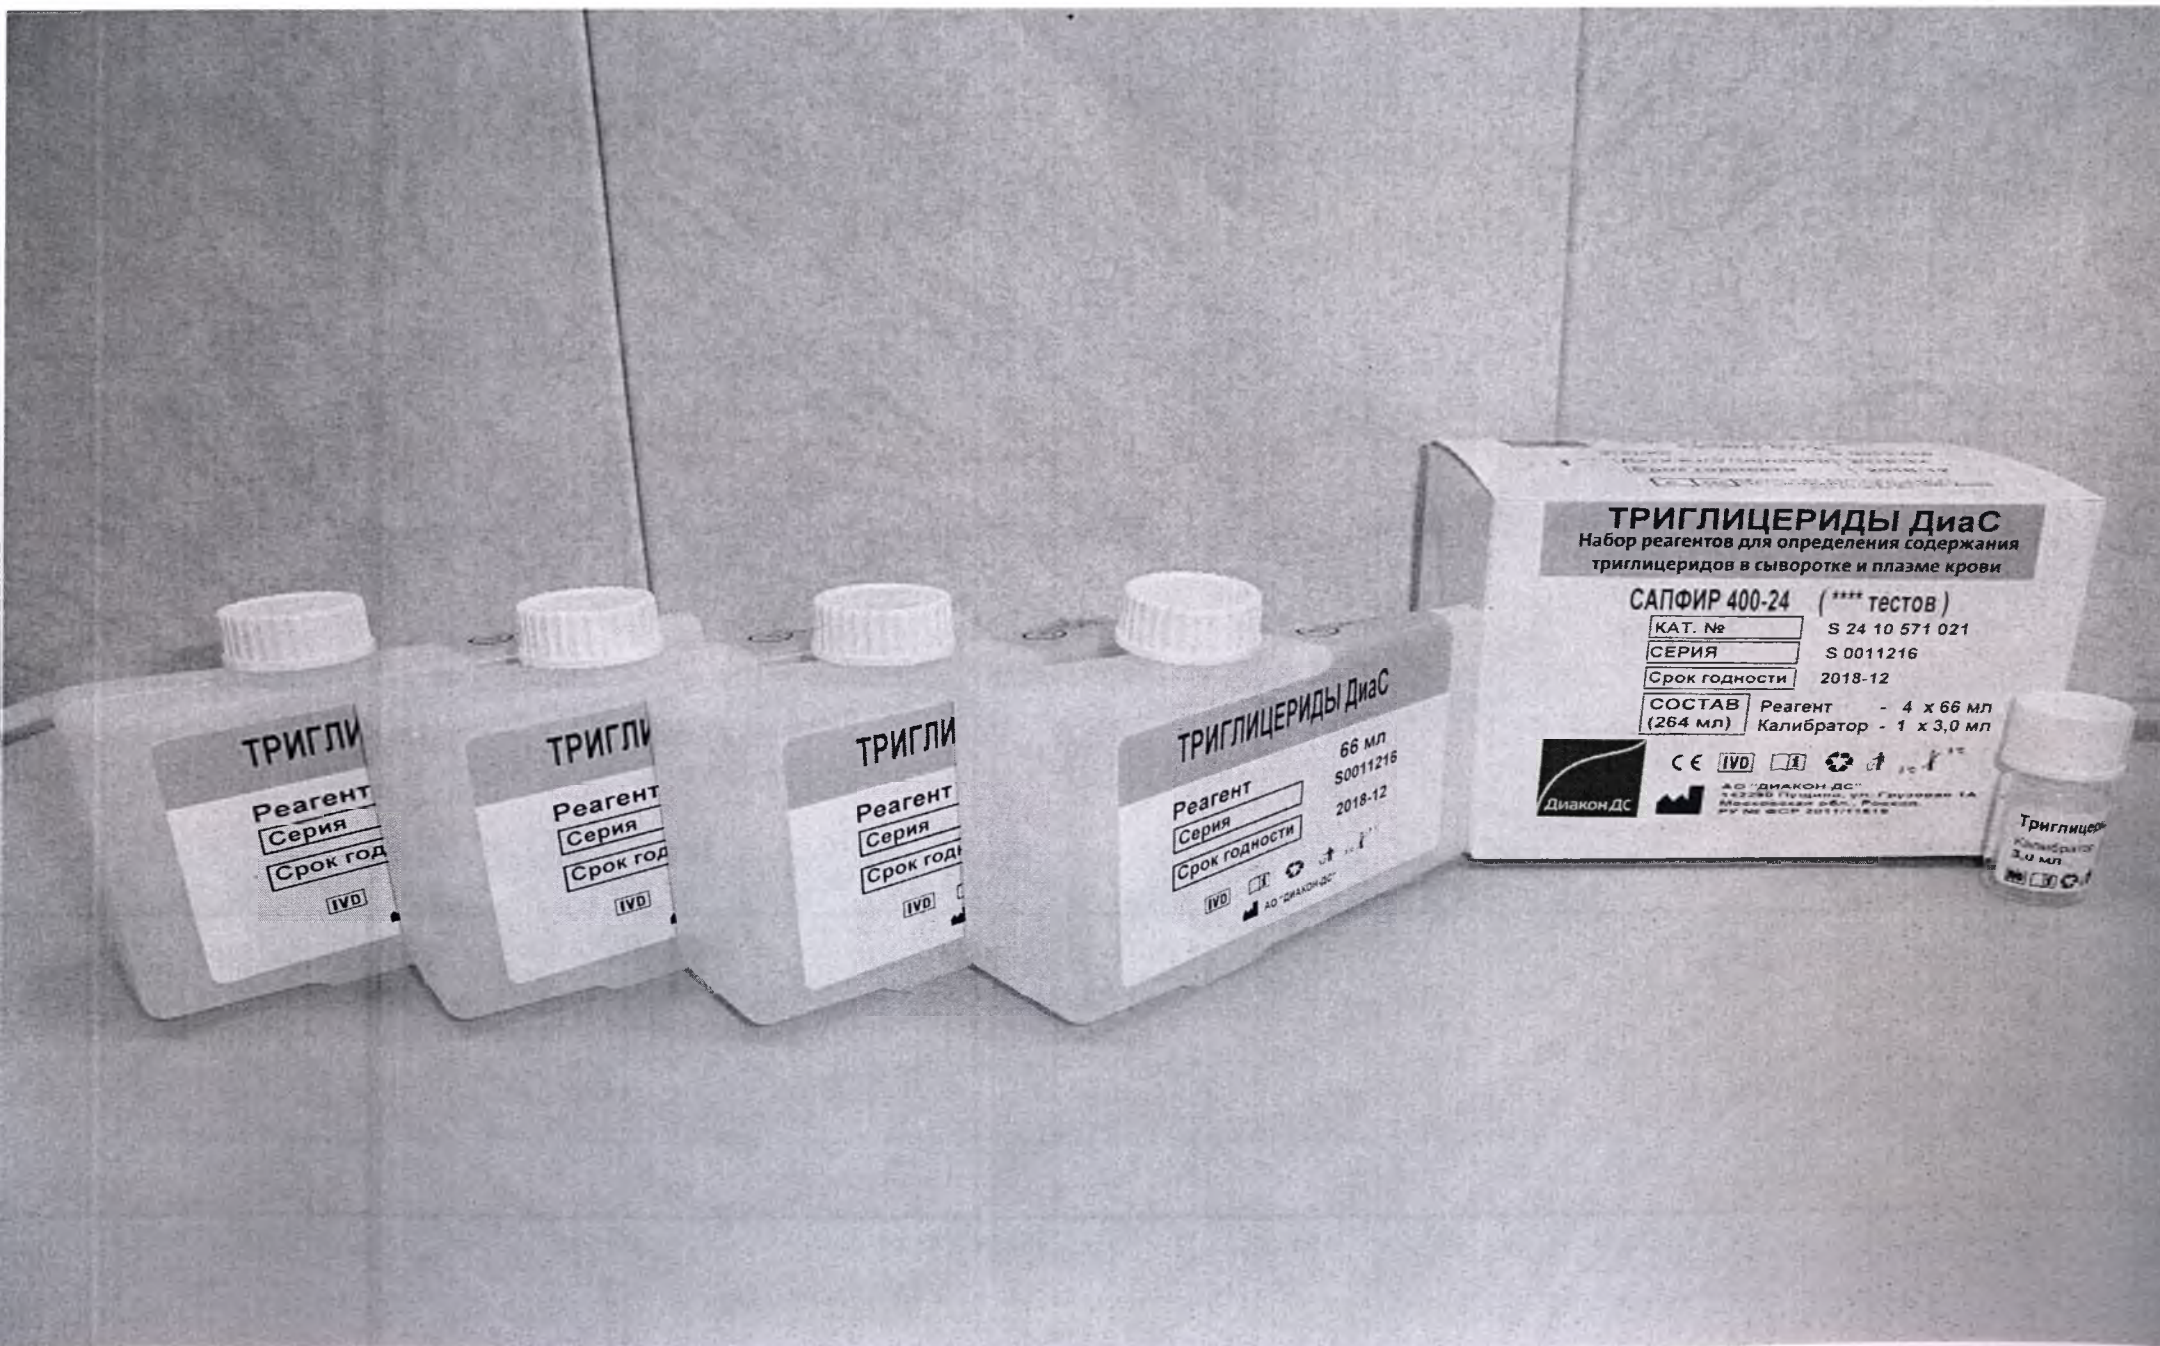


Набора реагентов для определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови  
(ТРИГЛИЦЕРИДЫ ДиаС)




Набора реагентов для определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови  
(ТРИГЛИЦЕРИДЫ ДиаС)

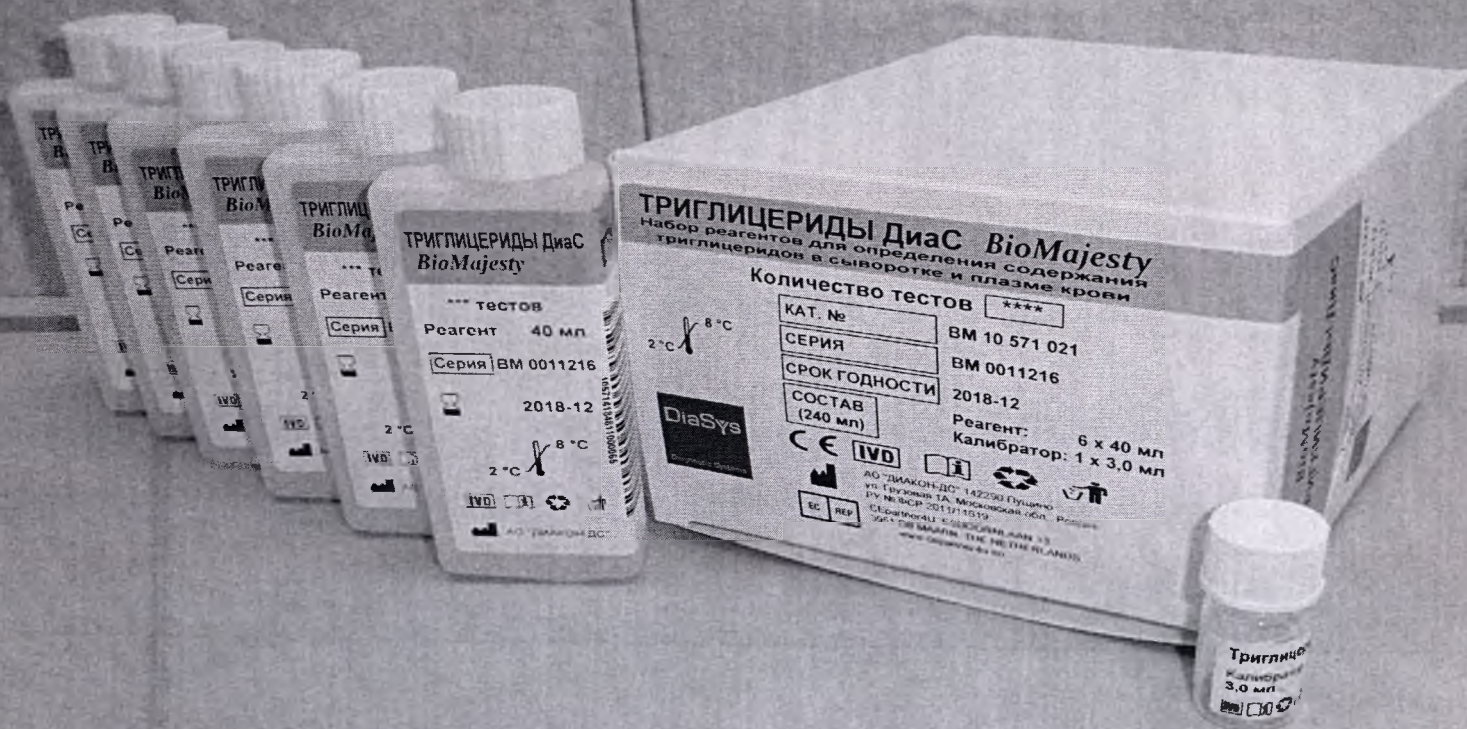


Набора реагентов для определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови  
(ТРИГЛИЦЕРИДЫ ДИАС)

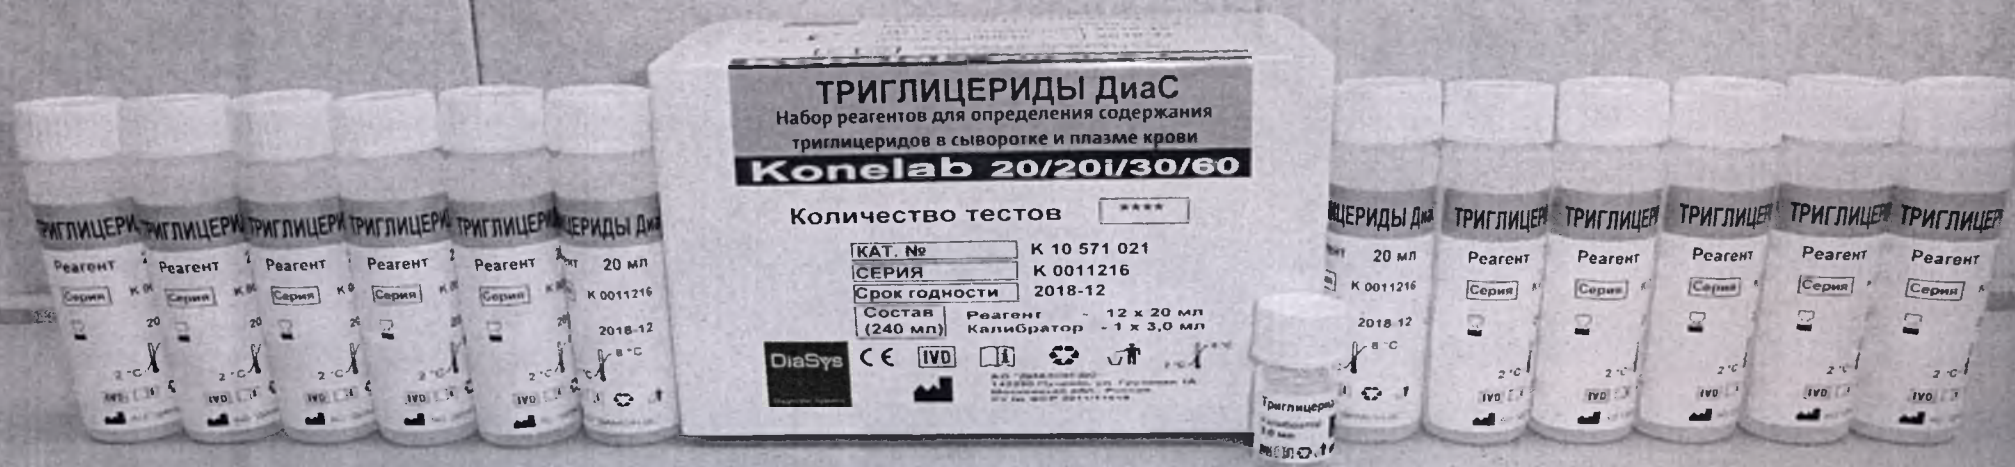


Набора реагентов для определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови  
(ТРИГЛИЦЕРИДЫ ДиаС)

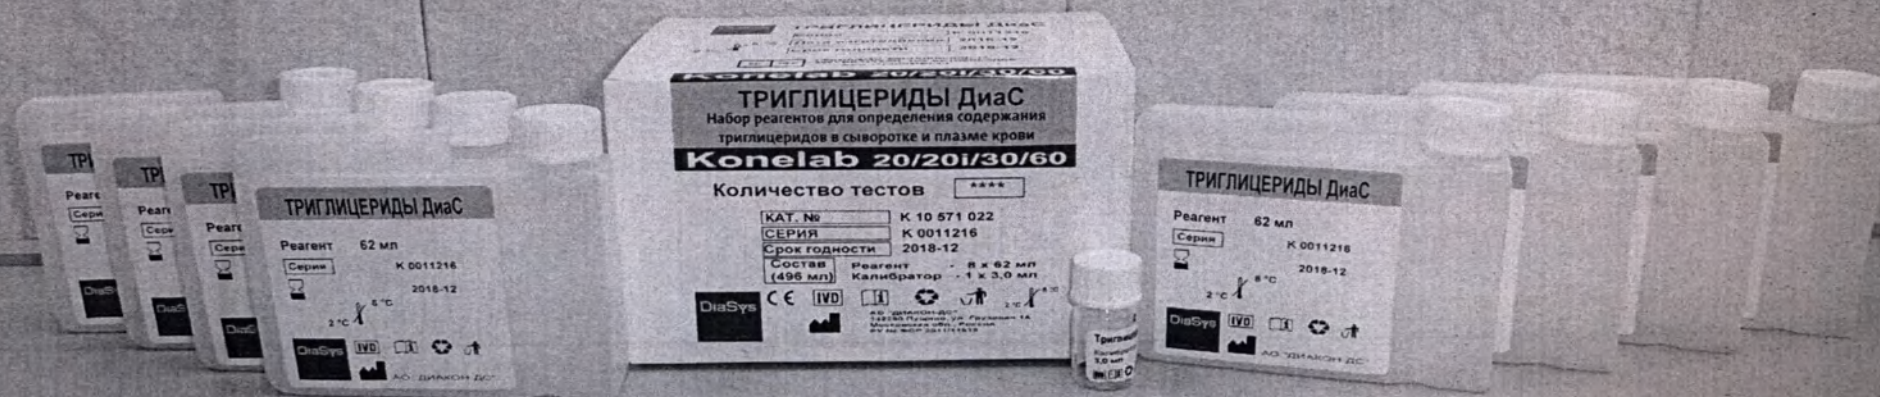

**Набор реагентов для определения содержания триглицеридов  
(ТРИГЛИЦЕРИДЫ ДиаС)**

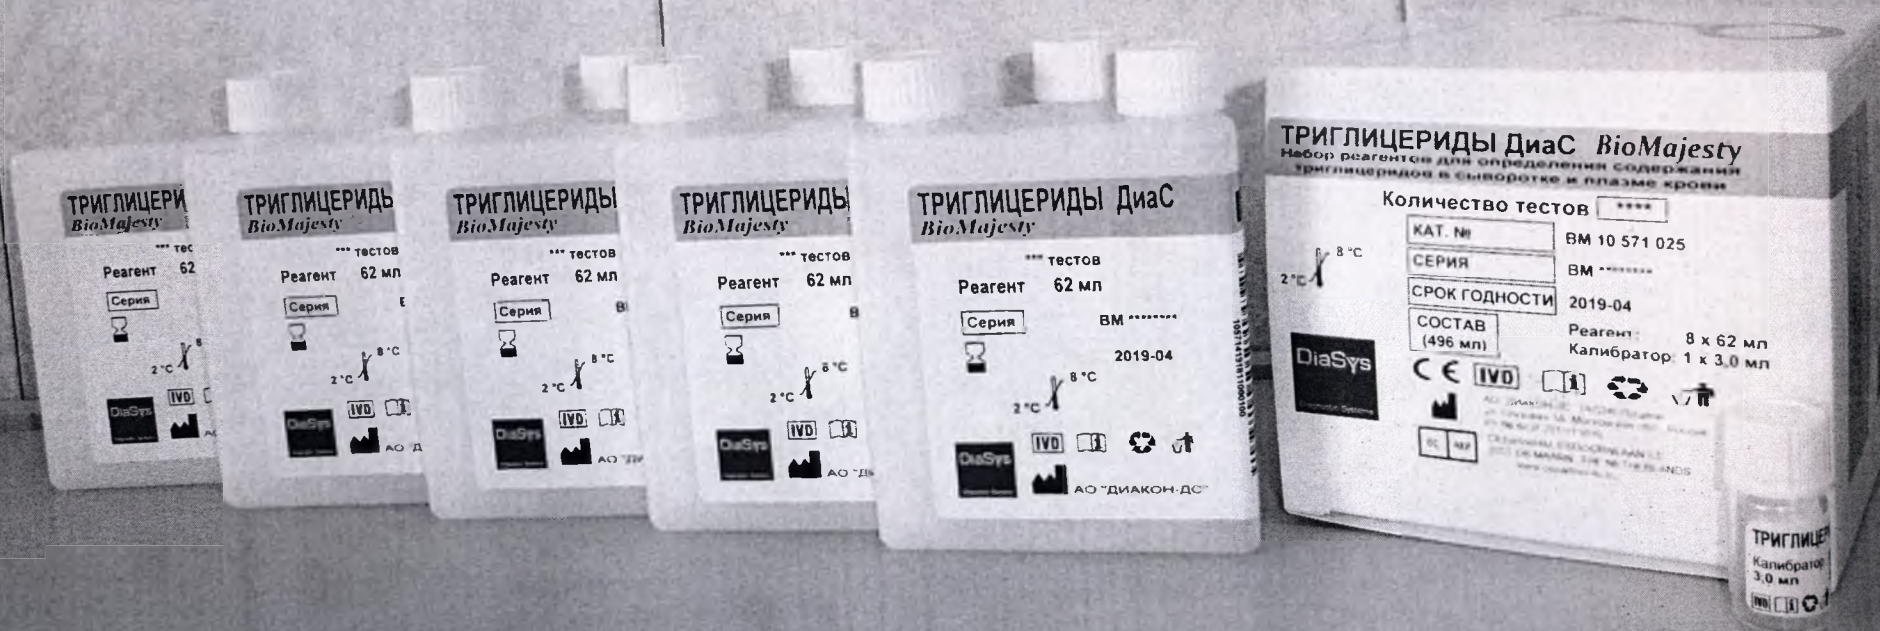

**(ТРИГЛИЦЕРИДЫ ДИАС)**






|               |             |
|---------------|-------------|
| КАТ. №        | А ** *** ** |
| СЕРИЯ         | А 0011216   |
| Срок годности | 2018-12     |

|                           |            |              |
|---------------------------|------------|--------------|
| <b>СОСТАВ</b><br>(250 мл) | Реагент    | - 5 x 50 мл  |
|                           | Капибратор | - 1 x 3,0 мл |


CE IVD

[illegible]

Набора реагентов для определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови  
(ТРИГЛИЦЕРИДЫ ДиаС)

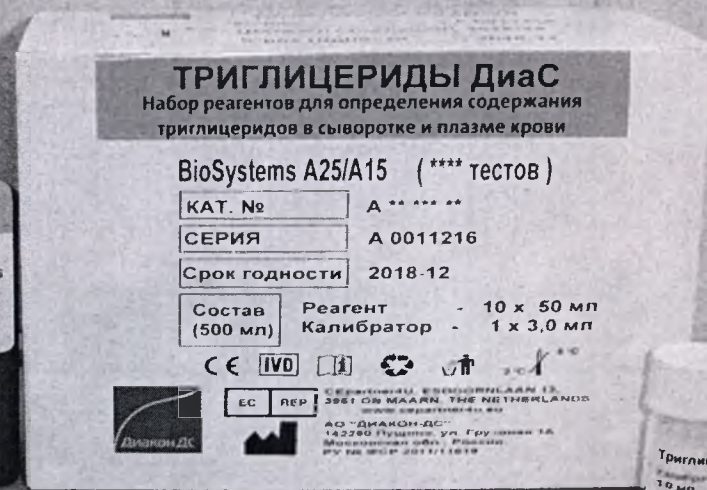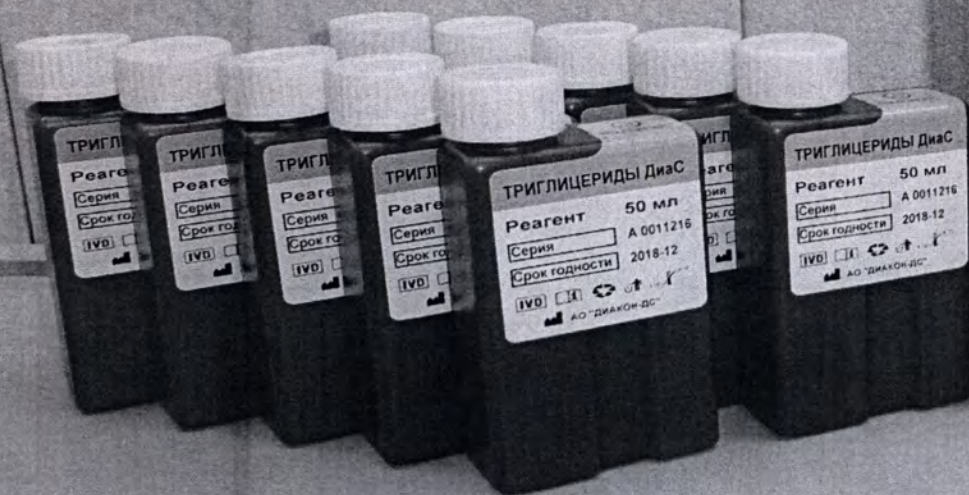

Набора реагентов для определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови  
(ТРИГЛИЦЕРИДЫ ДиаС)

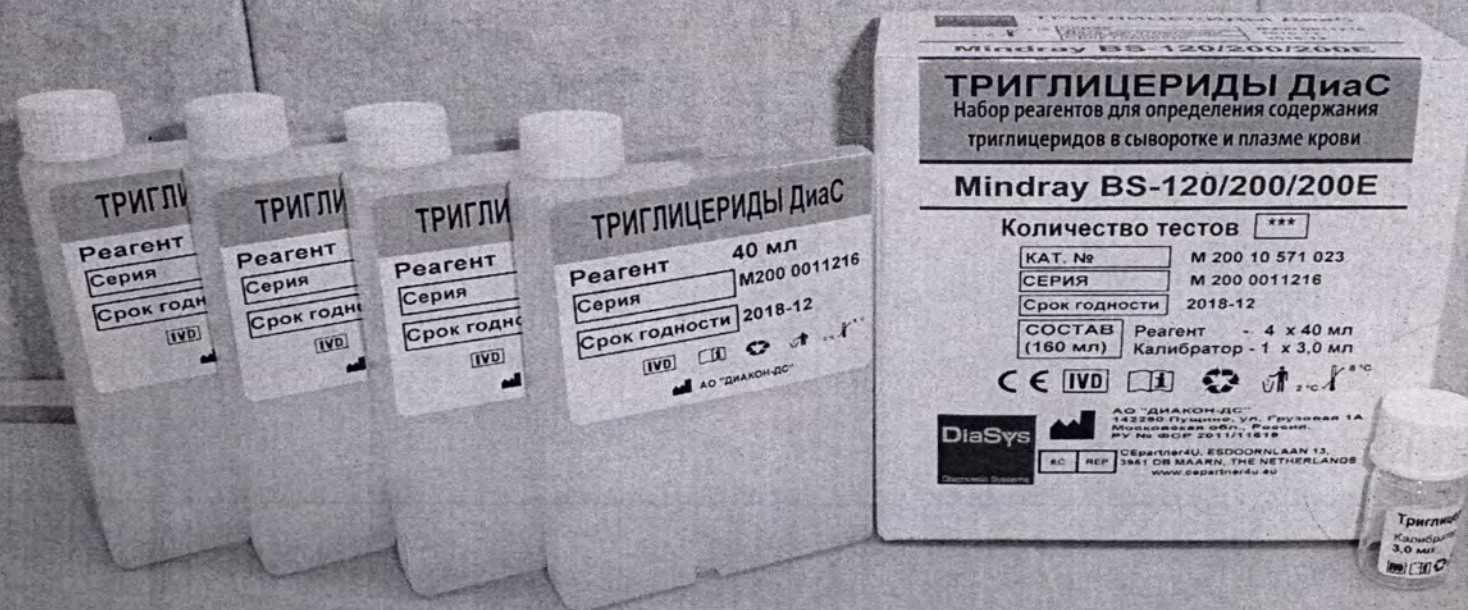

Набора реагентов для определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови  
(ТРИГЛИЦЕРИДЫ ДиаС)




Набора реагентов для определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови  
(ТРИГЛИЦЕРИДЫ ДиаС)




Определение содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови  
(ТРИГЛИЦЕРИДЫ ДиаС)




Набора реагентов для определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови  
(ТРИГЛИЦЕРИДЫ ДиаС)

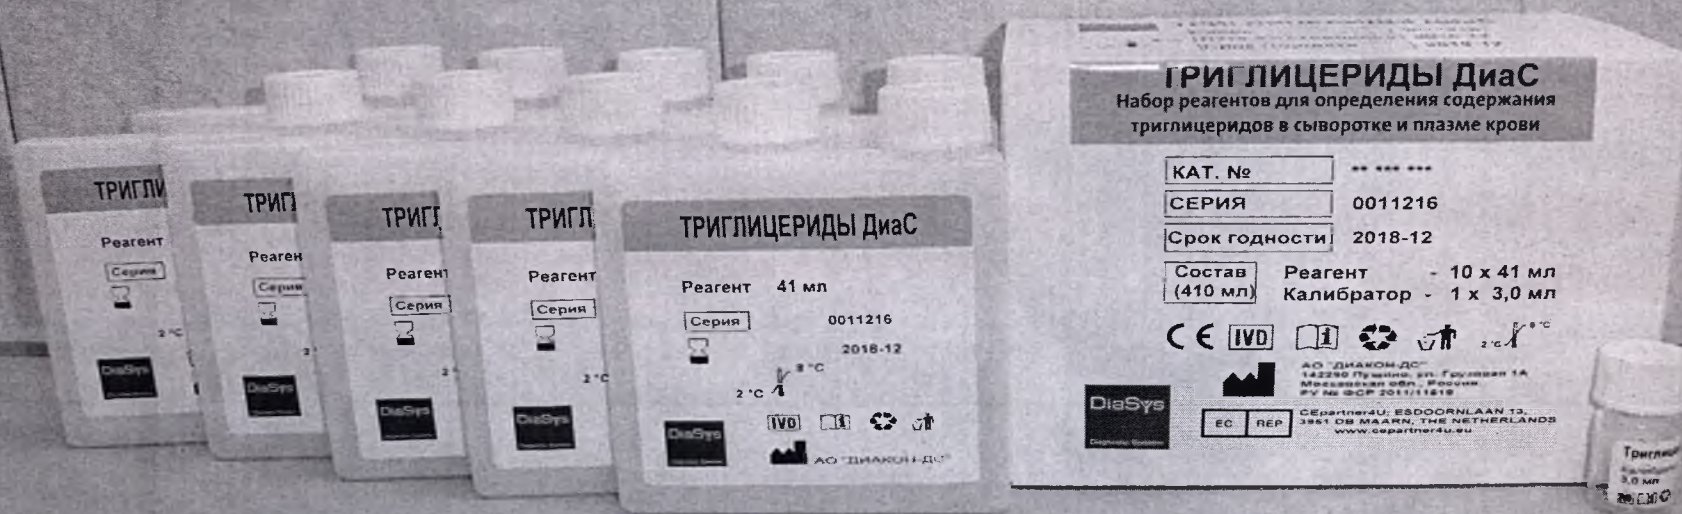


... для определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови  
(ТРИГЛИЦЕРИДЫ ДиаС)

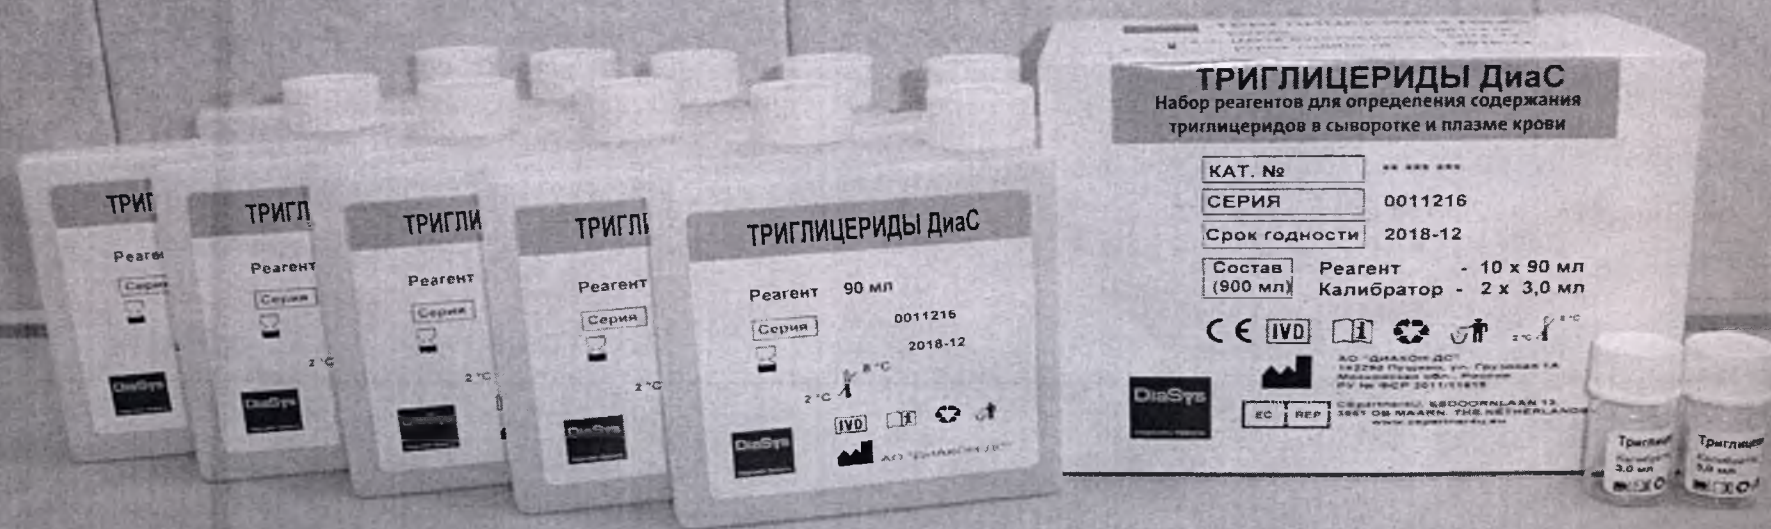

Набора реагентов для определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови  
(ТРИГЛИЦЕРИДЫ ДиаС)

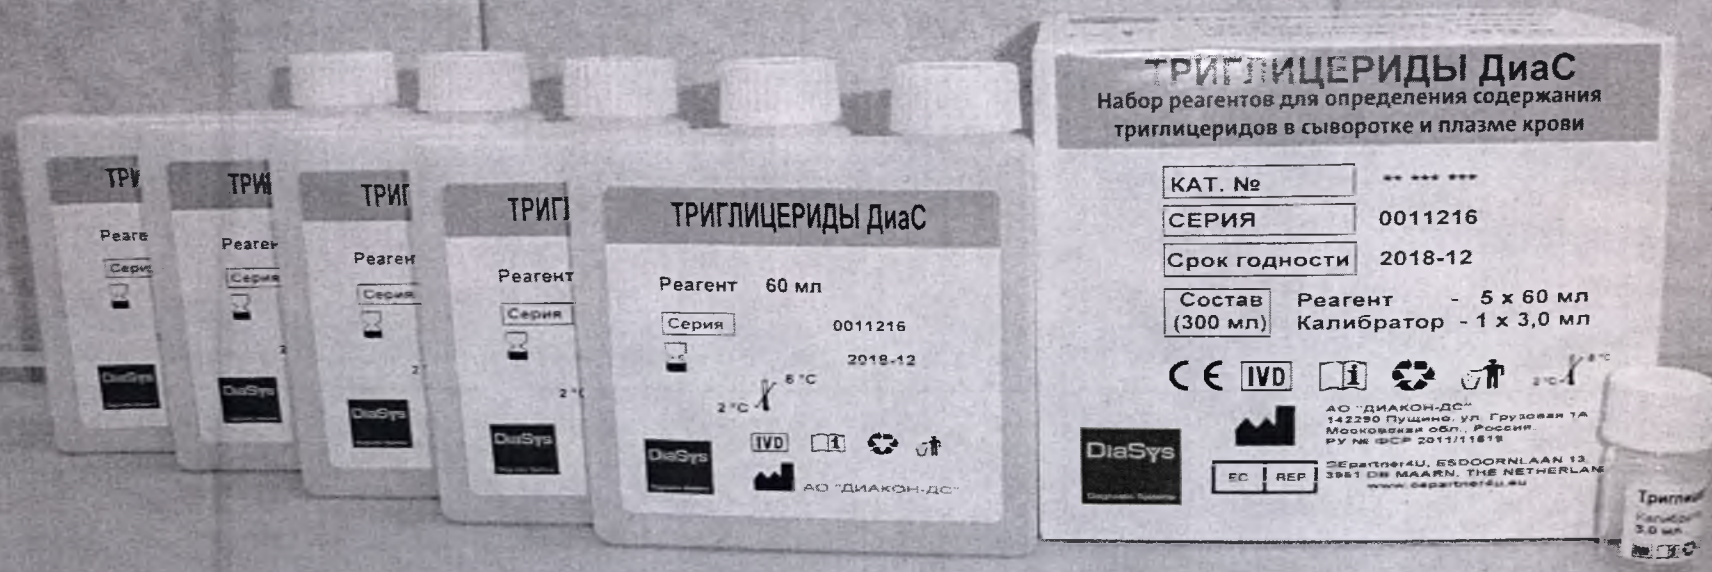

Реагенты для определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови  
(ТРИГЛИЦЕРИДЫ ДиаС)

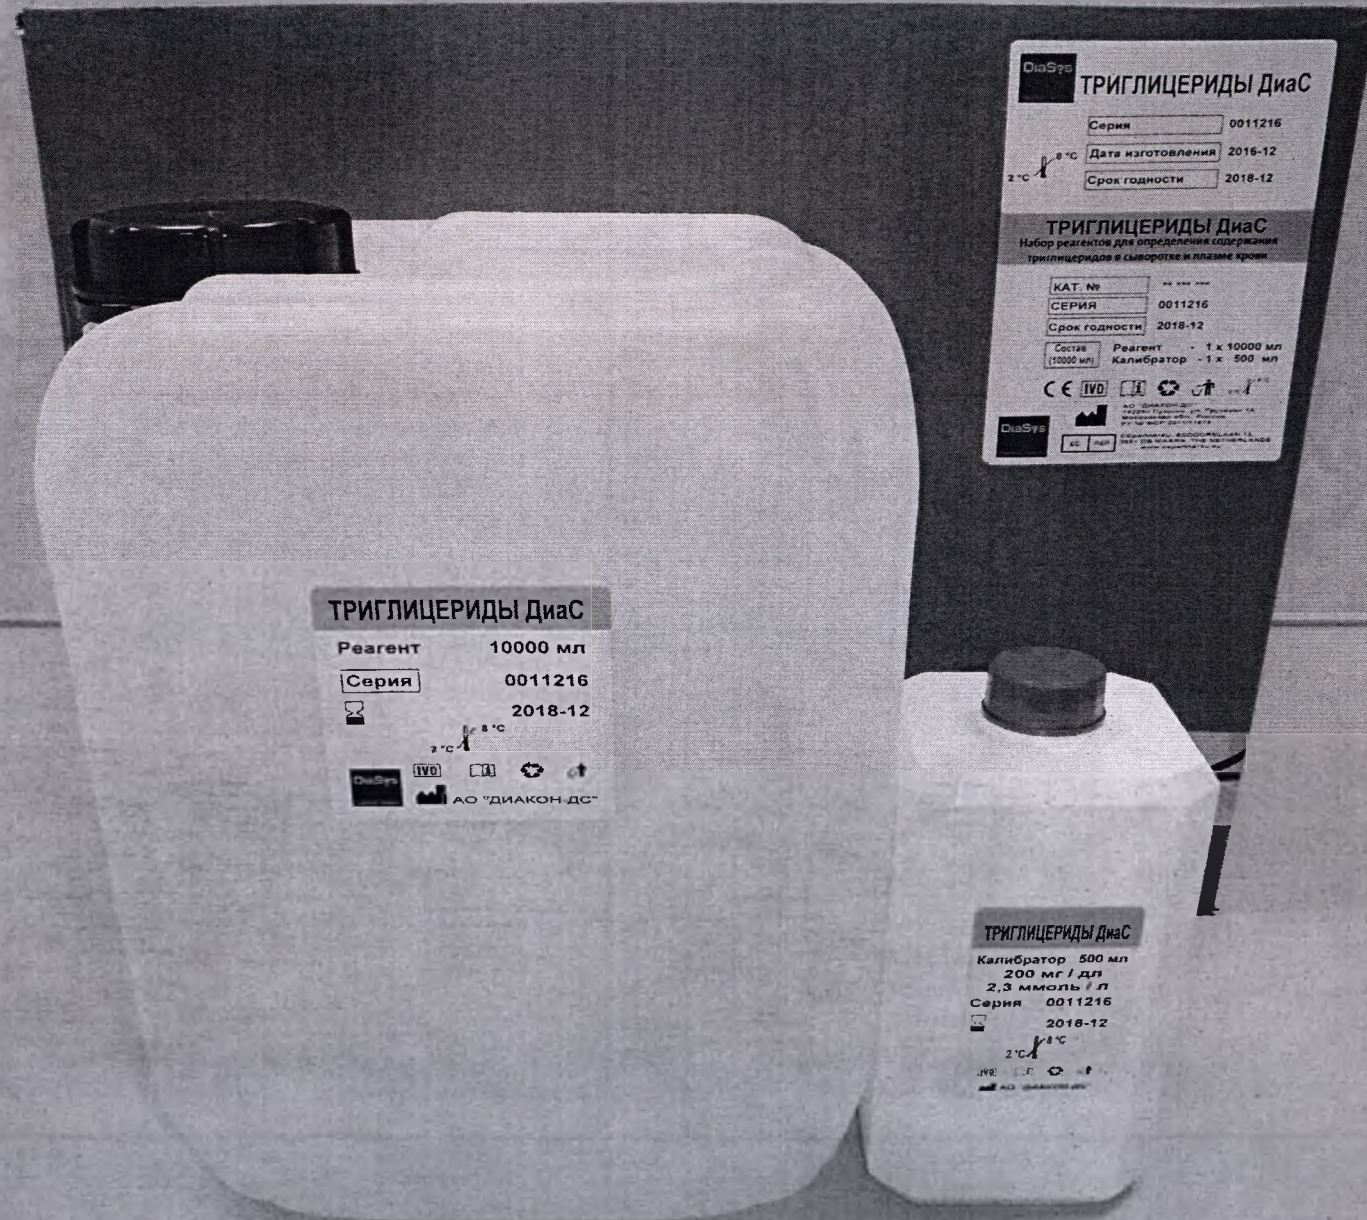

**ДиаС** ТРИГЛИЦЕРИДЫ ДиаС

Серия 0011216

Дата изготовления 2016-12

Срок годности 2018-12

ТРИГЛИЦЕРИДЫ ДиаС  
Набор реагентов для определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови

КАТ. № 0011216

СЕРИЯ 0011216

Срок годности 2018-12

Состав Реагент - 1 x 10000 мл  
Калибратор - 1 x 500 мл

CE IVD

АО "ДИАКОН ДС"

**ТРИГЛИЦЕРИДЫ ДиаС**

Реагент 10000 мл

Серия 0011216

2018-12

2°C

ДиаС

АО "ДИАКОН ДС"

**ТРИГЛИЦЕРИДЫ ДиаС**

Калибратор 500 мл

200 мг / дл

2,3 ммоль / л

Серия 0011216

2018-12

2°C

ДиаС

АО "ДИАКОН ДС"

Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 25 лист(ов)

Генеральный директор  
АО «ДИАКОН-ДС»

Смирнов А.В.

