


Внешний вид

Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке крови и моче
(α -АМИЛАЗА ДиаС) по ТУ 9398-106-48813770-2015


Комплектация 1

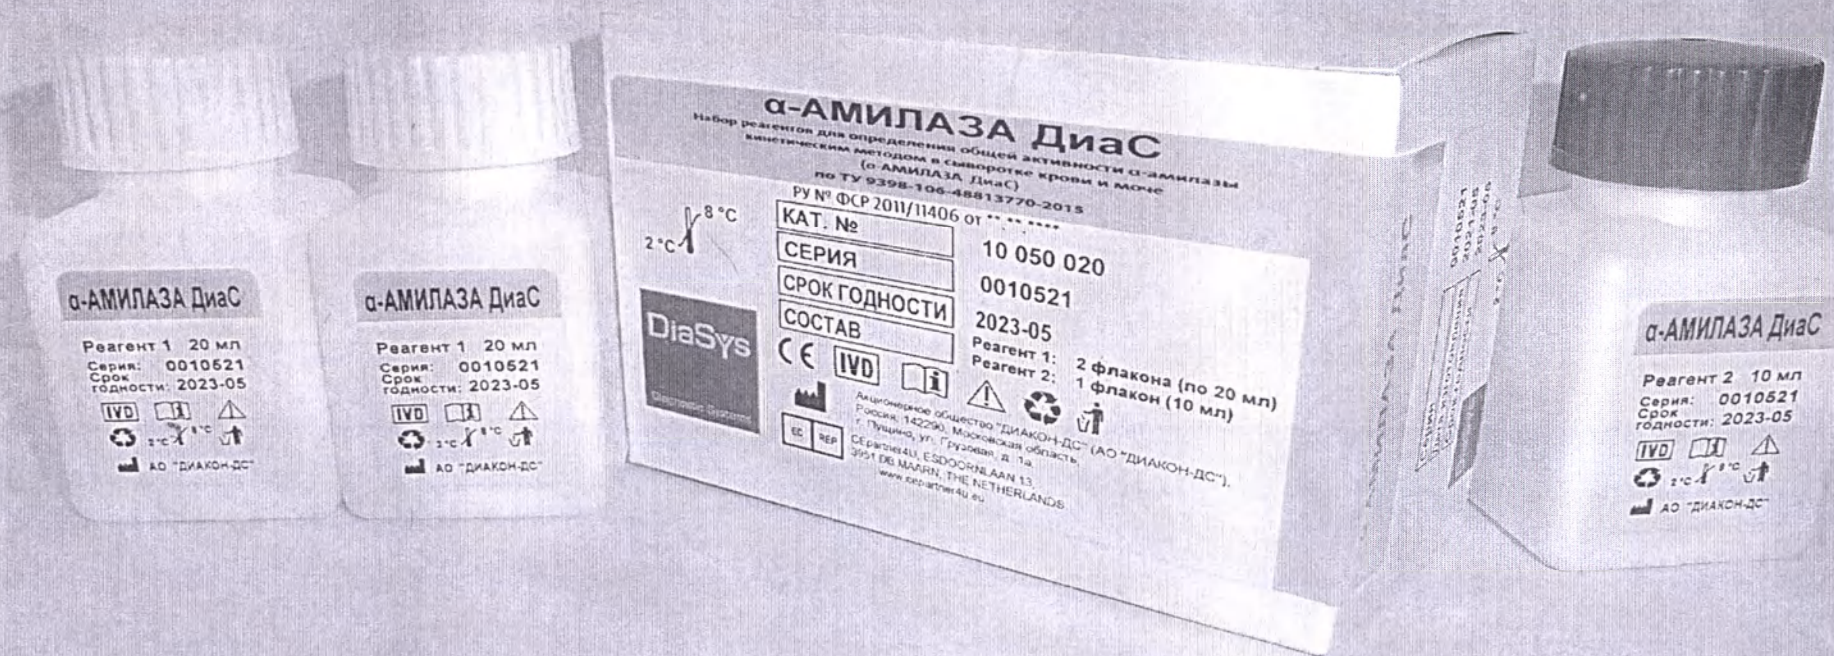

Внешний вид

Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке крови и моче
(α -АМИЛАЗА ДиаС) по ТУ 9398-106-48813770-2015


ация 2

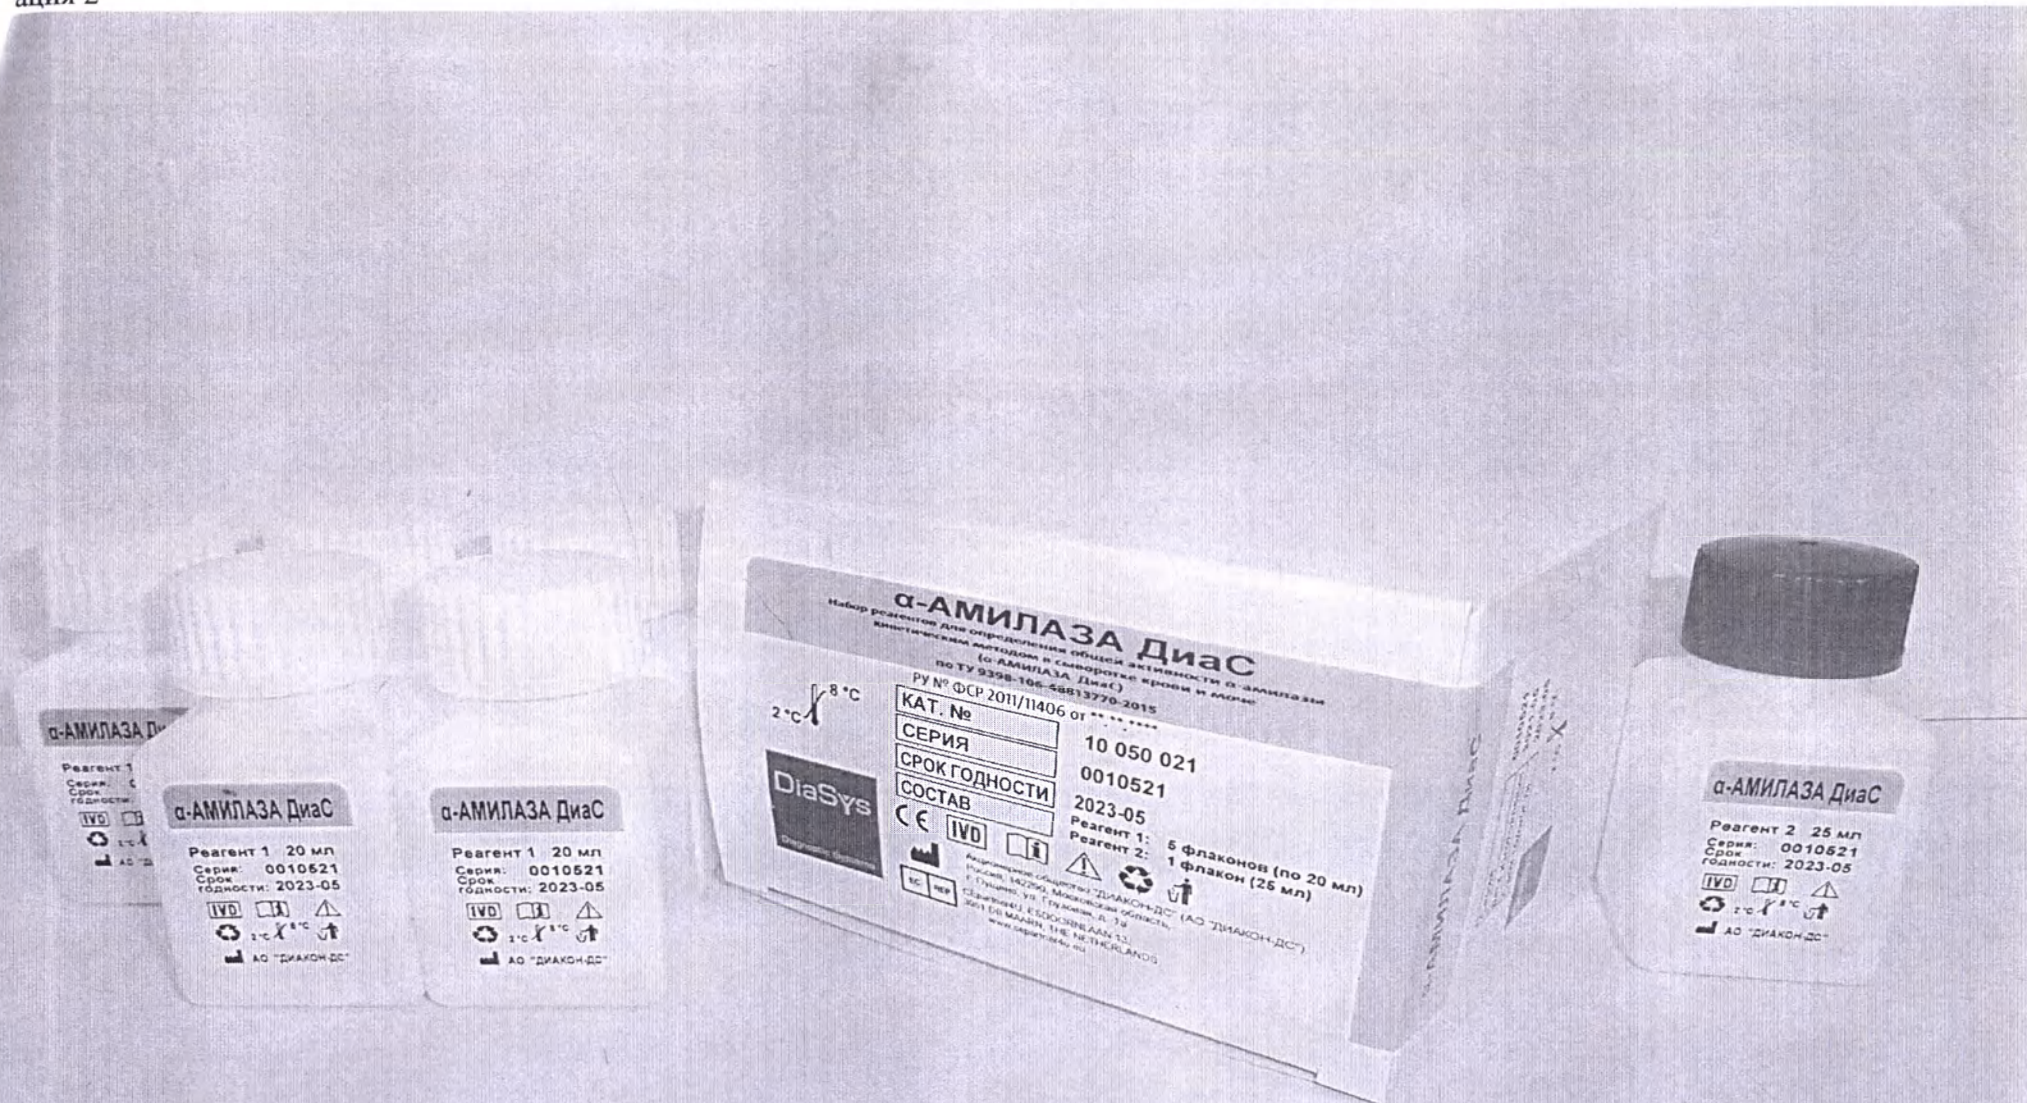

Внешний вид

Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке крови и моче (α -АМИЛАЗА ДиаС) по ТУ 9398-106-48813770-2015


тация 3

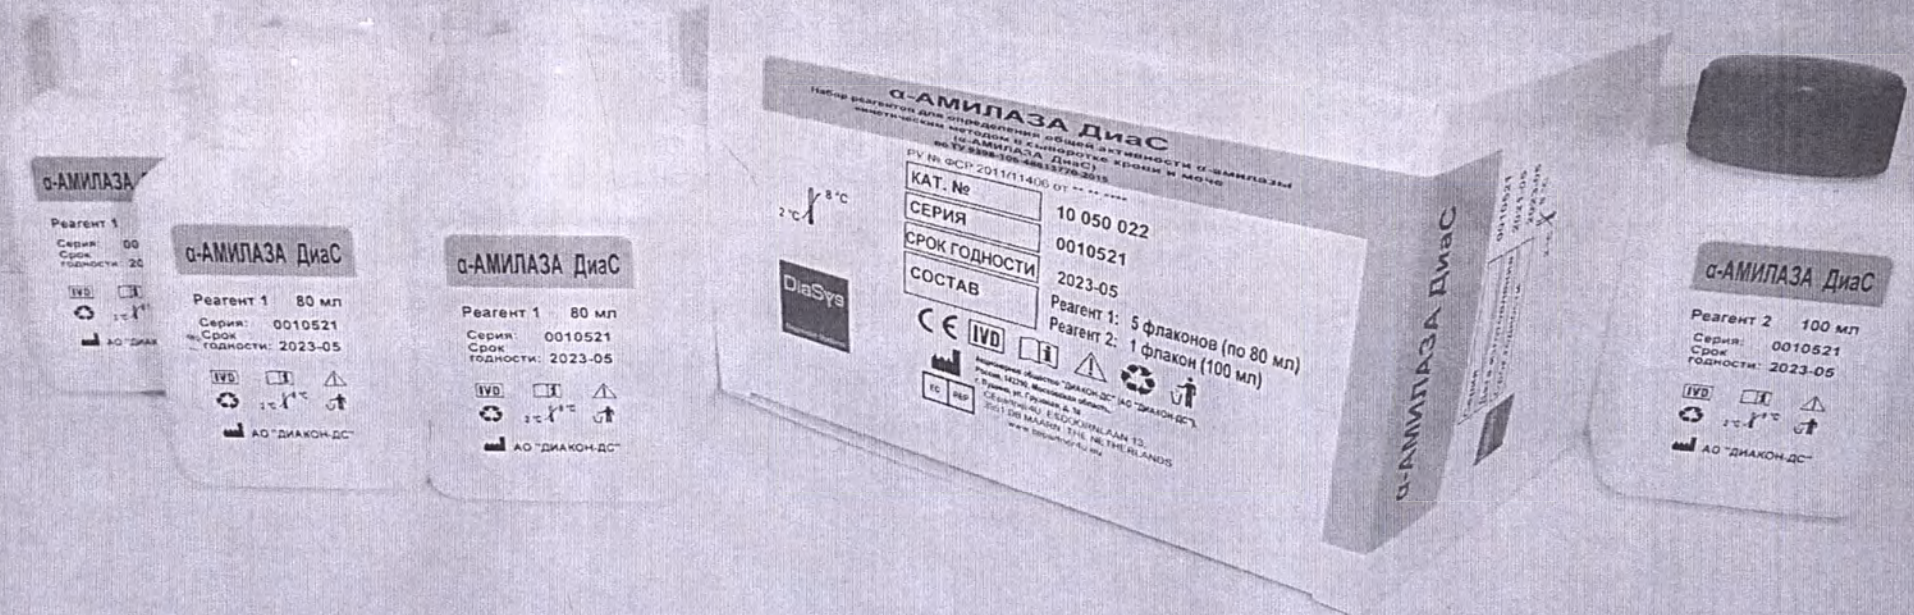

Внешний вид


Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке крови и моче
(α -АМИЛАЗА ДиаС) по ТУ 9398-106-48813770-2015

гация 4

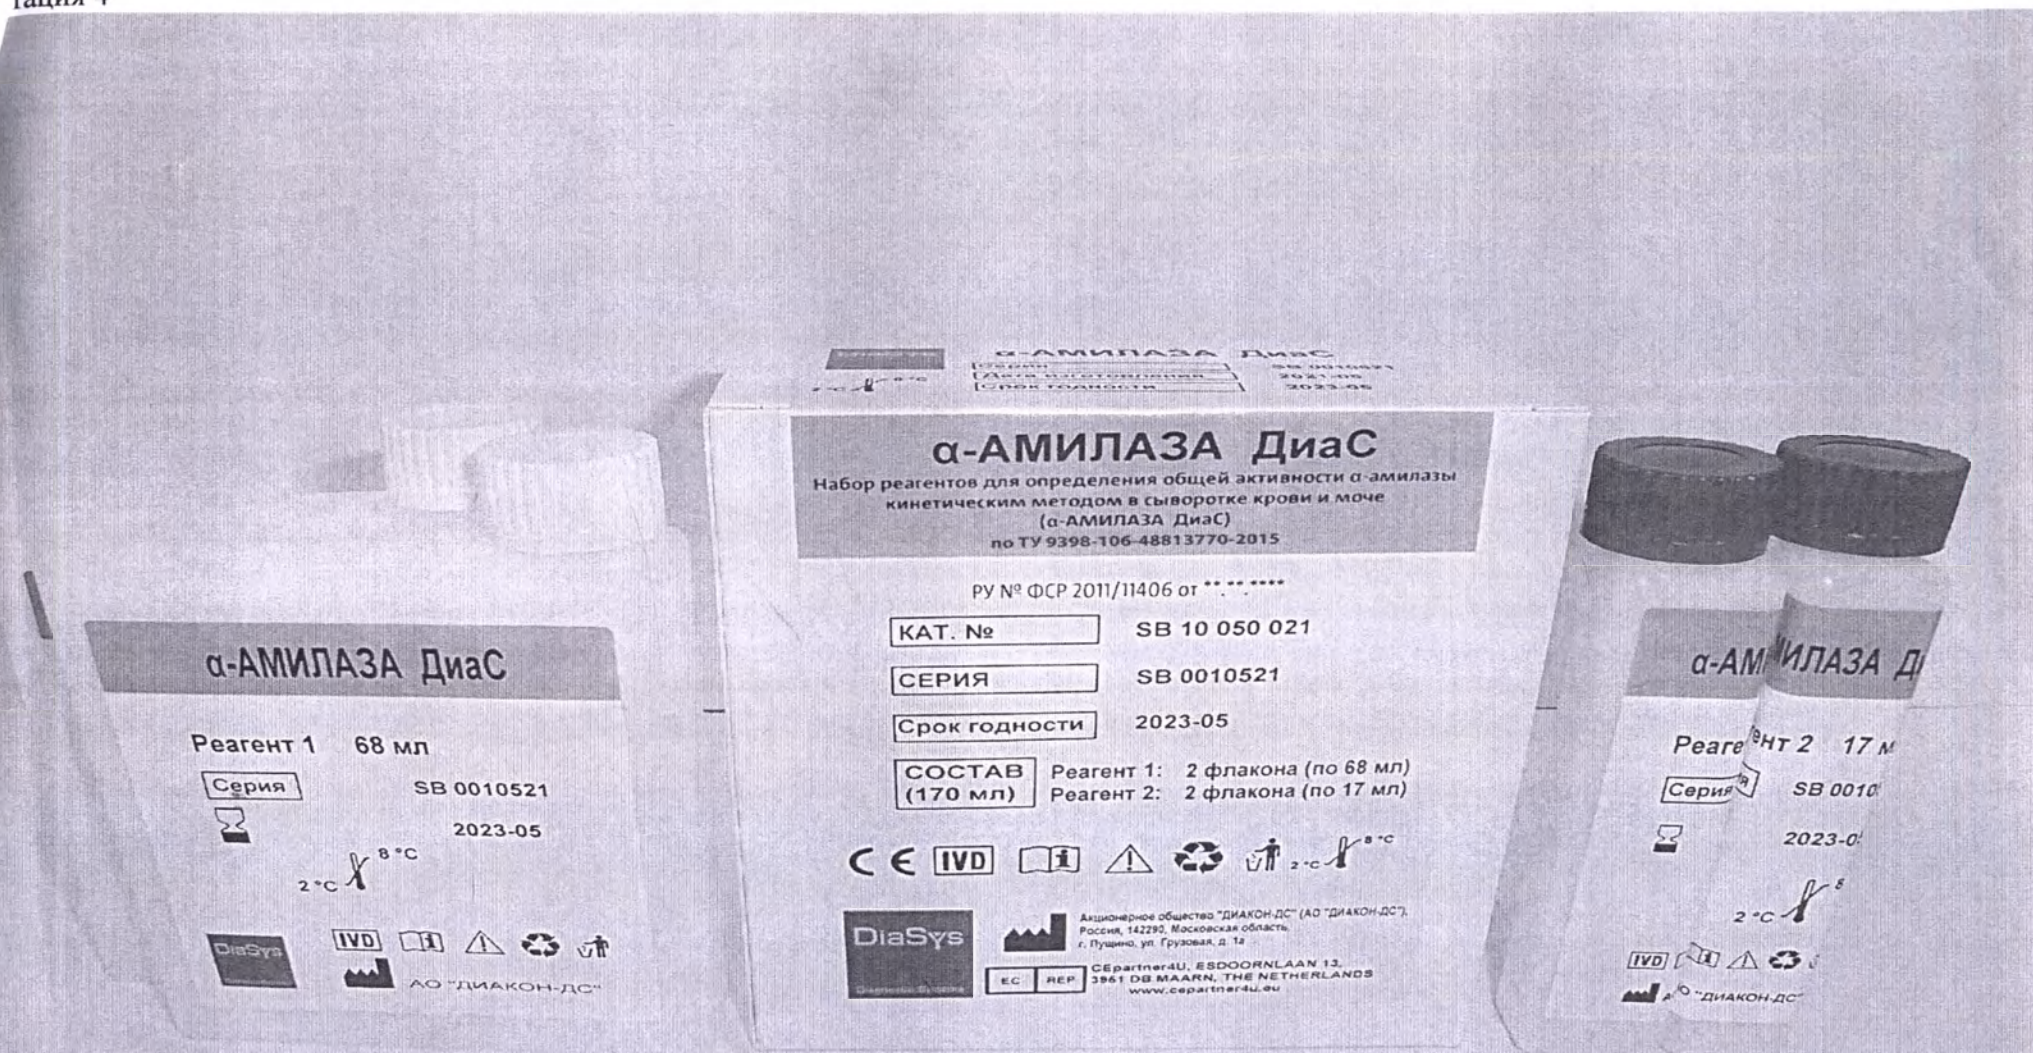

Внешний вид
Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке крови и моче
(α -АМИЛАЗА ДиаС) по ТУ 9398-106-48813770-2015

Стация 5

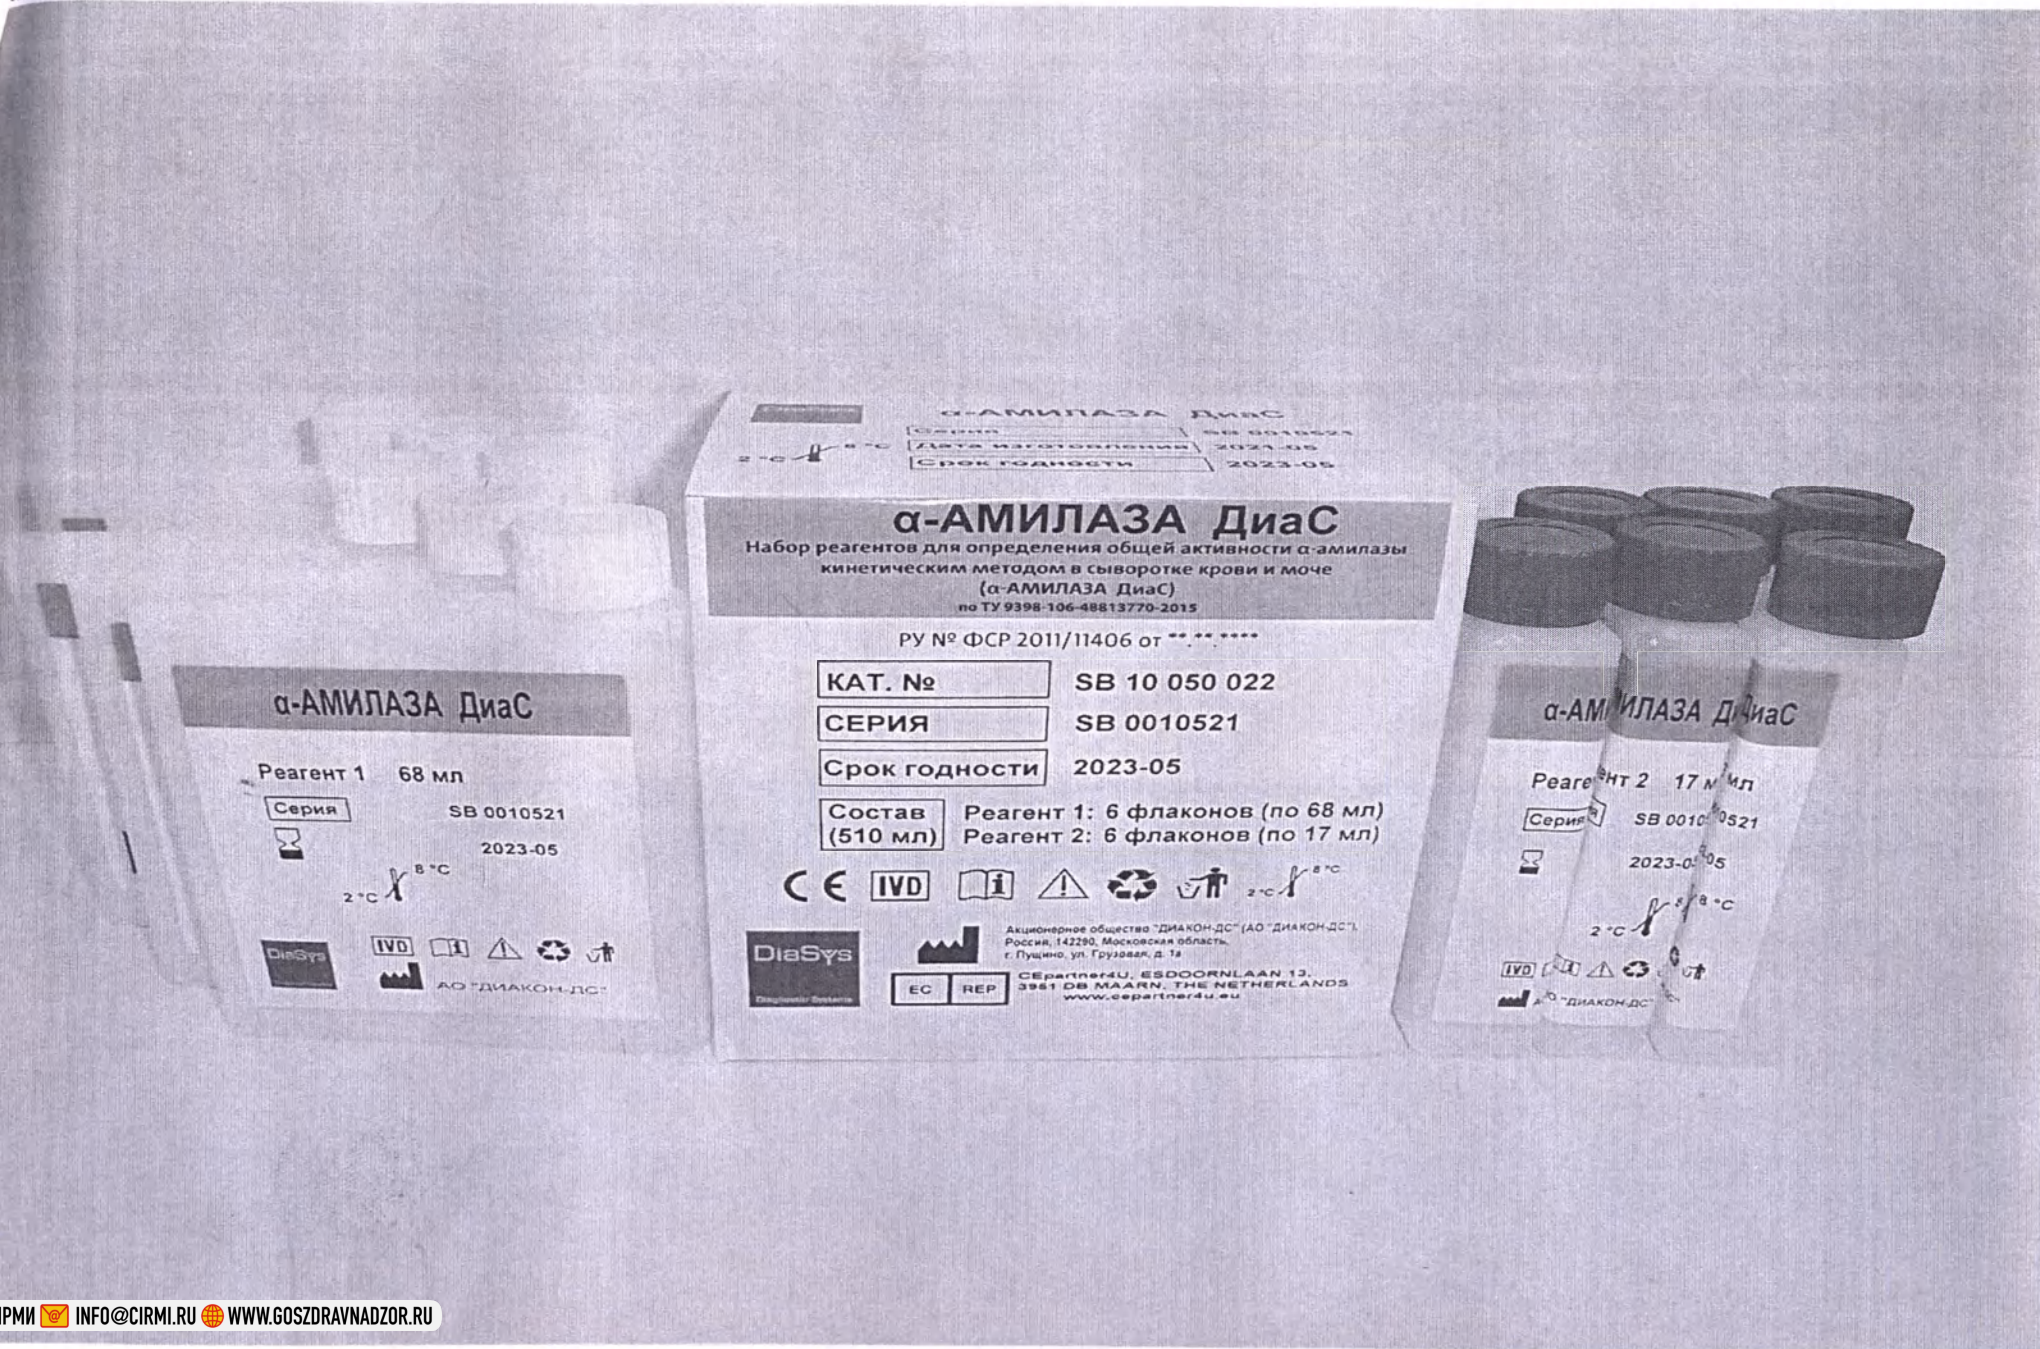

Внешний вид

Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке крови и моче
(α -АМИЛАЗА ДиаС) по ТУ 9398-106-48813770-2015

ектация 7



Внешний вид
Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке крови и моче
(α -АМИЛАЗА ДиаС) по ТУ 9398-106-48813770-2015

лектация 8



Внешний вид
Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке крови и моче
(α -АМИЛАЗА ДиаС) по ТУ 9398-106-48813770-2015

лектация 9



Внешний вид


Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке крови и моче (α -АМИЛАЗА ДиаС) по ТУ 9398-106-48813770-2015

лектация 10



Внешний вид
Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке крови и моче
(α -АМИЛАЗА ДиаС) по ТУ 9398-106-48813770-2015


Инструкция 11 (1)

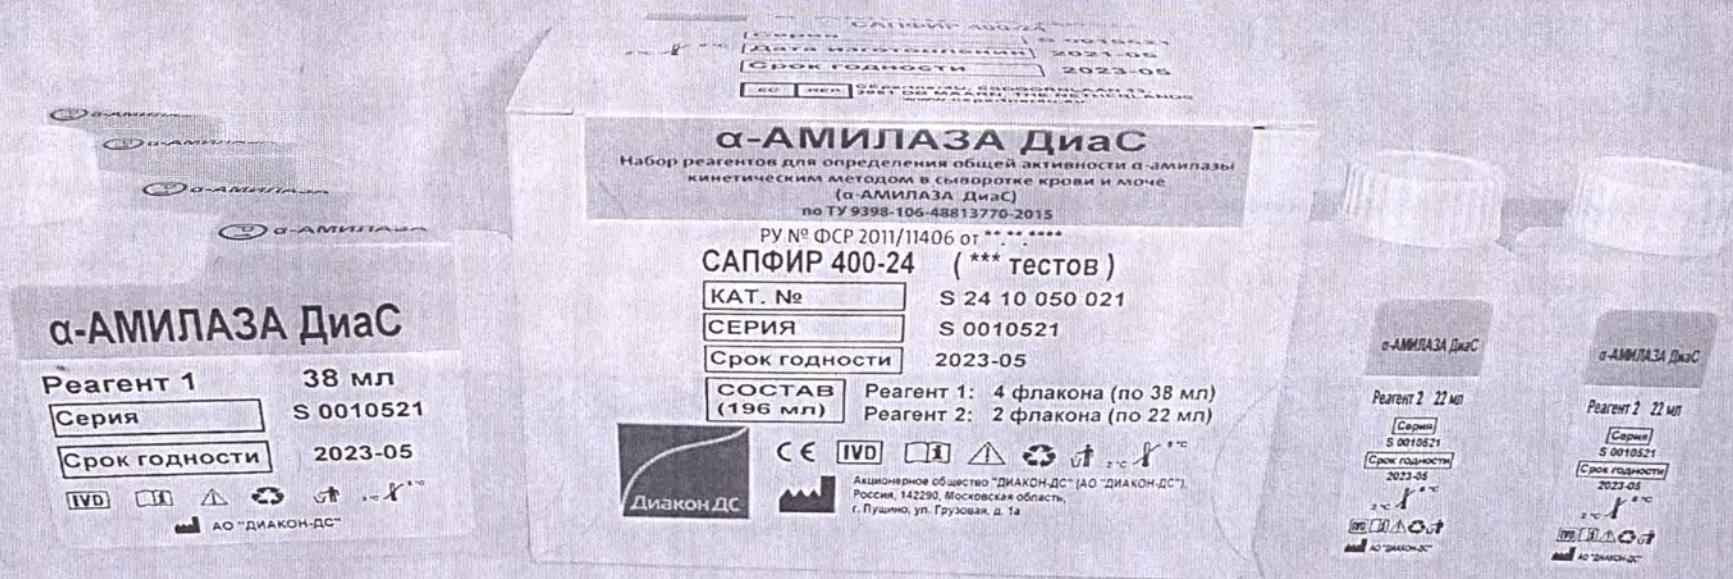

Внешний вид

Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке крови и моче
(α -АМИЛАЗА ДиаС) по ТУ 9398-106-48813770-2015


лектация 11 (2)

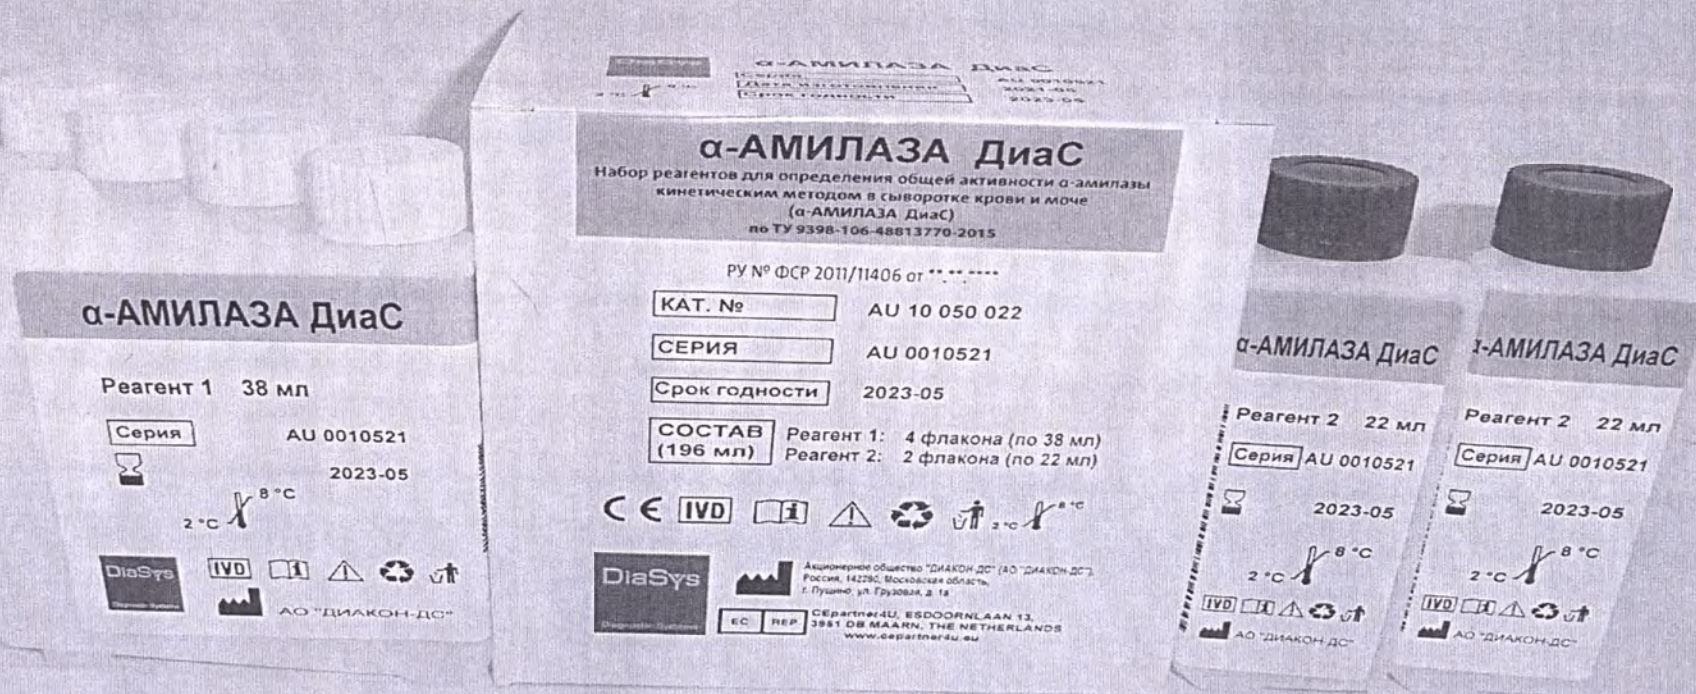

Внешний вид

Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке крови и моче
(α -АМИЛАЗА ДиаС) по ТУ 9398-106-48813770-2015


Инструкция 12

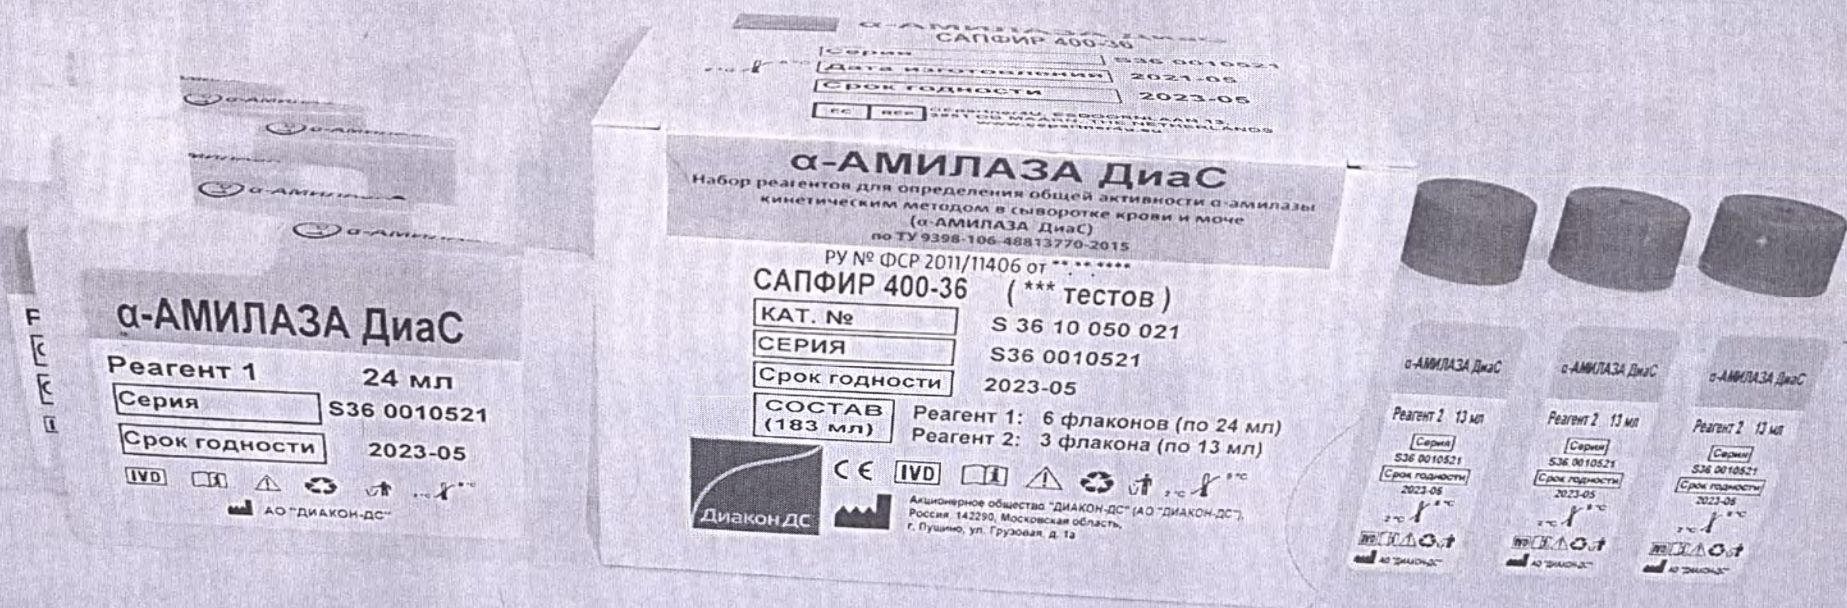

Внешний вид

Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке крови и моче
(α -АМИЛАЗА ДиаС) по ТУ 9398-106-48813770-2015

ектация 13

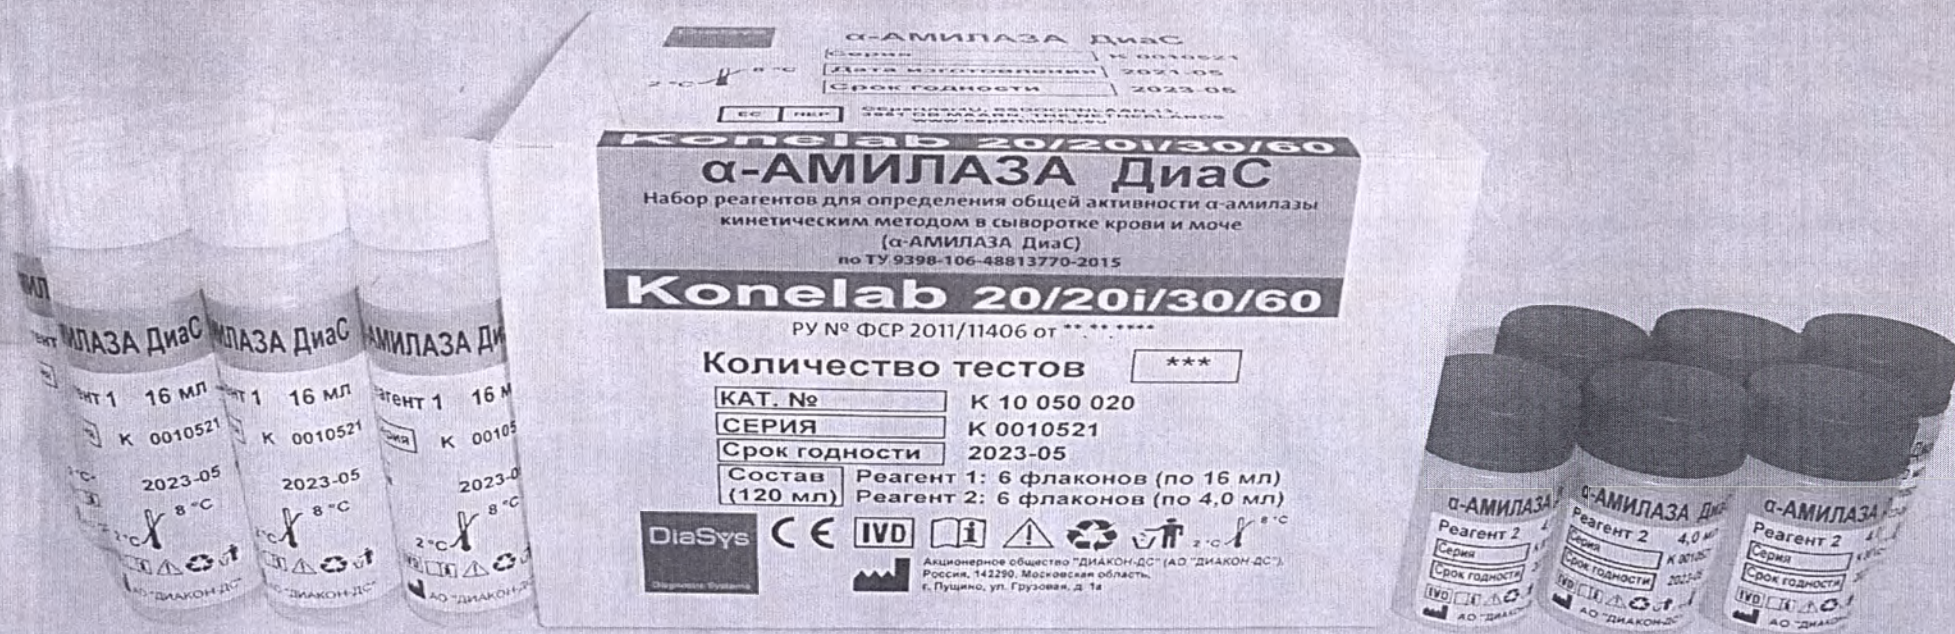

Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке крови и моче (α -АМИЛАЗА ДиаС) по ТУ 9398-106-48813770-2015

РУ № ФСР 2011/11406 от " " .

Количество тестов

КАТ. №	К 10 050 021
СЕРИЯ	К 0010521
Срок годности	2023-05

Состав (400 мл)	Реагент 1: 5 флаконов (по 62 мл)
	Реагент 2: 5 флаконов (по 18 мл)










Акционерное общество "ДИАКОН-ДС" (АО "ДИАКОН-ДС"),
 Россия, 142290, Московская область,
 г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1а

α-АМИЛАЗА ДиаС

Реагент 1 62 мл

Серия К 0010521

2023-05

2°C λ 8°C

DiaSys

IVD

1999

10

"ДИА"

КОН-Д

ac

 ООО ЦИПМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Внешний вид


Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке крови и моче (α -АМИЛАЗА ДиаС) по ТУ 9398-106-48813770-2015

лектация 15



Внешний вид
Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке крови и моче
(α -АМИЛАЗА ДиаС) по ТУ 9398-106-48813770-2015


ектация 16

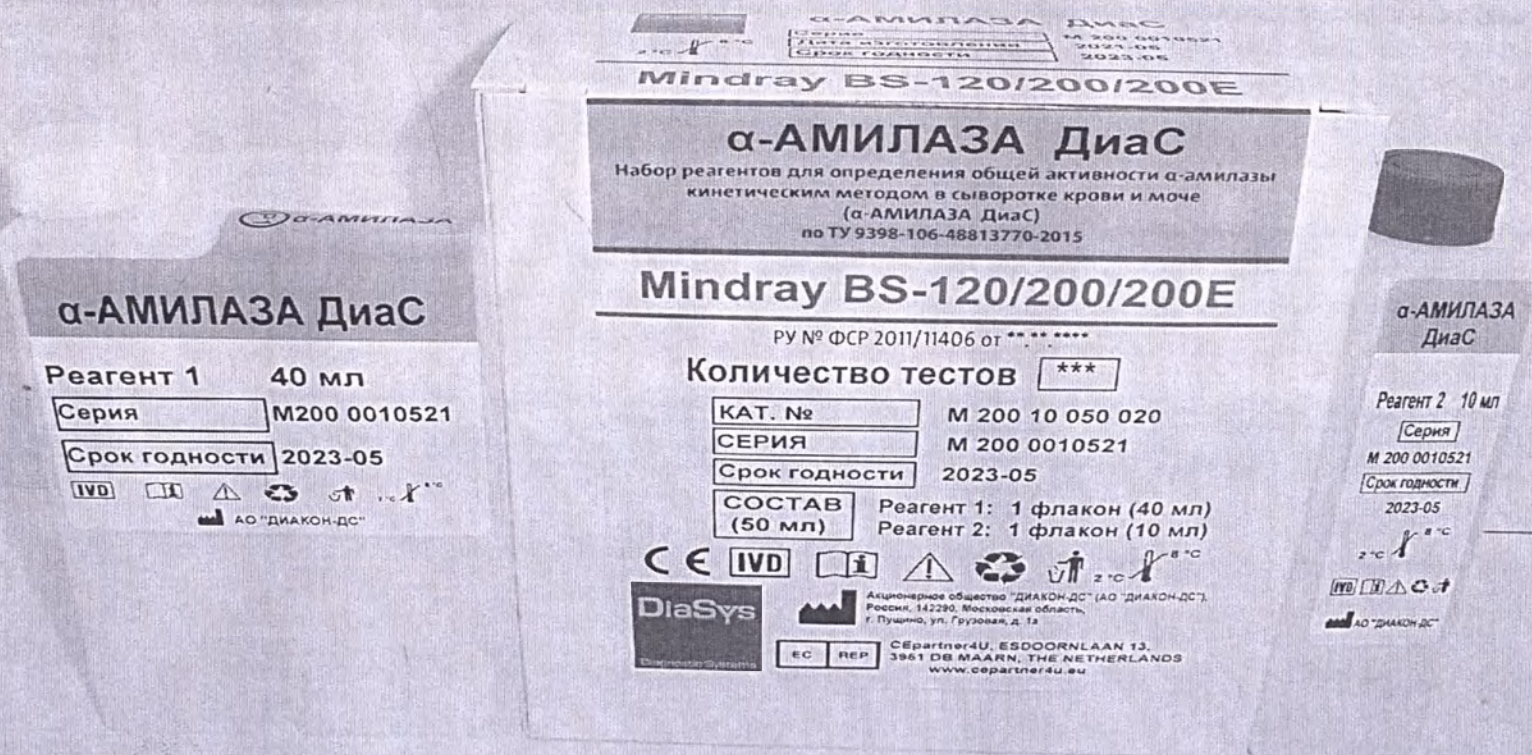

Внешний вид


Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке крови и моче
(α -АМИЛАЗА ДиаС) по ТУ 9398-106-48813770-2015

секция 17

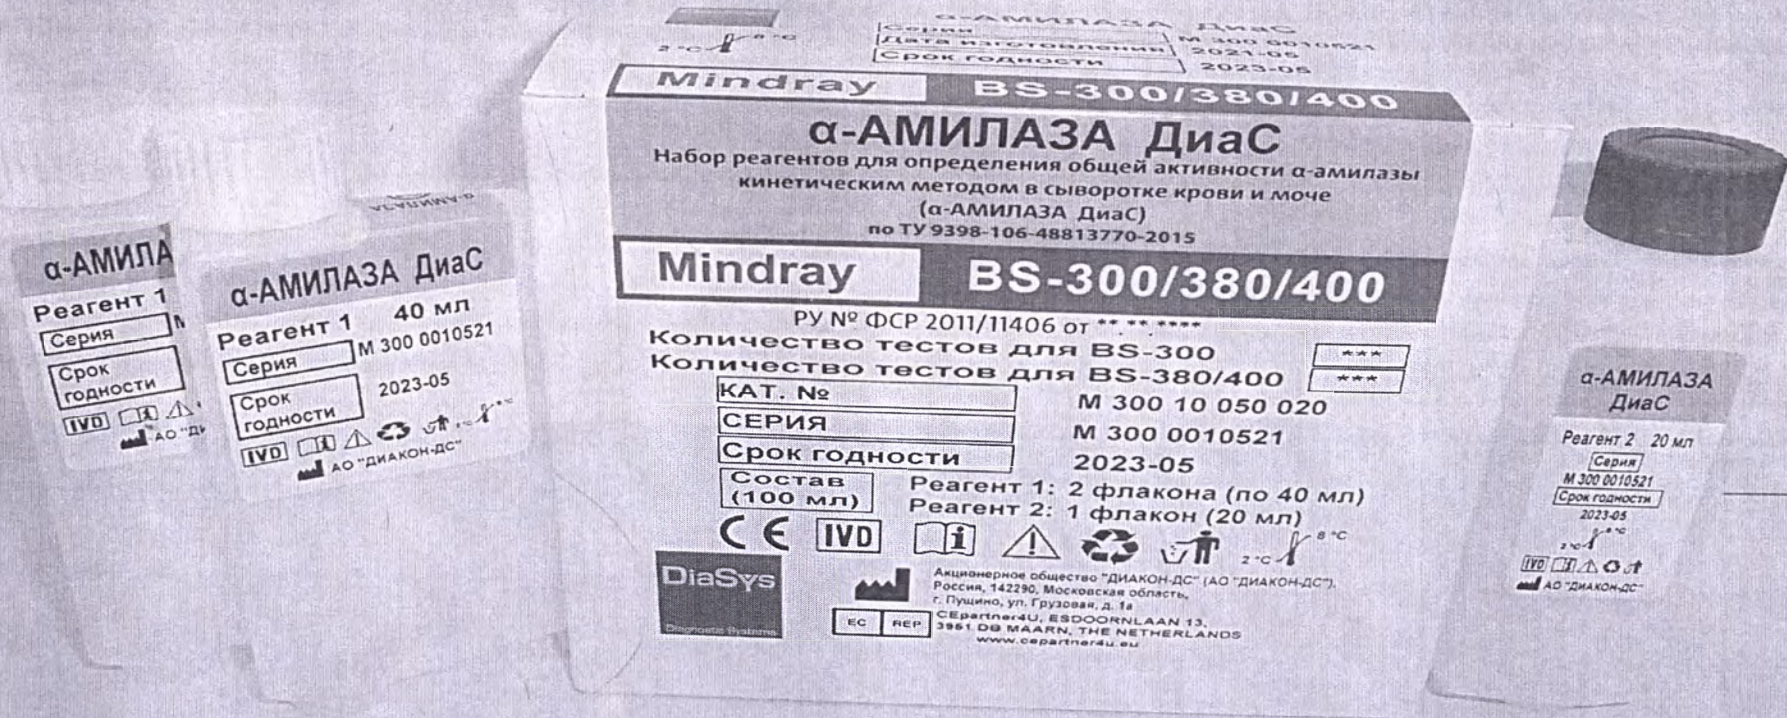


Внешний вид
Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке крови и моче
(α -АМИЛАЗА ДиаС) по ТУ 9398-106-48813770-2015

Инструкция 18

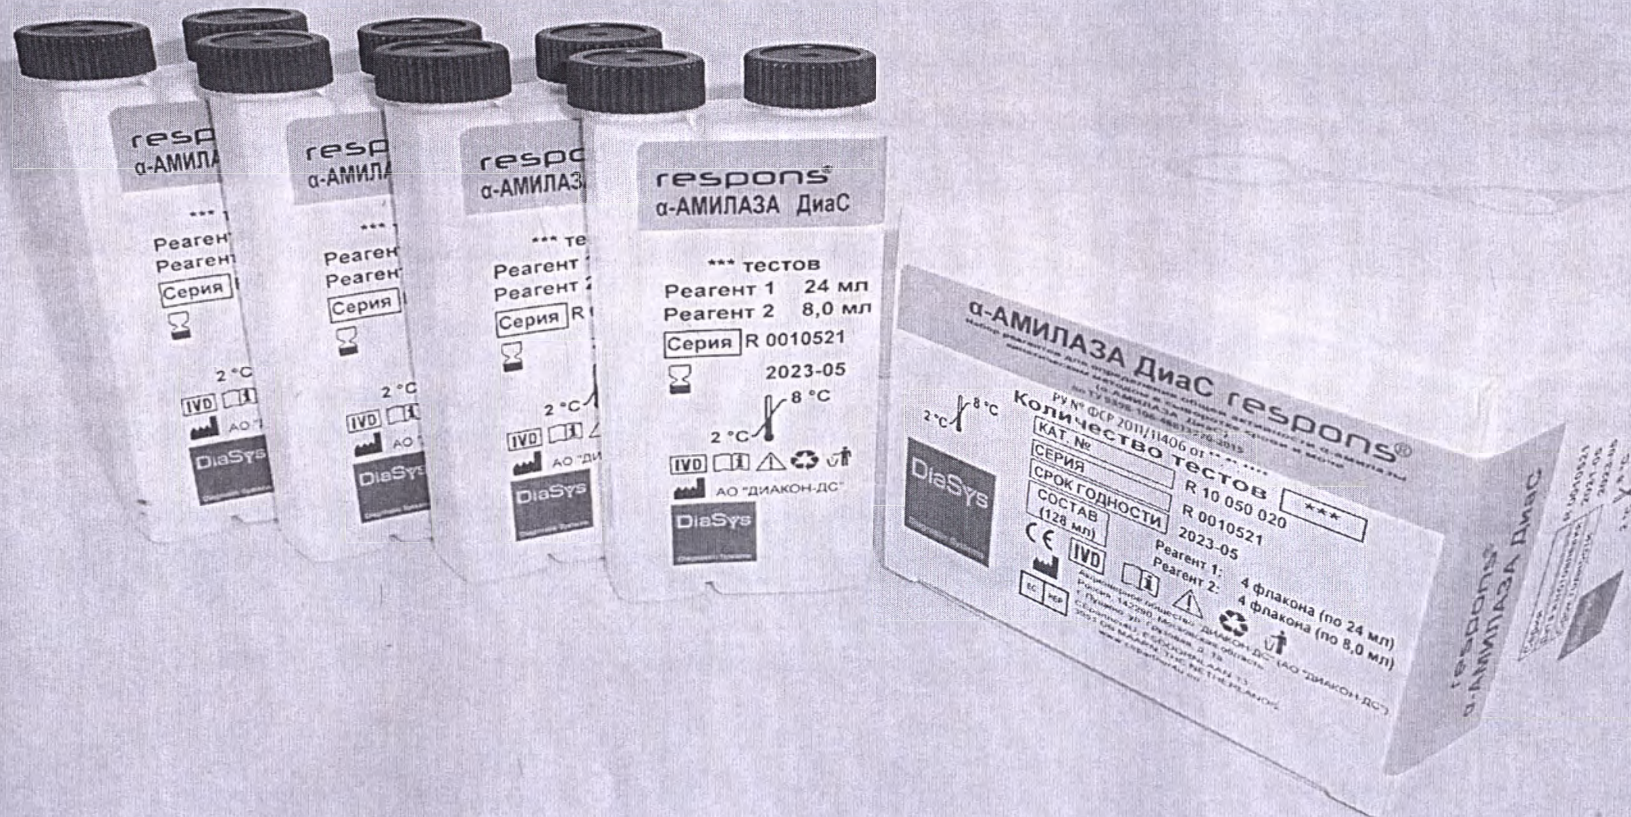


Внешний вид
Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке крови и моче
(α -АМИЛАЗА ДиаС) по ТУ 9398-106-48813770-2015

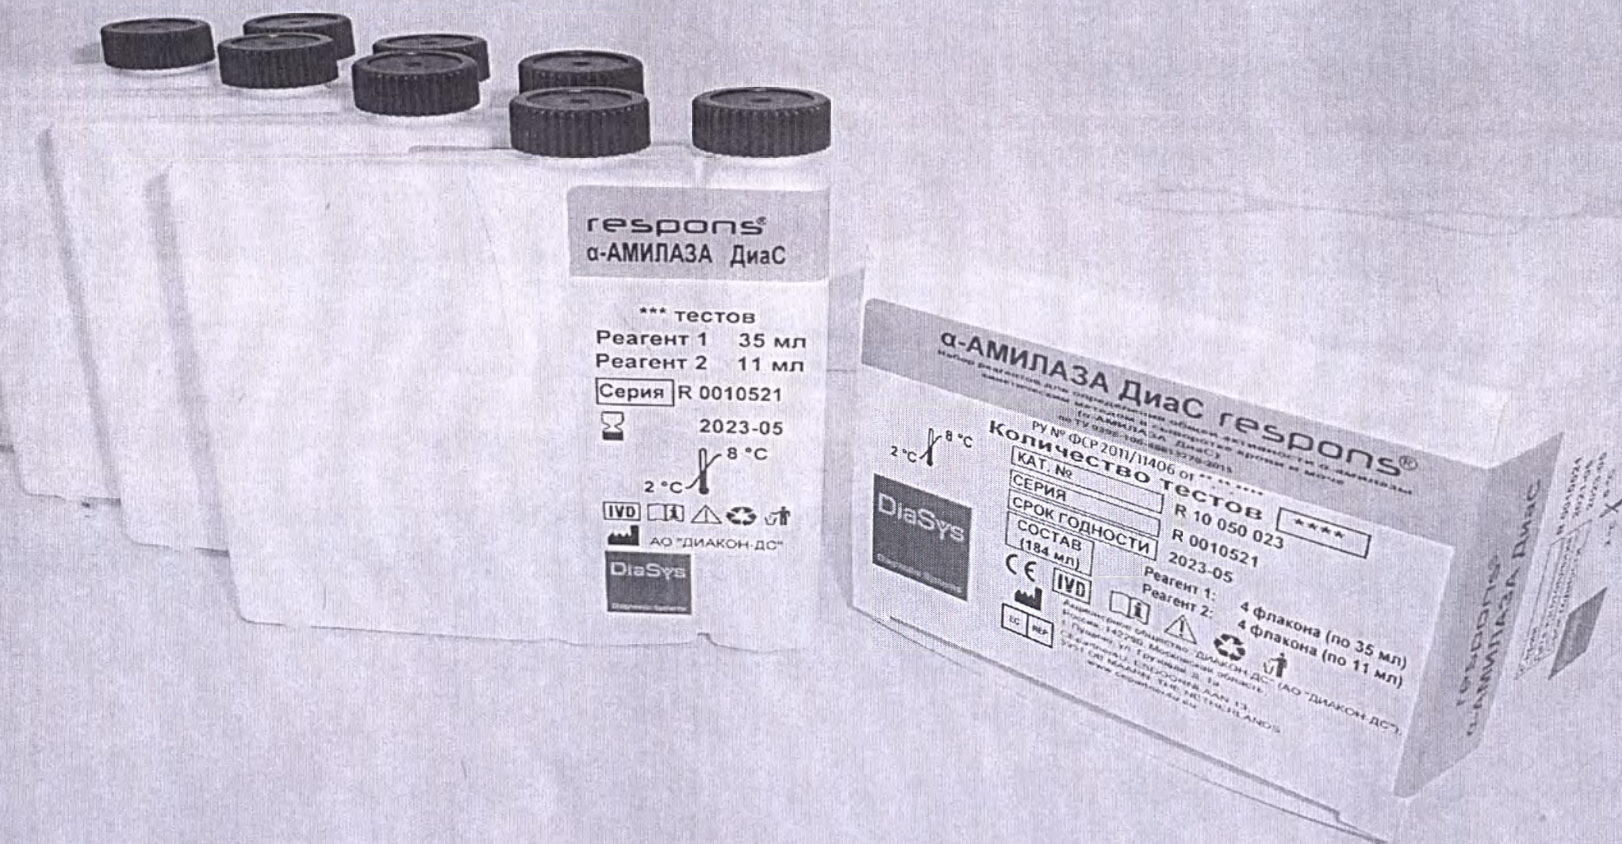

Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке крови и моче (α -АМИЛАЗА ДиаС) по ТУ 9398-106-48813770-2015


Внешний вид
Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке крови и моче
(α -АМИЛАЗА ДиаС) по ТУ 9398-106-48813770-2015

лектация 21

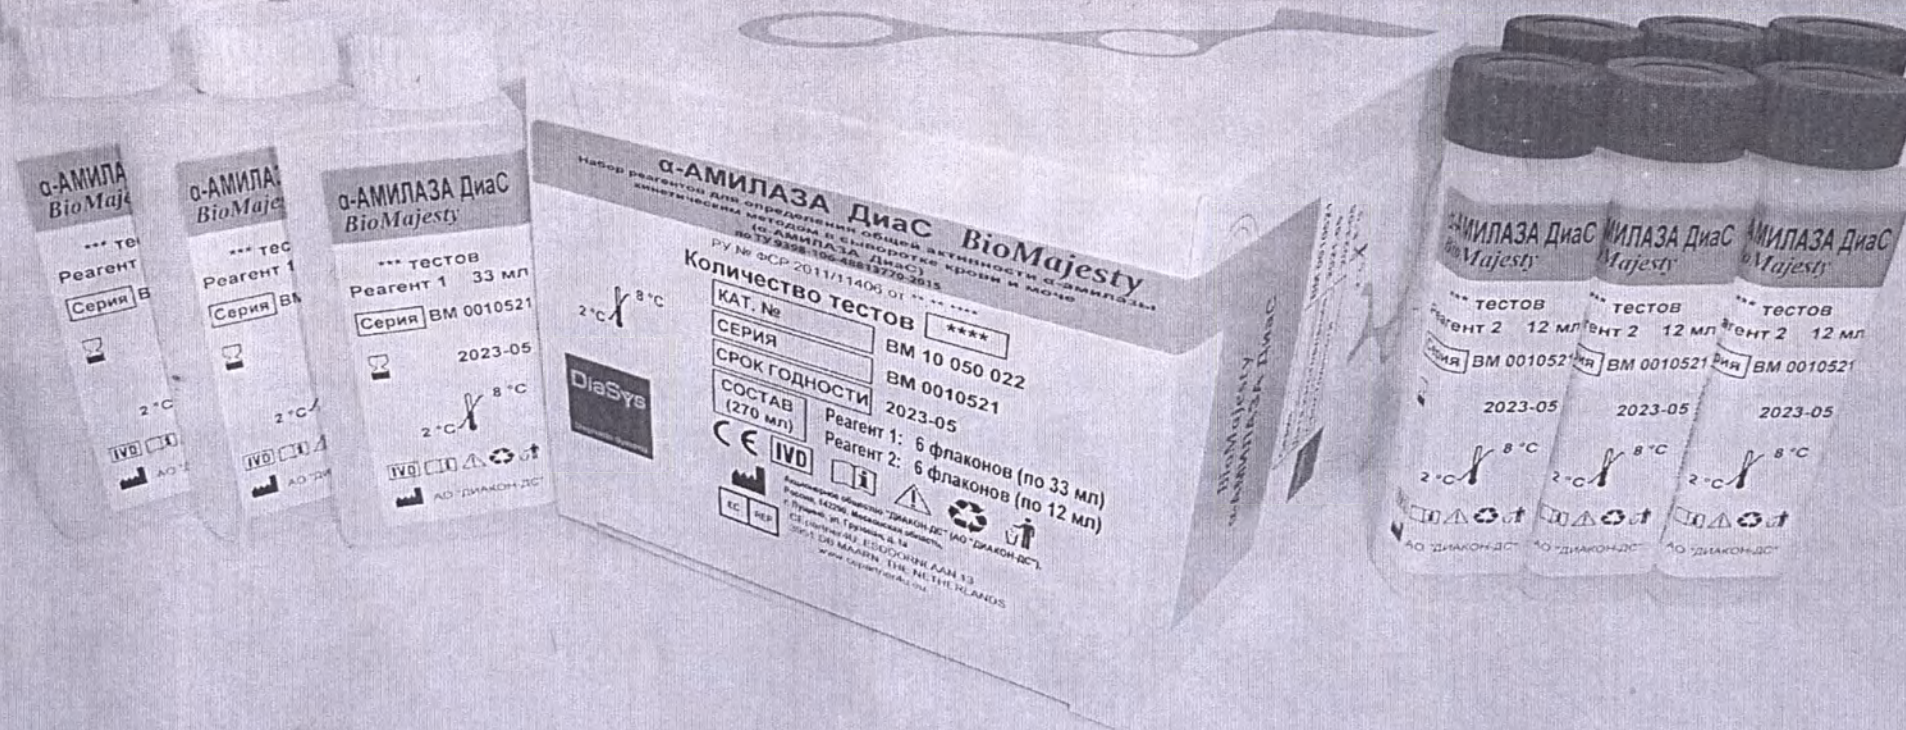


Внешний вид
Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке крови и моче
(α -АМИЛАЗА ДиаС) по ТУ 9398-106-48813770-2015

лектация 22

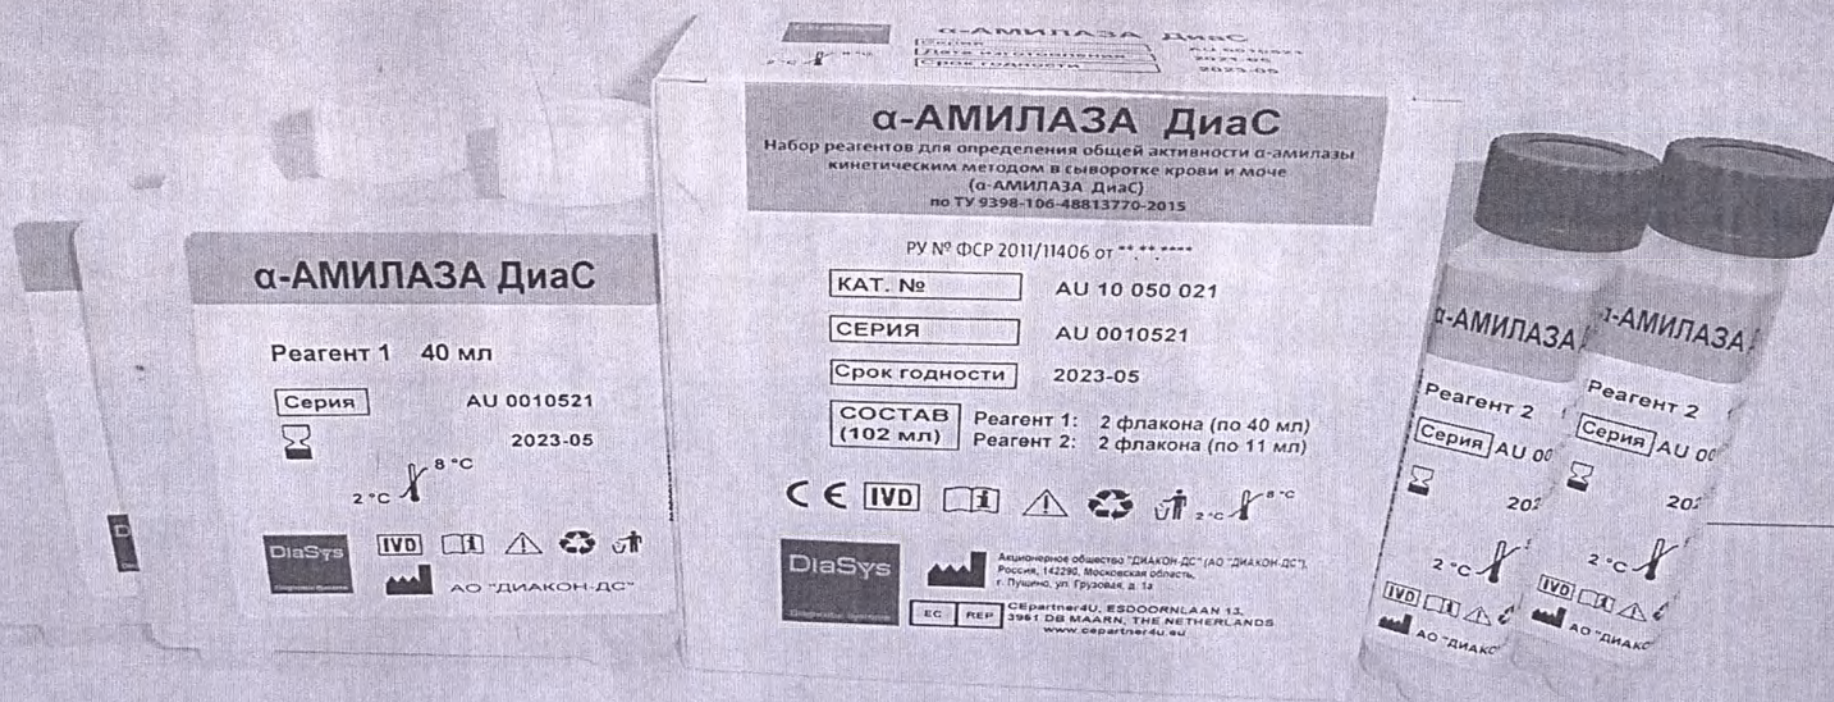



Внешний вид
Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке крови и моче
(α -АМИЛАЗА ДиаС) по ТУ 9398-106-48813770-2015

лектация 23

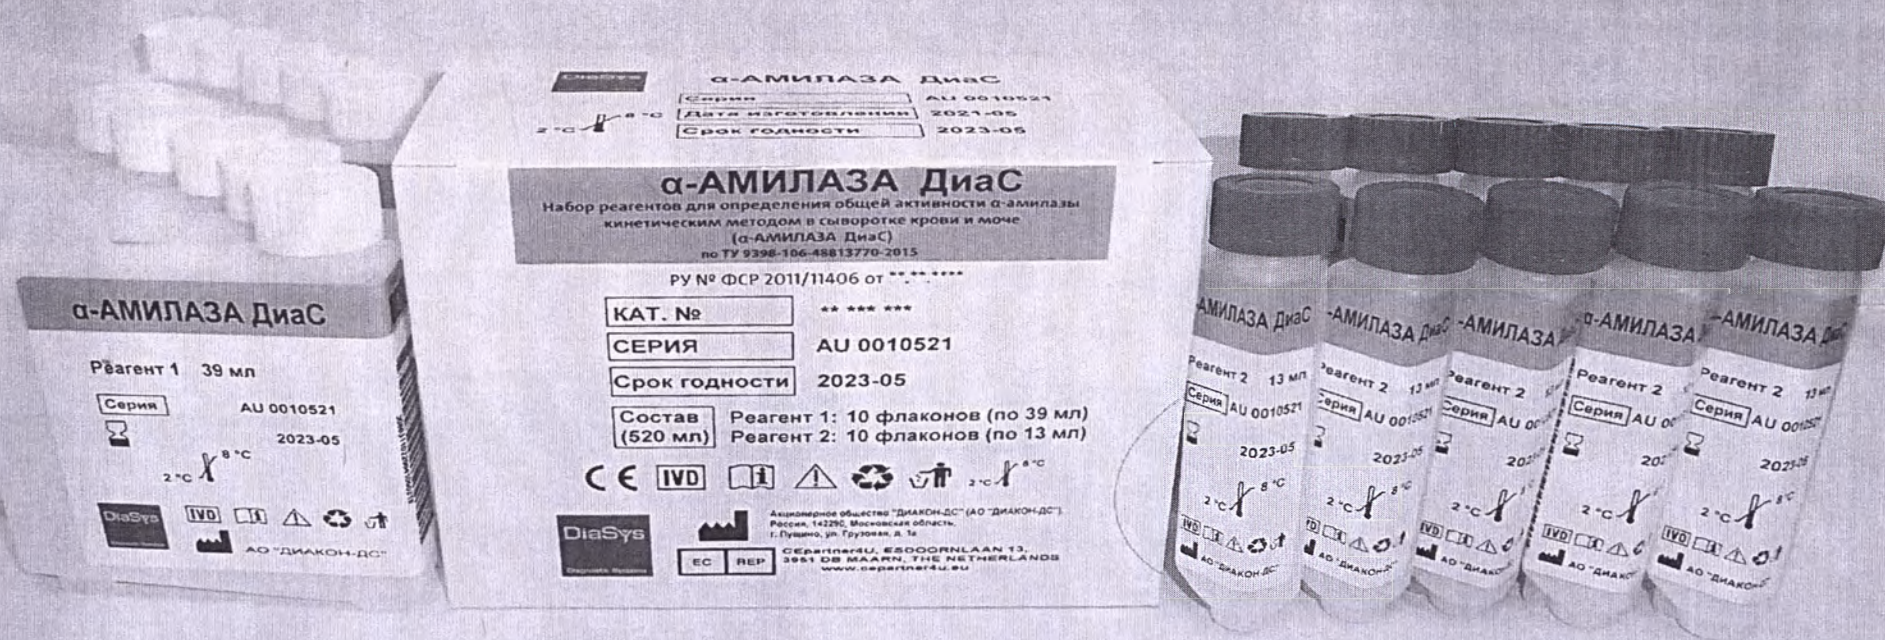

Внешний вид
Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке крови и моче
(α -АМИЛАЗА ДиаС) по ТУ 9398-106-48813770-2015




лектация 24

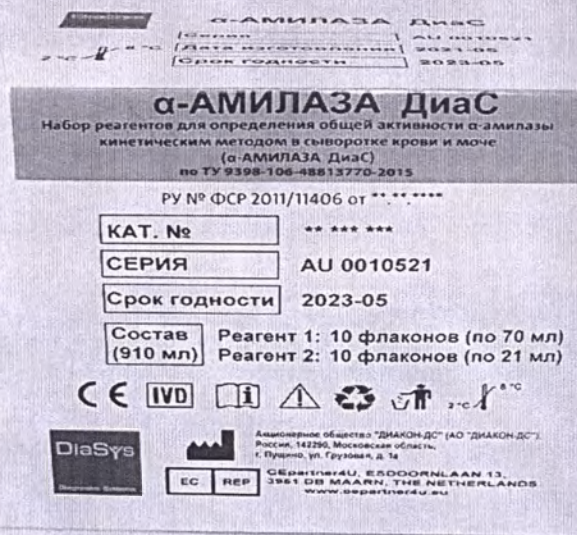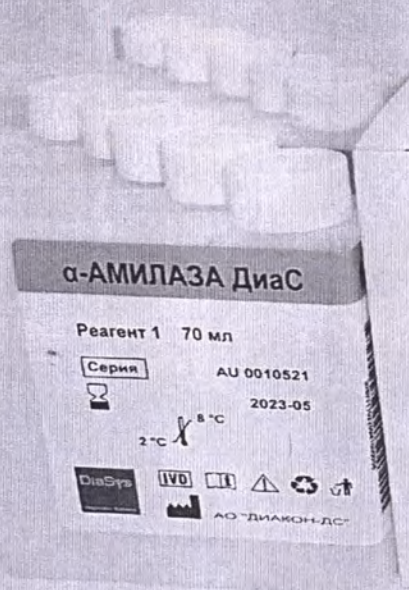

Внешний вид

Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке крови и моче
(α -АМИЛАЗА ДиаС) по ТУ 9398-106-48813770-2015



Инструкция 25

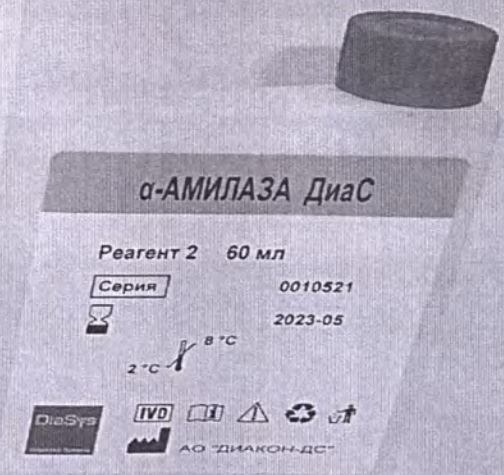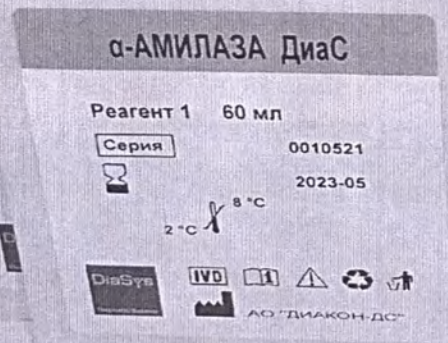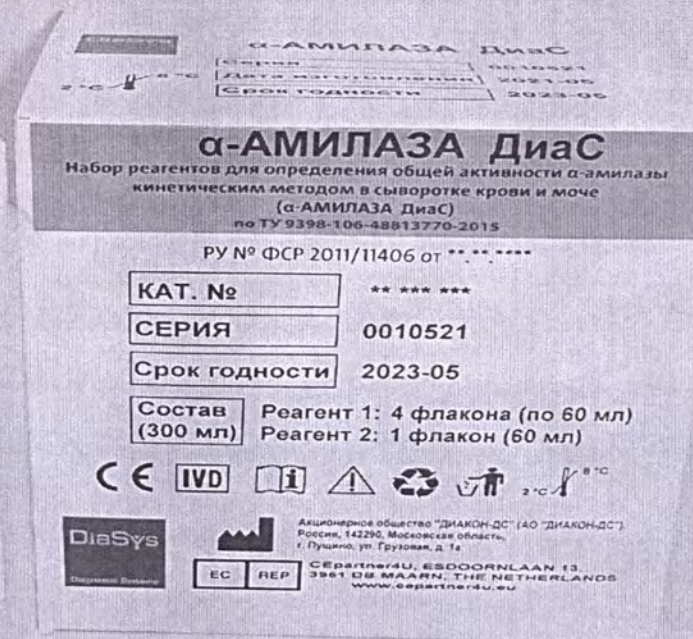

Внешний вид

Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке крови и моче (α -АМИЛАЗА ДиаС) по ТУ 9398-106-48813770-2015

лектация 26

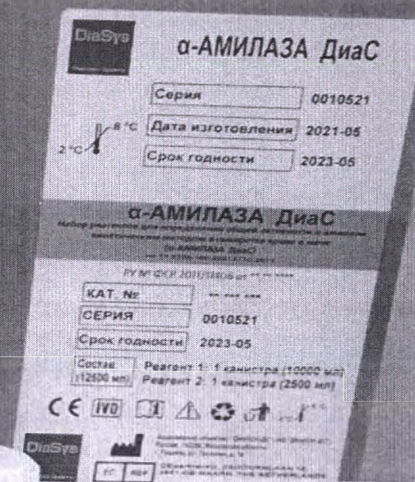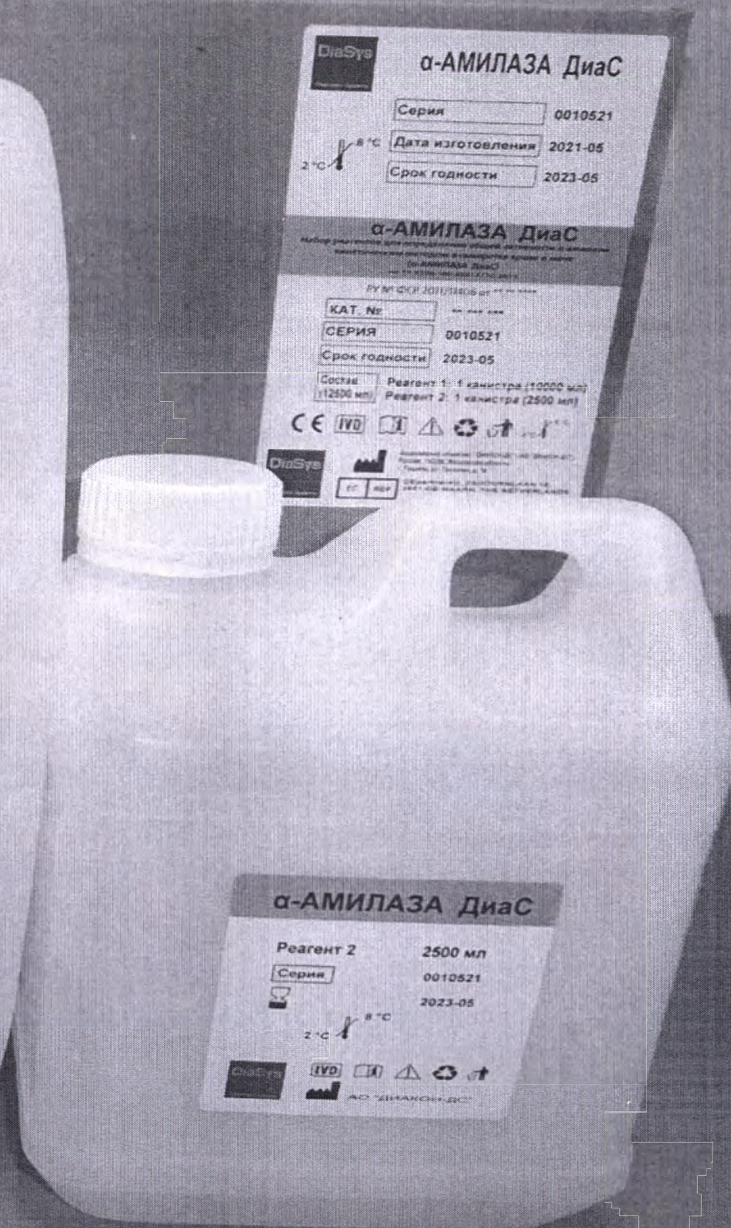



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 24
Генеральный директор
АО «ДИАКОН-ДС»

Т.Ю. Корзун