


Внешний вид


Набора реагентов для количественного определения содержания общего билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ДиаС) по ТУ 9398-115-48813770-2015

Комплектация 1

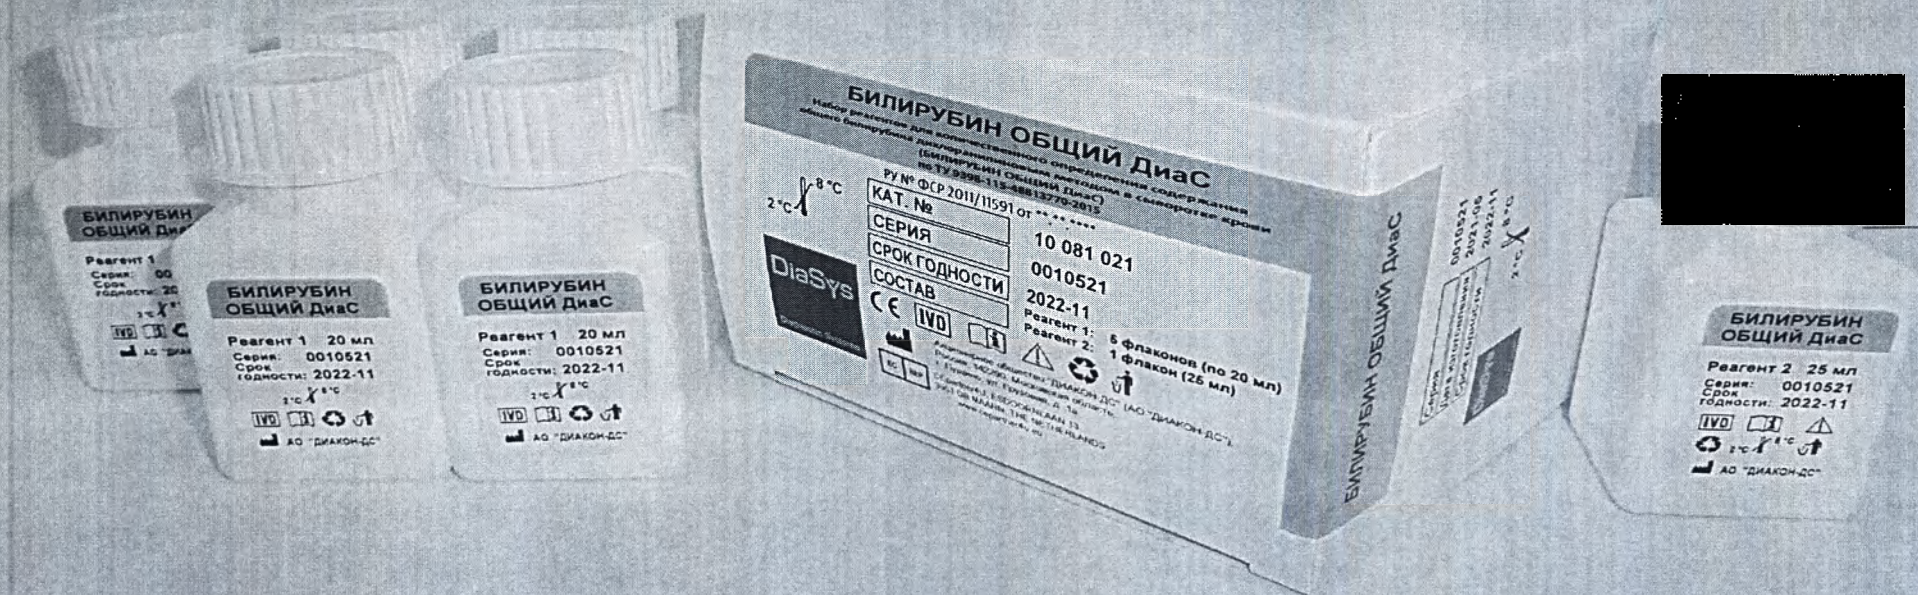

Внешний вид
Набора реагентов для количественного определения содержания общего билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ДиаС) по ТУ 9398-115-48813770-2015


Мплектация 2

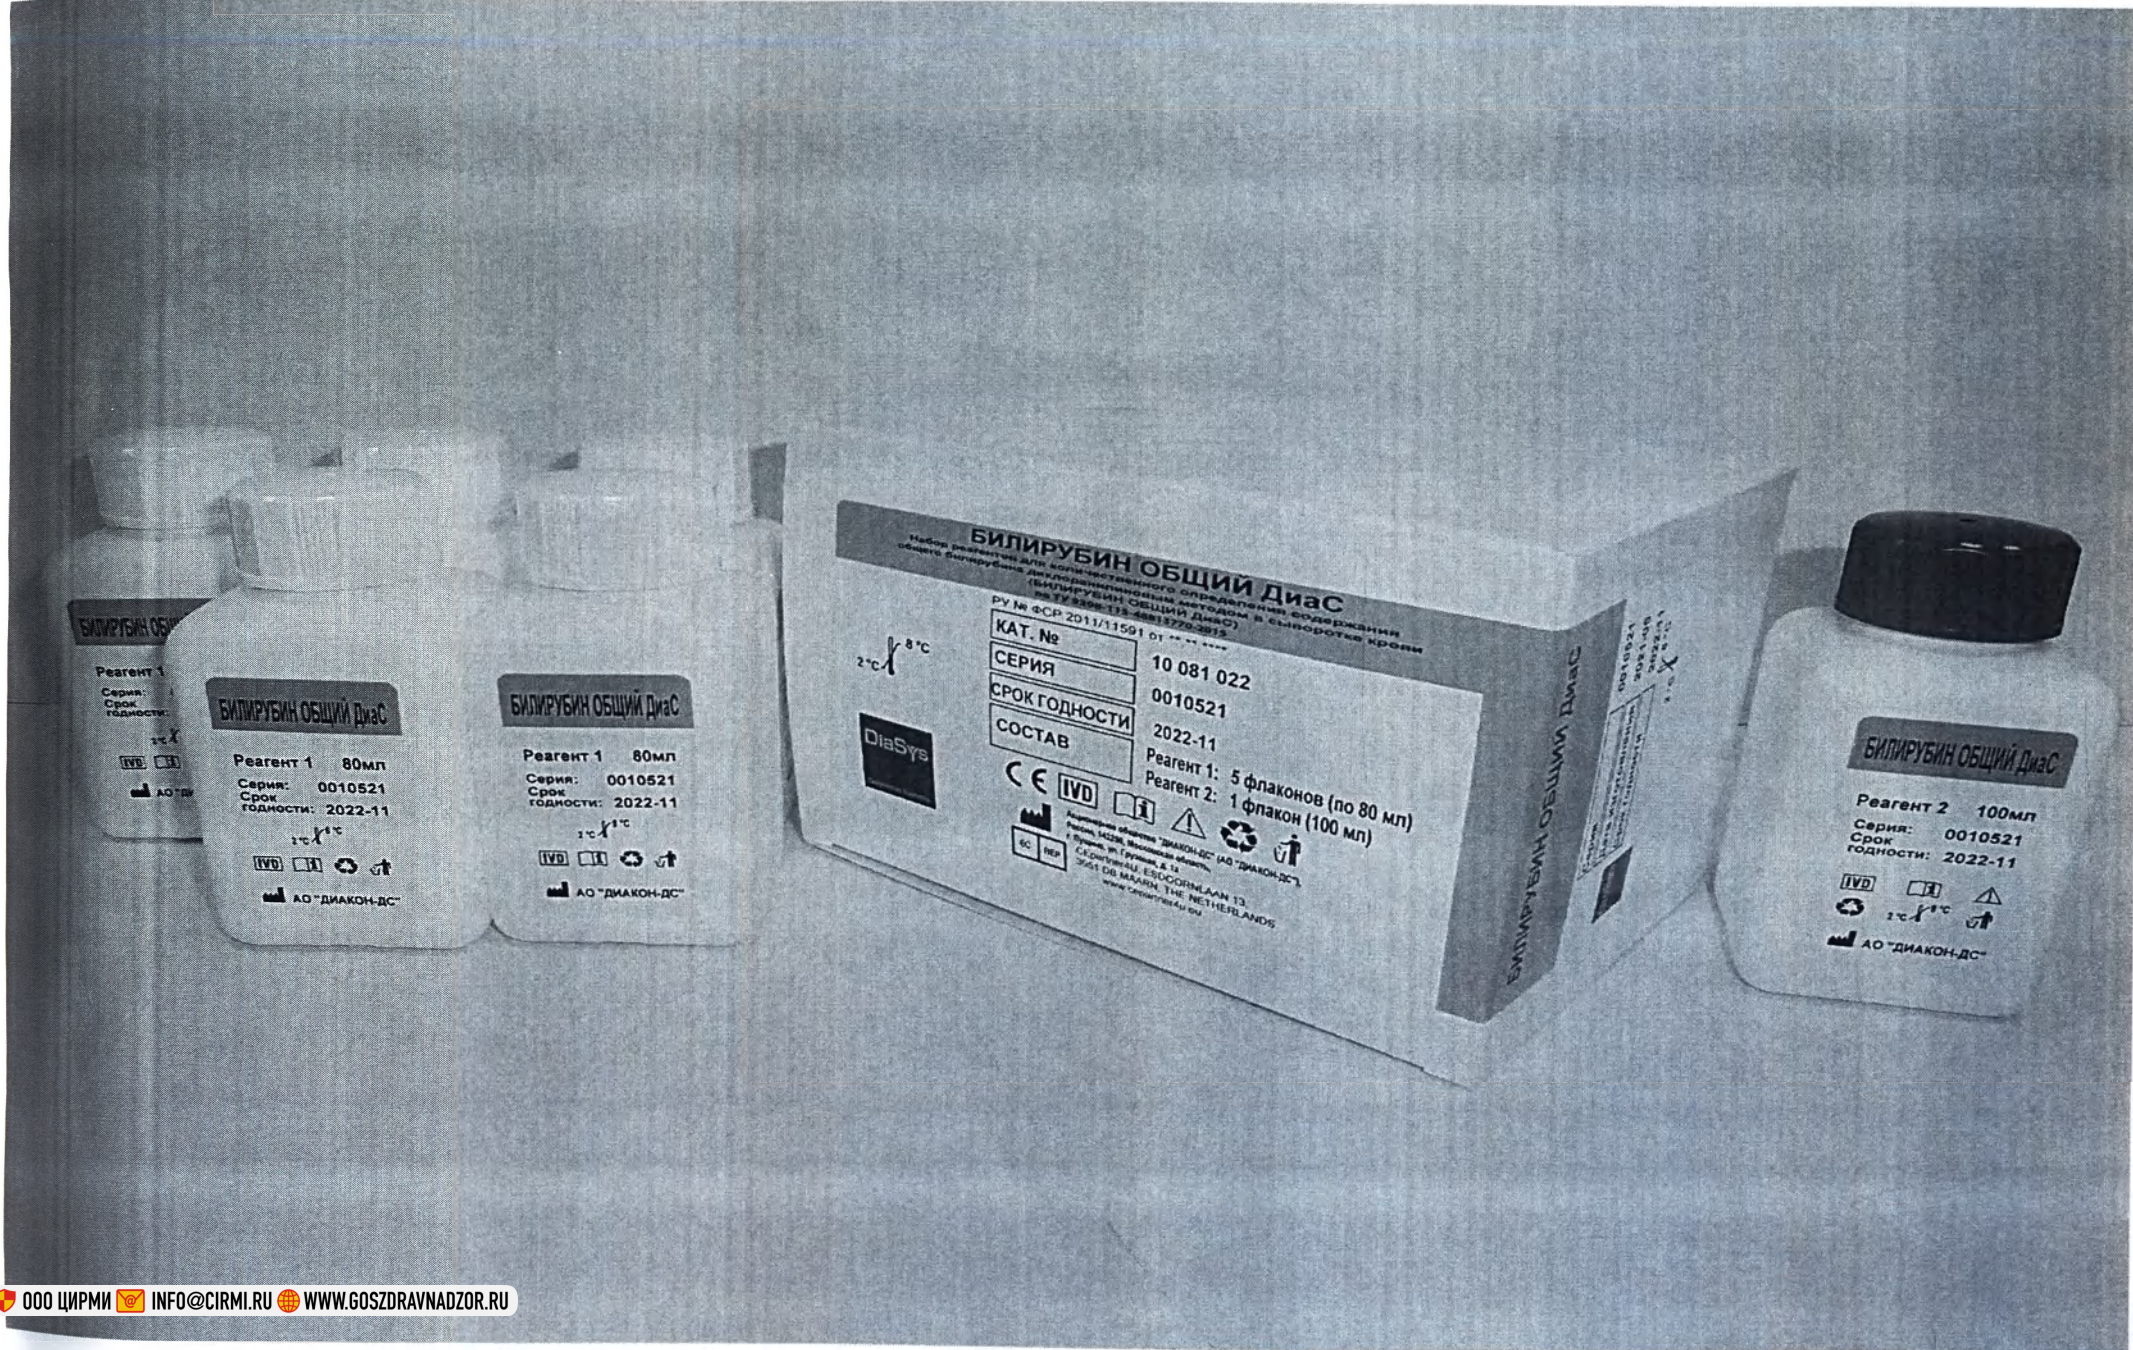

Внешний вид

Набора реагентов для количественного определения содержания общего билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови (БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ДиаС) по ТУ 9398-115-48813770-2015

мплектация 3

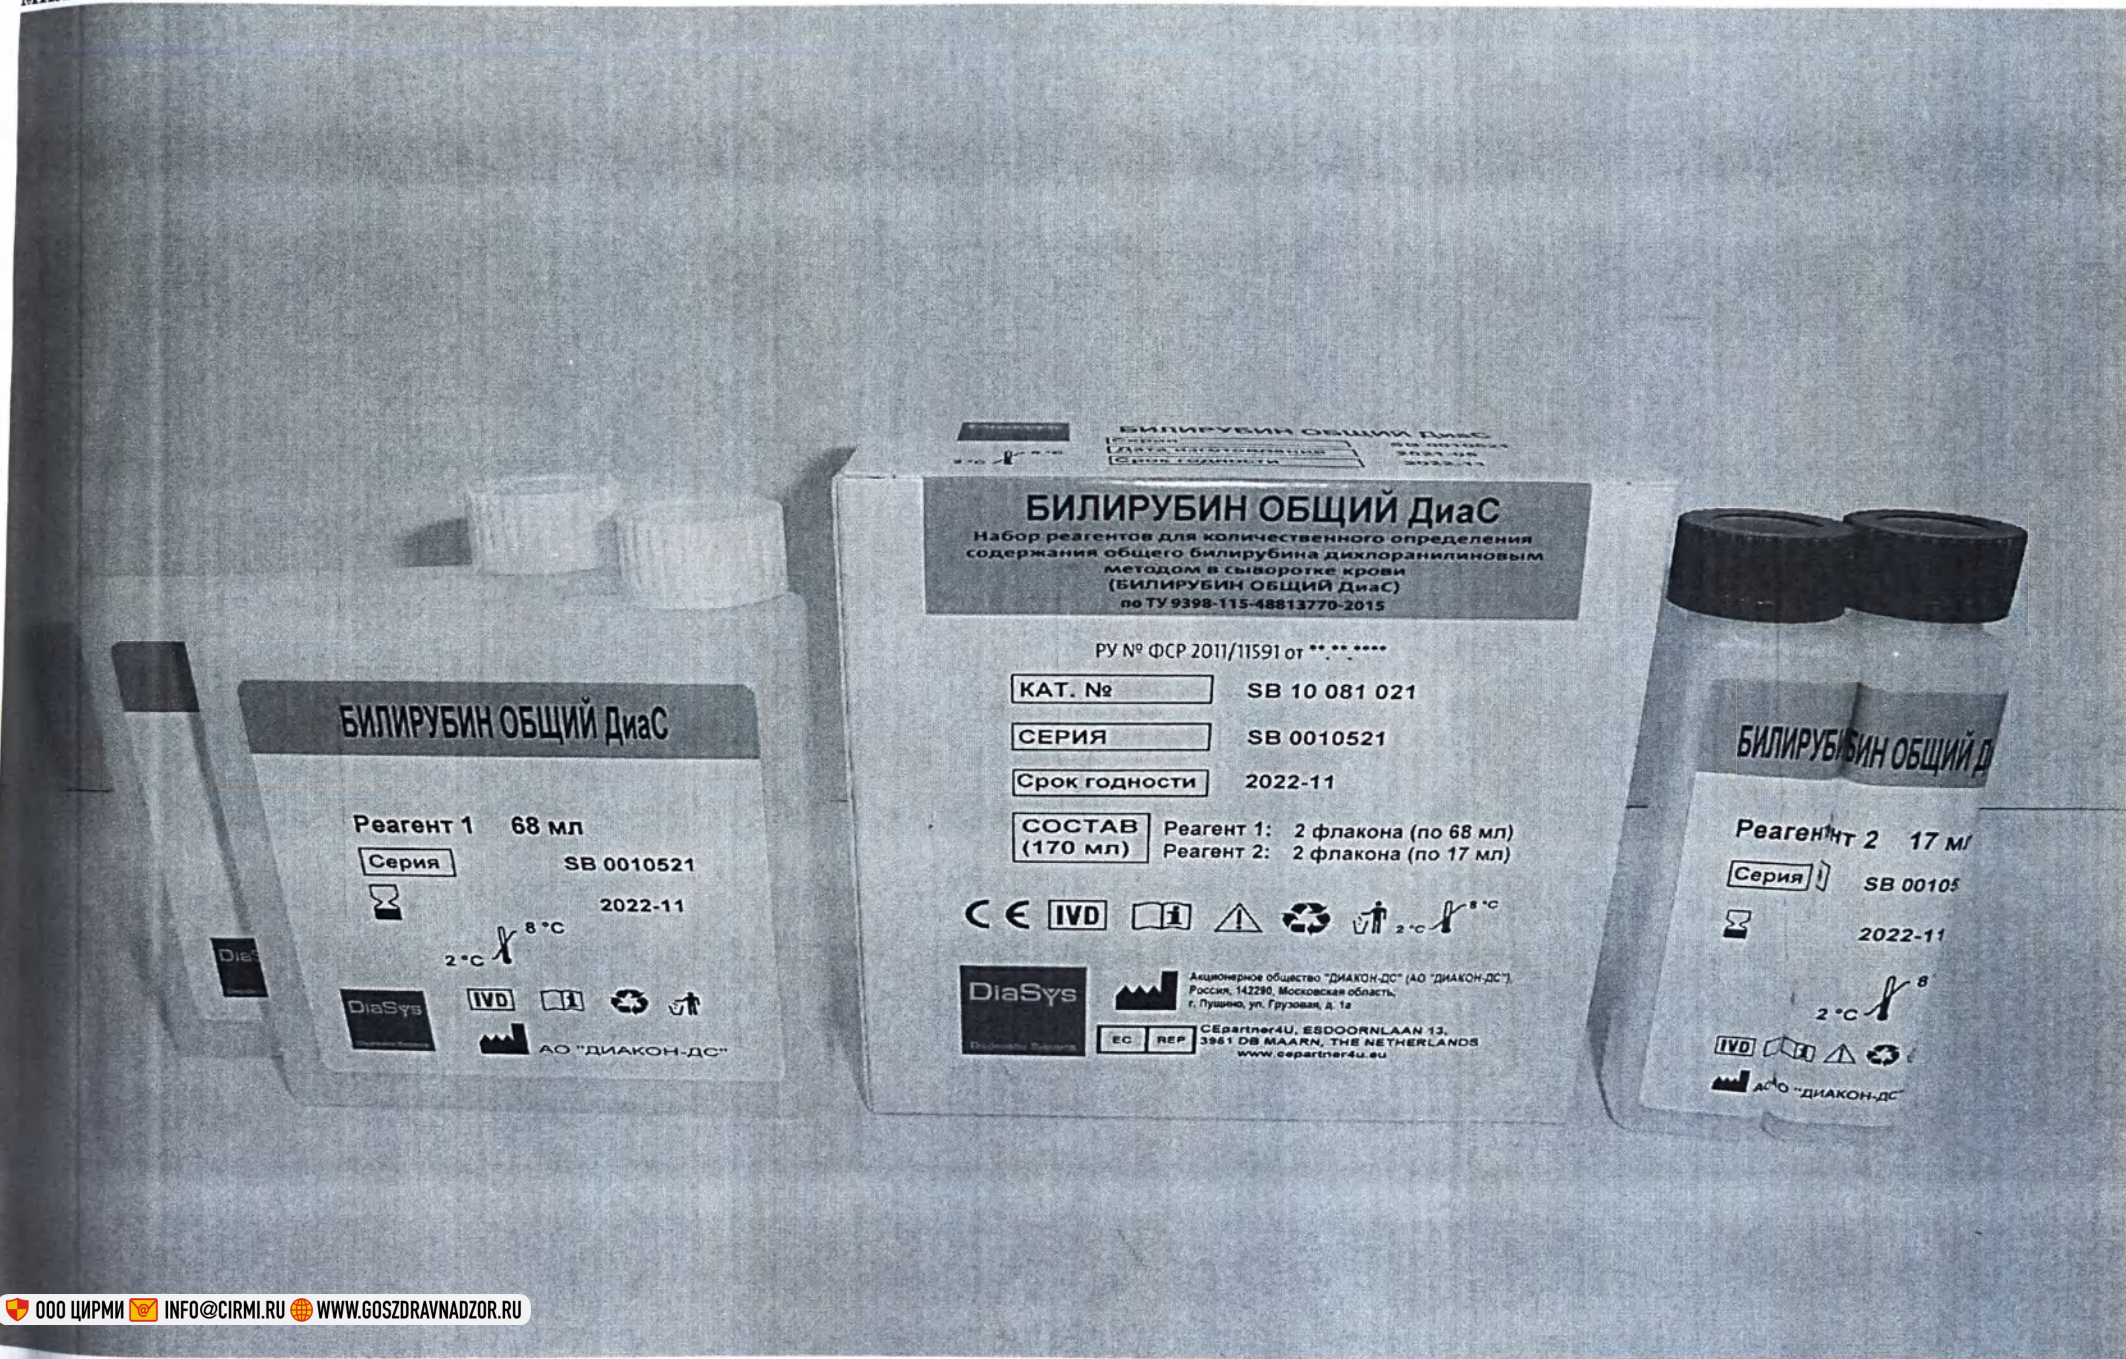

Набора реагентов для количественного определения содержания общего билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови (БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ДиаС) по ТУ 9398-115-48813770-2015

БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ДиаС
Набор реагентов для количественного определения содержания общего билирубина диоксиданилиновым методом в сыворотке крови (БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ДиаС) по ТУ 9398-115-48813770-2015

ПУ № ФСР 2011/11591 от **.*.****

КАТ. №	SB 10 081 022
СЕРИЯ	SB 0010521
Срок годности	2022-11

Состав
(510 мл) Реагент 1: 6 флаконов (по 68 мл)
Реагент 2: 6 флаконов (по 17 мл)

CE IVD

Акционерное общество "ДИАКОН-ДС" (АО "ДИАКОН-ДС"),
Россия, 142290, Московская область,
г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 12

СЕpartner4U, ESDOORNLAAN 13,
3861 DS MAARN, THE NETHERLANDS
www.separtner4u.eu

Реагент 1 68 мл
Серия SB 0010521
2022-11


Реагент 2 17 мл
Серия SB 0010521
2022-11

АО "ДИАКОН-ДС"

Внешний вид

Набора реагентов для количественного определения содержания общего билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови (БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ДиаС) по ТУ 9398-115-48813770-2015


Комплектация 5

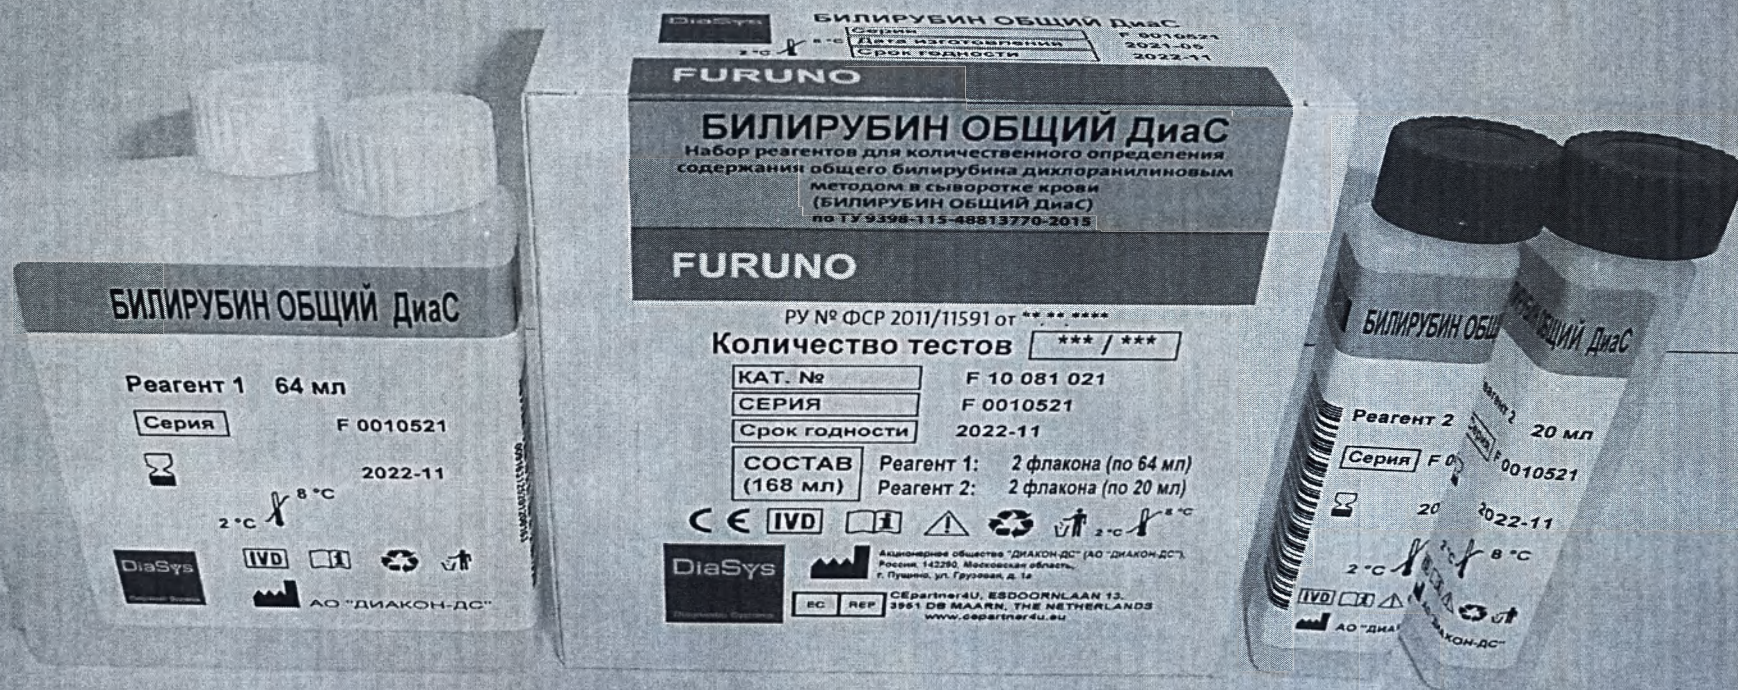

Внешний вид

Набора реагентов для количественного определения содержания общего билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови (БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ДиаС) по ТУ 9398-115-48813770-2015


Милектация 6 (1)

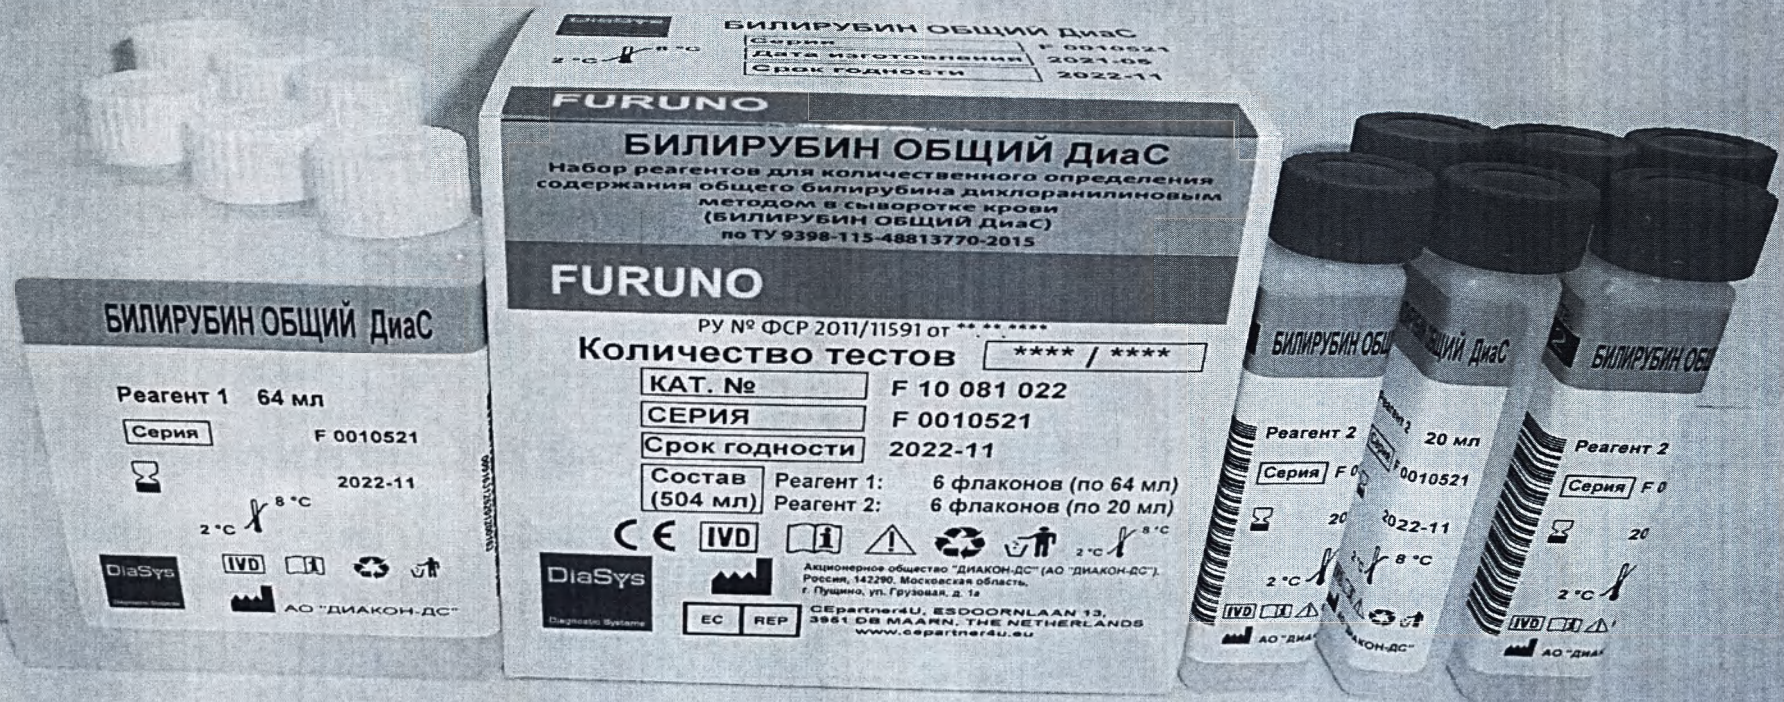

Внешний вид

Набора реагентов для количественного определения содержания общего билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови (БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ДиаС) по ТУ 9398-115-48813770-2015

Мплектация 6 (2)

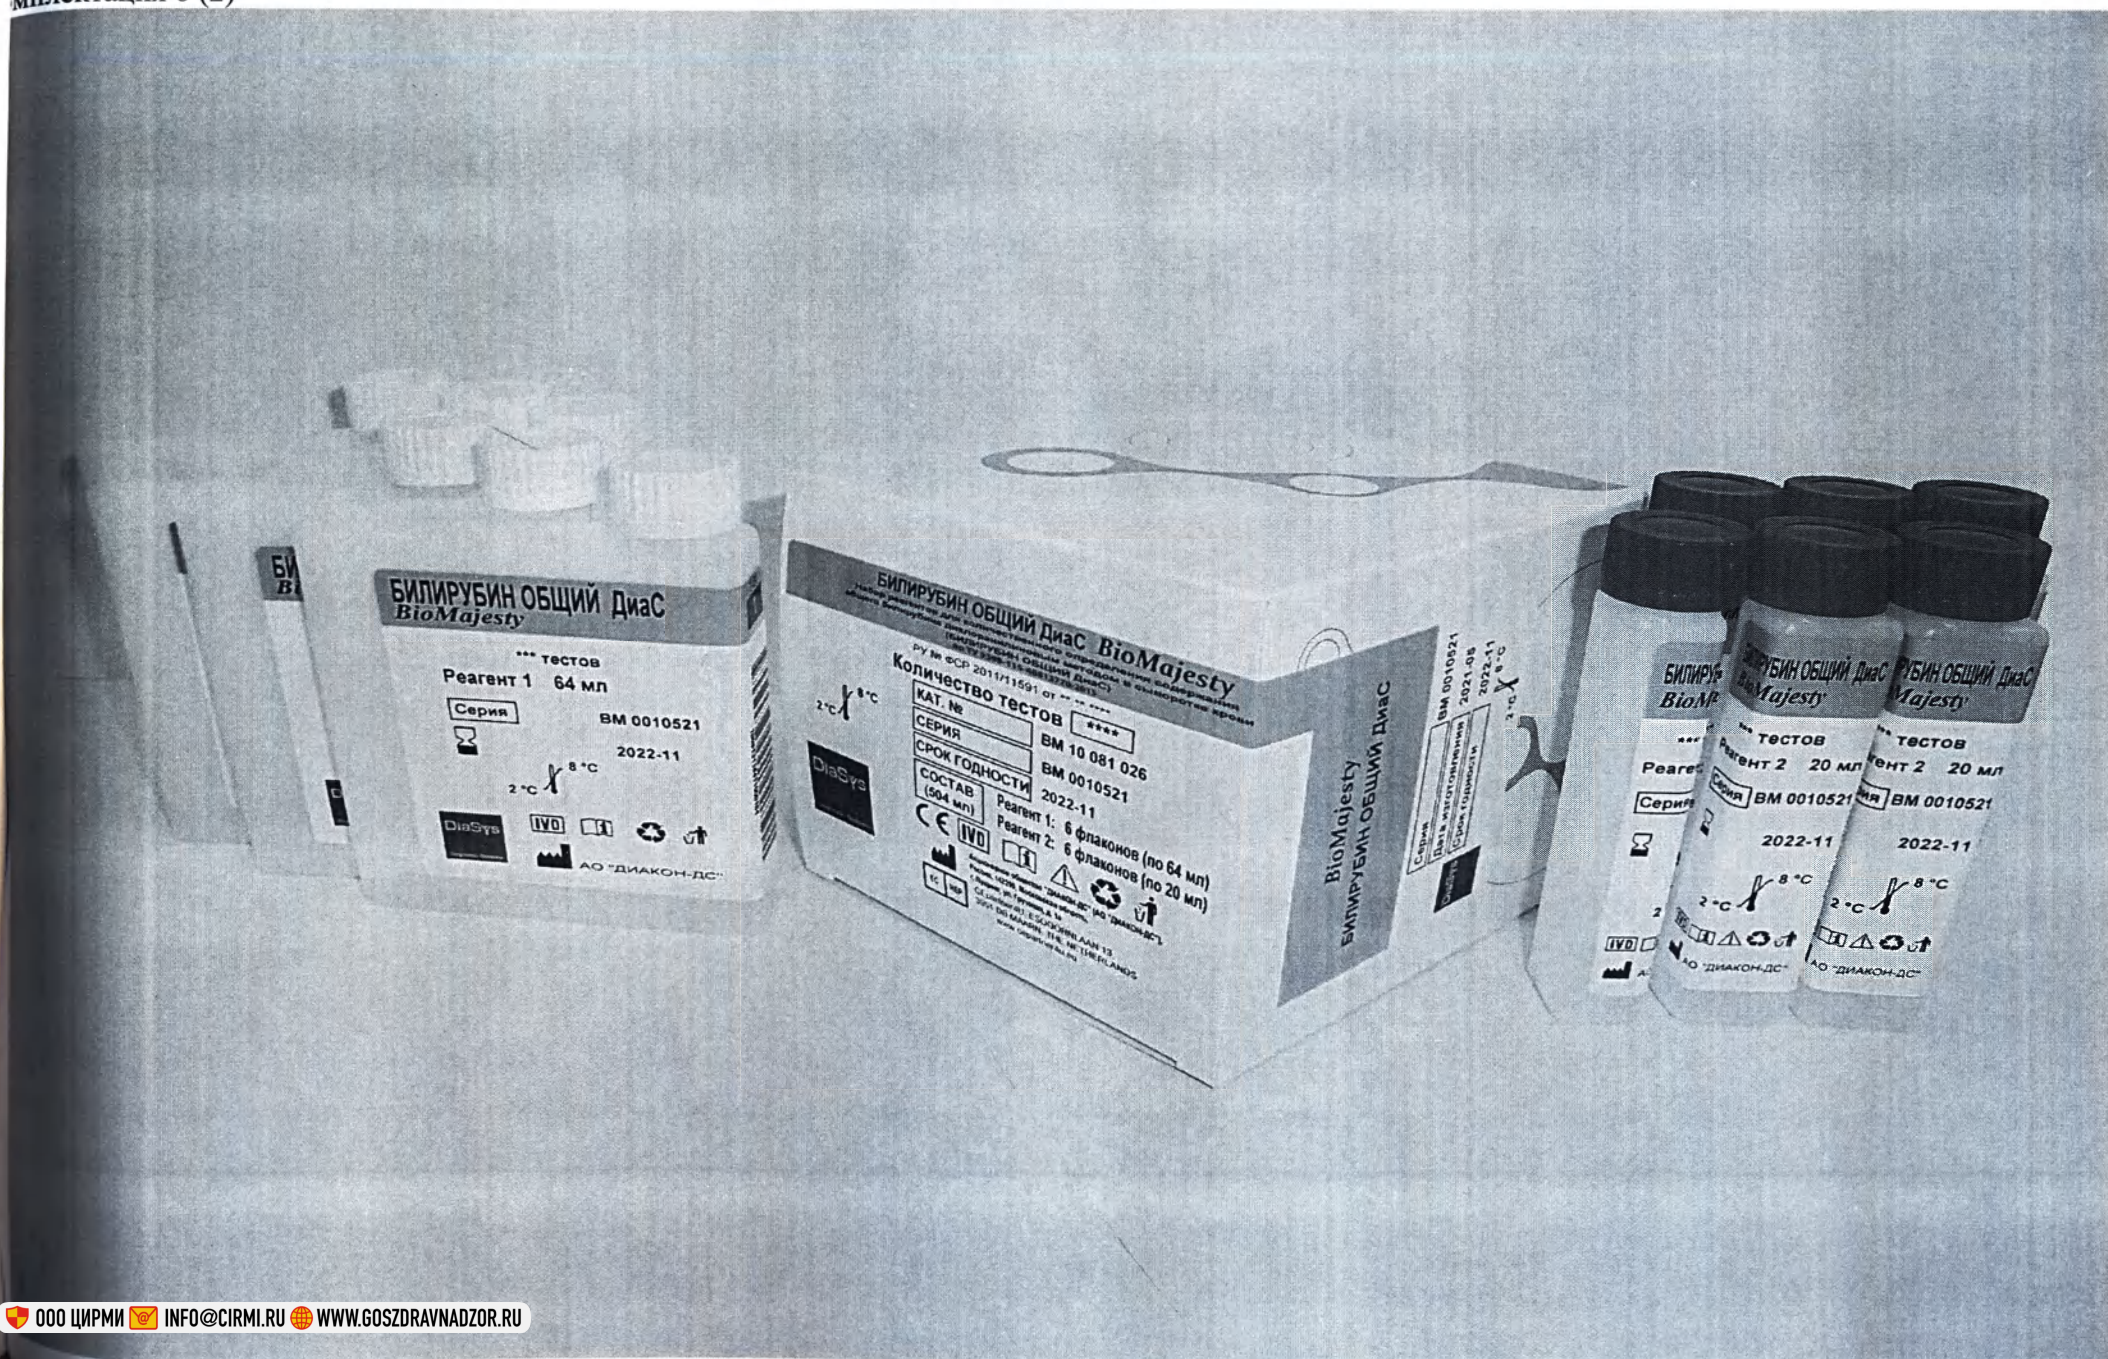

Набора реагентов для количественного определения содержания общего билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови (БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ДиаС) по ТУ 9398-115-48813770-2015

БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ДиаС

Набор реагентов для количественного определения содержания общего билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови (БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ДиаС) по ТУ 9398-115-48813770-2015

DIRUI CS-T240/CS-600B

ПУ № ФСР 2011/11591 от **/ **/ **

Количество тестов *** / ***

КАТ. №	D 10 081 021
СЕРИЯ	D 0010521
Срок годности	2022-11

СОСТАВ Реагент 1: 2 флакона (по 65 мл)
(170 мл) Реагент 2: 2 флакона (по 20 мл)

CE IVD **ISO 13485** **2-8°C**

DiaSys **EC REP** **ESOPartner4U** **ESOPartner4U**
Акционерное общество "ДИАКОН-ДС" (АО "ДИАКОН-ДС"),
Россия, 142280, Московская область,
г. Пушкино, ул. Грузовая д. 1а
www.esopartner4u.eu


Реагент 1 65 мл
Серия D 0010521
2022-11
2-8°C
ДиаС
ИВД
ISO 13485
АО "ДИАКОН-ДС"

Реагент 2 20 мл
Серия D 0010521
2022-11
2-8°C
ДиаС
ИВД
ISO 13485
АО "ДИАКОН-ДС"

Внешний вид

Набора реагентов для количественного определения содержания общего билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови (БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ДиаС) по ТУ 9398-115-48813770-2015

Комплектация 8

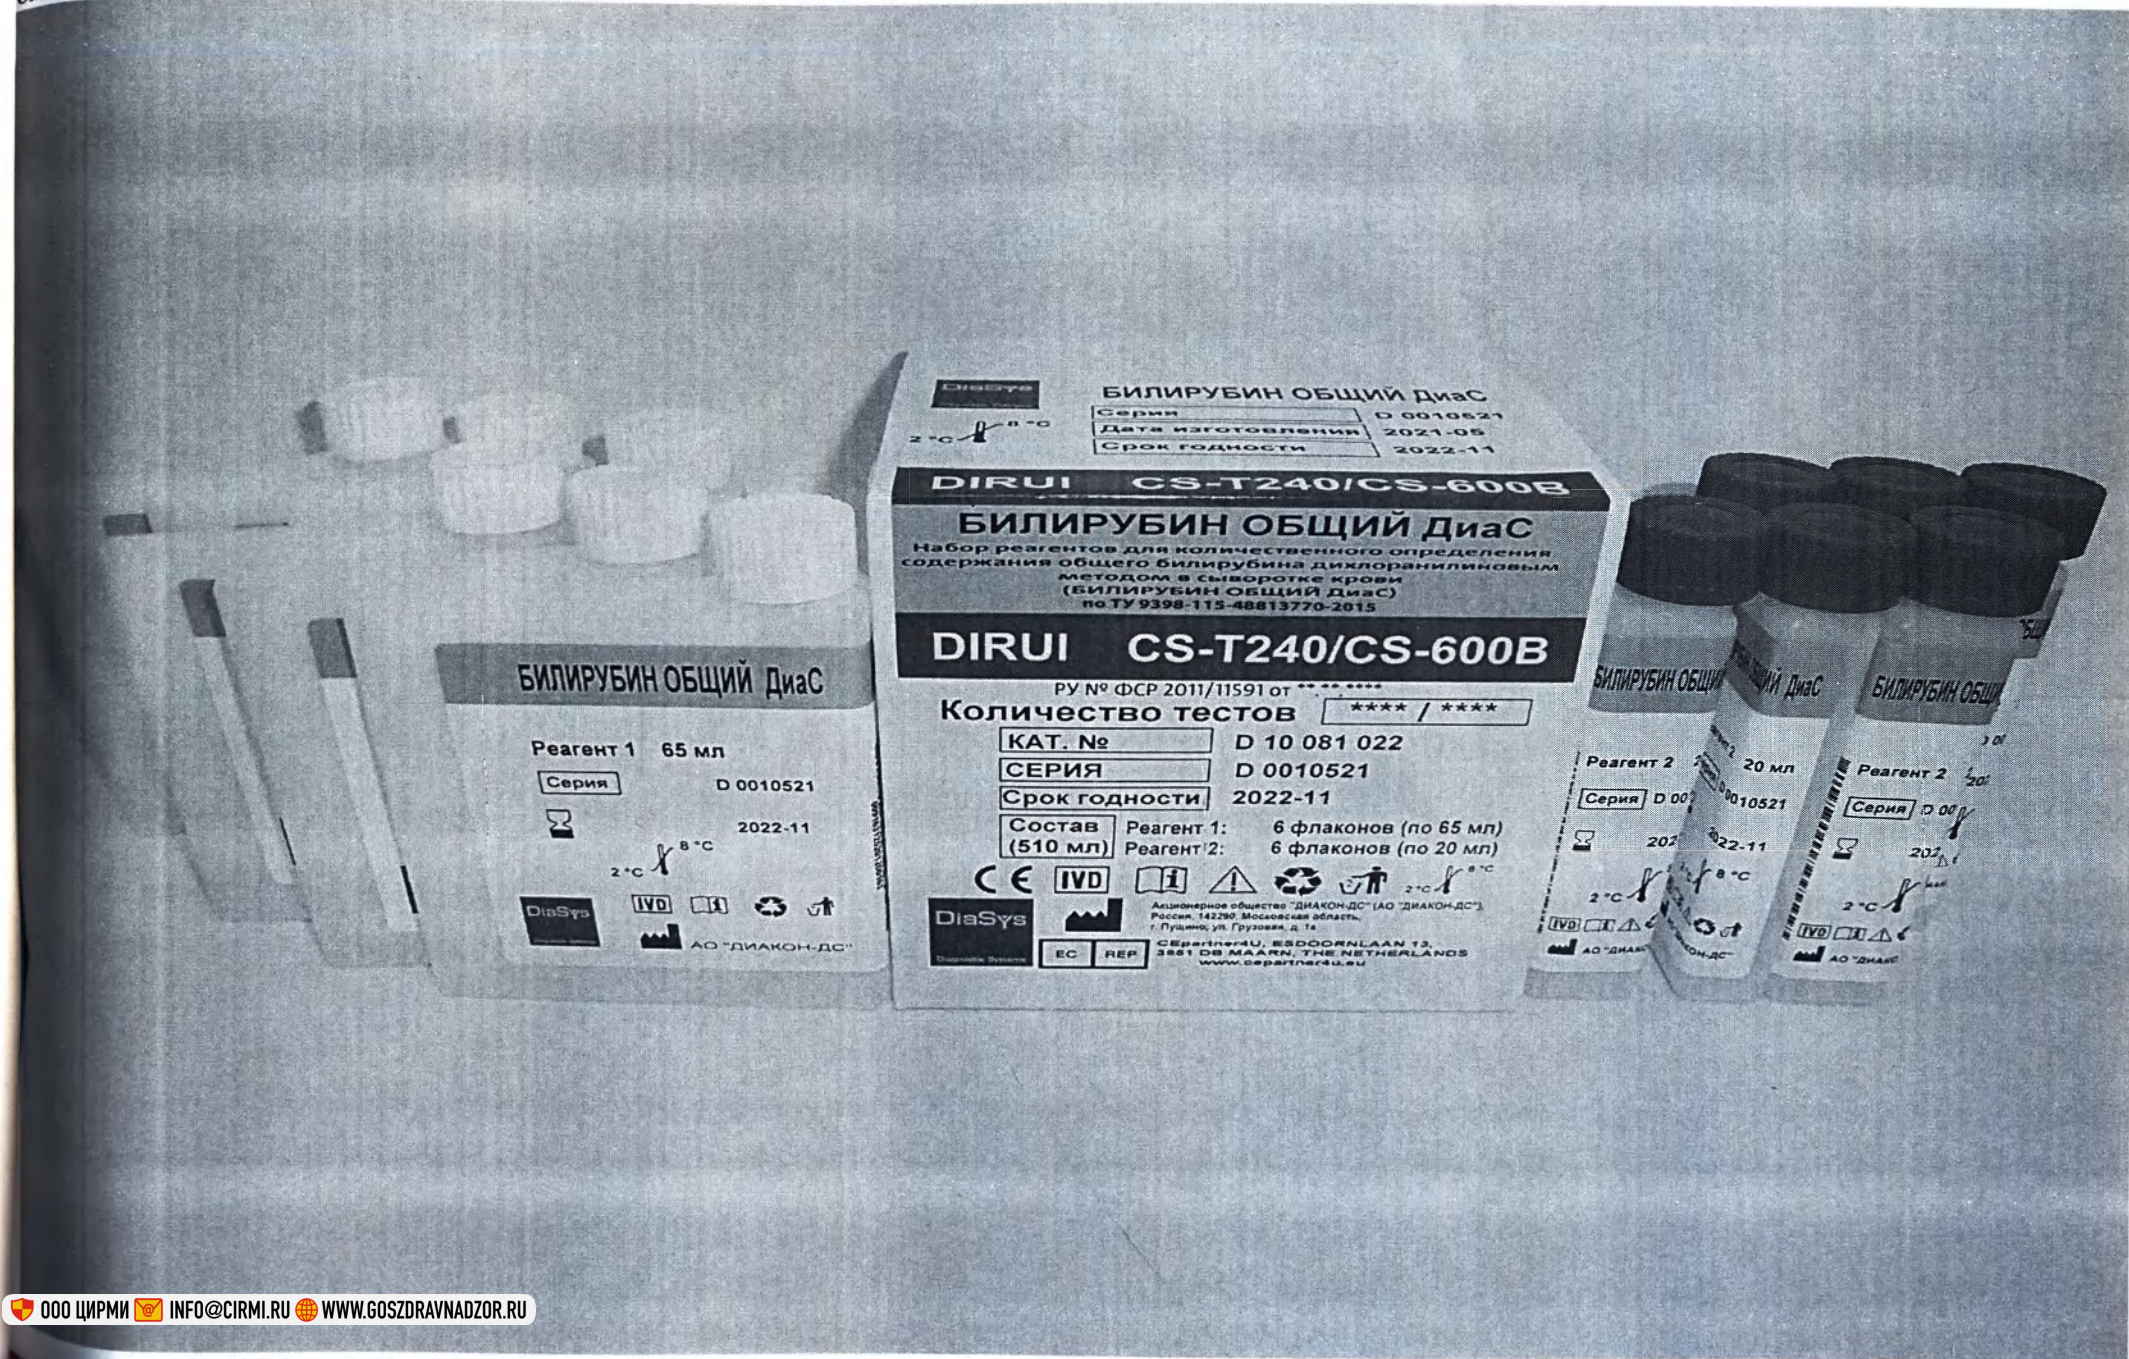

Внешний вид

Набора реагентов для количественного определения содержания общего билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови (БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ДиаС) по ТУ 9398-115-48813770-2015



Комплектация 9



Внешний вид

Набора реагентов для количественного определения содержания общего билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови (БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ДиаС) по ТУ 9398-115-48813770-2015


Комплектация 10

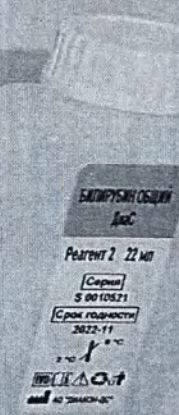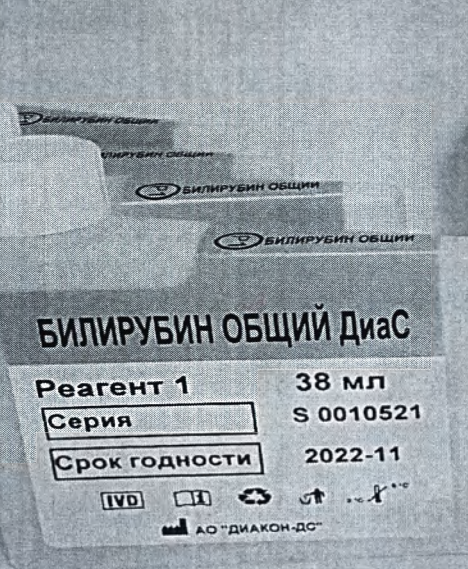

Внешний вид

Набора реагентов для количественного определения содержания общего билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови (БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ДиаС) по ТУ 9398-115-48813770-2015


Комплектация 11

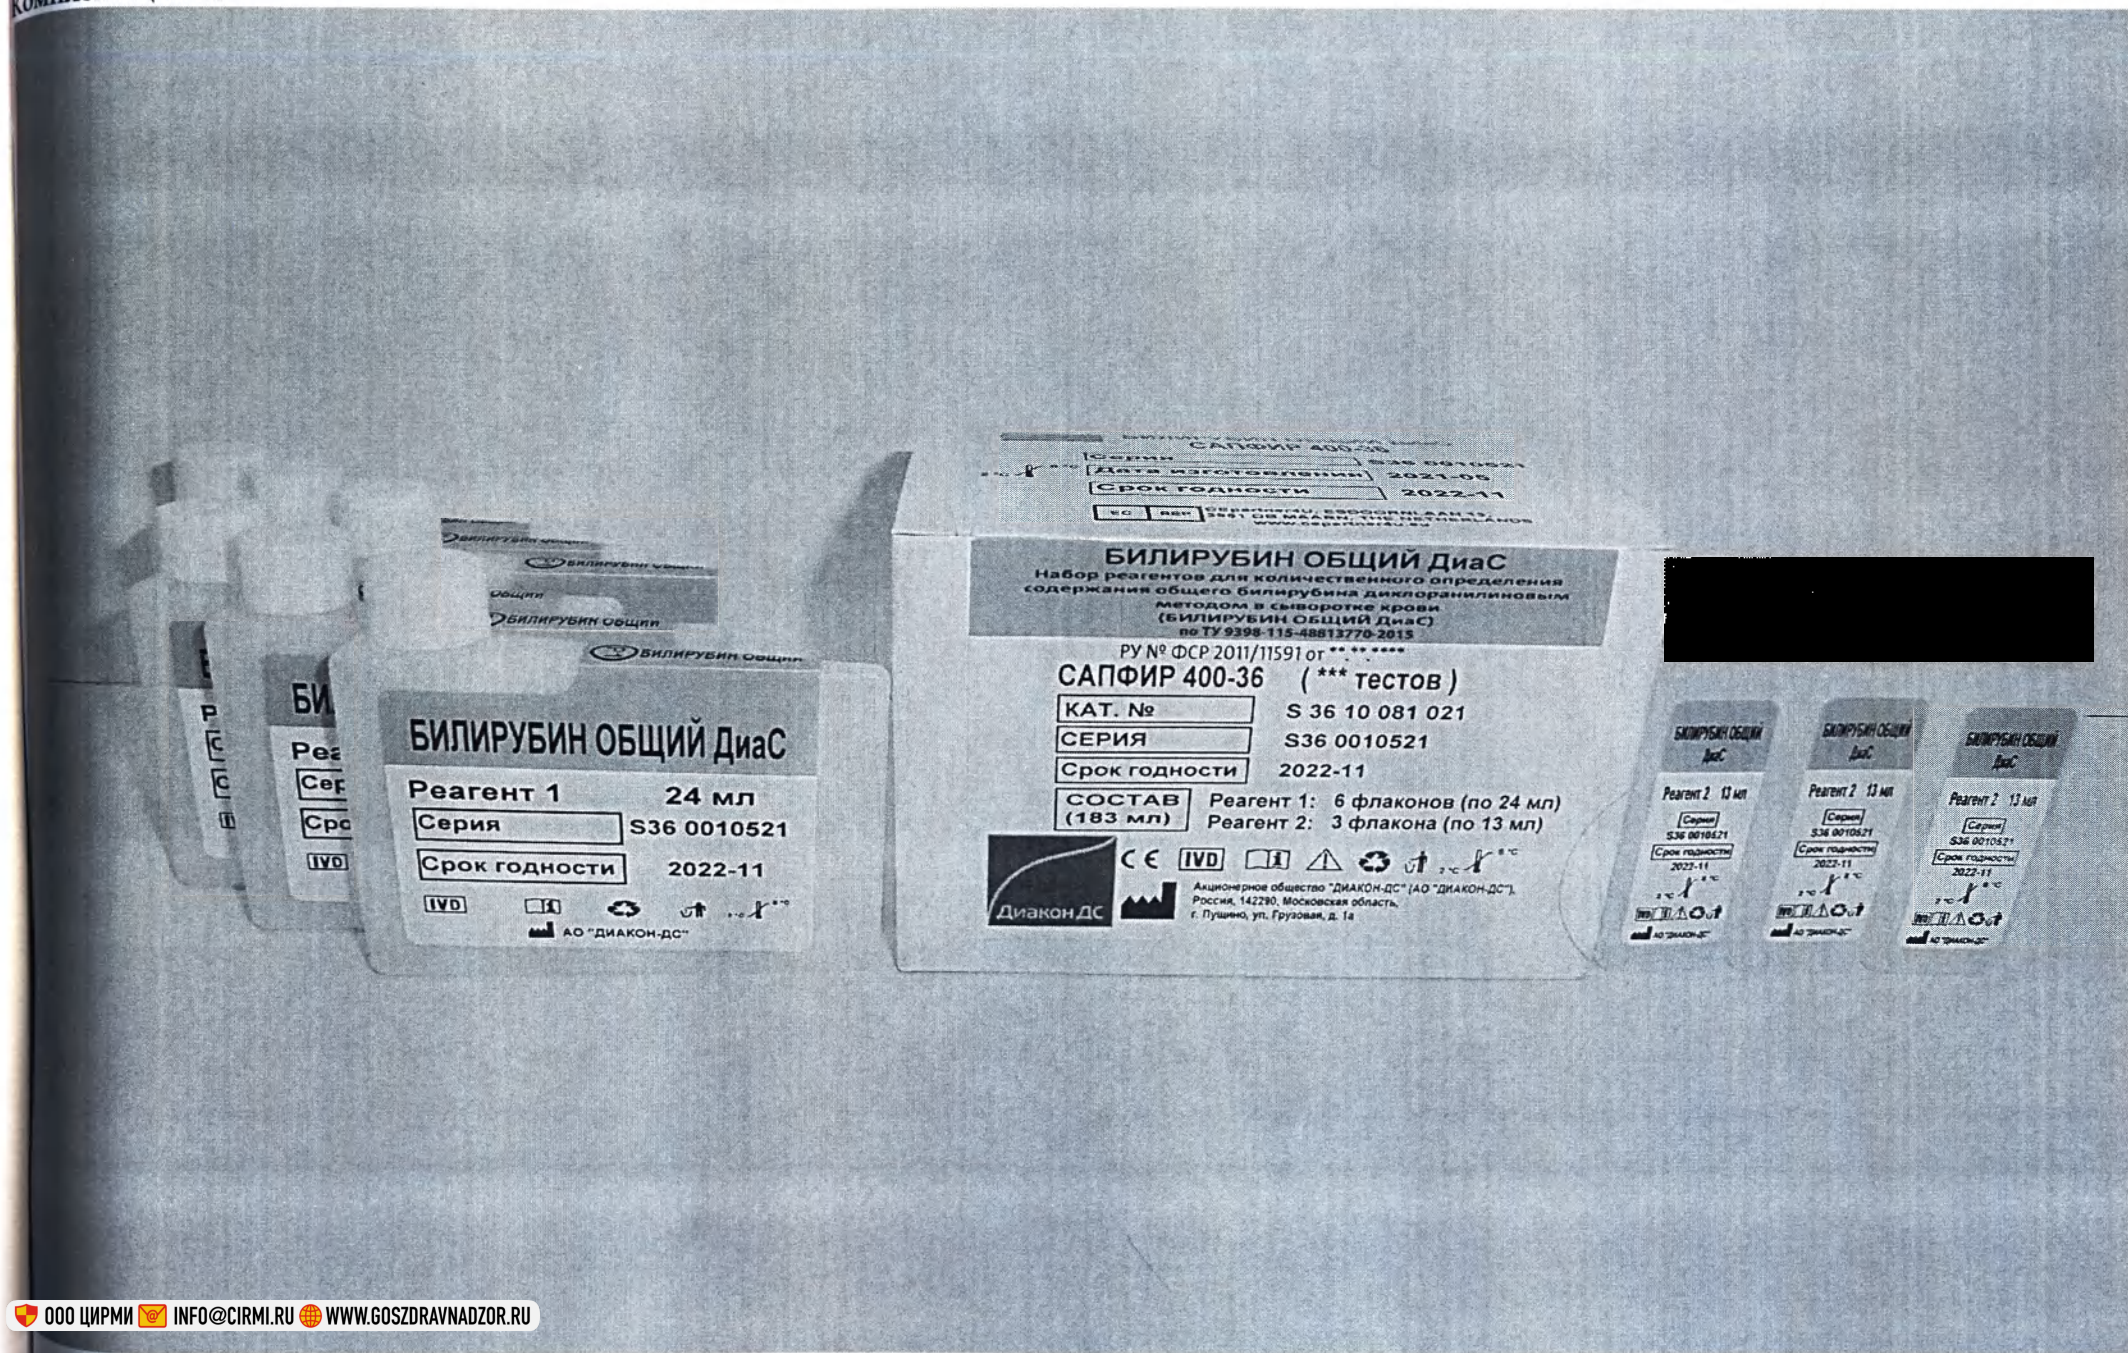

Внешний вид

Набора реагентов для количественного определения содержания общего билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови (БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ДиаС) по ТУ 9398-115-48813770-2015

Комплектация 12

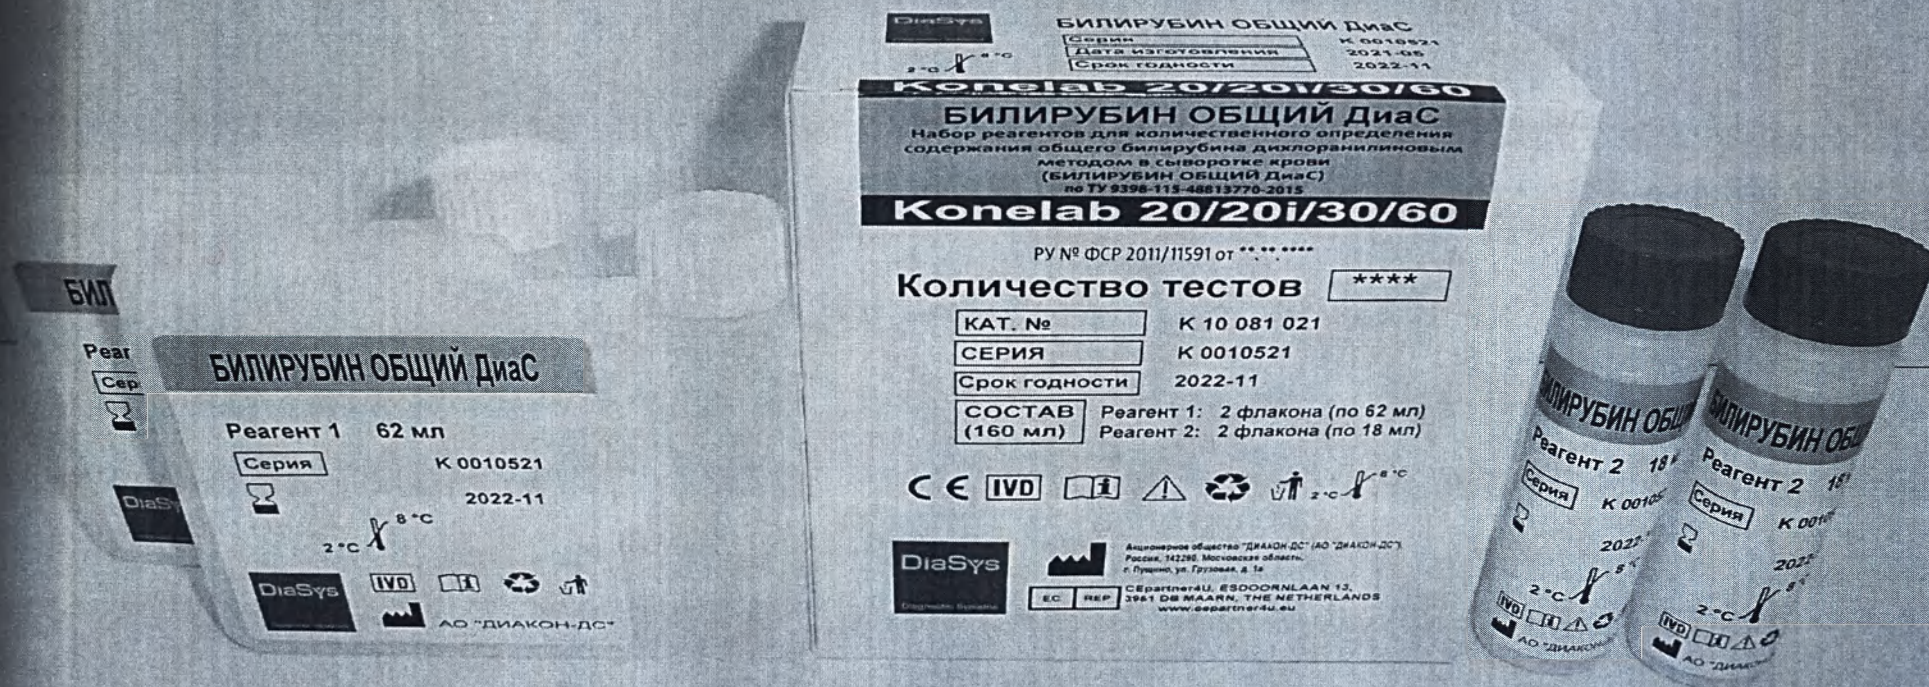

Внешний вид
Набора реагентов для количественного определения содержания общего билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови (БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ДиаС) по ТУ 9398-115-48813770-2015

РУ № ФСР 2011/11591 от **.**.****

Количество тестов ★★★★

КАТ. №	К 10 081 022
СЕРИЯ	К 0010521
Срок годности	2022-11

Состав (400 мл)	Реагент 1: 5 флаконов (по 62 мл) Реагент 2: 5 флаконов (по 18 мл)
--------------------	--

DiaSys       $z^{\circ}C$ $k^{\circ}C$

Агентское общество "ДИАКОМ-ДС" (АО "ДИАКОМ-ДС"),
Россия, 142280, Московская область,
г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1а

Акционерное общество "ДИАКОН-ДС" (АО "ДИАКОН-ДС"),
Россия, 142290, Московская область,
г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1а


[illegible]

The image shows four vials of Bilirubin Reagent 2, 18% (Билирубин Общ. Реагент 2 18%) from AO 'Diamid'. Each vial has a black cap and a white label with black text. The label includes the product name in Russian, 'Реагент 2 18%', a serial number (Серия К 00108), a lot number (2022), and a temperature range (2°C to 30°C). The vials are arranged in a row, slightly overlapping.

Внешний вид


Набора реагентов для количественного определения содержания общего билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови (БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ДиаС) по ТУ 9398-115-48813770-2015

Комплектация 14 (1)

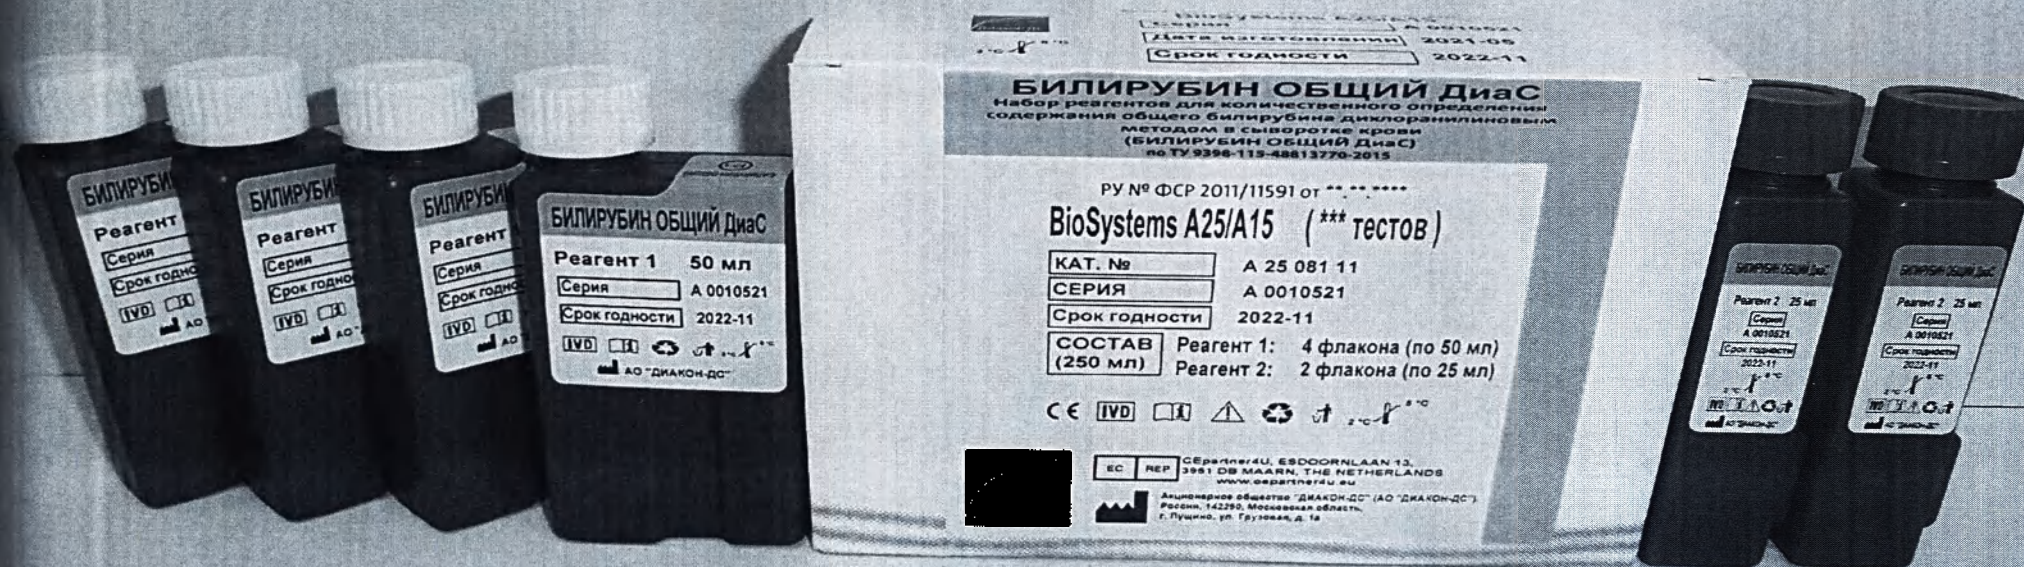

Внешний вид
Набора реагентов для количественного определения содержания общего билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ДиаС) по ТУ 9398-115-48813770-2015


Комплектация 14 (2)

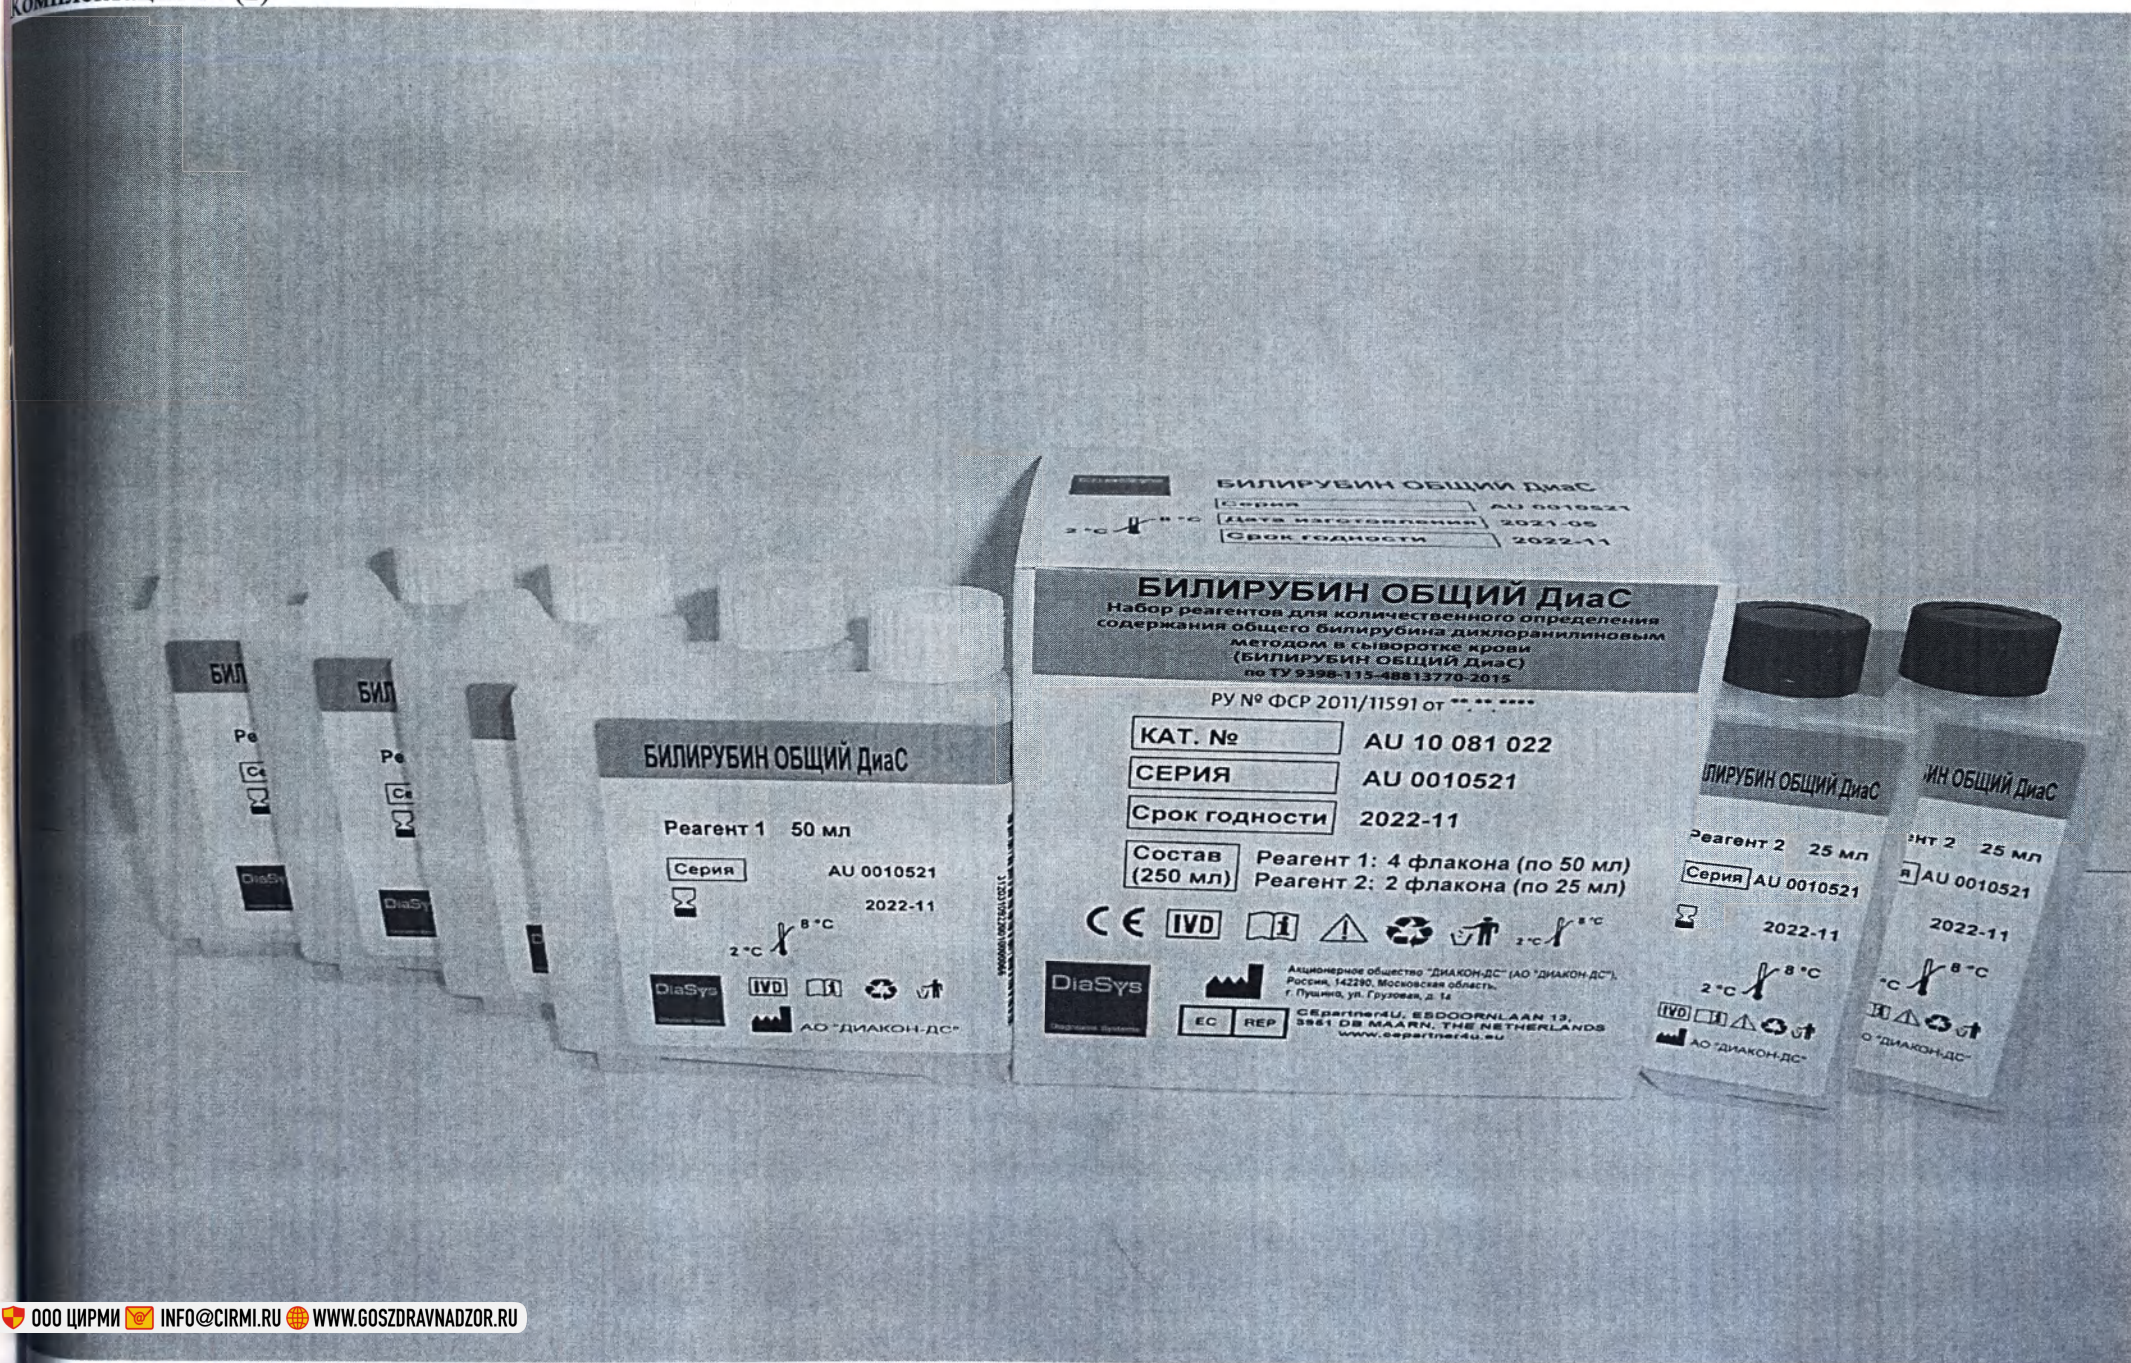

Внешний вид

Набора реагентов для количественного определения содержания общего билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови (БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ДиаС) по ТУ 9398-115-48813770-2015

Комплектация 15

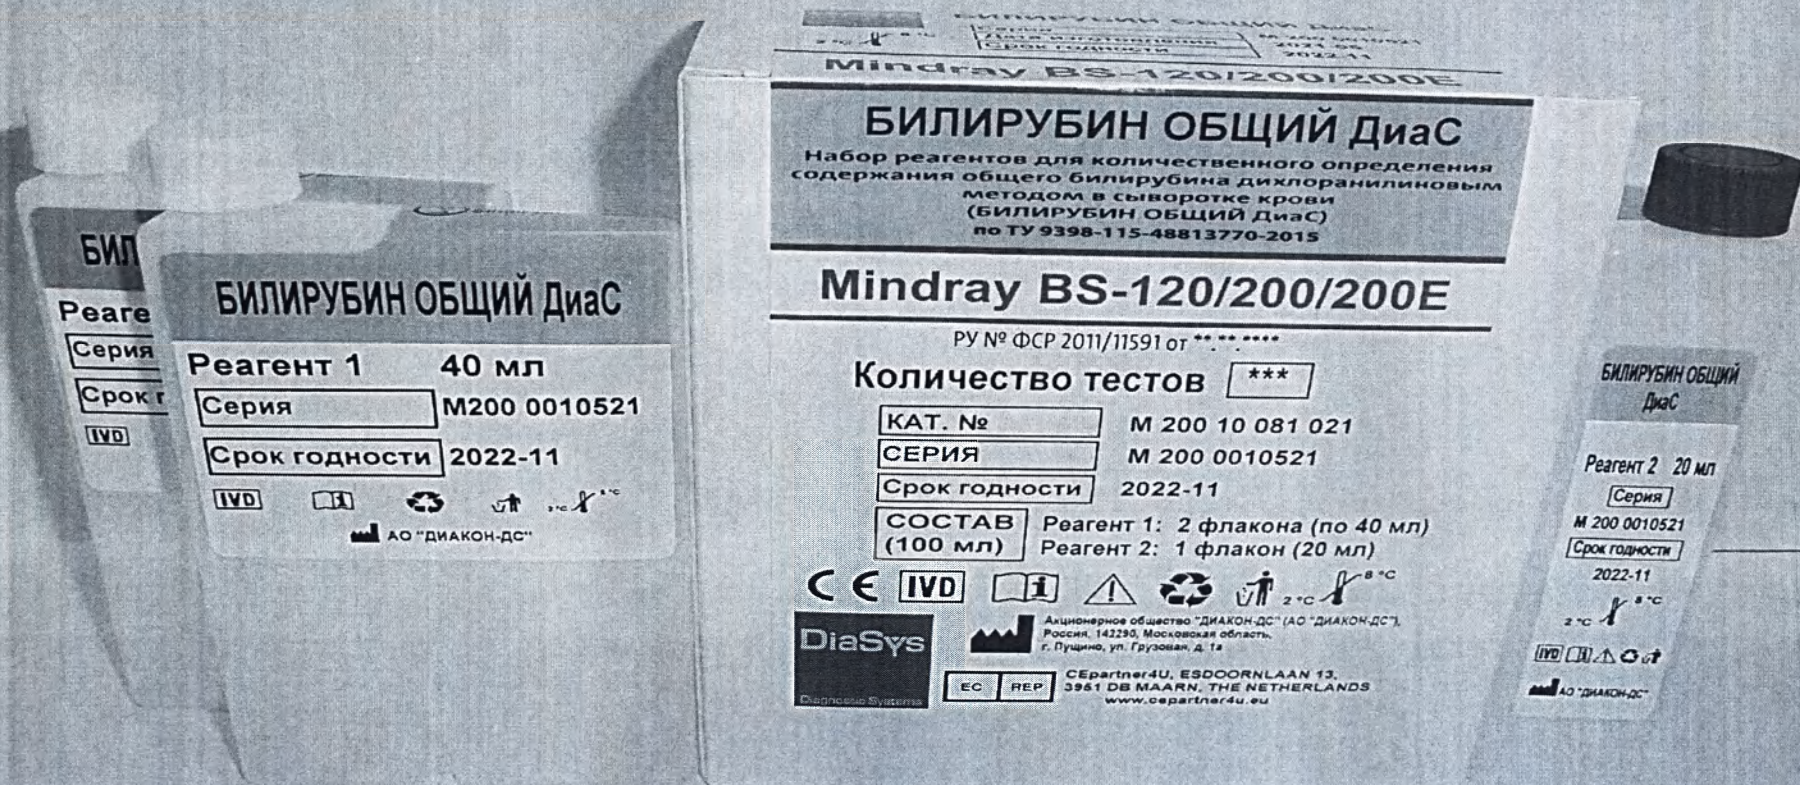

БИЛ

Реаге

Серия

Срок г

IVD

БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ДиаС

Реагент 1 40 мл

Серия M200 0010521

Срок годности 2022-11

IVD

1

2

3

4

5

АО "ДИАКОН-ДС"

Mindray BS-120/200/200E

БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ДиаС

Набор реагентов для количественного определения содержания общего билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови (БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ДиаС) по ТУ 9398-115-48813770-2015

Mindray BS-120/200/200E

ПУ № ФСР 2011/11591 от **.*.***

Количество тестов ***

КАТ. №

M 200 10 081 021

СЕРИЯ

M 200 0010521

Срок годности

2022-11

СОСТАВ (100 мл)

Реагент 1: 2 флакона (по 40 мл)
Реагент 2: 1 флакон (20 мл)

CE

IVD

1

2

3

4

5

DiaSys

1

2

3

4

5

Акционерное общество "ДИАКОН-ДС" (АО "ДИАКОН-ДС"),
Россия, 142290, Московская область,
г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а

EC REP

CEpartner4U, ESDOORNLAAN 13,
3951 DB MAARN, THE NETHERLANDS
www.cepartner4u.eu

БИЛИРУБИН ОБЩИЙ
ДиаС

Реагент 2 20 мл

Серия

M 200 0010521

Срок годности

2022-11

2 °C

IVD

1

2

3

4

АО "ДИАКОН-ДС"

Внешний вид

Набора реагентов для количественного определения содержания общего билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови (БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ДиаС) по ТУ 9398-115-48813770-2015


Комплектация 16



Внешний вид

Набора реагентов для количественного определения содержания общего билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови (БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ДиаС) по ТУ 9398-115-48813770-2015


Комплектация 17

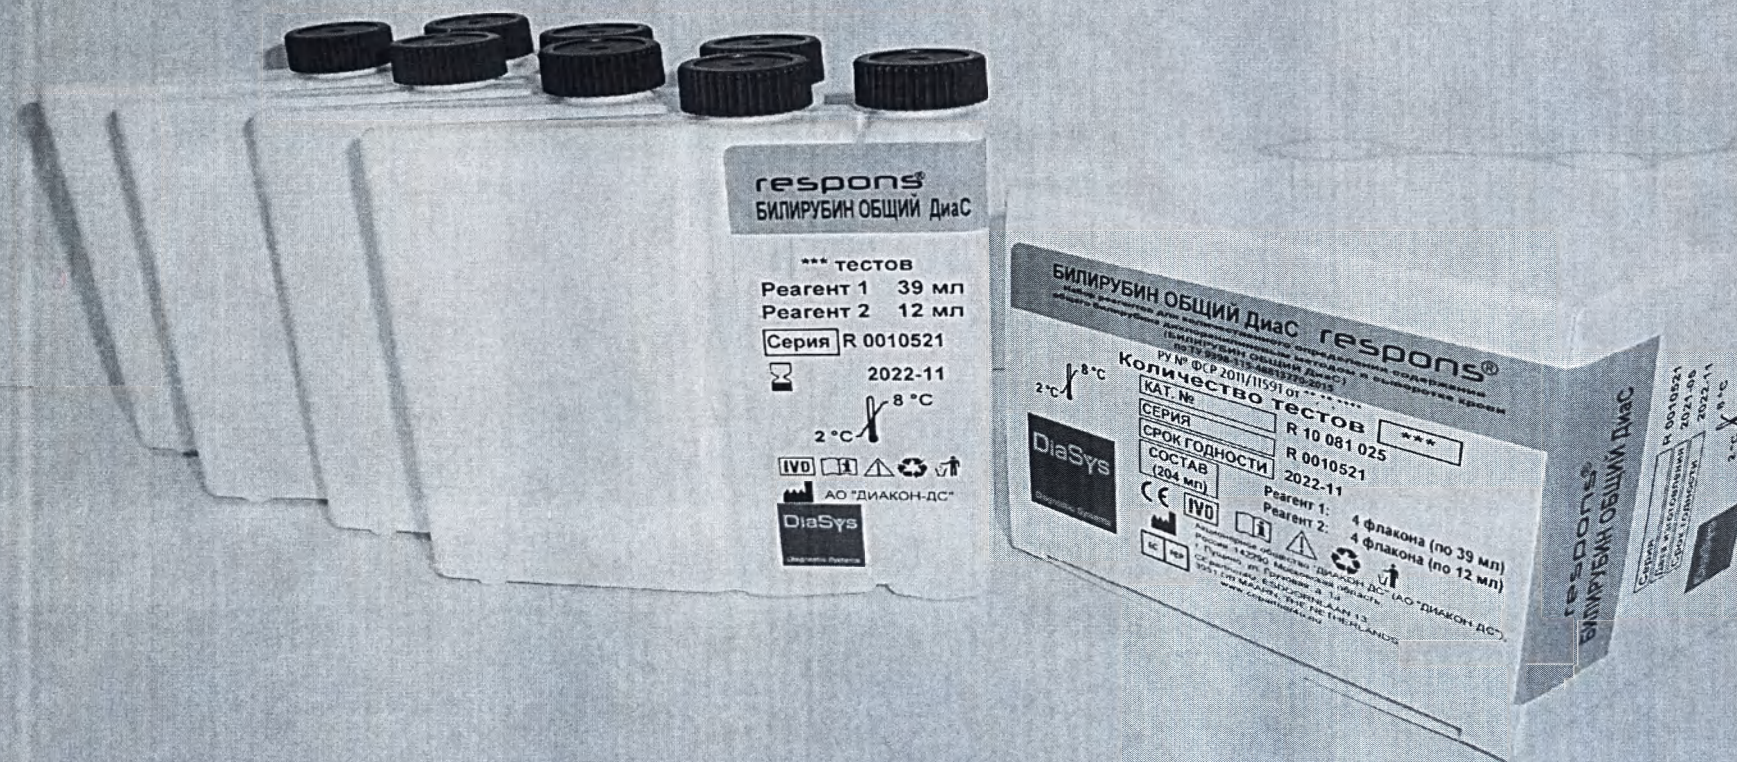

Внешний вид

Набора реагентов для количественного определения содержания общего билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови (БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ДиаС) по ТУ 9398-115-48813770-2015


Комплектация 18

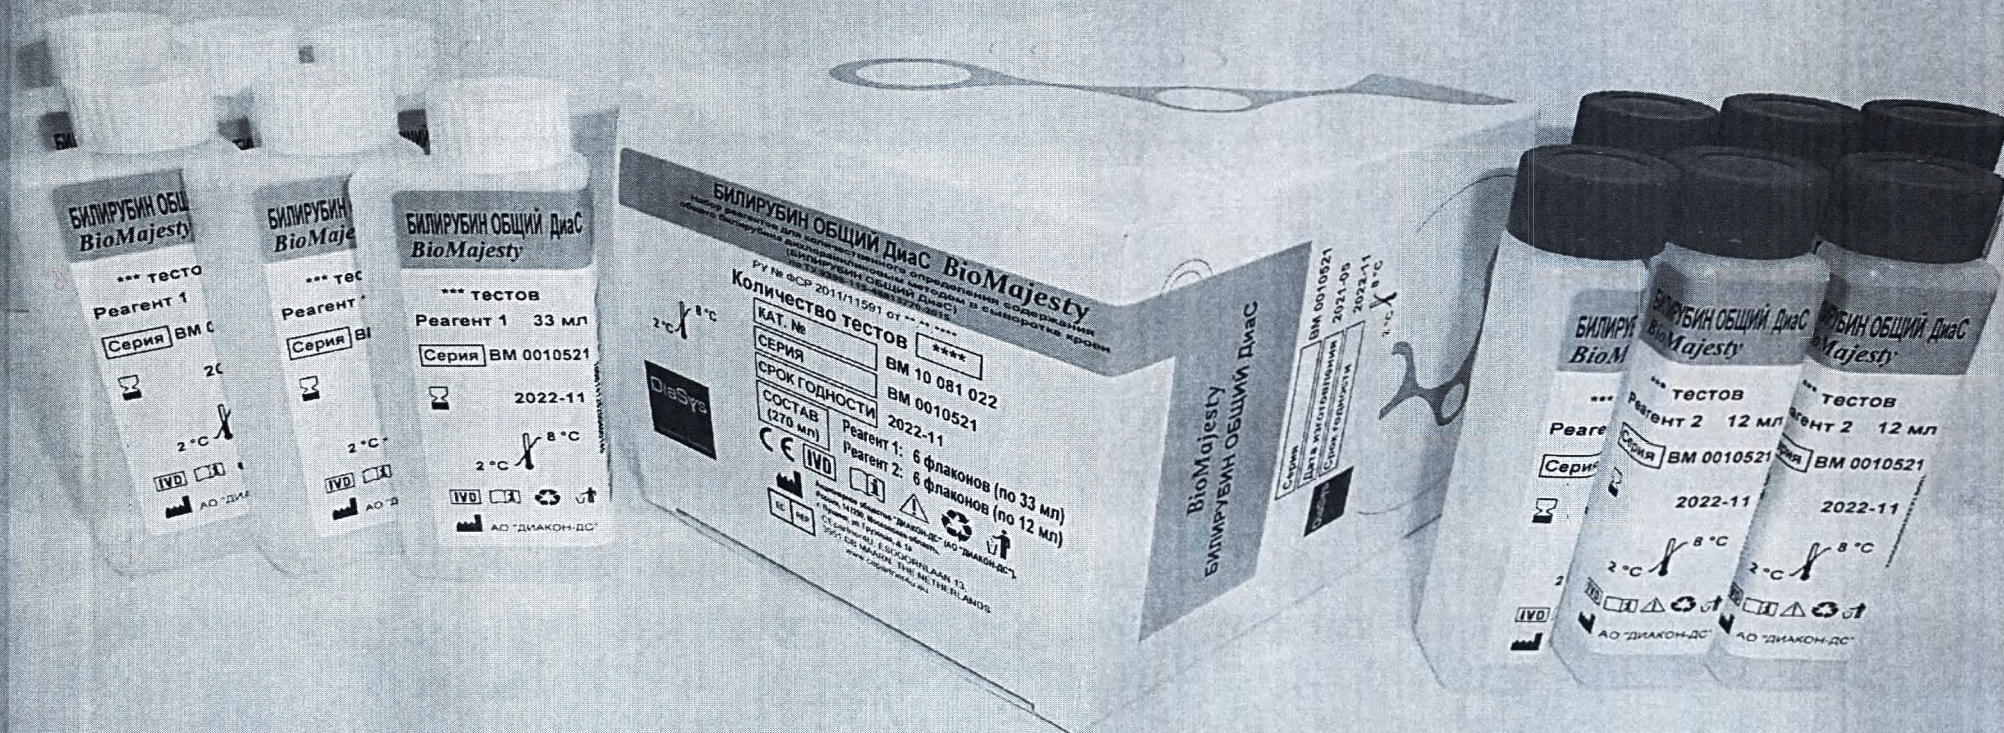

Внешний вид

Набора реагентов для количественного определения содержания общего билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови (БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ДиаС) по ТУ 9398-115-48813770-2015

Комплектация 19

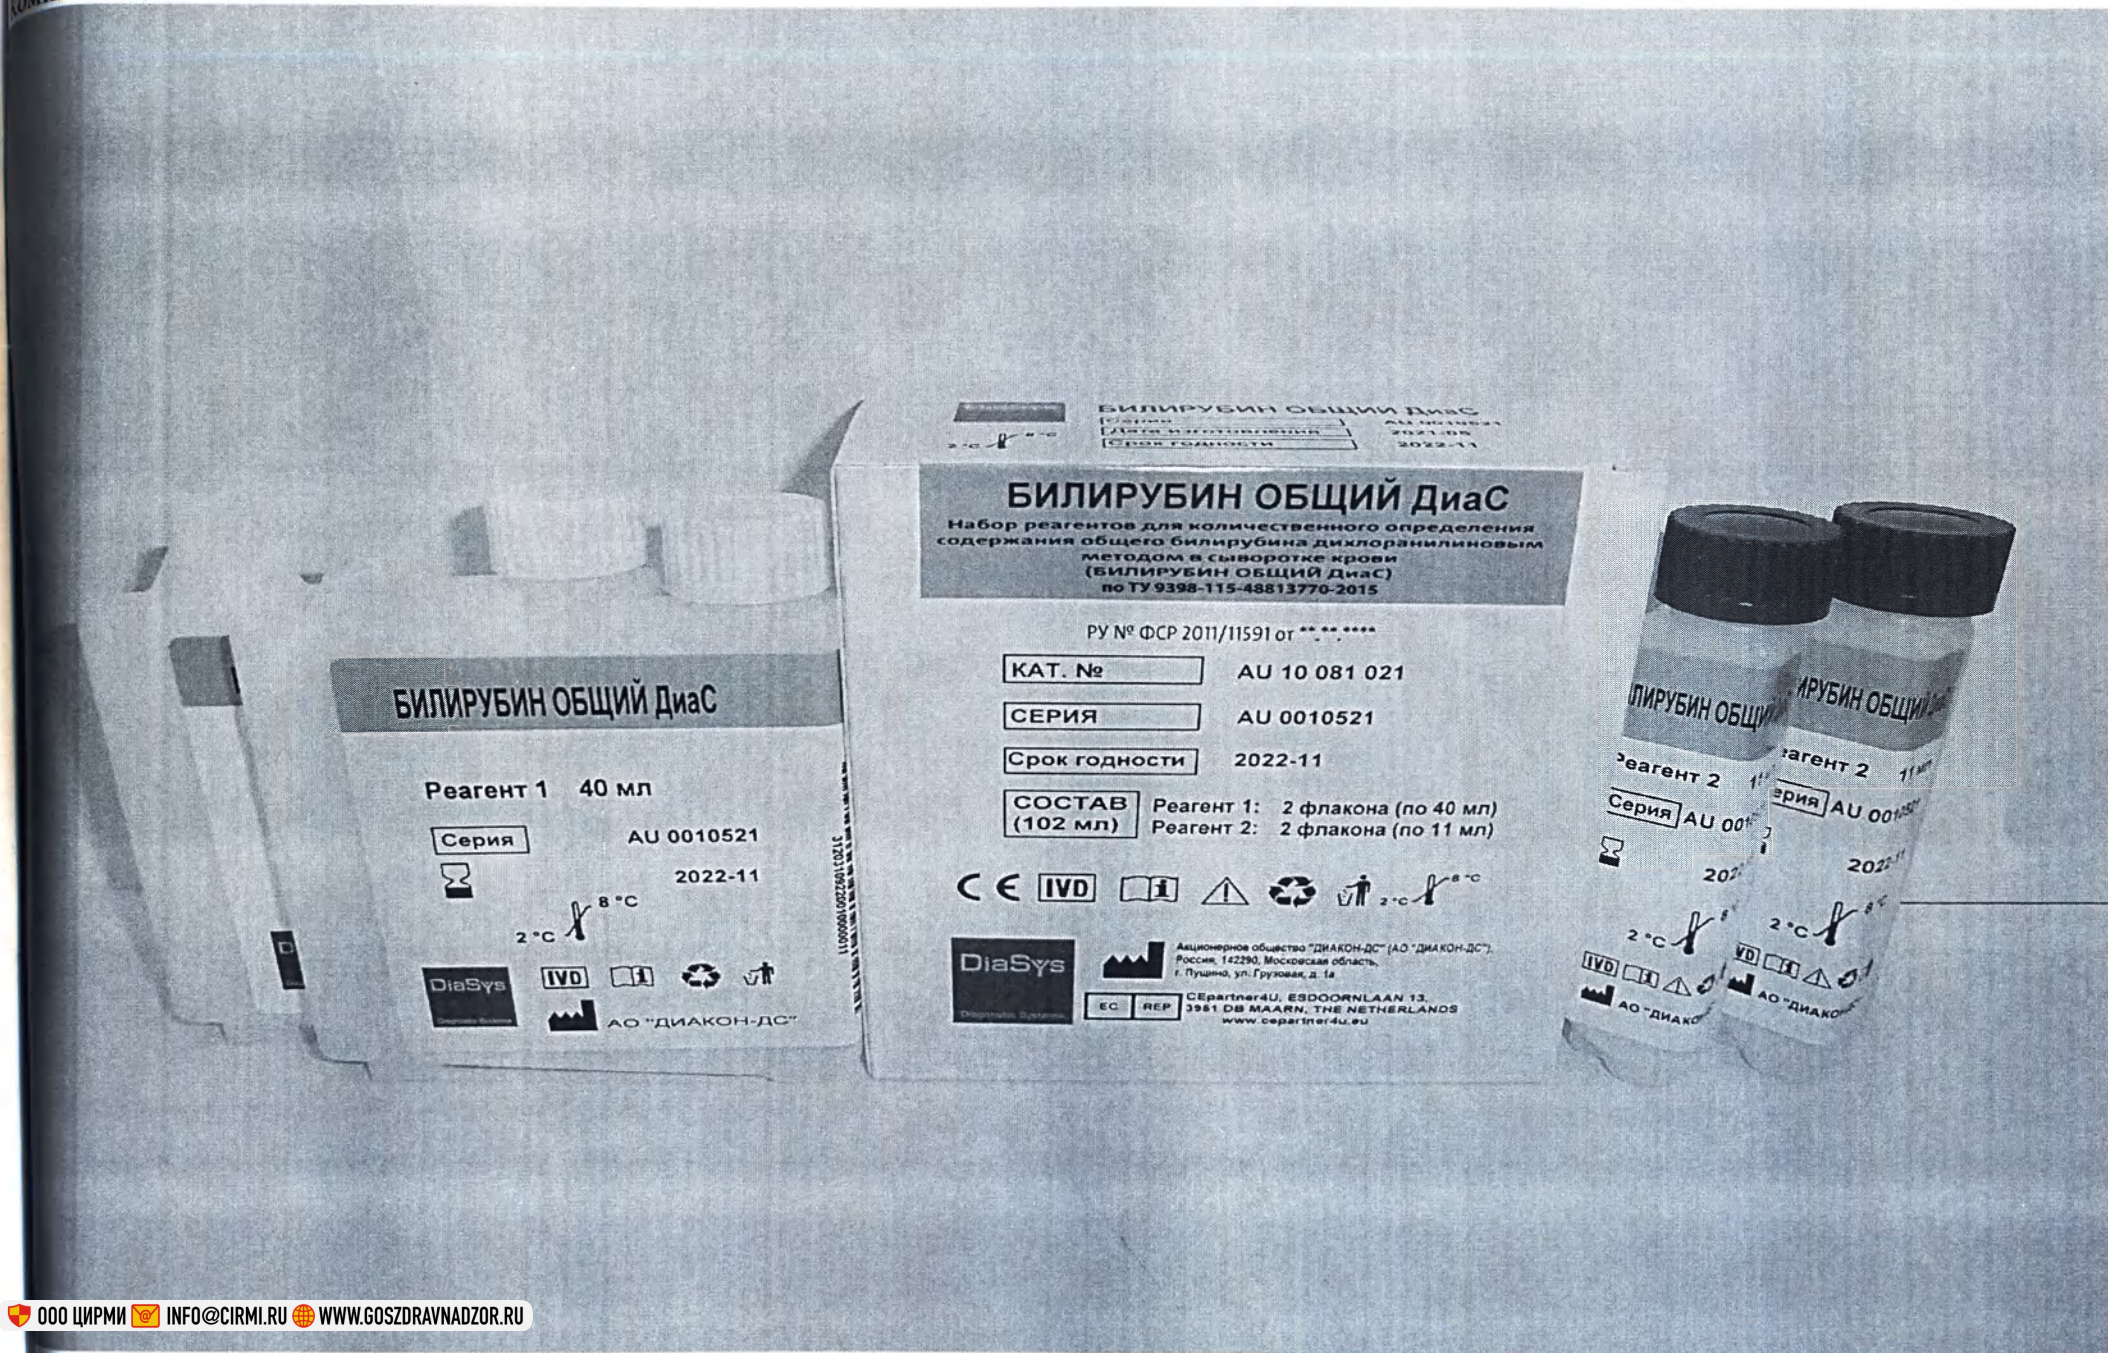


Набора реагентов для количественного определения содержания общего билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови (БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ДиаС) по ТУ 9398-115-48813770-2015

Внешний вид

Набора реагентов для количественного определения содержания общего билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови (БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ДиаС) по ТУ 9398-115-48813770-2015

Комплектация 21

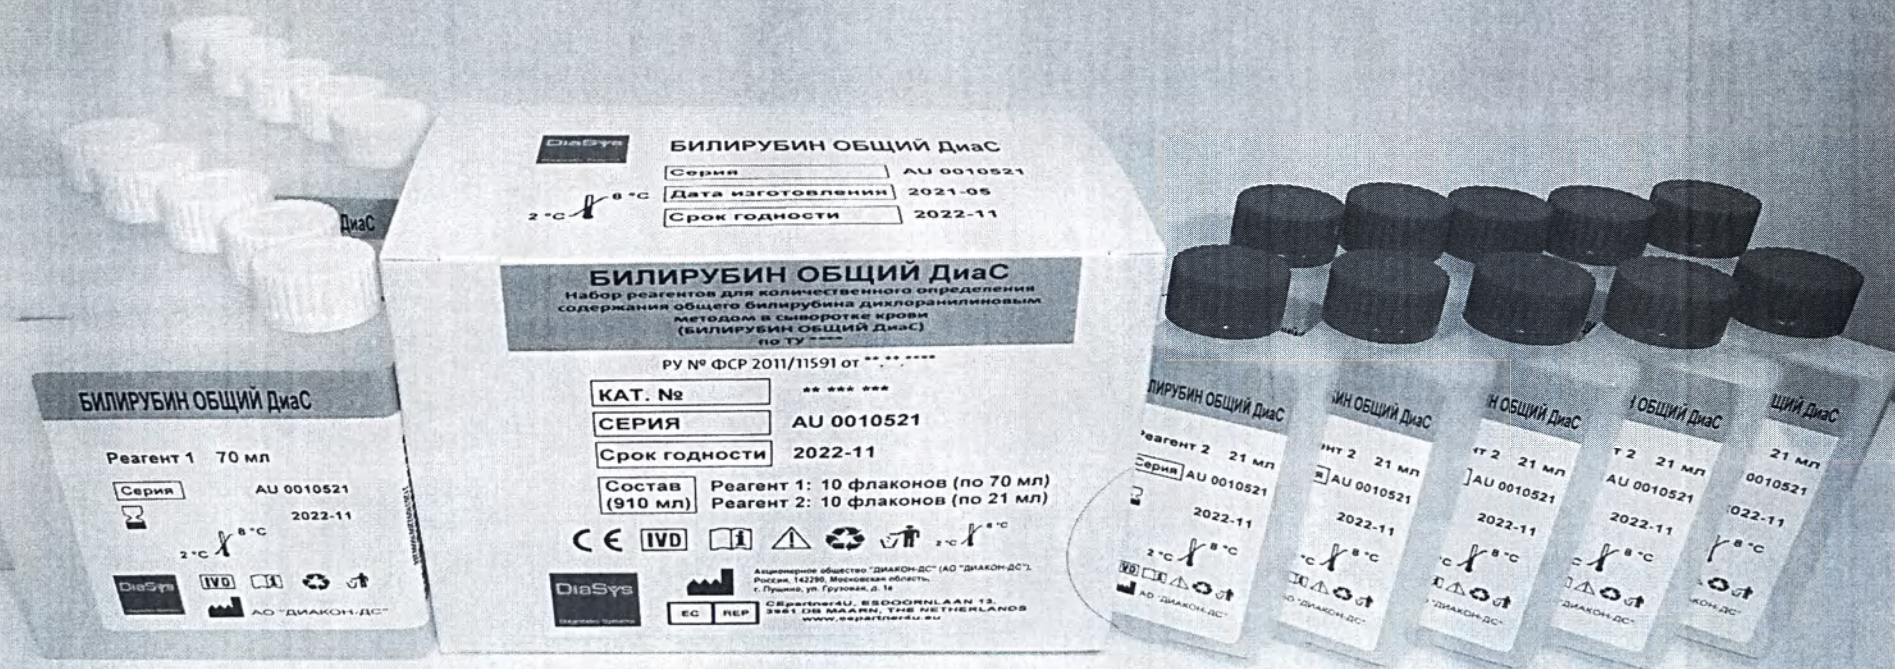

Внешний вид


Набора реагентов для количественного определения содержания общего билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови (БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ДиаС) по ТУ 9398-115-48813770-2015

Комплектация 22 (1)




Набора реагентов для количественного определения содержания общего билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови (БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ДиаС) по ТУ 9398-115-48813770-2015

 000 ЦИПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

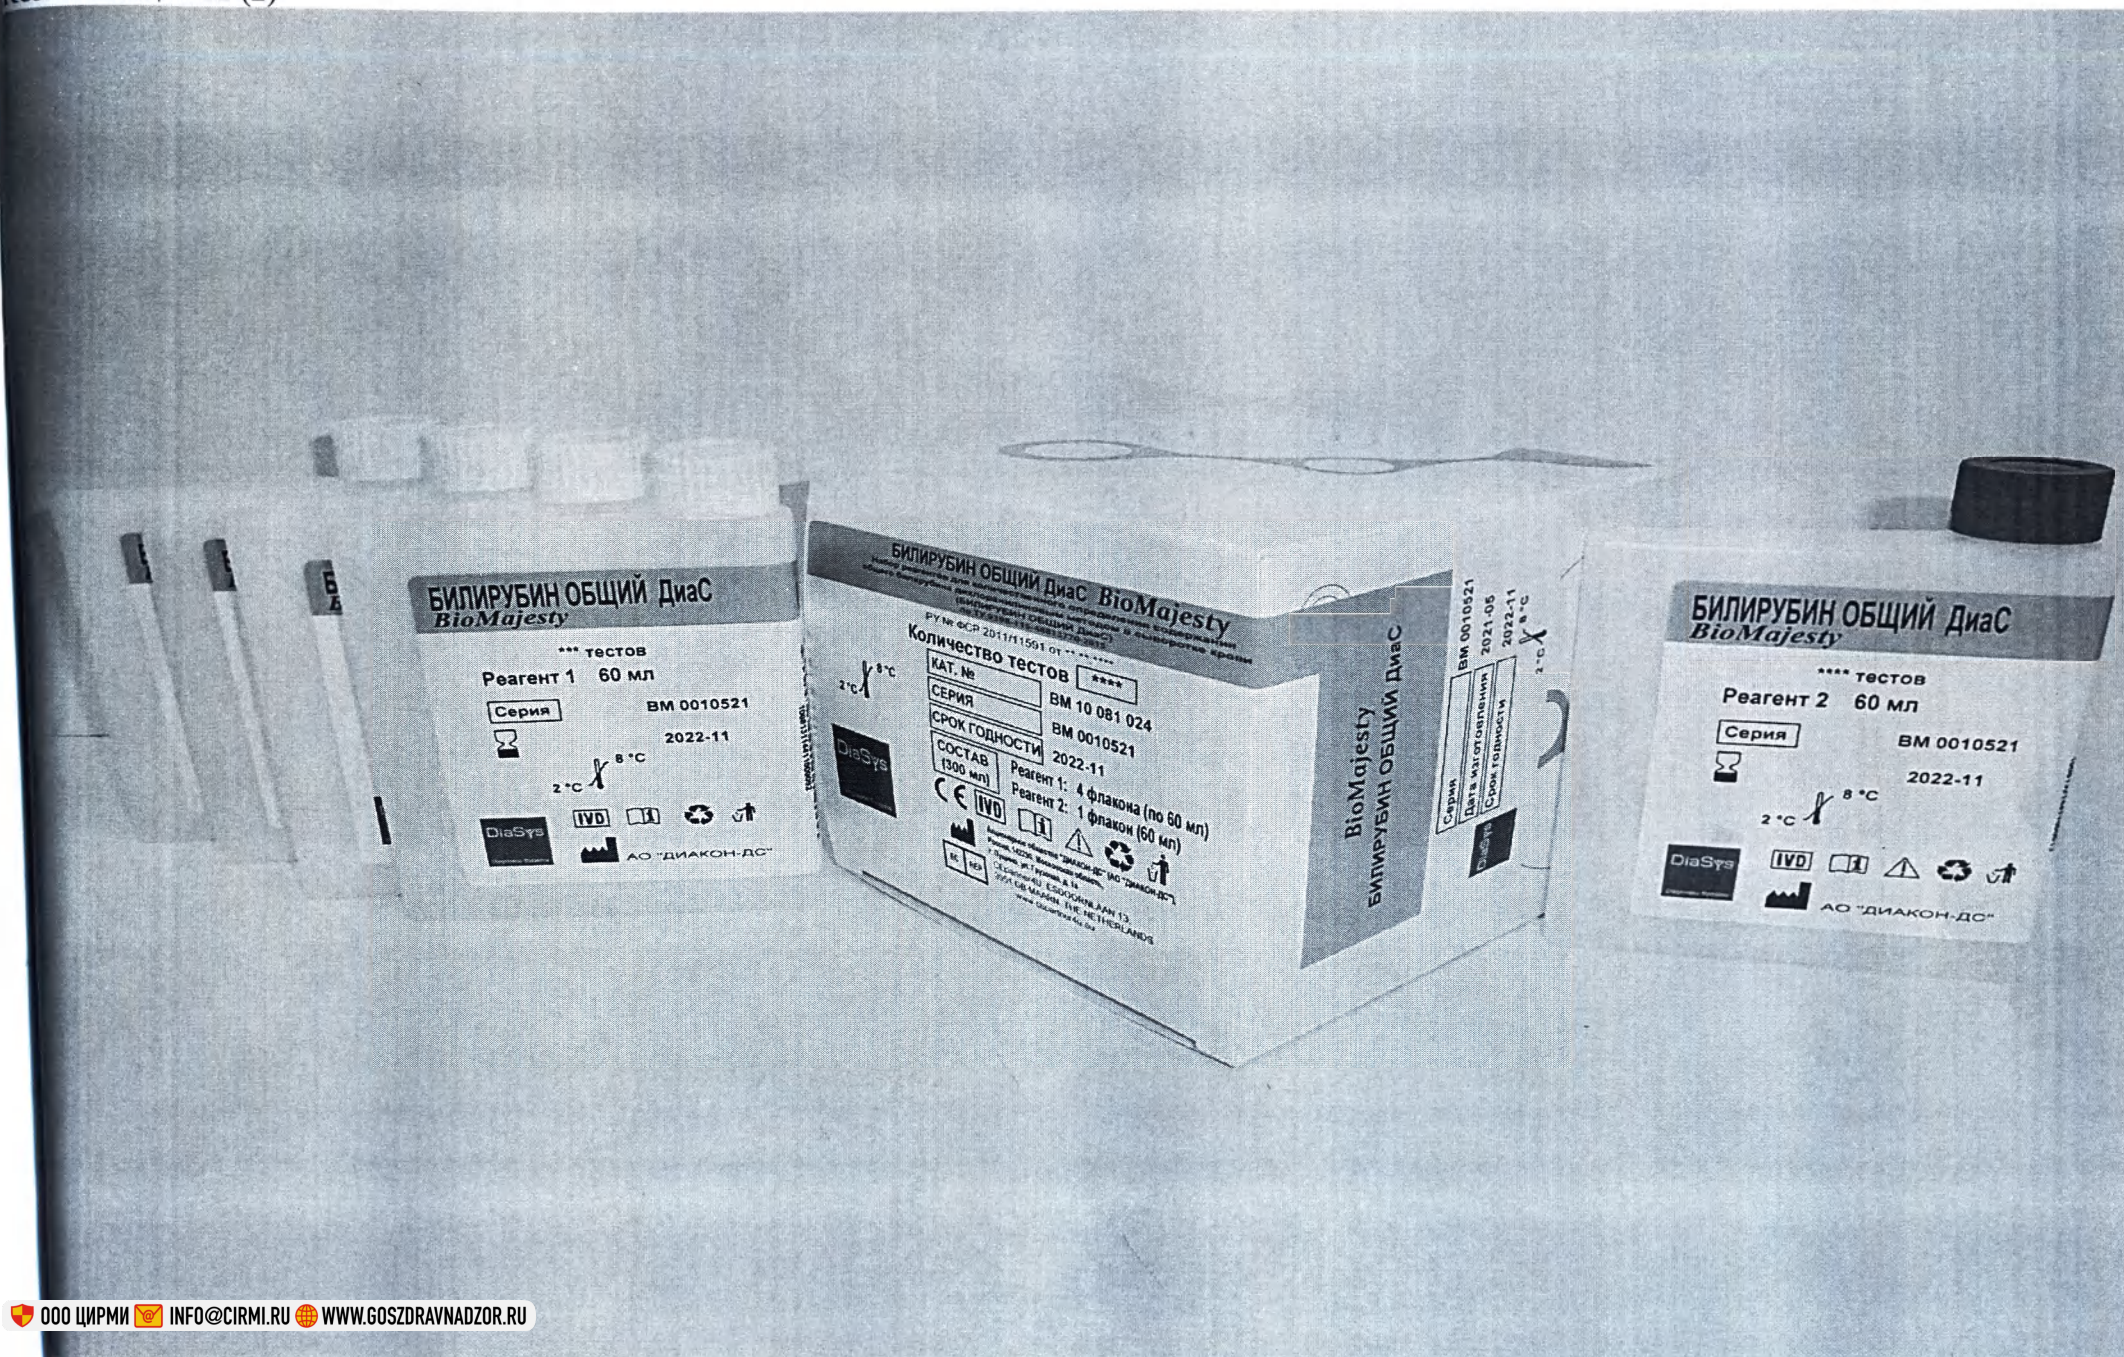

Внешний вид
Набора реагентов для количественного определения содержания общего билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ДиаС) по ТУ 9398-115-48813770-2015

Комплектация 23

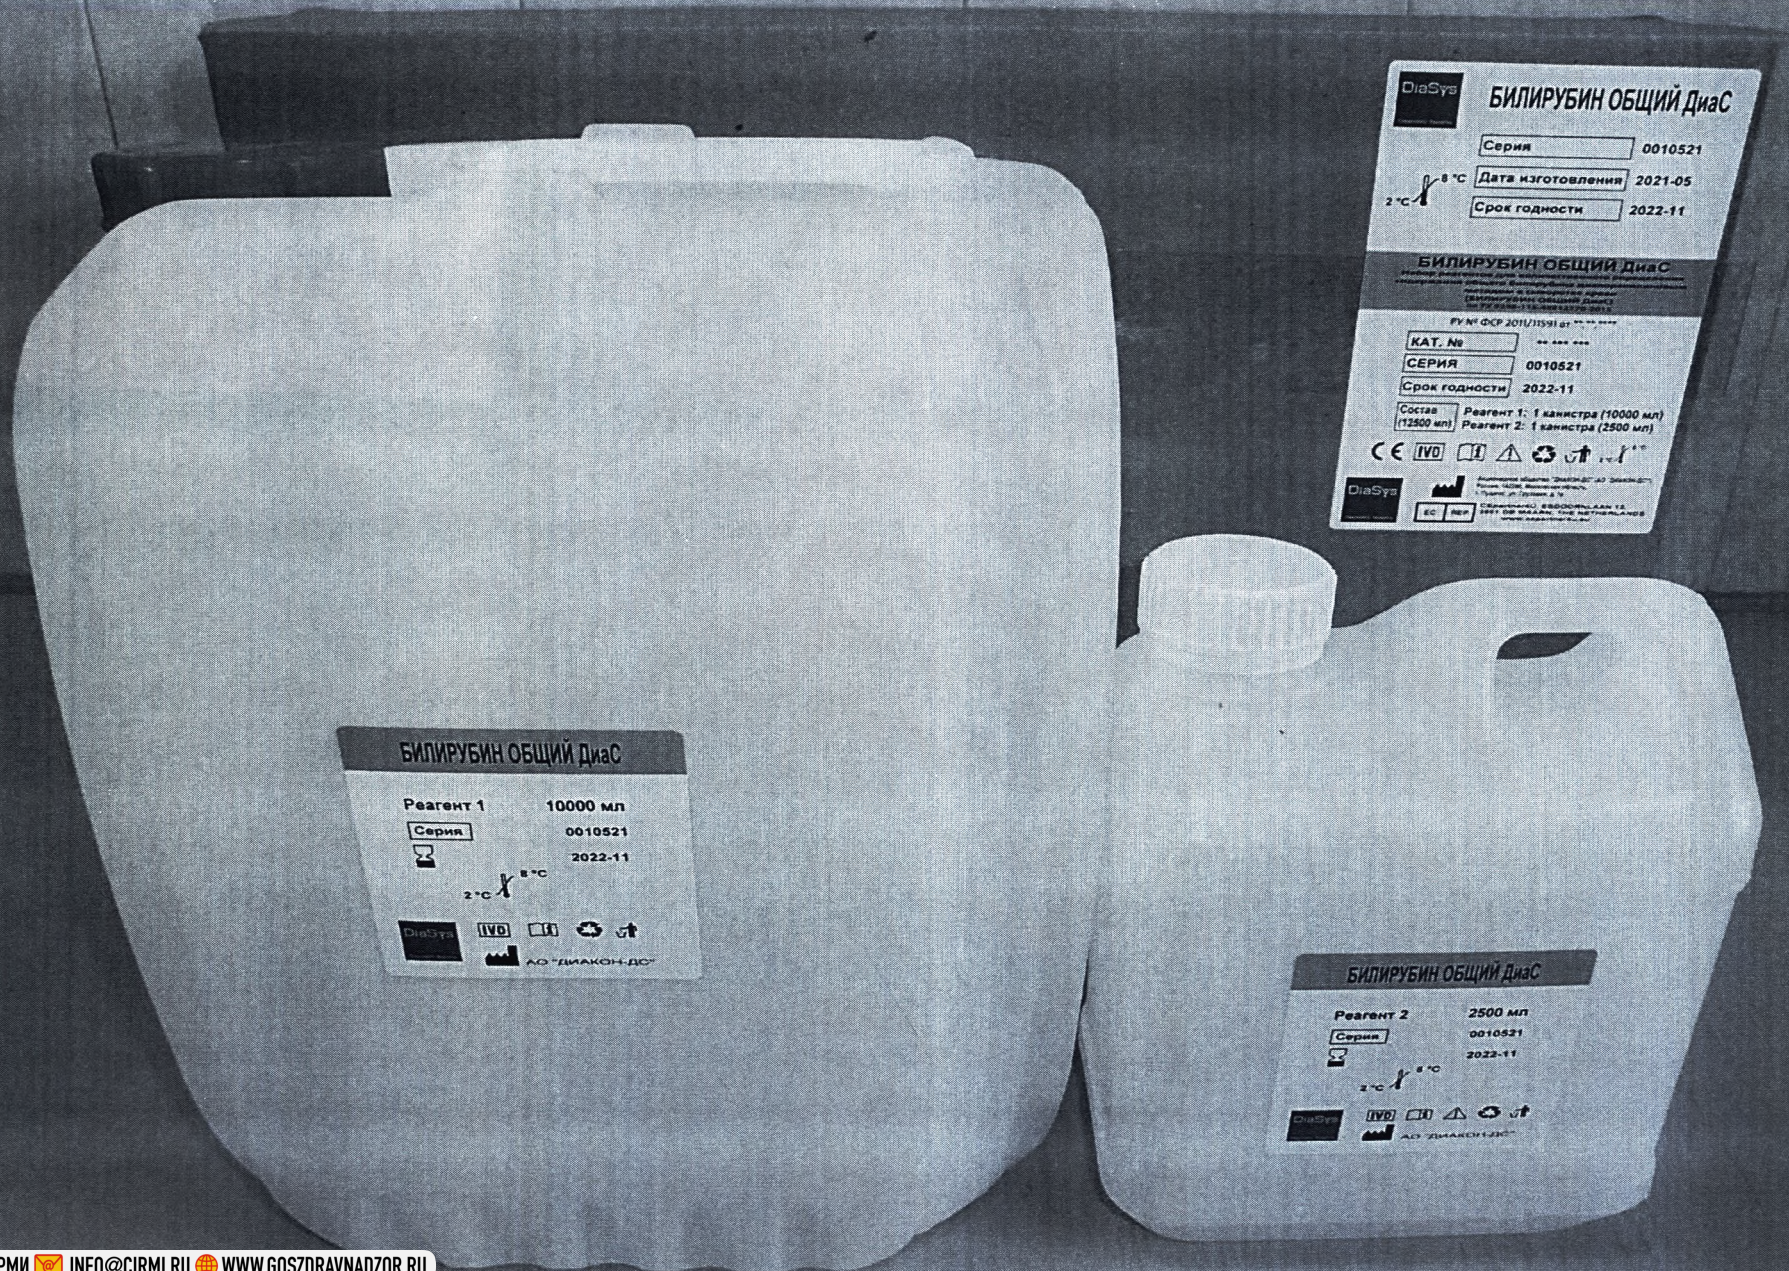



Прочито, пронумеровано и
скреплено печатью 26
Генеральный директор
АО «ДИАКОН-ДС»

Т.Ю. Корзун