



Внешний вид
Набора реагентов для определения содержания железа в сыворотке крови
(ЖЕЛЕЗО ДиаС)

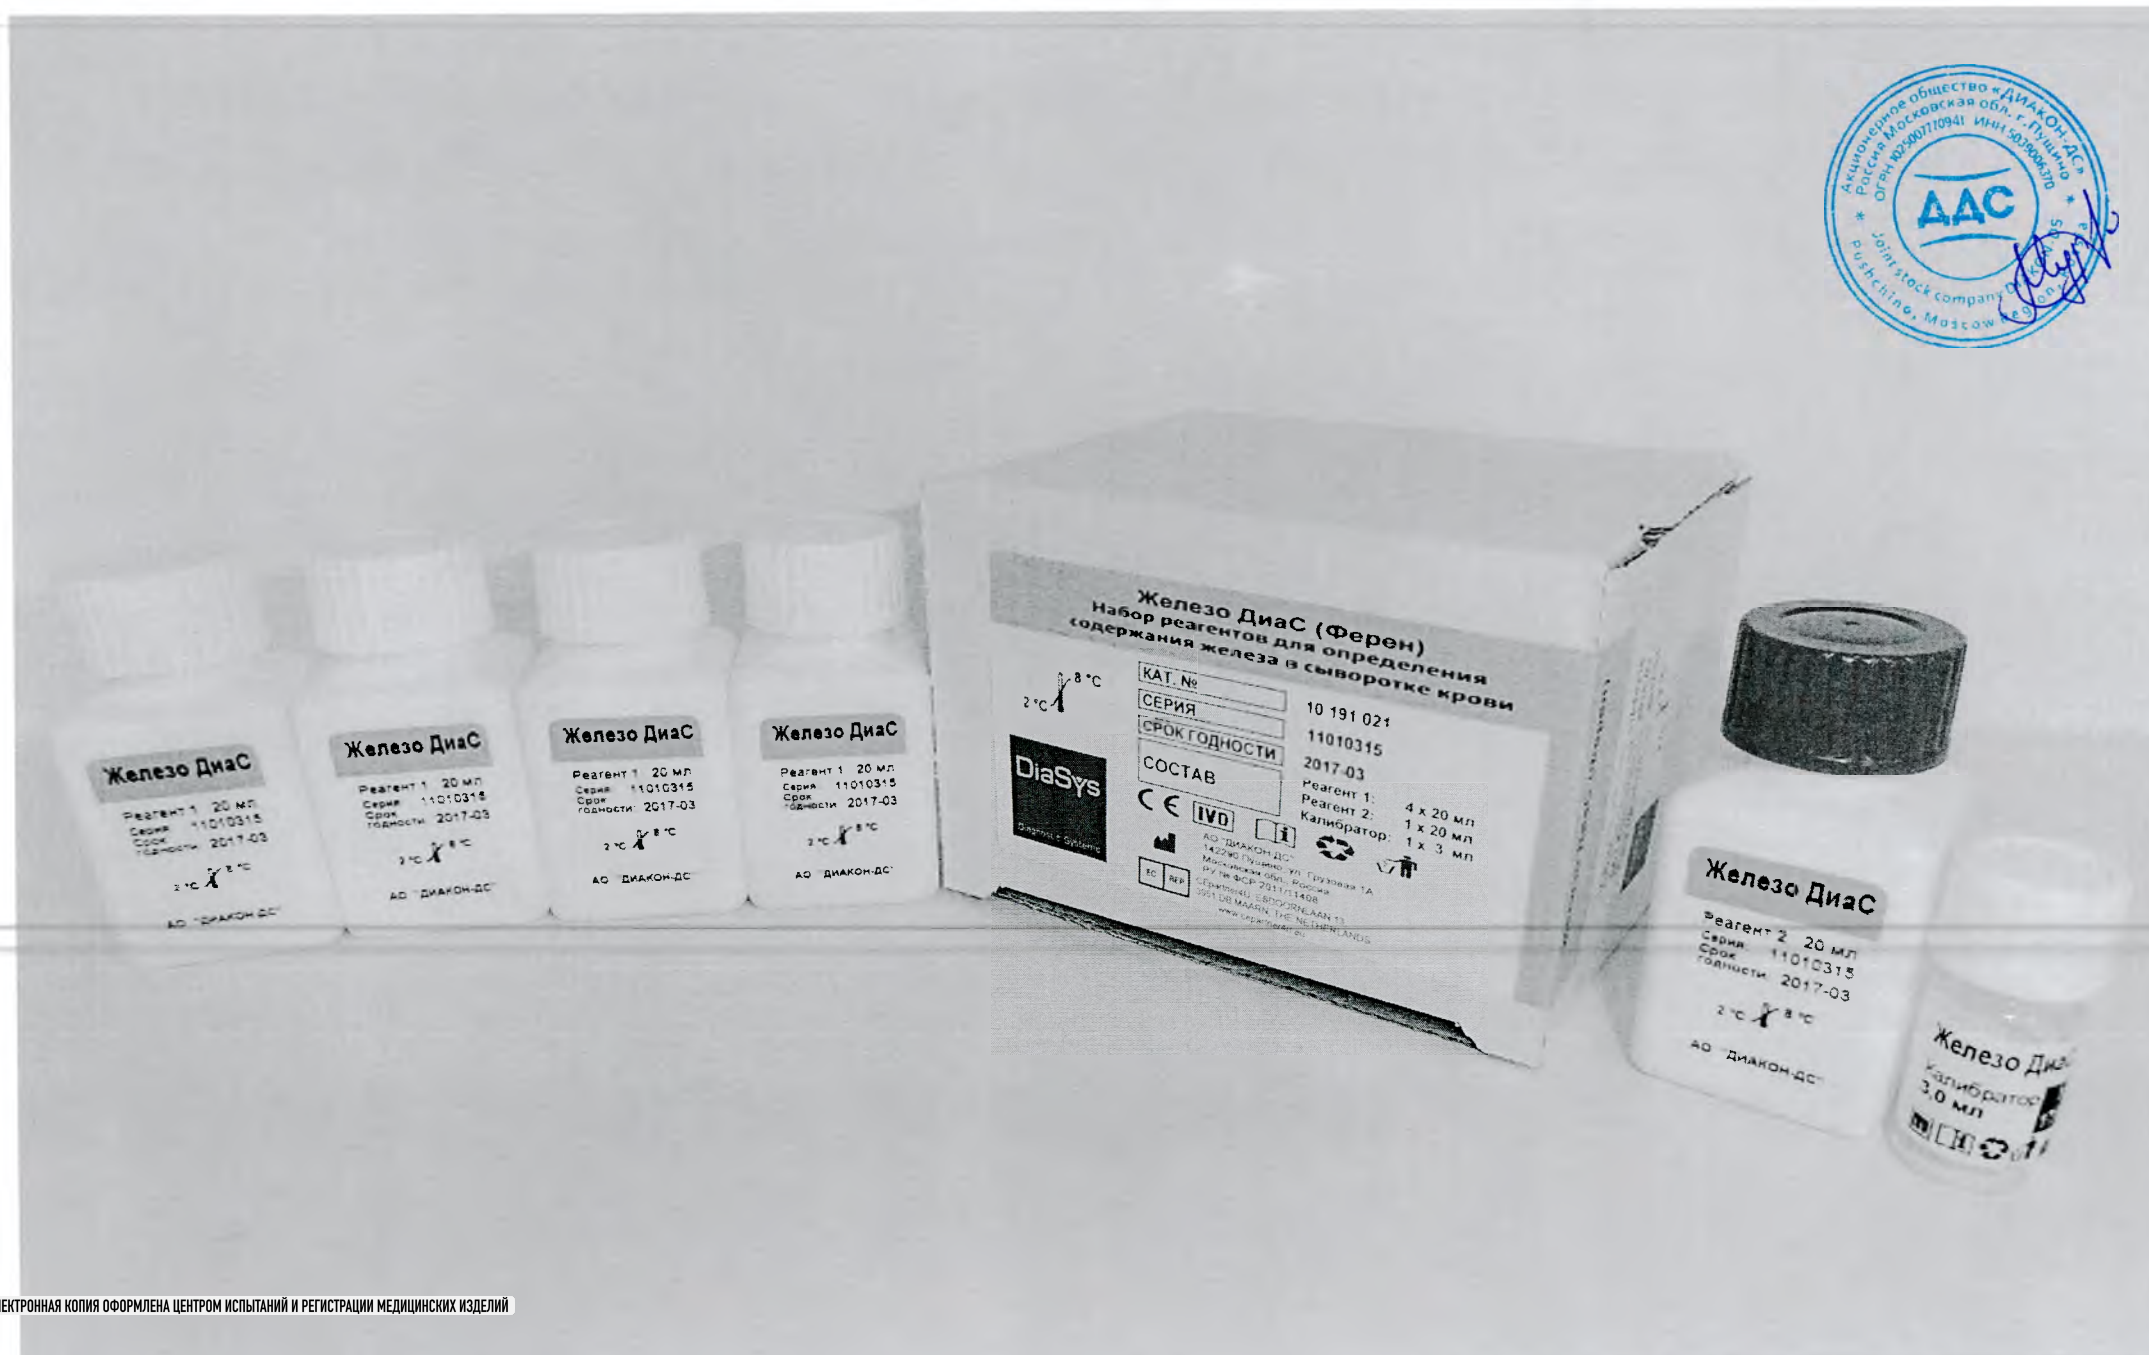

Внешний вид
Набора реагентов для определения содержания железа в сыворотке крови
(ЖЕЛЕЗО ДиаС)

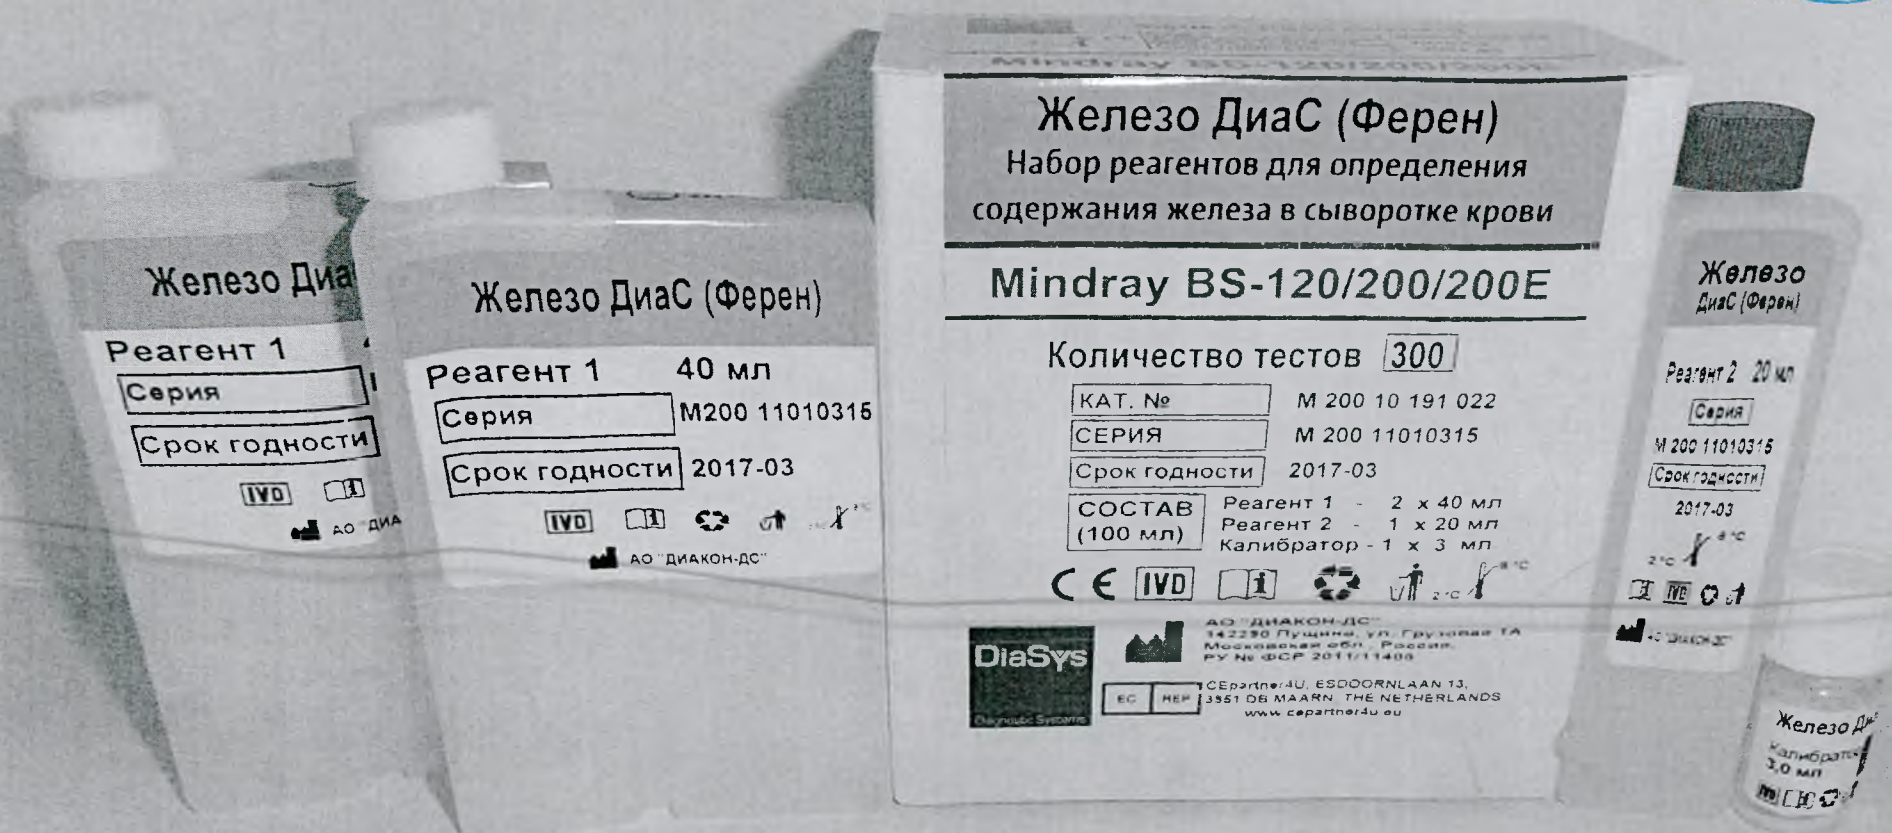

Внешний вид
Набора реагентов для определения содержания железа в сыворотке крови
(ЖЕЛЕЗО ДиаС)



Железо ДиаС (Ферен)
Набор реагентов для определения
содержания железа в сыворотке крови

Железо ДиаС (Ферен)
Набор реагентов для определения
содержания железа в сыворотке крови

КАТ. №


СЕРИЯ 11030215

Срок годности 2017-02

СОСТАВ Реагент 1 - 2 x 40 мл
Реагент 2 - 2 x 11 мл
Калибратор - 1 x 3 мл



DiaSys
AO DIAKON-DC
14290 Пушкино, 311, Пушкино, 14
142900 МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ПУШКИНО
50/004370 ОГРН 105500710941
СООБЩАЕМ: БИОКОМПАНИИ
3961 ОБ МААТН, ПАС-НЕ-ТАБЛАНДС
www.diasys.ru

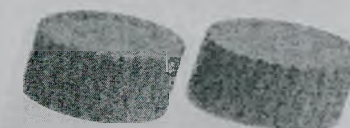


Железо ДиаС (Ферен)

Реагент 1 40 мл

Серия



2°C 8°C





Железо ДиаС (Ферен)

Реагент 1 40 мл


Серия




2°C 8°C




Внешний вид
Набора реагентов для определения содержания железа в сыворотке крови
(ЖЕЛЕЗО ДиаС)

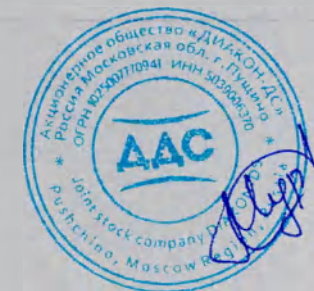




Внешний вид
Набора реагентов для определения содержания железа в сыворотке крови
(ЖЕЛЕЗО ДиаС)

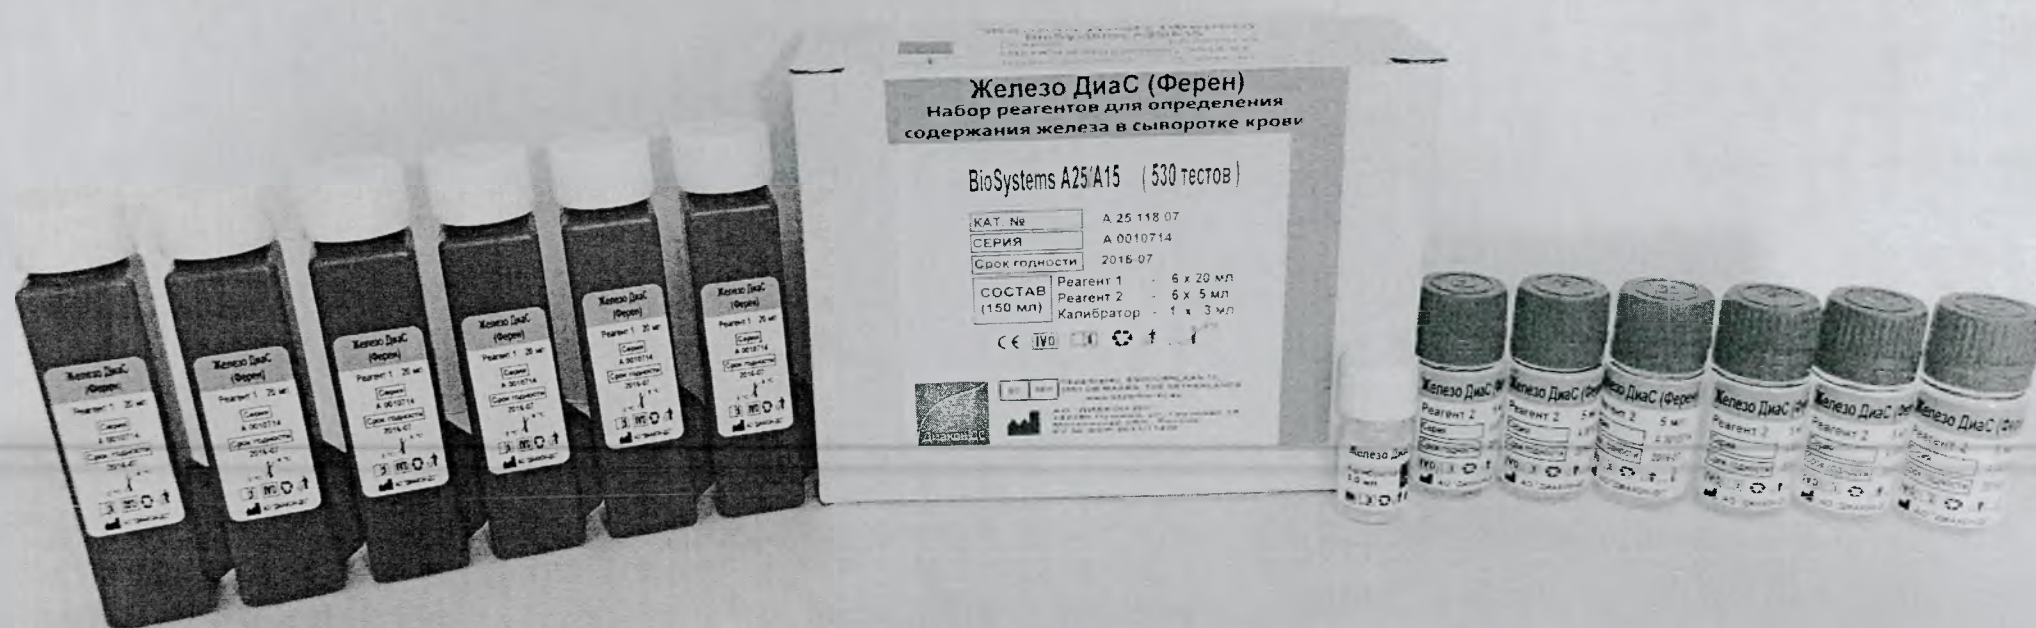


Внешний вид
Набора реагентов для определения содержания железа в сыворотке крови
(ЖЕЛЕЗО ДиаС)

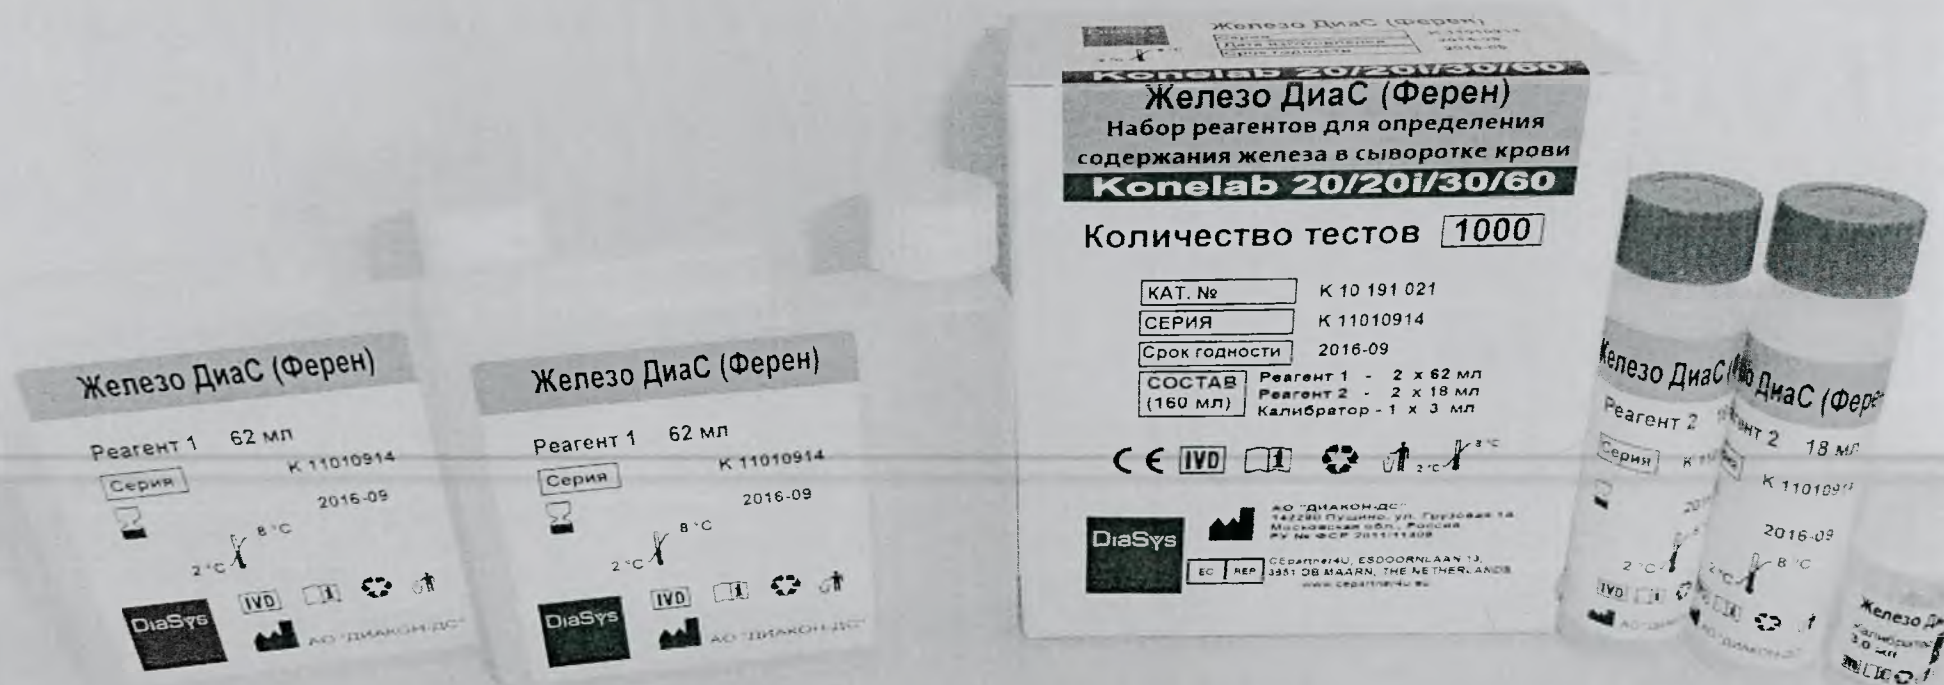



Внешний вид
Набора реагентов для определения содержания железа в сыворотке крови
(ЖЕЛЕЗО ДиаС)

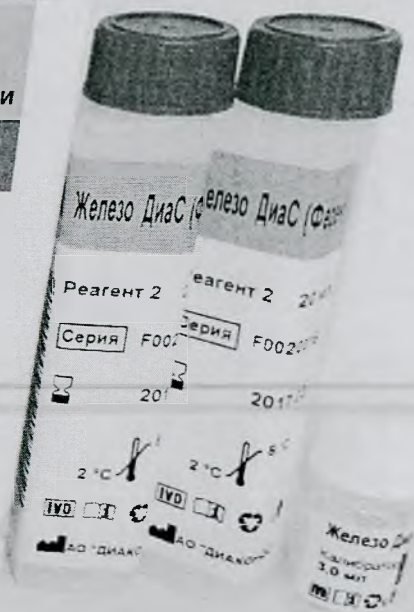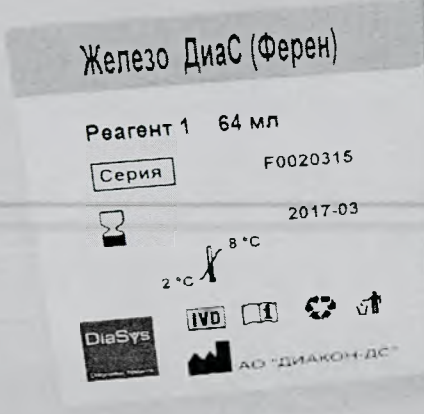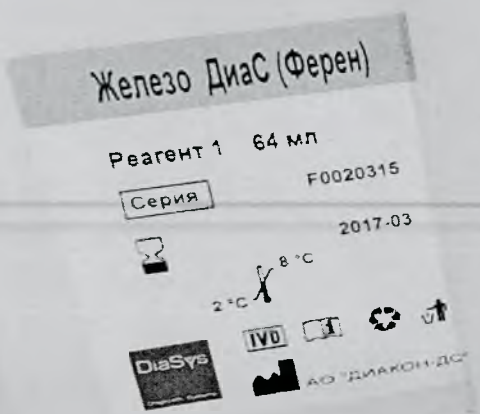

Внешний вид
Набора реагентов для определения содержания железа в сыворотке крови
(ЖЕЛЕЗО ДиаС)

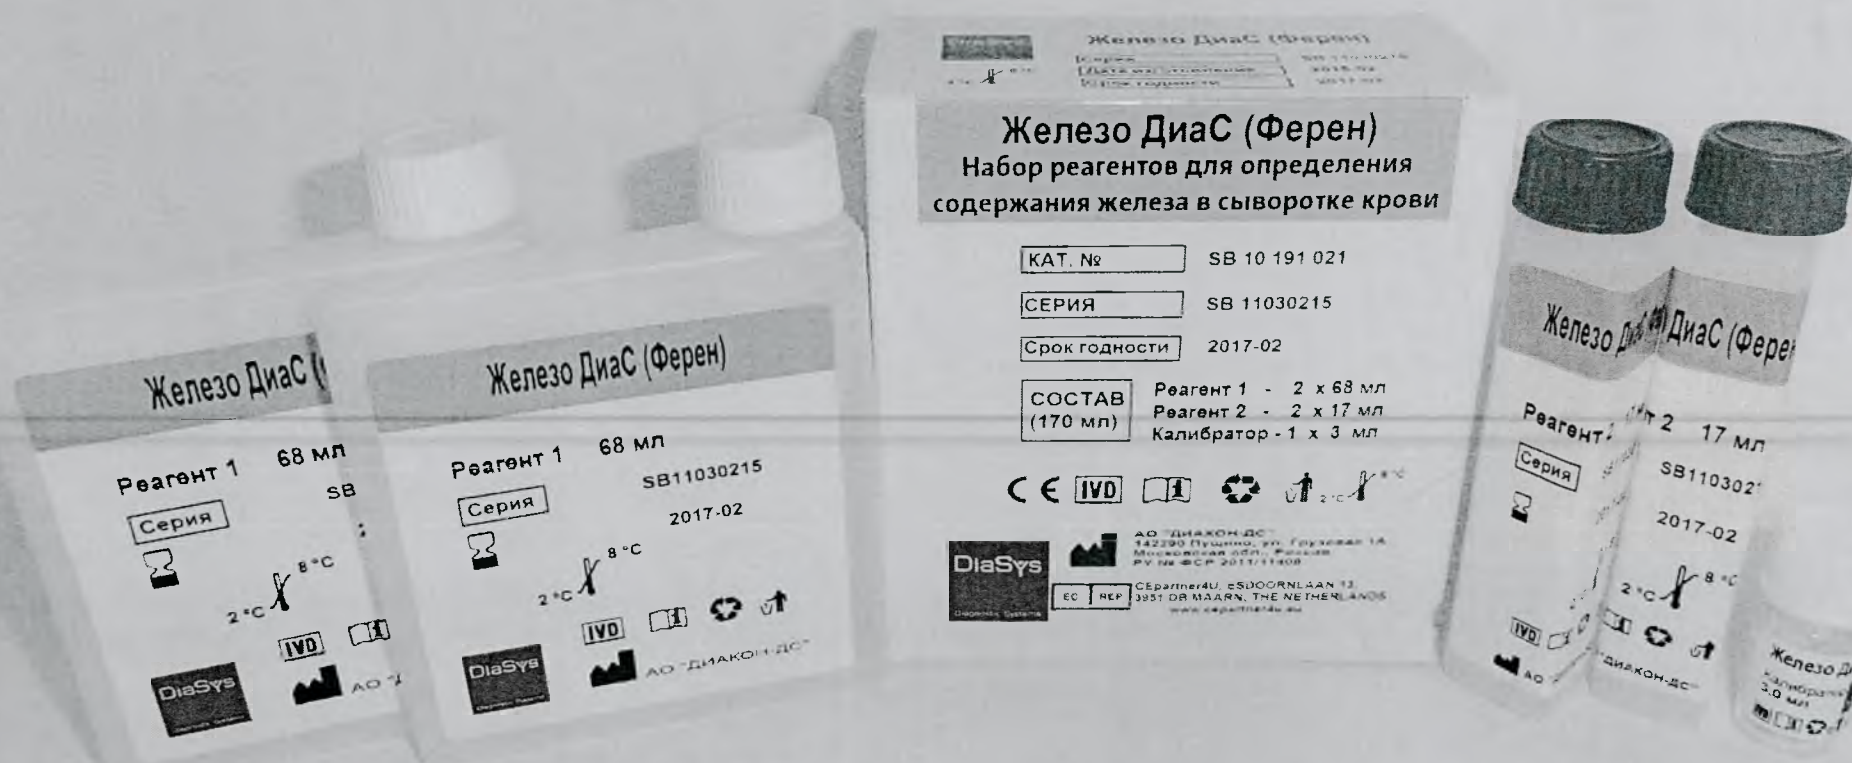



Внешний вид
Набора реагентов для определения содержания железа в сыворотке крови
(ЖЕЛЕЗО ДиаС)

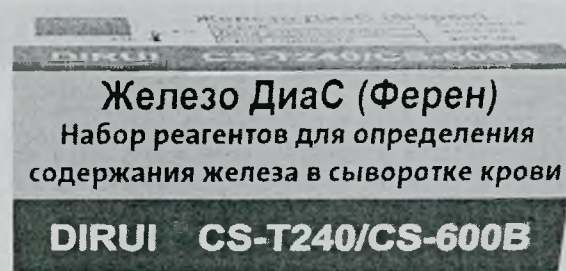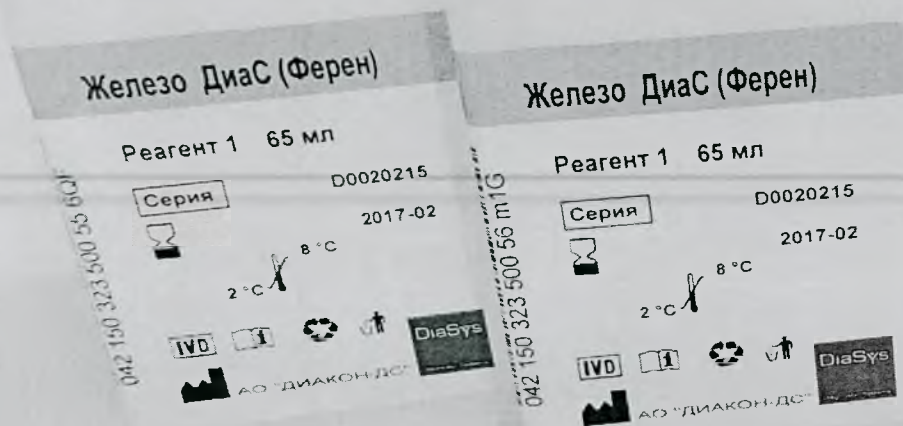




Количество тестов **540 / 690**

КАТ. №	D 10 191 021
СЕРИЯ	D 0020215
Срок годности	2017-02


СОСТАВ (170 мл)	Реагент 1 - 2 x 66 мл Реагент 2 - 2 x 20 мл Калибратор - 1 x 3 мл
-----------------	---

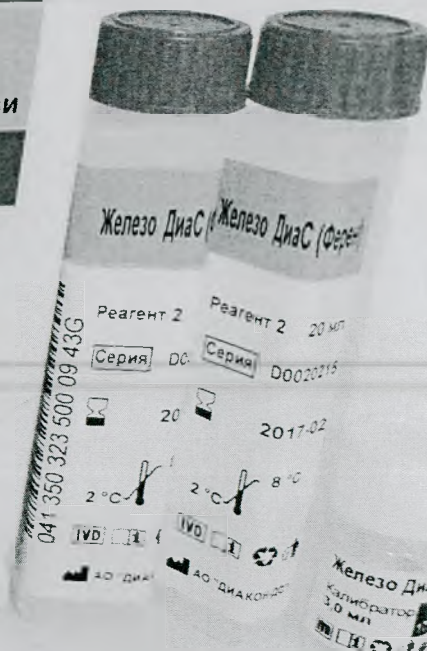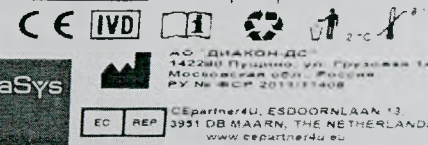


Внешний вид
Набора реагентов для определения содержания железа в сыворотке крови
(ЖЕЛЕЗО ДиаС)

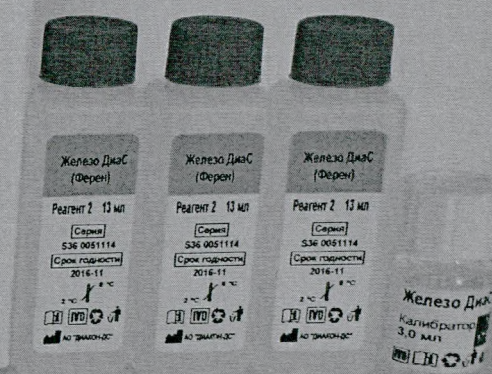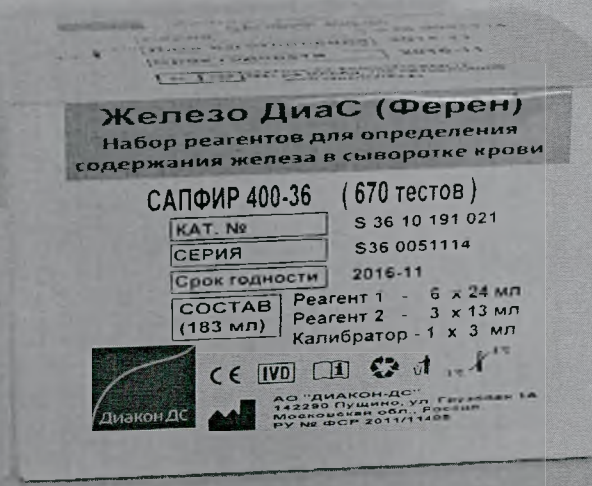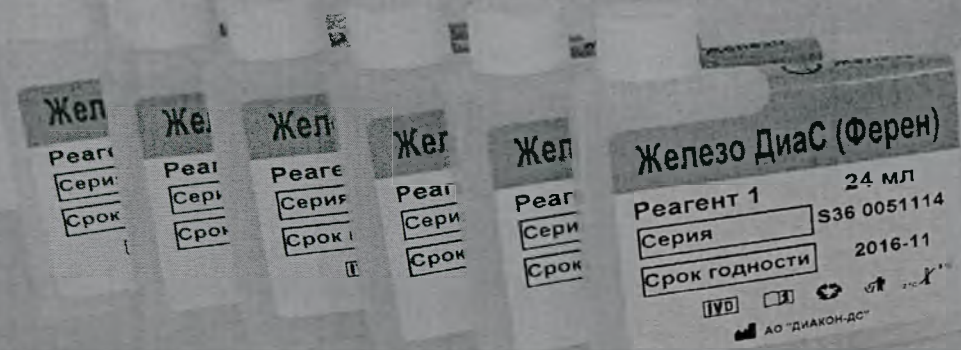

Внешний вид
Набора реагентов для определения содержания железа в сыворотке крови
(ЖЕЛЕЗО ДиаС)

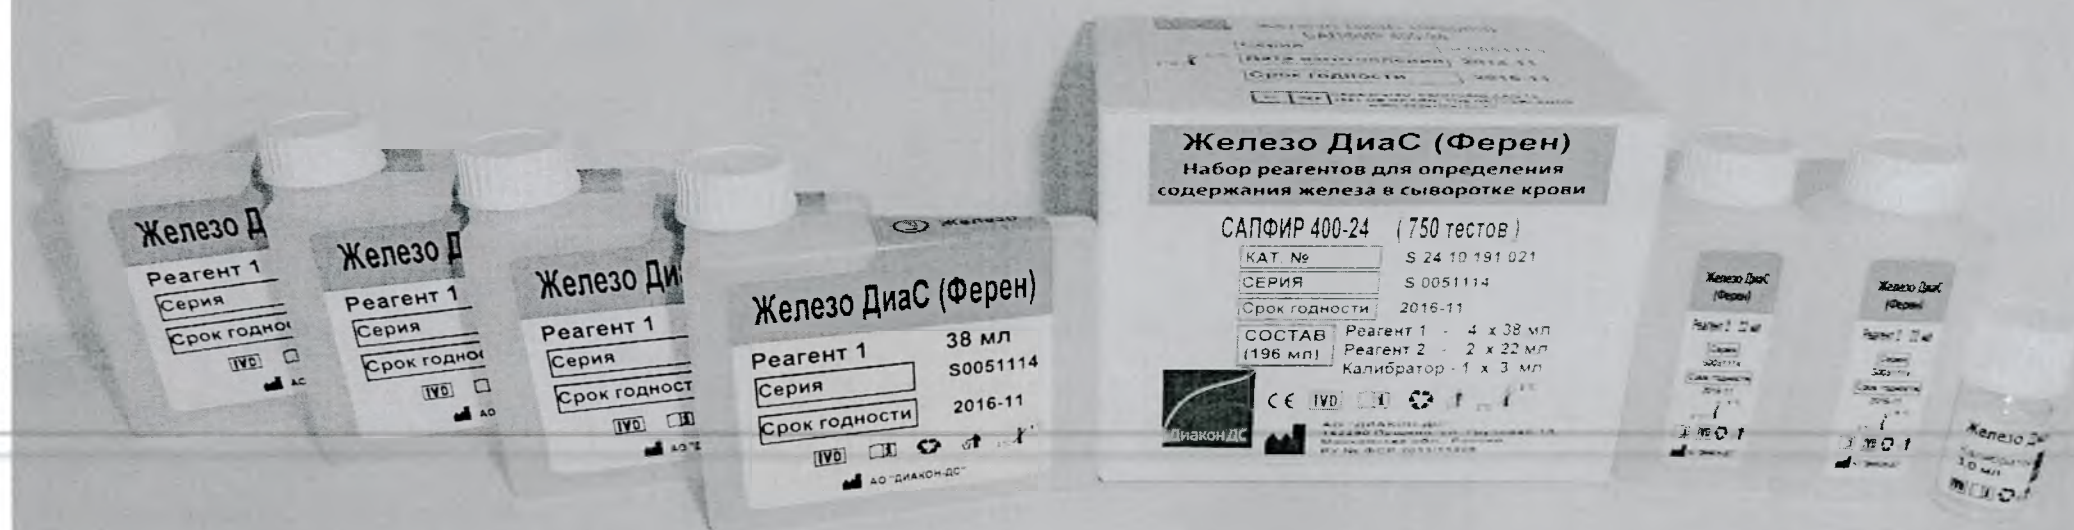

Внешний вид
Набора реагентов для определения содержания железа в сыворотке крови
(ЖЕЛЕЗО ДиаС)

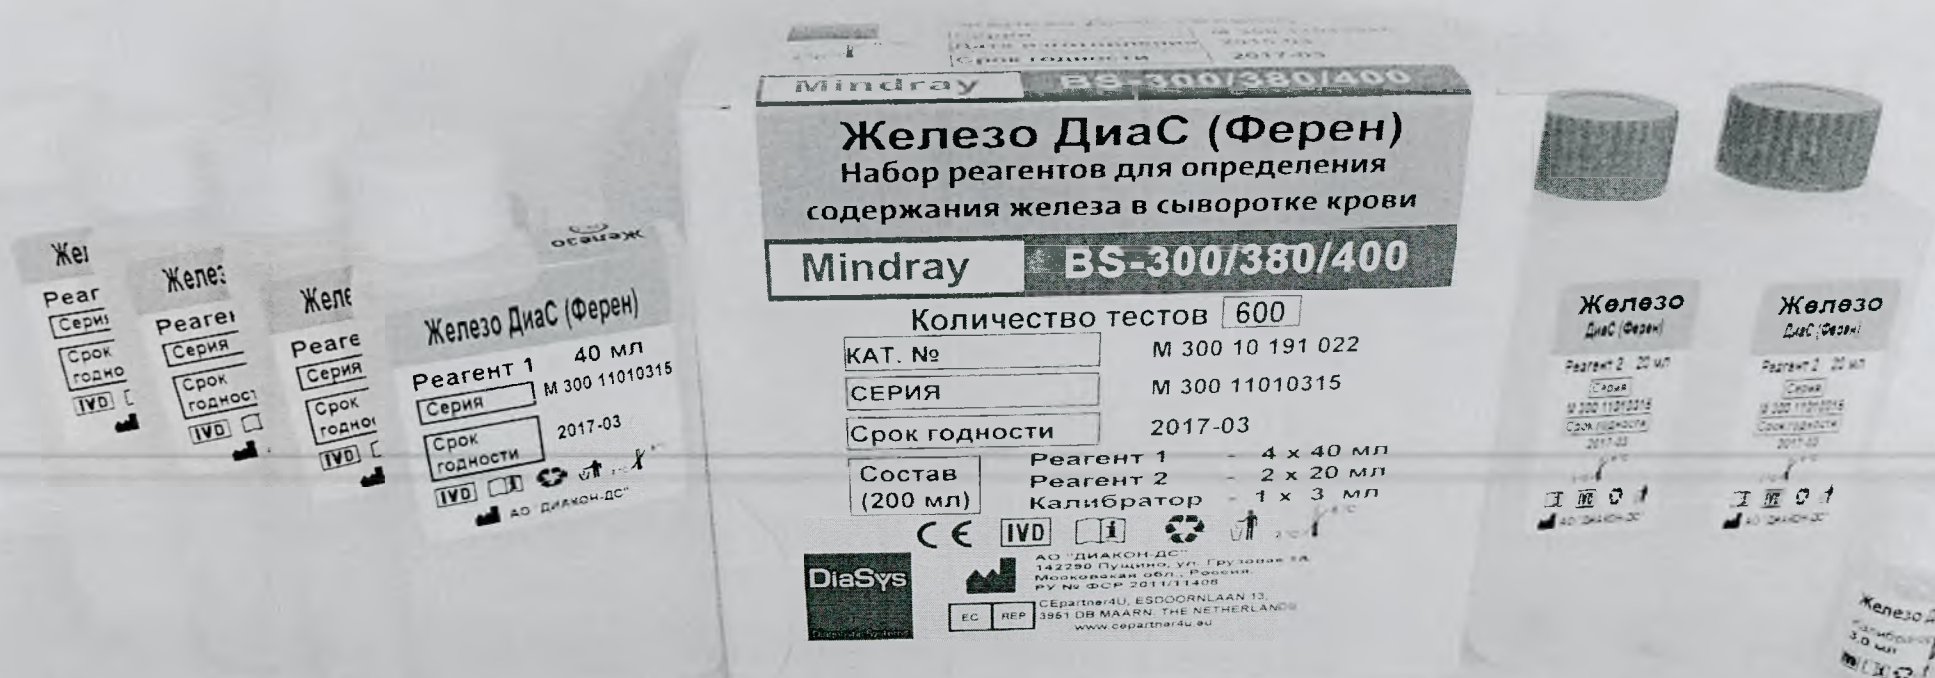

Mindray BS-300/380/400

Железо ДиаС (Ферен)
Набор реагентов для определения
содержания железа в сыворотке крови

Mindray BS-300/380/400

Количество тестов 600

КАТ. №	M 300 10 191 022
СЕРИЯ	M 300 11010315
Срок годности	2017-03
Состав (200 мл)	Реагент 1 - 4 x 40 мл Реагент 2 - 2 x 20 мл Калибратор - 1 x 3 мл




CE IVD

АО "ДИАКОН-ДС"
142250 Пушкино, ул. Грузовая 8А
Московская обл., Россия
РУ № ФСР 2011/11408

CEPARTNER4U, ESDOORNLAAN 13,
3961 DB MAARN, THE NETHERLANDS
www.cepartner4u.eu


Внешний вид
Набора реагентов для определения содержания железа в сыворотке крови
(ЖЕЛЕЗО ДиаС)

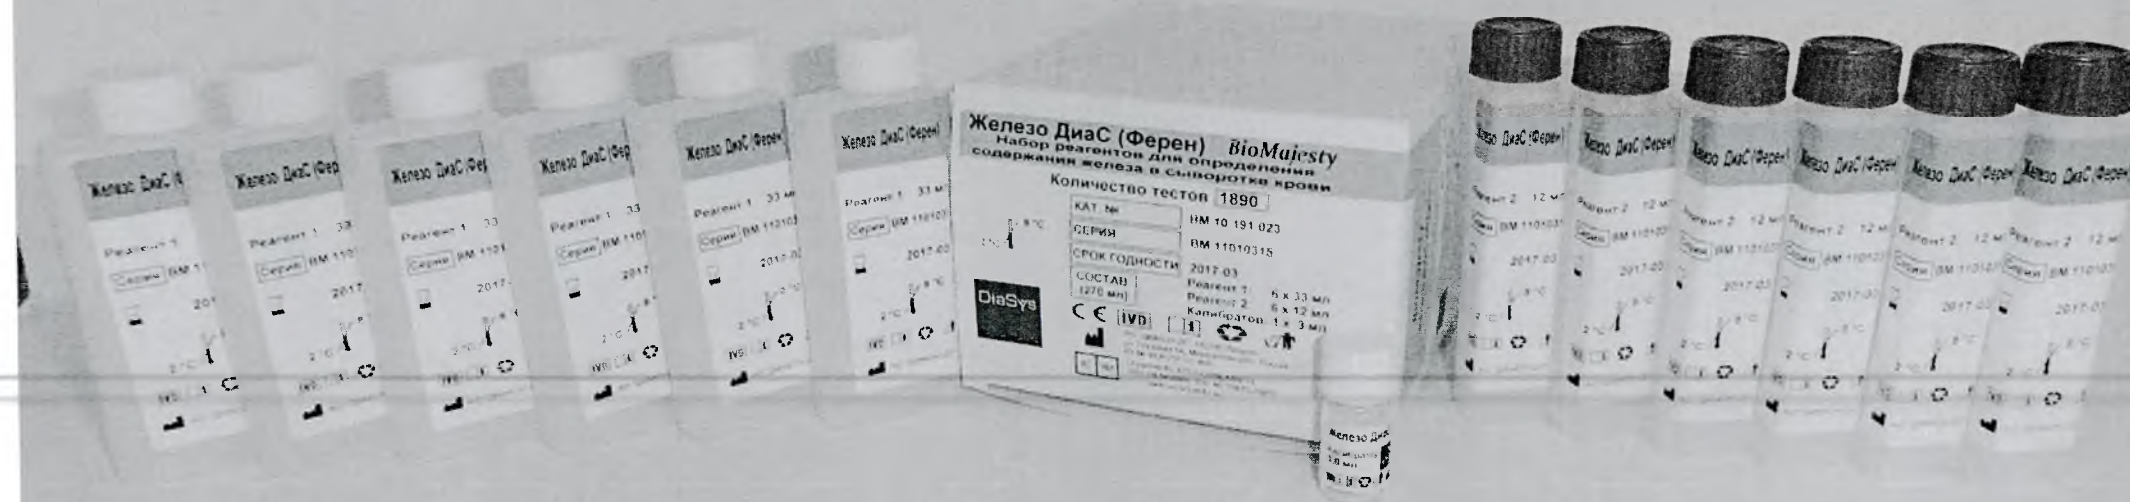


Внешний вид
Набора реагентов для определения содержания железа в сыворотке крови
(ЖЕЛЕЗО ДиаС)



Внешний вид
Набора реагентов для определения содержания железа в сыворотке крови
(ЖЕЛЕЗО ДиаС)

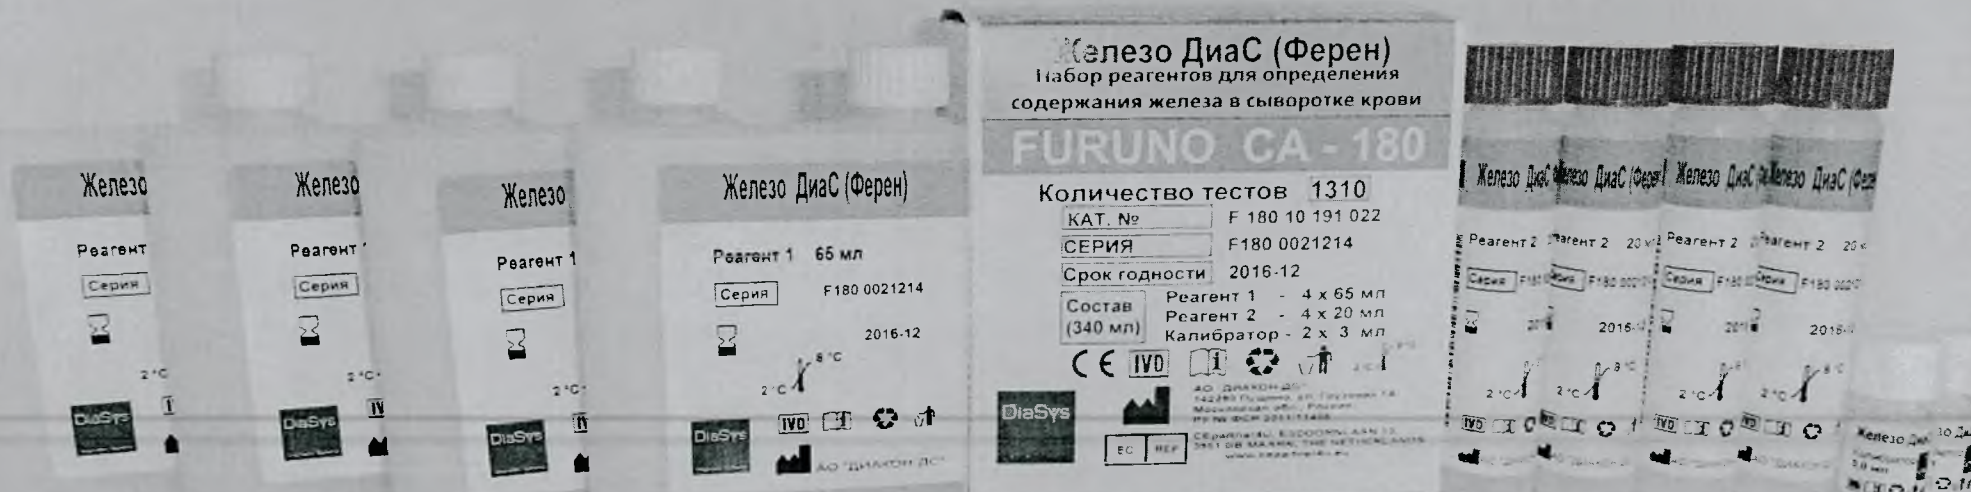

Внешний вид
Набора реагентов для определения содержания железа в сыворотке крови
(ЖЕЛЕЗО ДиаС)

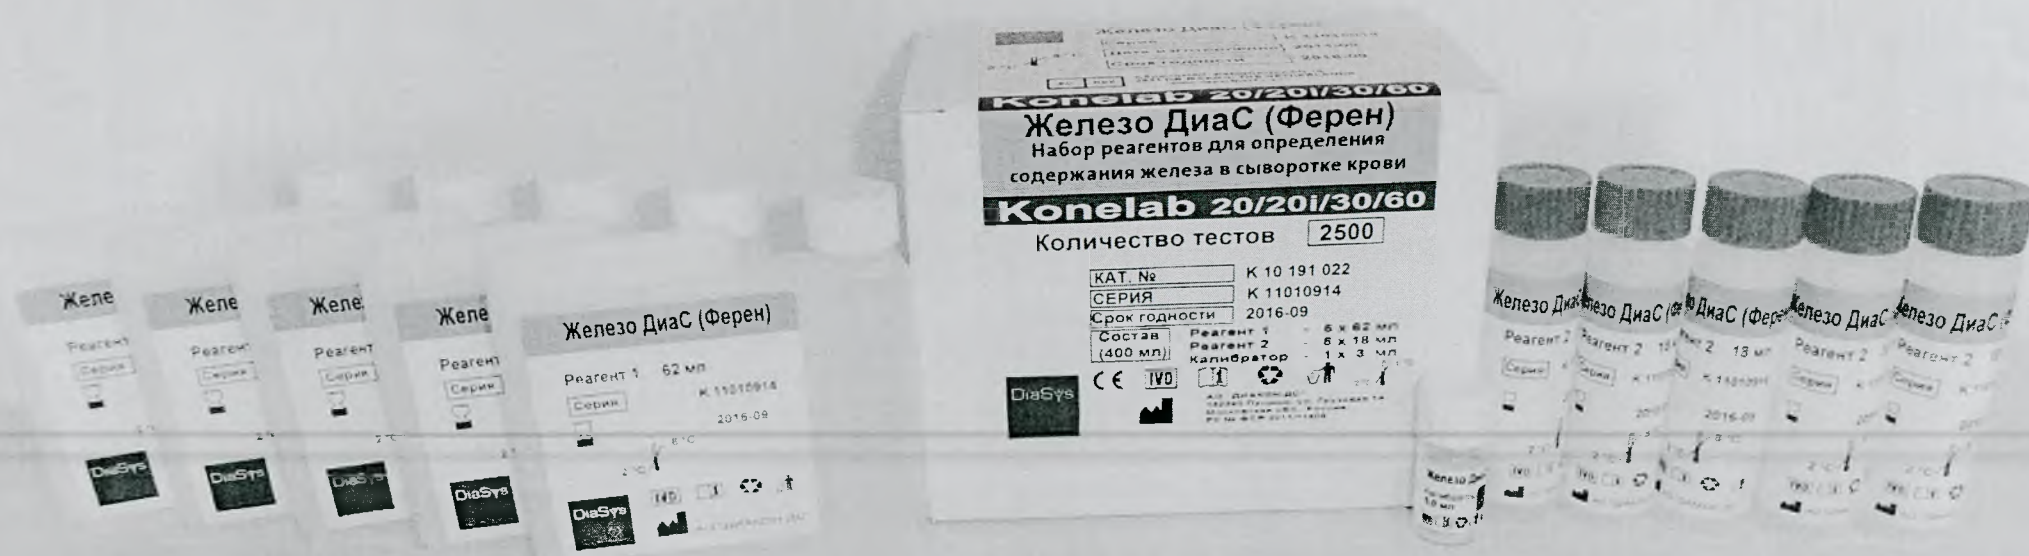


Внешний вид
Набора реагентов для определения содержания железа в сыворотке крови
(ЖЕЛЕЗО ДиаС)



Внешний вид
Набора реагентов для определения содержания железа в сыворотке крови
(ЖЕЛЕЗО ДиаС)





Внешний вид
Набора реагентов для определения содержания железа в сыворотке крови
(ЖЕЛЕЗО ДиаС)

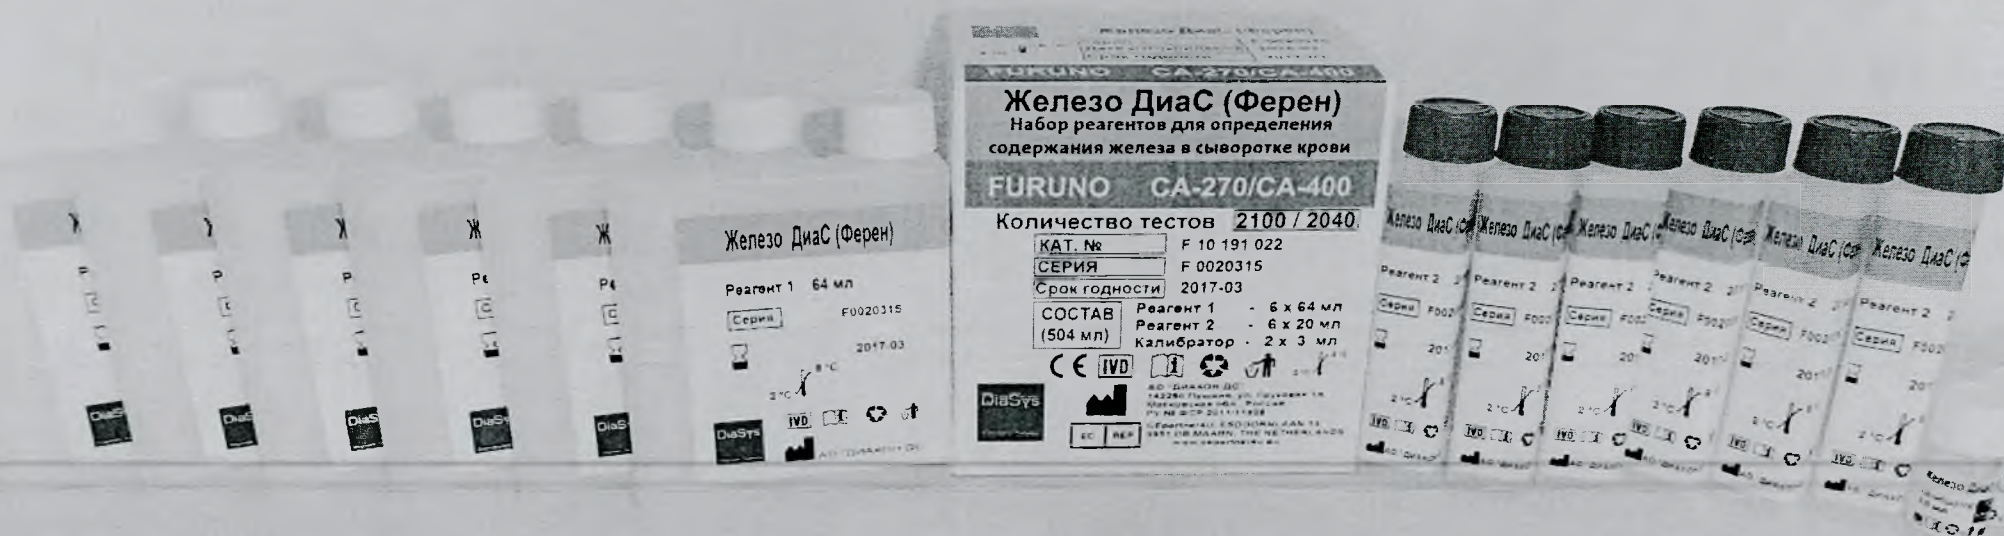

Внешний вид
Набора реагентов для определения содержания железа в сыворотке крови
(ЖЕЛЕЗО ДиаС)



Внешний вид
Набора реагентов для определения содержания железа в сыворотке крови
(ЖЕЛЕЗО ДиаС)

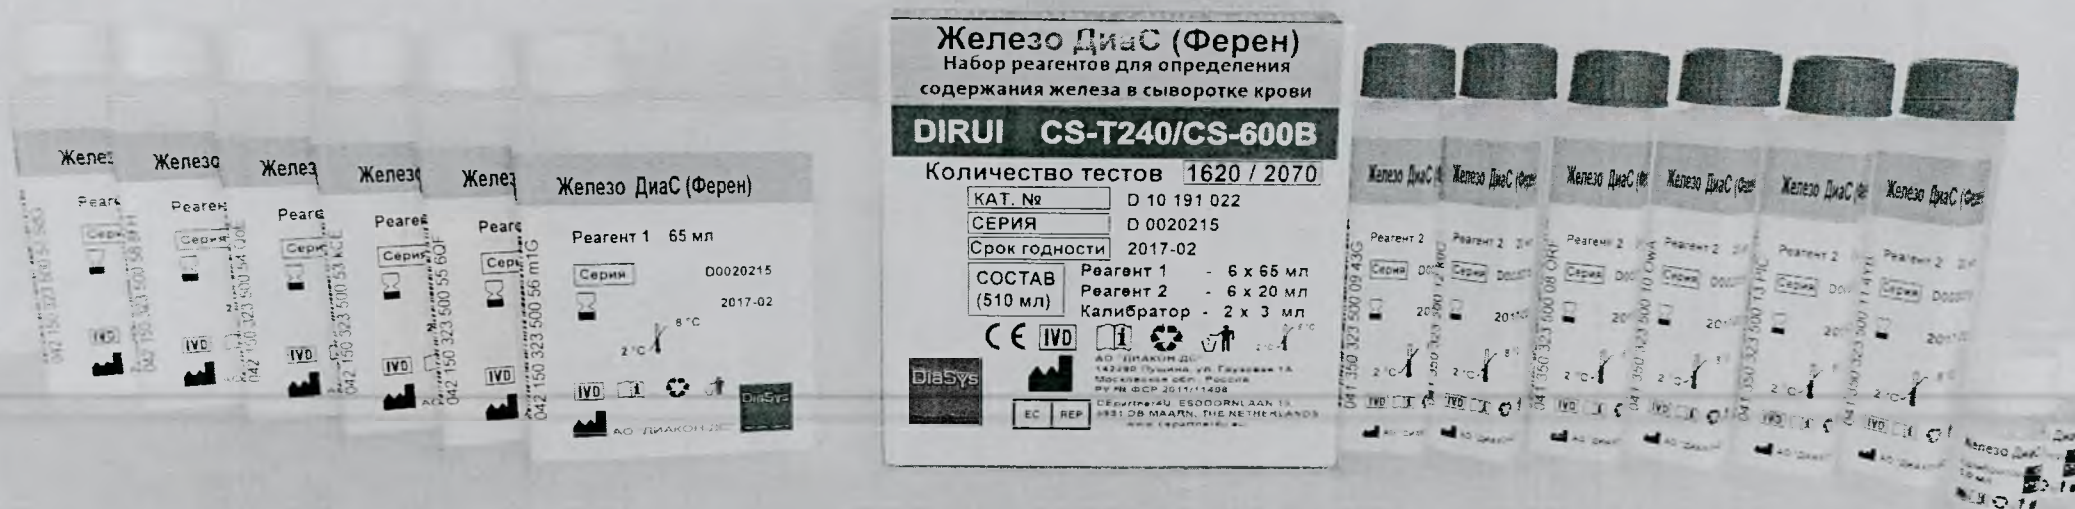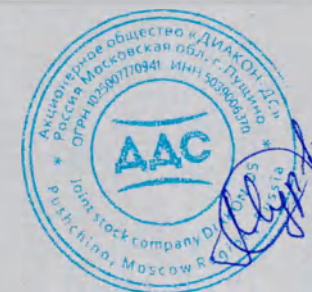



Внешний вид
Набора реагентов для определения содержания железа в сыворотке крови
(ЖЕЛЕЗО ДиаС)



Железо ДиаС (Ферен)
Реагент 1
Реагент 2
Калибратор


Железо ДиаС (Ферен)
Набор реагентов для определения
содержания железа в сыворотке крови

КАТ. №

СЕРИЯ 11030215

Срок годности 2017-02

СОСТАВ
(910 мл) Реагент 1 - 10 x 70 мл
Реагент 2 - 10 x 21 мл
Калибратор - 2 x 3 мл



ЖЕЛЕЗО ДИАС (ФЕРЕН)
Набор реагентов для определения
содержания железа в сыворотке крови

Внешний вид
Набора реагентов для определения содержания железа в сыворотке крови
(ЖЕЛЕЗО ДиаС)

