


Внешний вид

Набора реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови (БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ДиаС) по ТУ 9398-114-48813770-2015

Комплектация 1




Внешний вид
реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ДиаС) по ТУ 9398-114-48813770-2015

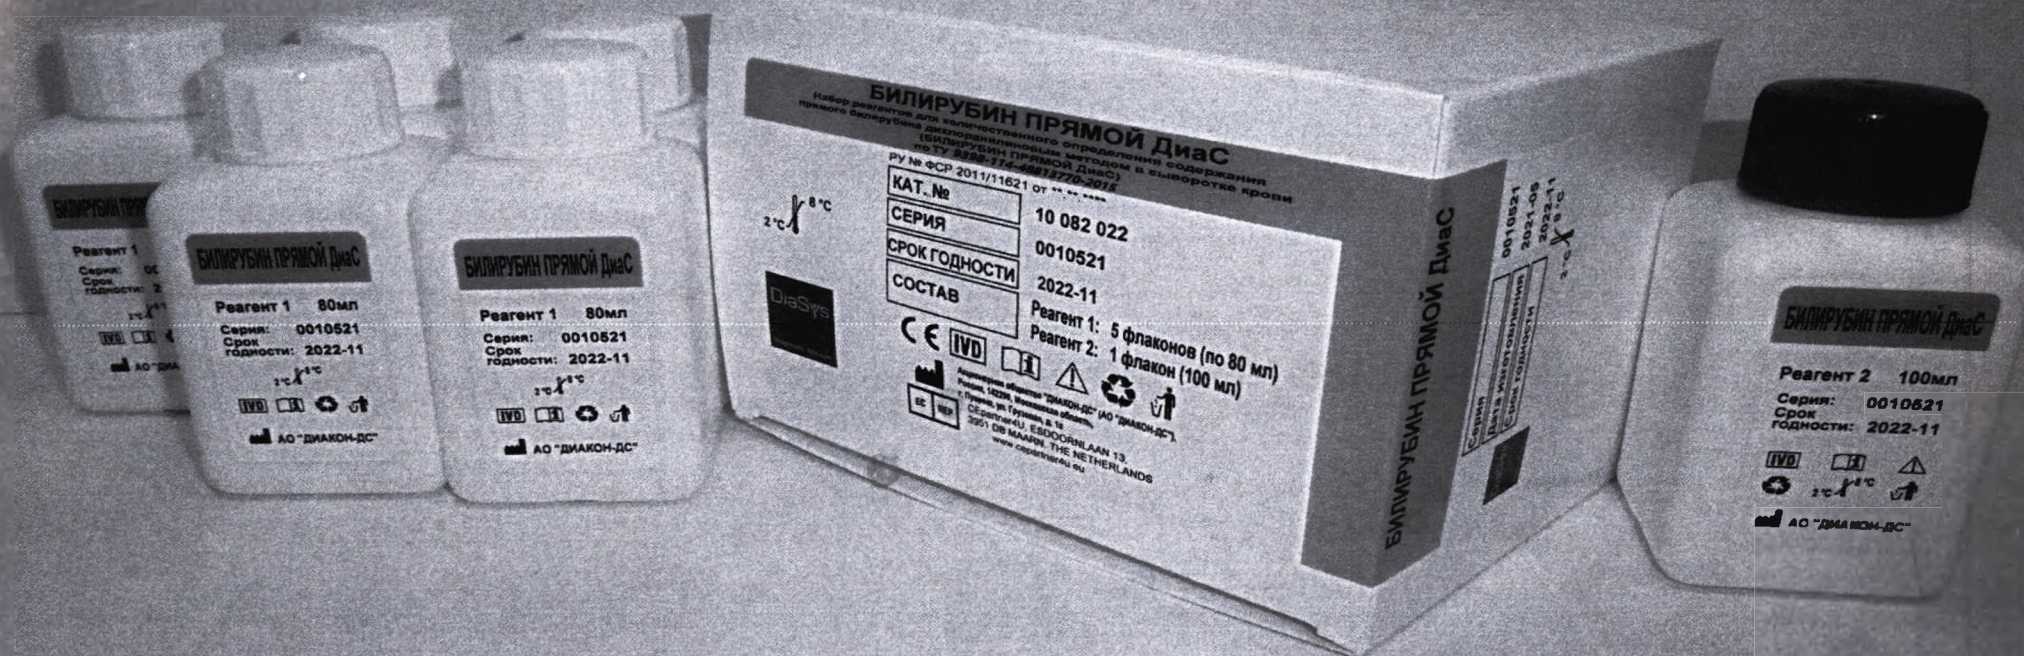

набора реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ДиаС) по ТУ 9398-114-48813770-2015

Лист 3

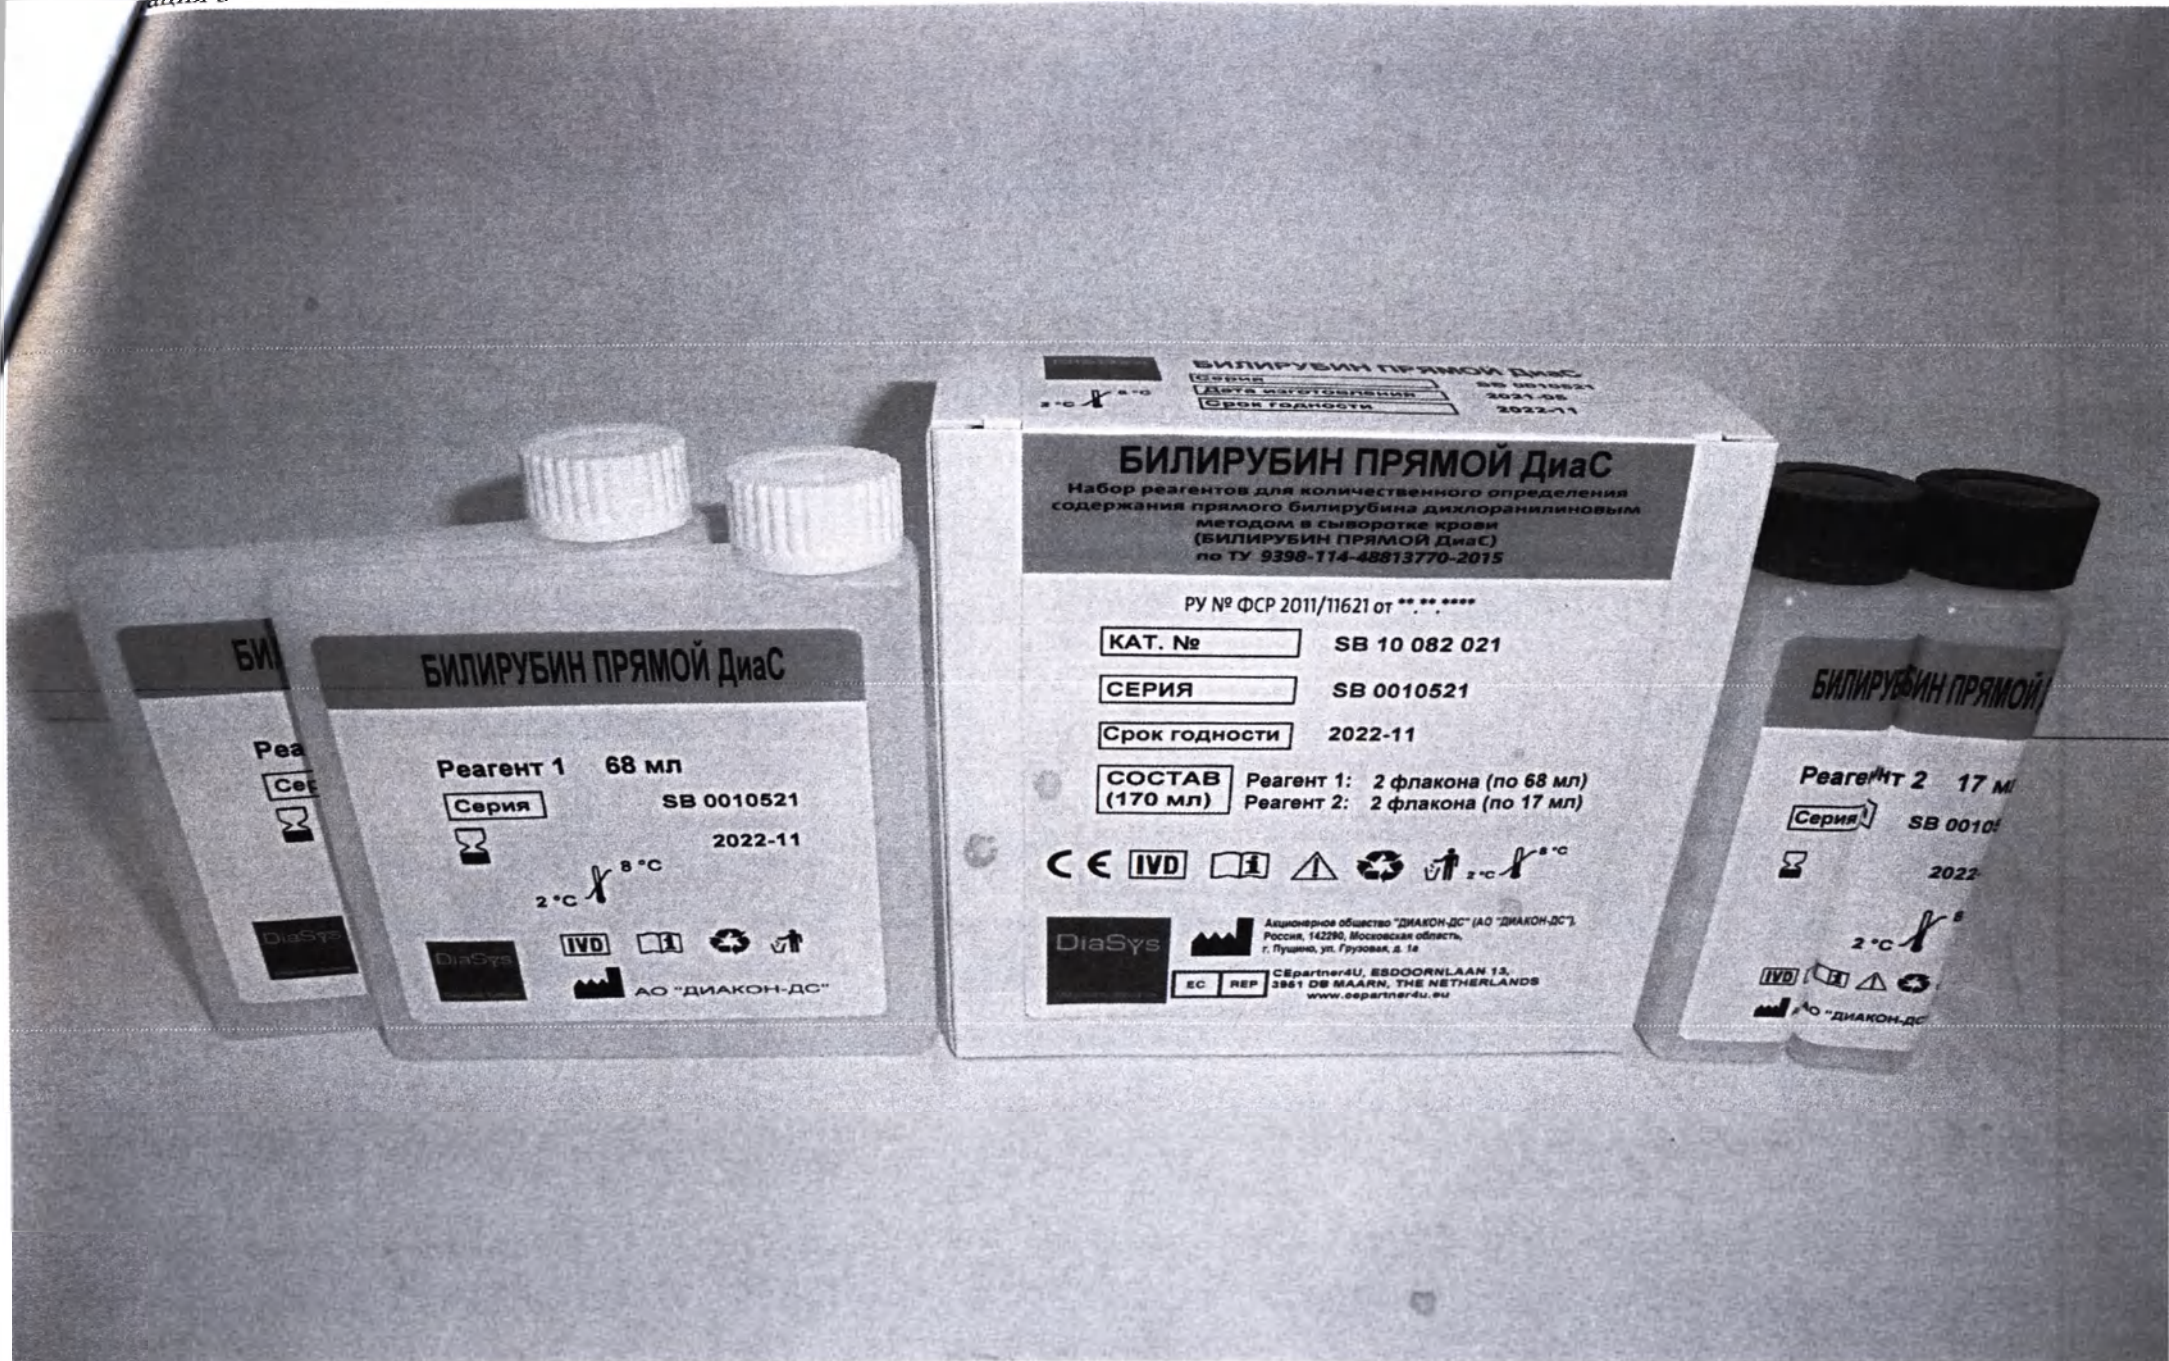

Внешний вид

ра реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ДиаС) по ТУ 9398-114-48813770-2015

ация 4



Внешний вид
реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ДиаС) по ТУ 9398-114-48813770-2015

я 5



Внешний вид

реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ДиаС) по ТУ 9398-114-48813770-2015

для 6 (1)




Внешний вид
Набор реактивов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ДиаС) по ТУ 9398-114-48813770-2015





Внешний вид
реактивов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ДиаС) по ТУ 9398-114-48813770-2015

8

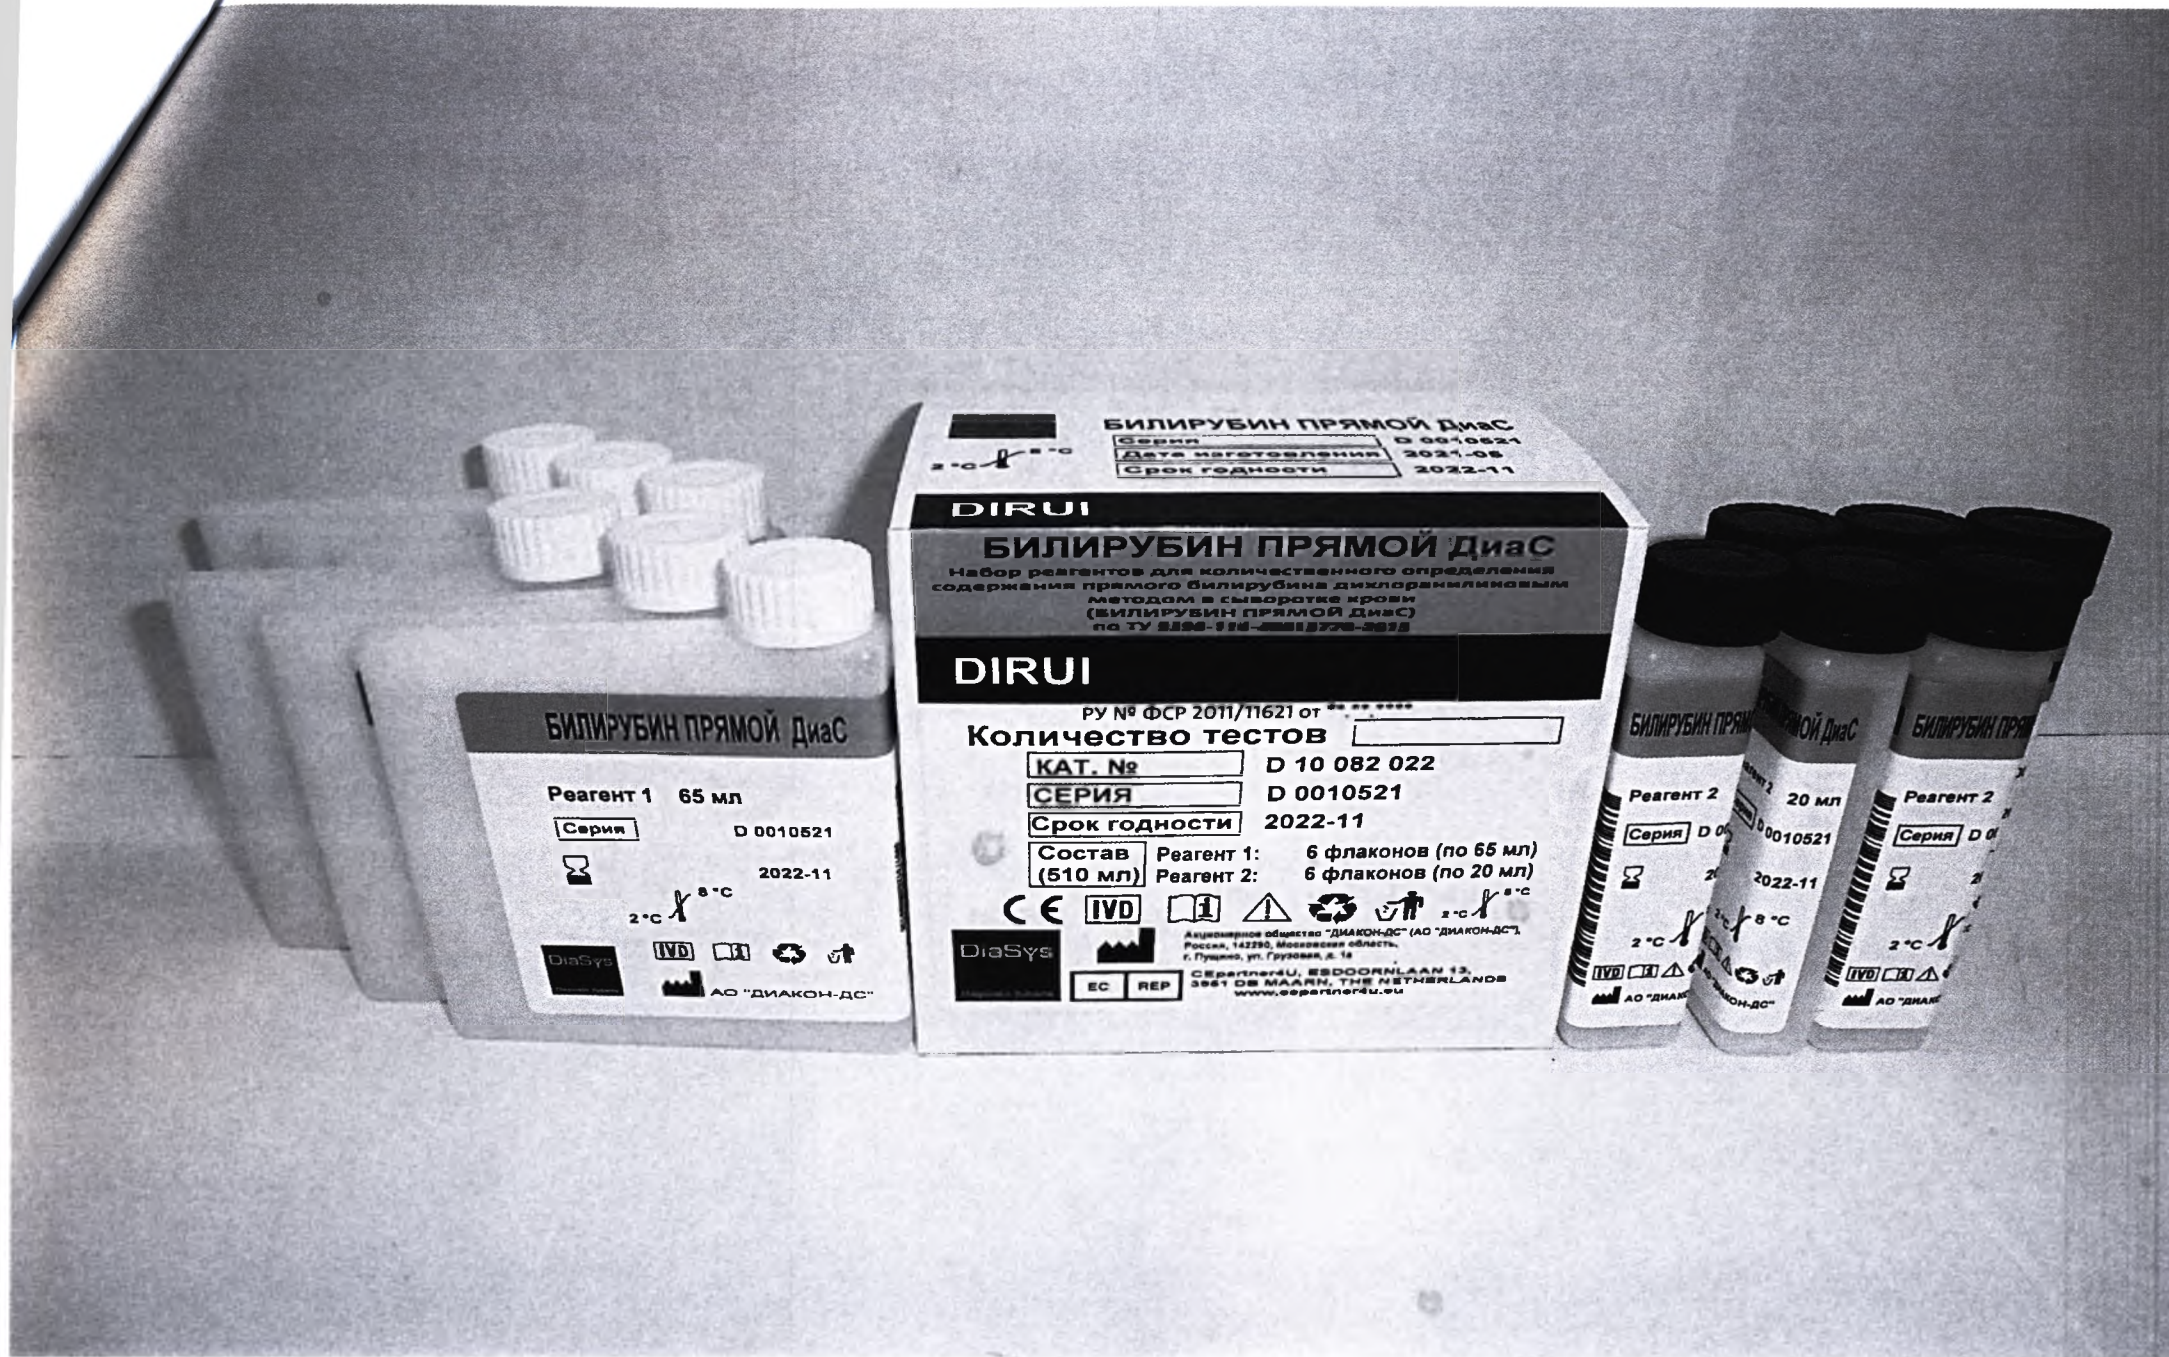

Внешний вид
Реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ДиаС) по ТУ 9398-114-48813770-2015


ия 9



Внешний вид

реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ДиаС) по ТУ 9398-114-48813770-2015

я 10

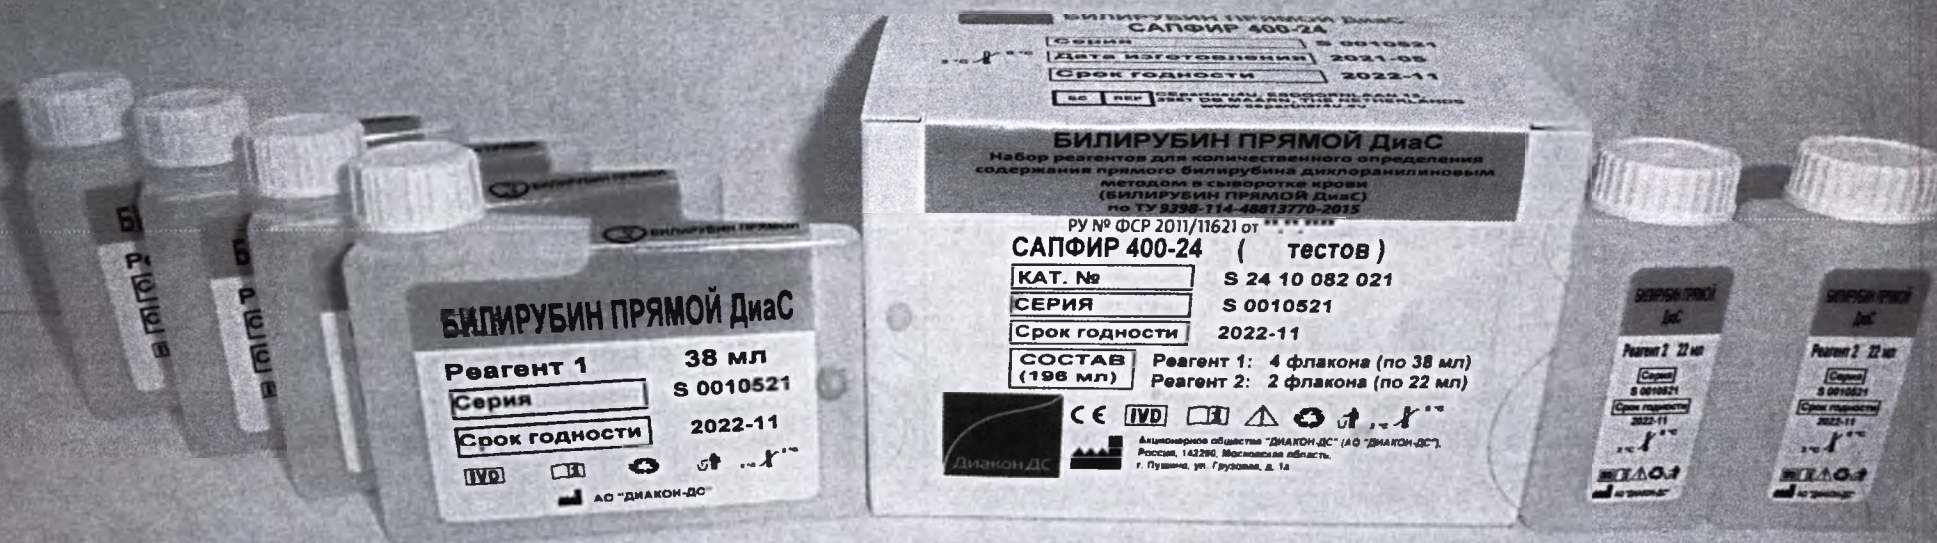



Внешний вид

Набор реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови (БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ДиаС) по ТУ 9398-114-48813770-2015

Страница 12

БИЛ

Реаг

Сер

DiaSys

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ДиаС

Реагент 1 62 мл

Серия

К 0010521

2022-11

2°C

DiaSys

IVD

1

2

3

4

5

6

7

АО "ДИАКОН-ДС"

DiaSys

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ДиаС
Серия
Дата изготовления
Срок годности

К 0010521
2021-08
2022-11

Konelab 20/20i/30/60

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ДиаС

Набор реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови (БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ДиаС) по ТУ 9398-114-48813770-2015

Konelab 20/20i/30/60

РУ № ФСР 2011/11621 от 09.09.2011

Количество тестов

КАТ. №

К 10 082 021

СЕРИЯ

К 0010521

Срок годности

2022-11

СОСТАВ
(160 мл)

Реагент 1: 2 флакона (по 62 мл)
Реагент 2: 2 флакона (по 18 мл)

CE

IVD

1

2

3

4

5

6

7

DiaSys

EC

MS

Акционерное общество "ДИАКОН-ДС" (АО "ДИАКОН-ДС"),
Россия, 162296, Новгородская область,
г. Пущино, ул. Грозненская, д. 14

SEPARTECH B.V., EERDHOORNLAAN 13,
3951 DB MAARN, THE NETHERLANDS
www.separtech.eu

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ

Реагент 2

Серия

К 001

2022

2°C

IVD

1

2

3

4

5

6

7

АО "ДИАКОН-ДС"

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ

Реагент 2

Серия

К 001

2022

2°C

IVD

1

2

3

4

5

6

7

АО "ДИАКОН-ДС"

Внешний вид

Набор реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови (БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ДиаС) по ТУ 9398-114-48813770-2015



ПУ № ФСР 2011/11621 от **.*.***



Количество тестов

КАТ. № К 10 082 022
СЕРИЯ К 0010521
Срок годности 2022-11

Состав Реагент 1: 5 флаконов (по 62 мл)
Реагент 2: 5 флаконов (по 18 мл)


DiaSys IVD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Акционерное общество "ДИАКОН-ДС" (АО "ДИАКОН-ДС"),
Россия, 143290, Московская область,
г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а

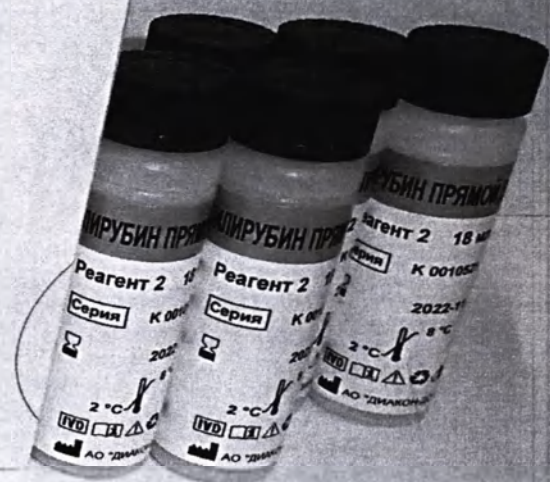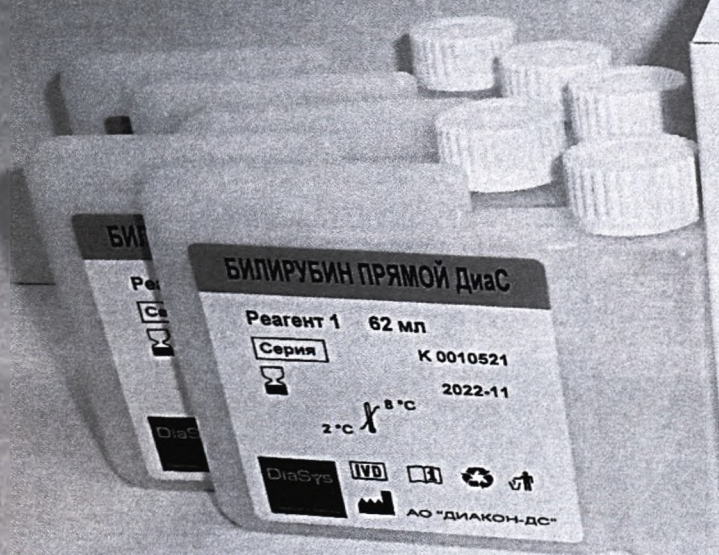


реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ДиаС) по ТУ 9398-114-48813770-2015

14 (1)

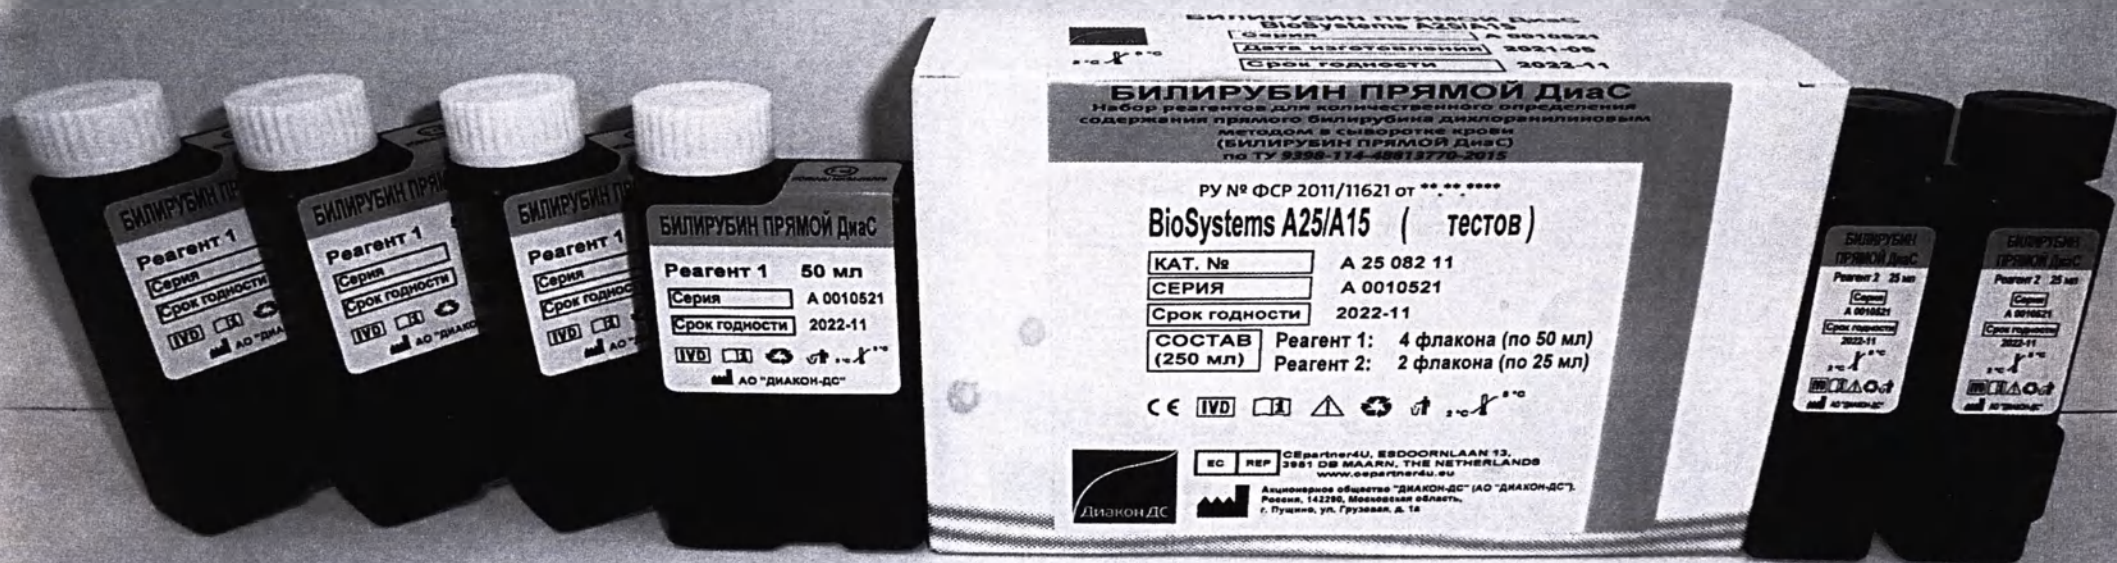

Внешний вид
Реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ДиаС) по ТУ 9398-114-48813770-2015

14 (2)

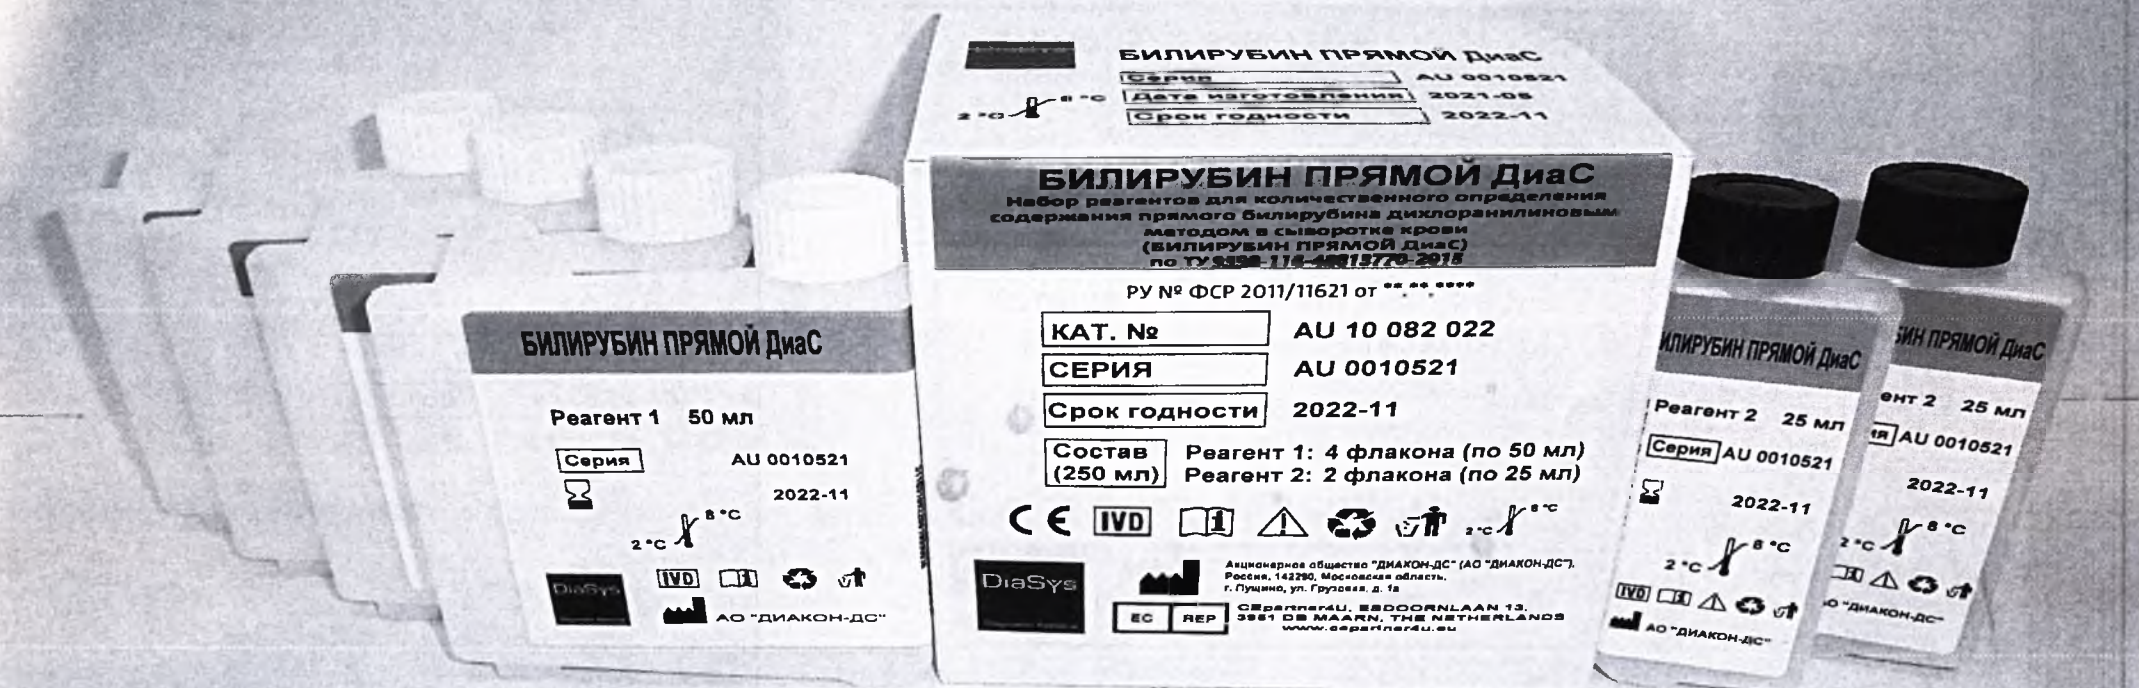

Внешний вид
реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛУРУБИН ПРЯМОЙ ДиаС) по ТУ 9398-114-48813770-2015


15



Внешний вид

реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови (БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ДиаС) по ТУ 9398-114-48813770-2015


дизайн 16

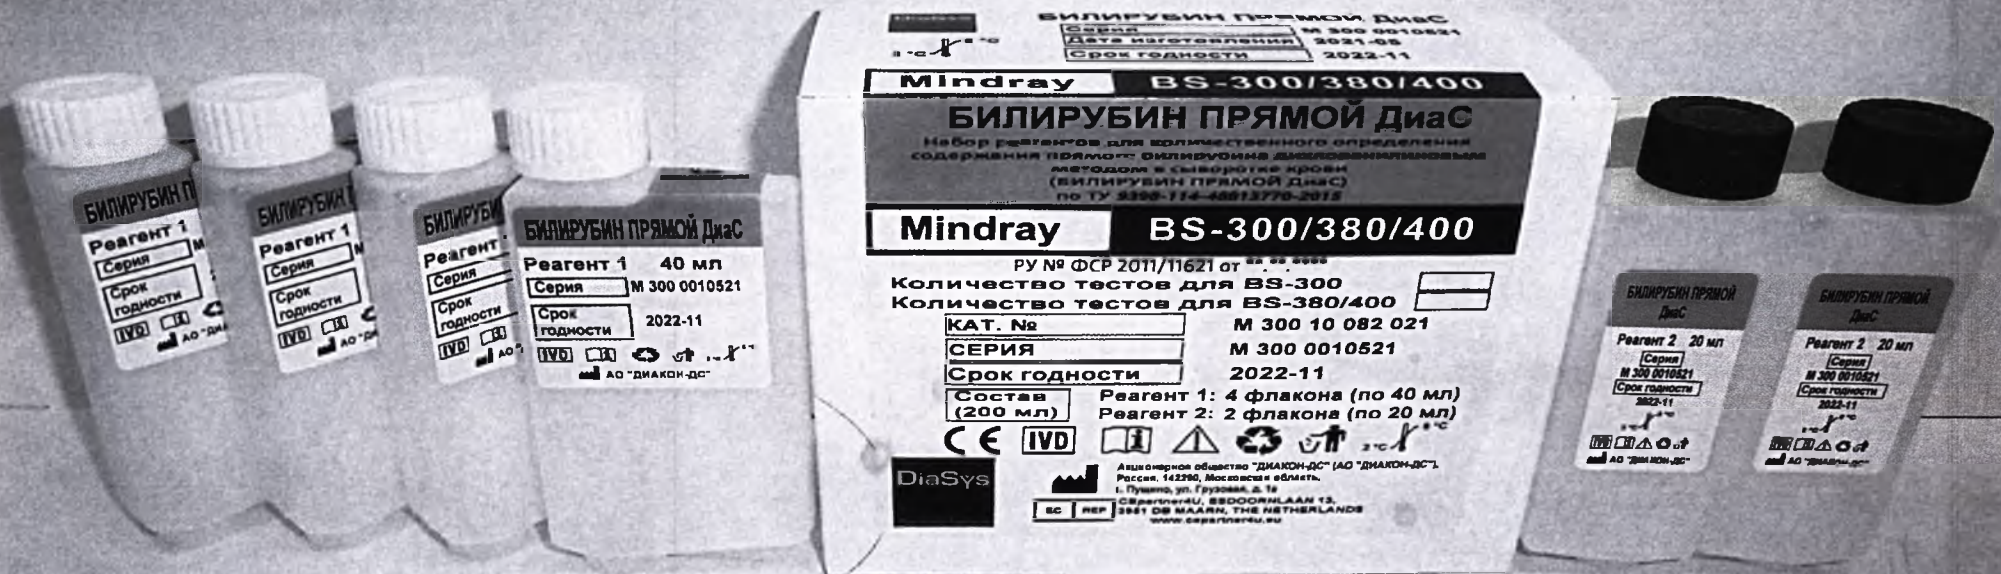

Внешний вид

реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови (БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ДиаС) по ТУ 9398-114-48813770-2015


ния 17

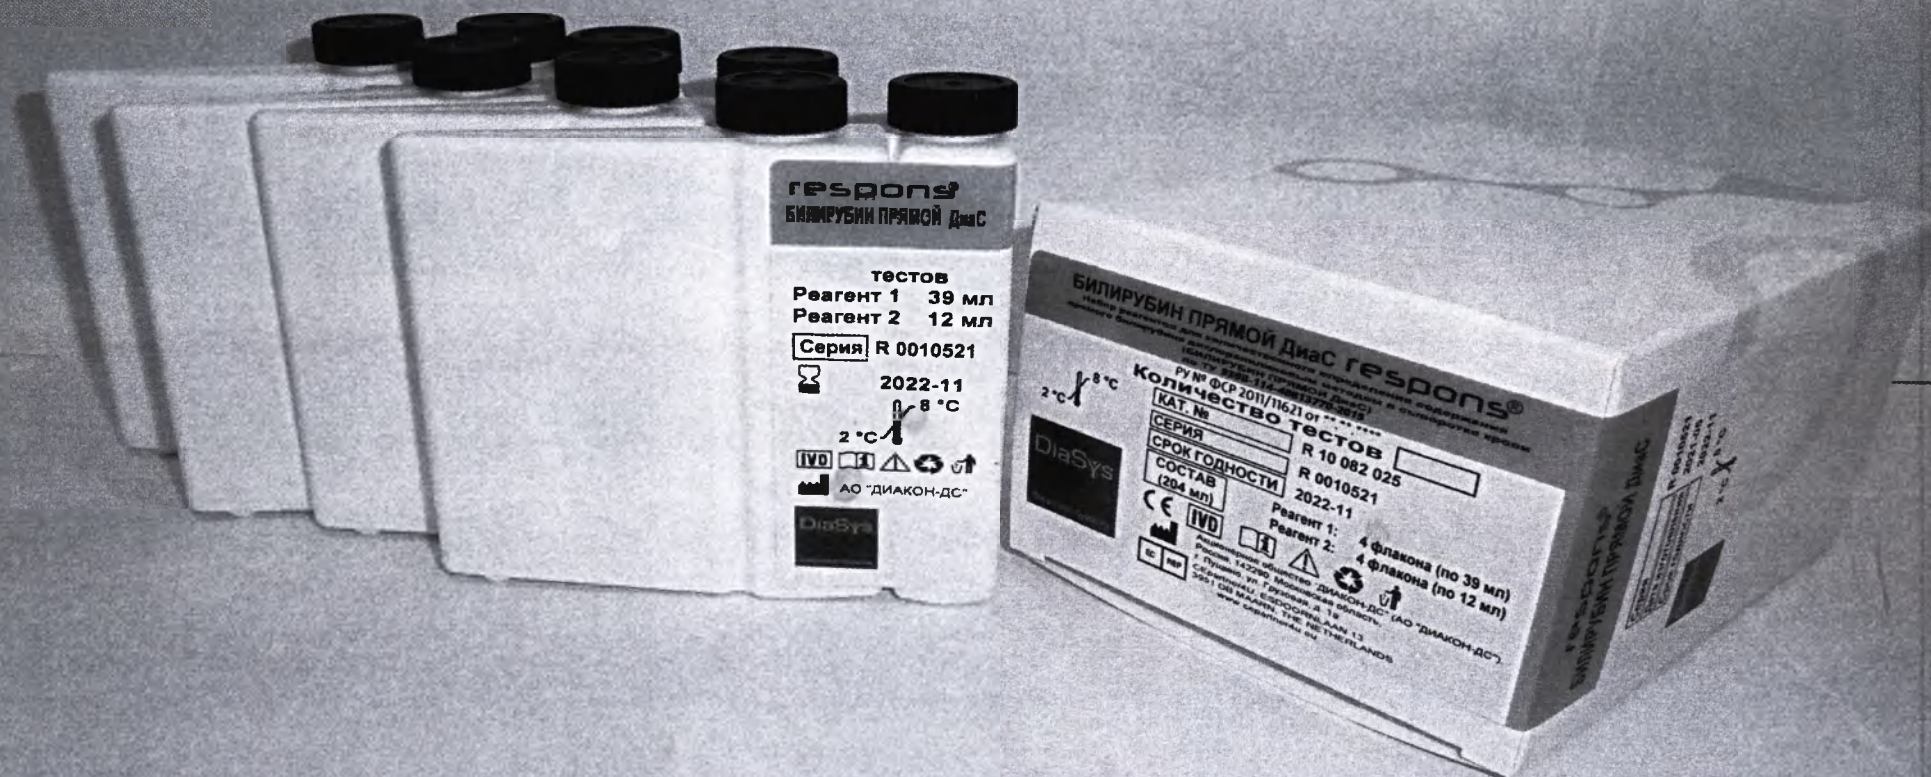

Внешний вид


реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови (БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ДиаС) по ТУ 9398-114-48813770-2015

ия 18

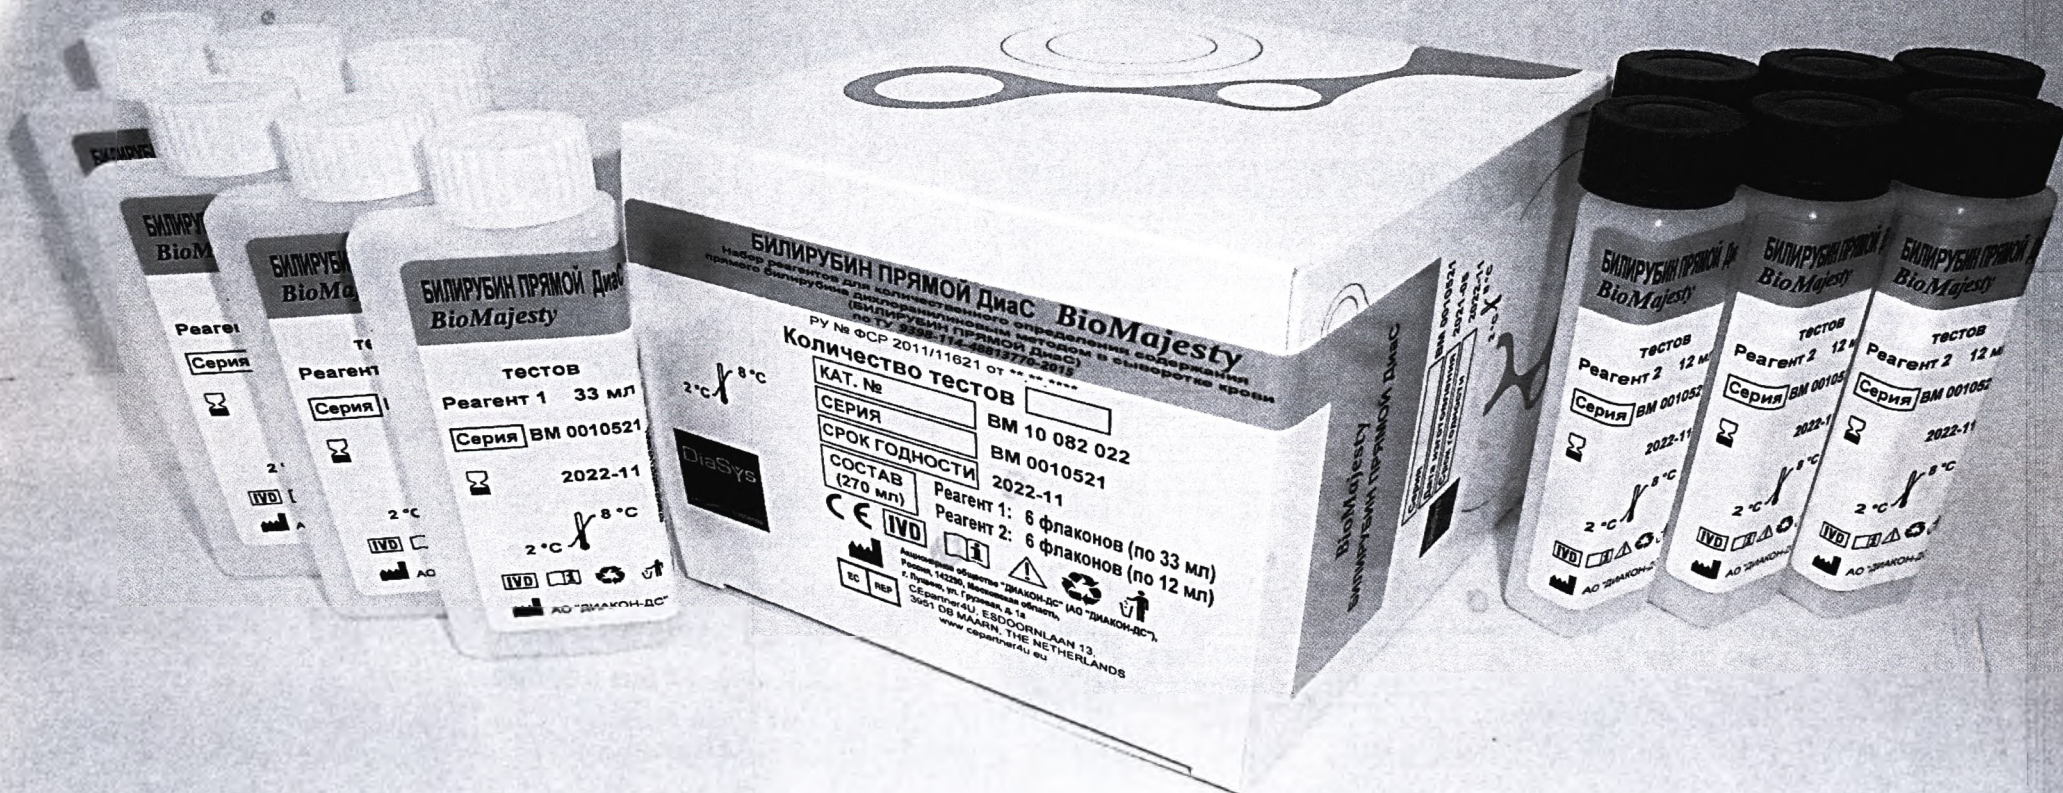

Внешний вид
реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ДиаС) по ТУ 9398-114-48813770-2015

дия 19

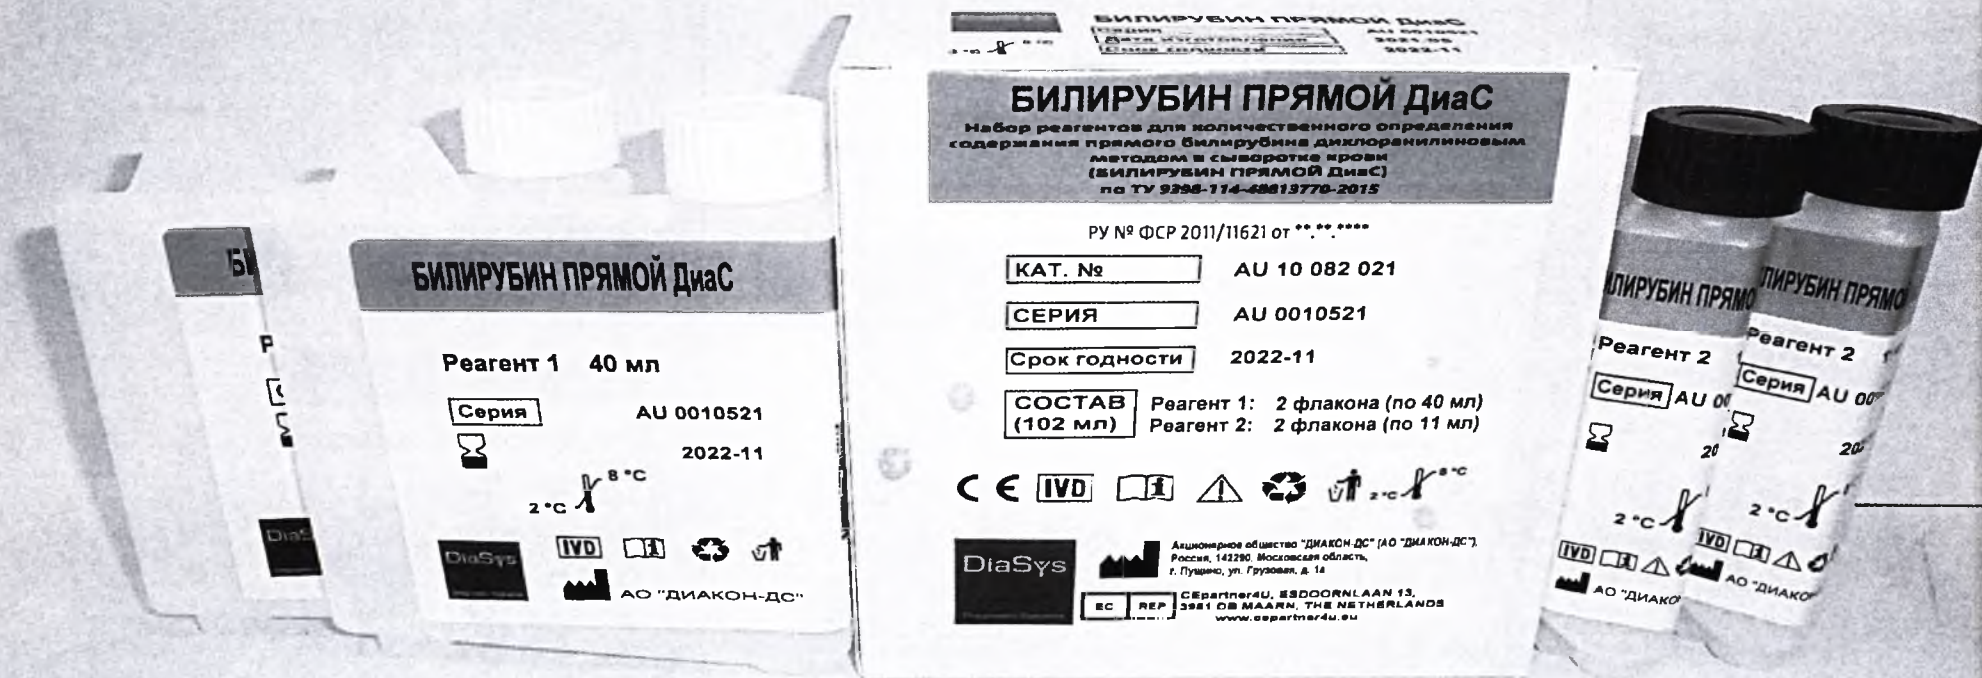

Внешний вид
реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ДиаС) по ТУ 9398-114-48813770-2015


ия 20



Внешний вид

реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови (БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ДиаС) по ТУ 9398-114-48813770-2015


дня 21

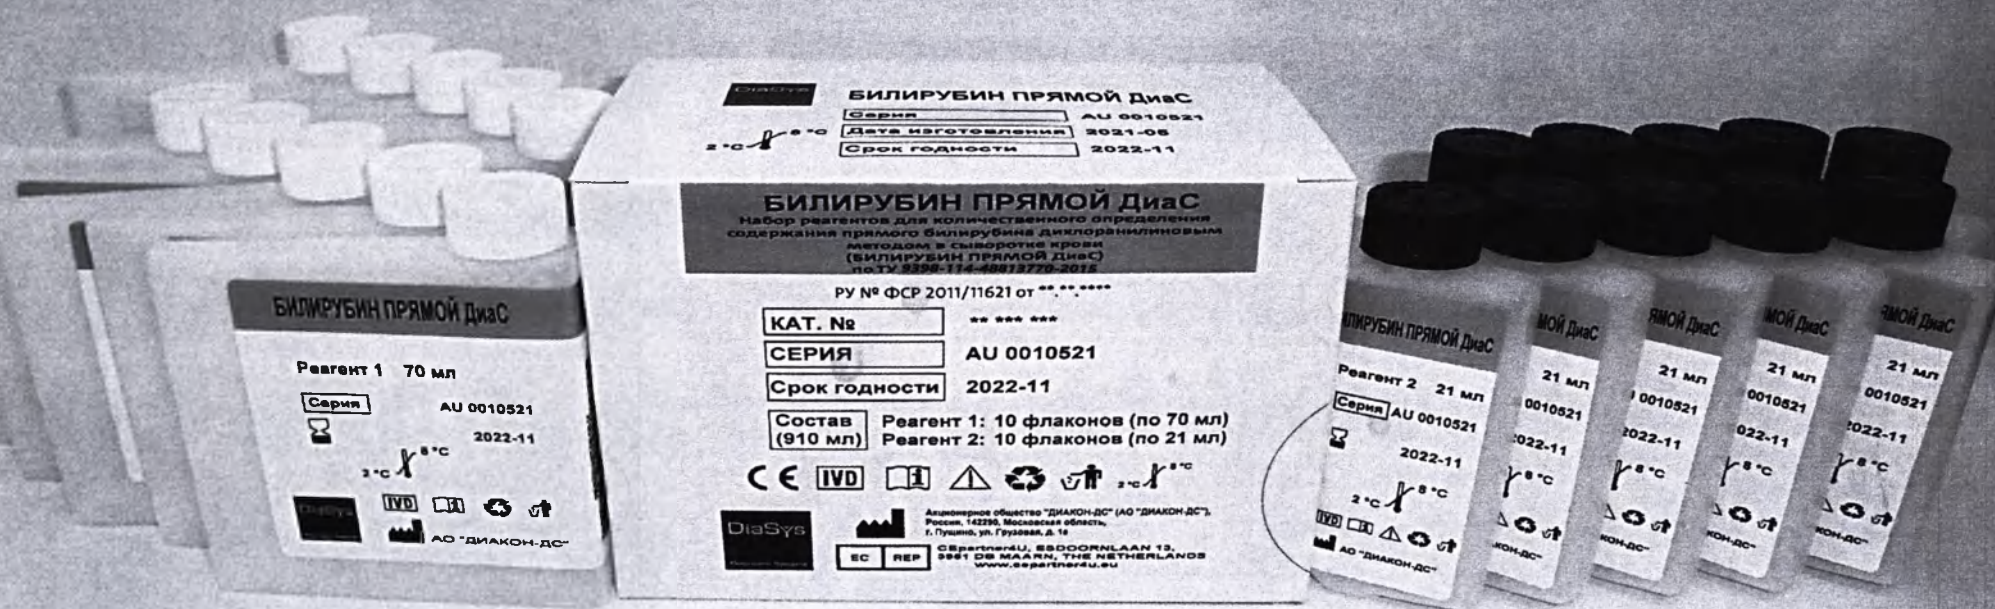

Внешний вид


реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови (БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ДиаС) по ТУ 9398-114-48813770-2015

ия 22 (1)

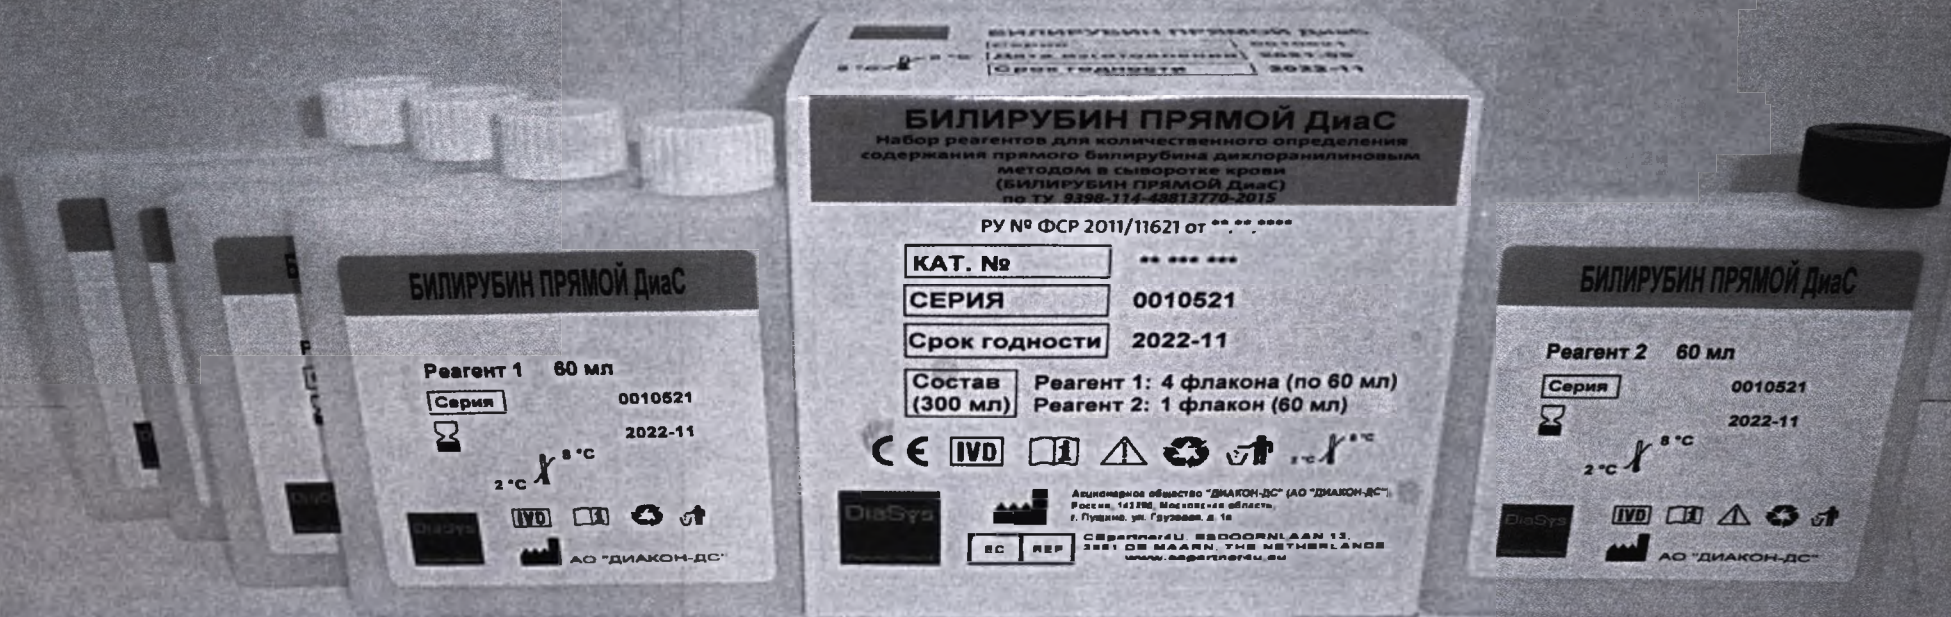

ДИА 22 (2)

Внешний вид
реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ДиаС) по ТУ 9398-114-48813770-2015

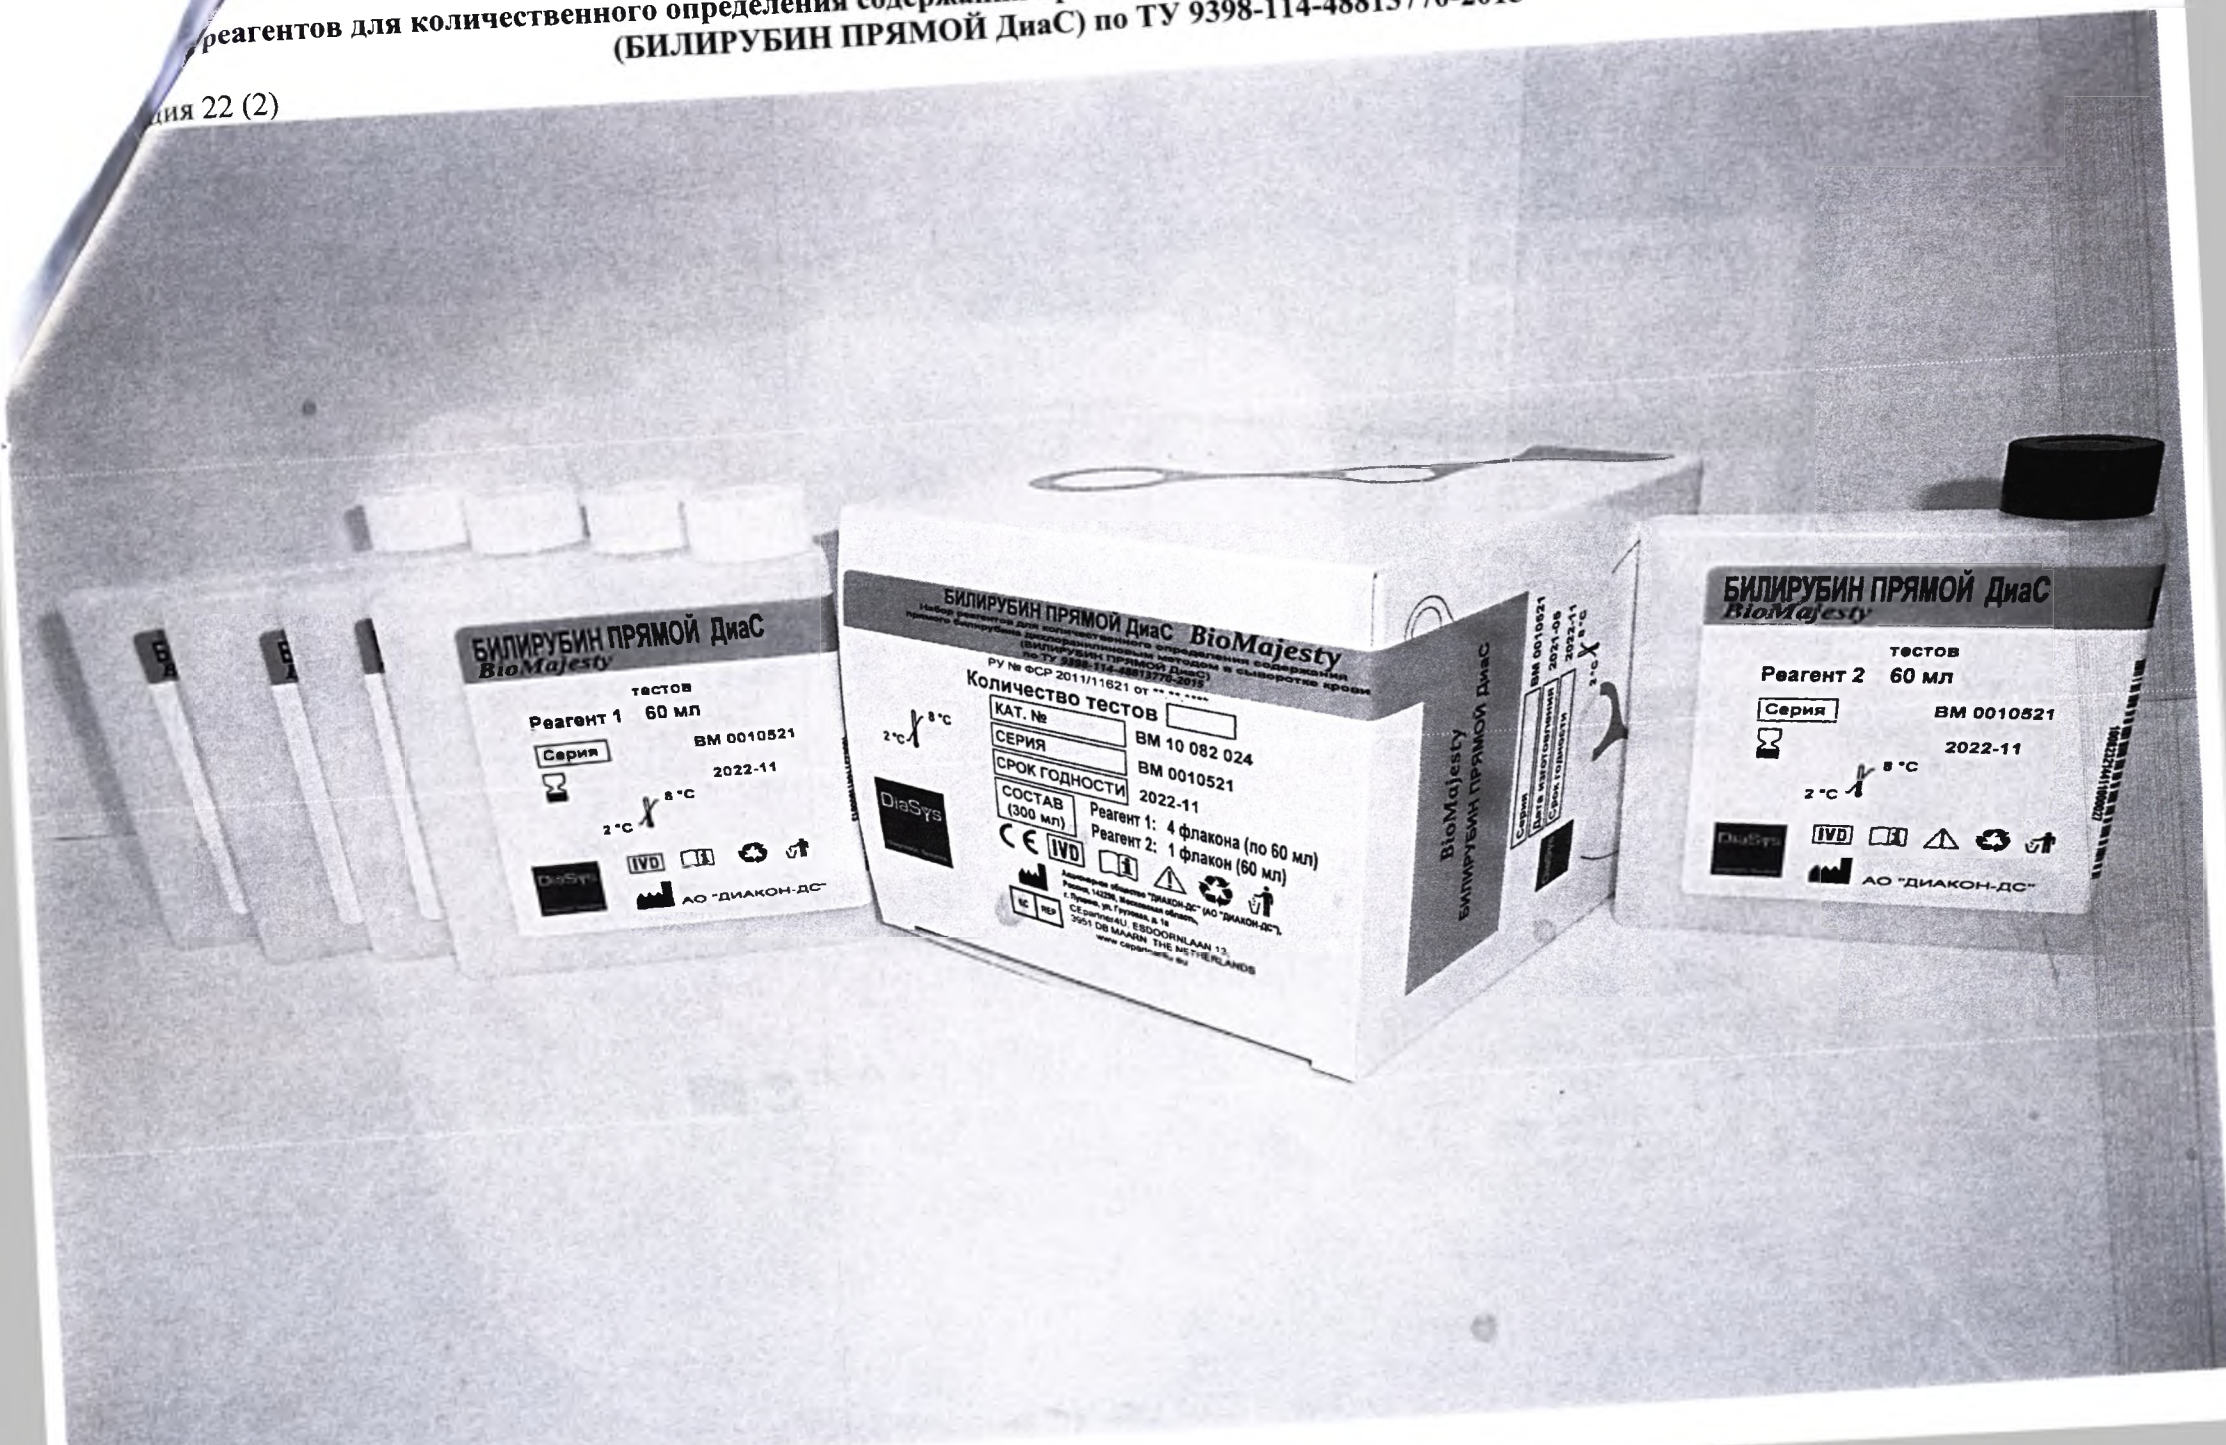

Внешний вид
реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ДиаС) по ТУ 9398-114-48813770-2015

ия 23



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 26

Генеральный директор
АО «ДИАКОН-ДС»

 Т.Ю. Корзун

