



Внешний вид
Набора реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДиаС)




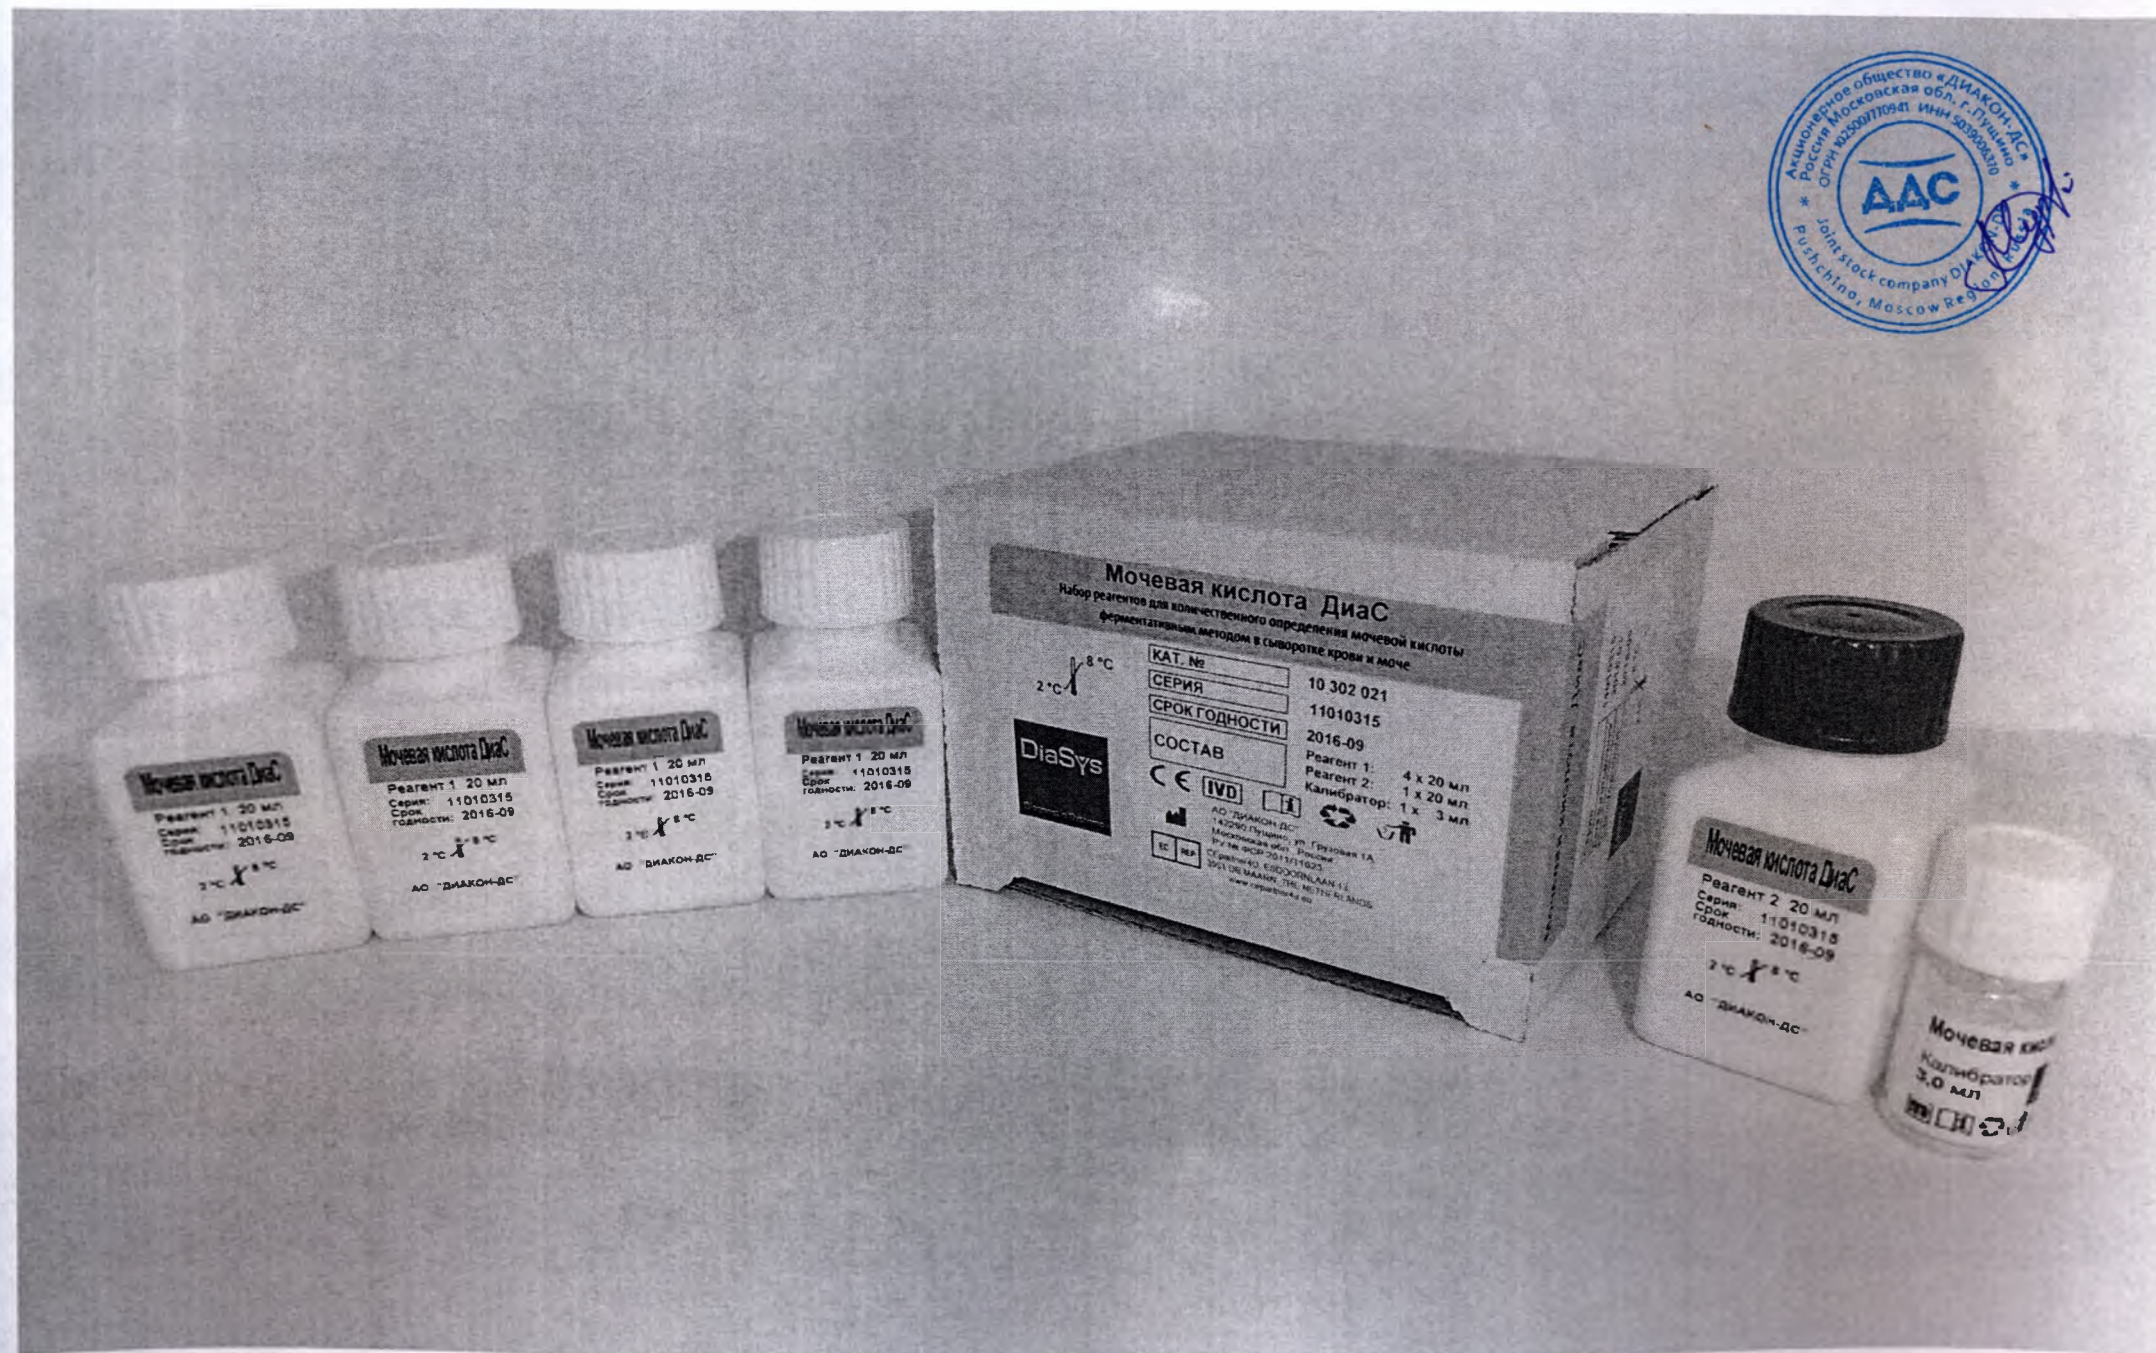


Внешний вид


Набора реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче (МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДиаС)

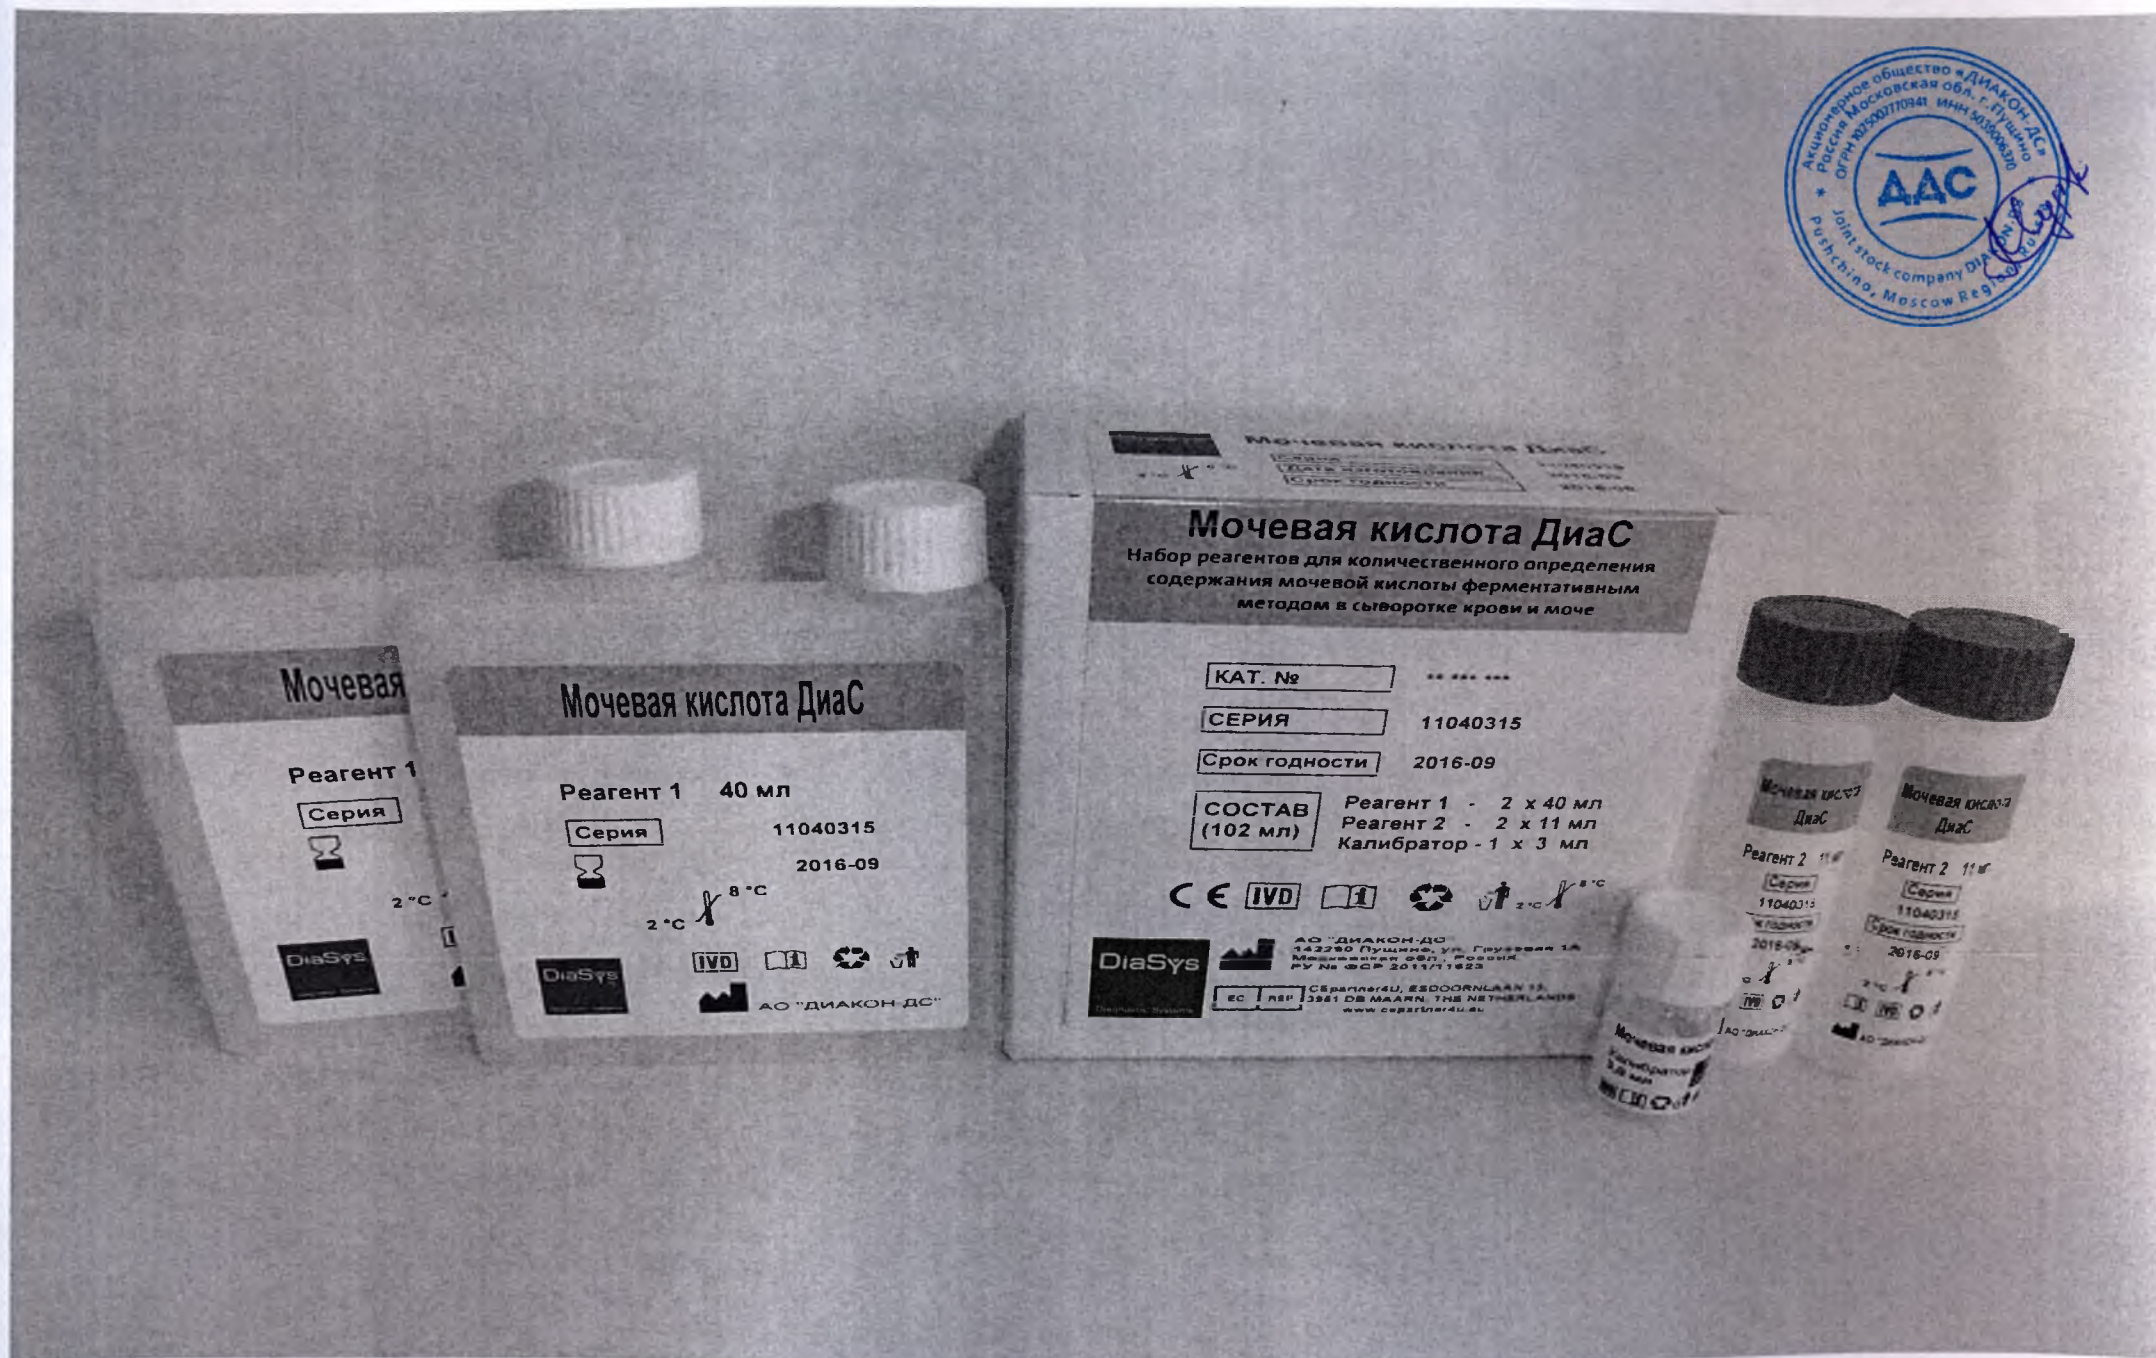

Внешний вид
Набора реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДиаС)

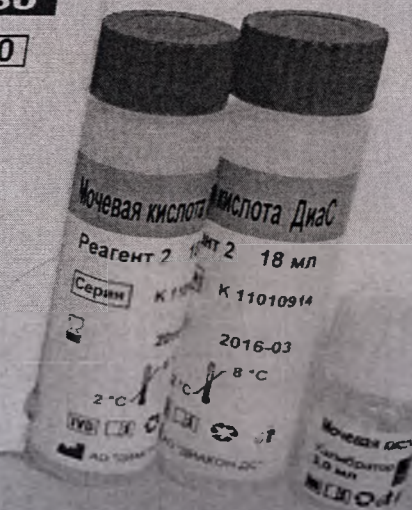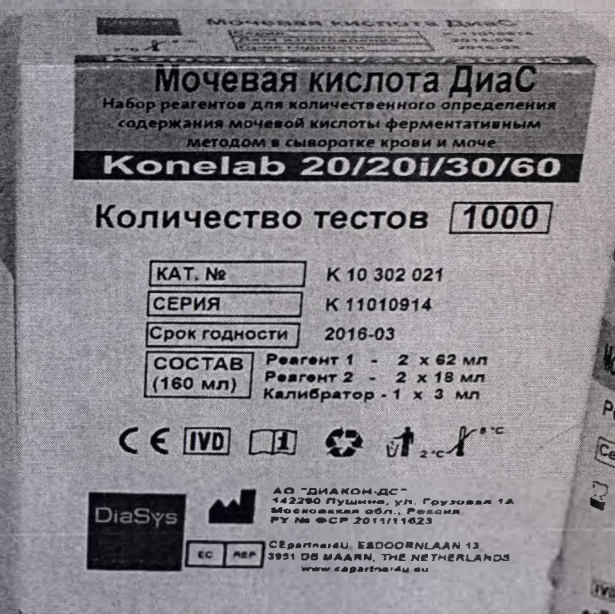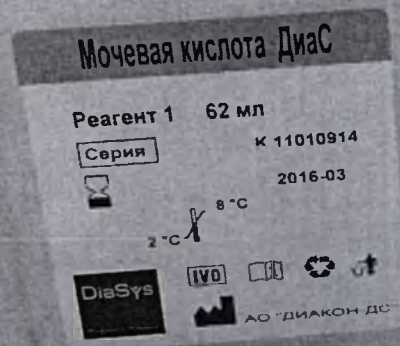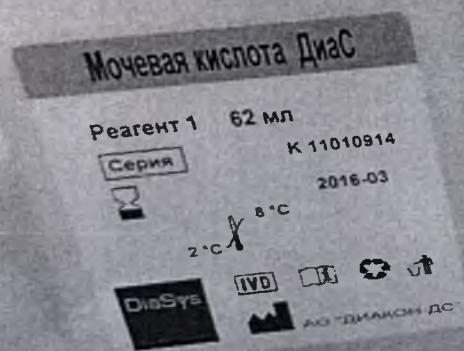




Внешний вид
Набора реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДиаС)

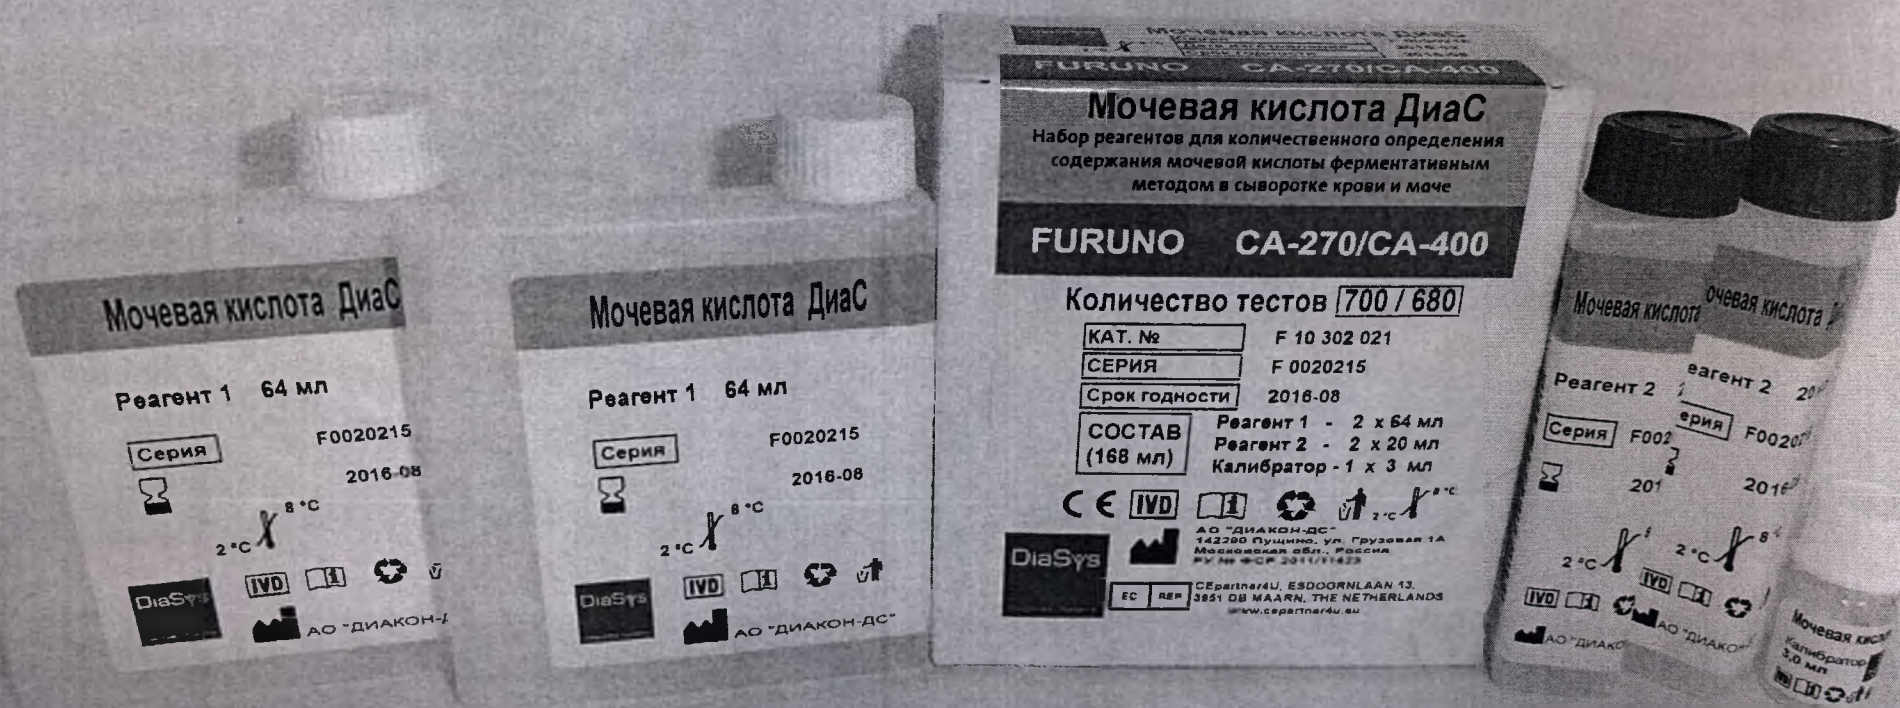



Внешний вид
Набора реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДиаС)



Набора реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче (МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДиаС)


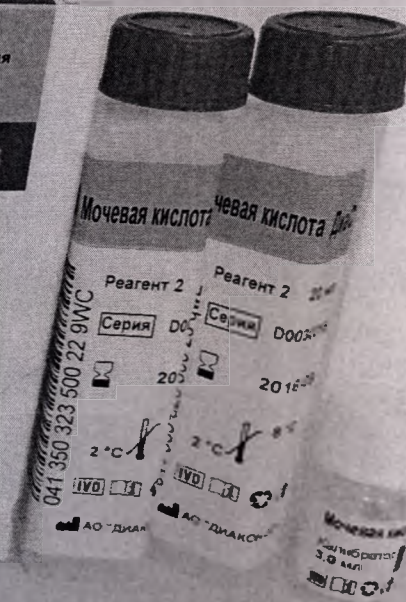
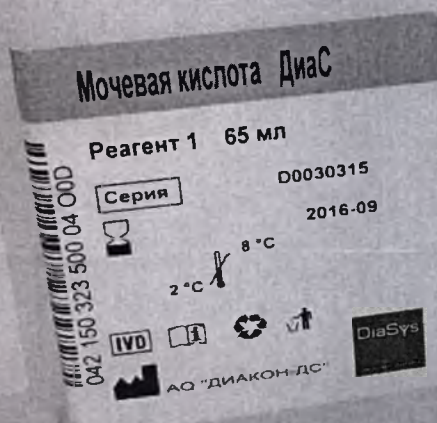
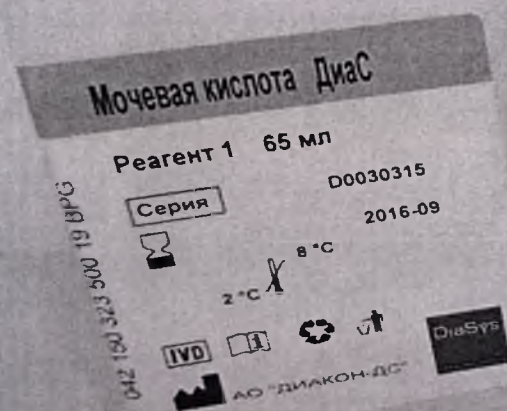


Внешний вид
Набора реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДиаС)

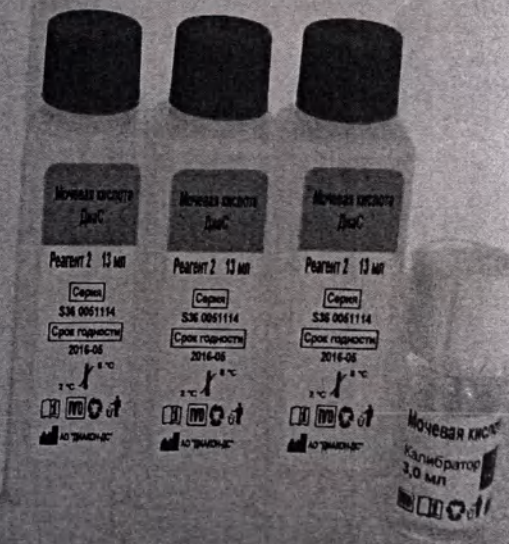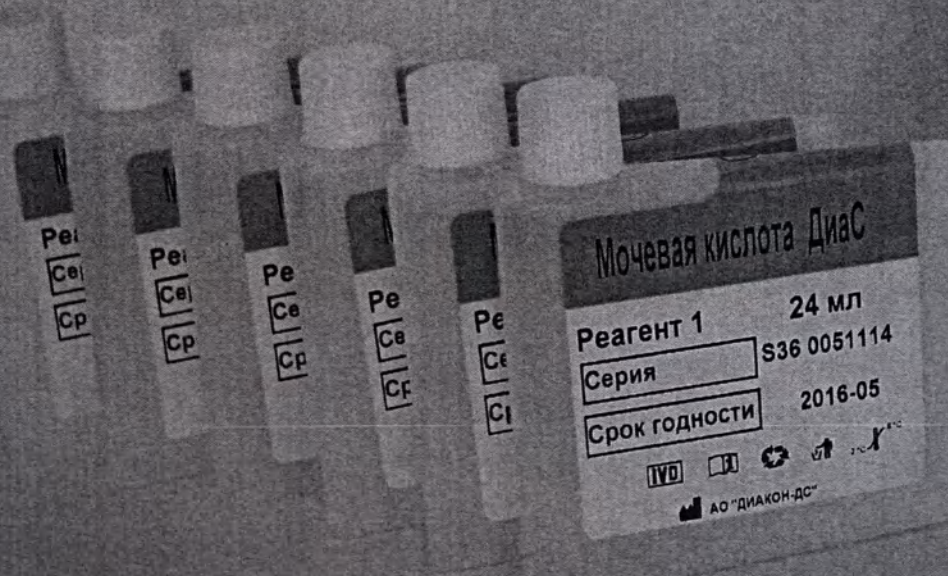



Внешний вид

Набора реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче (МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДиаС)

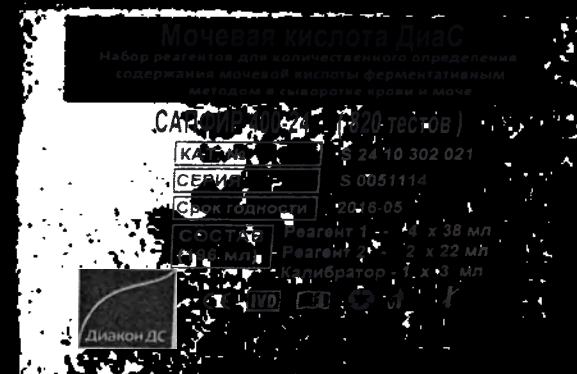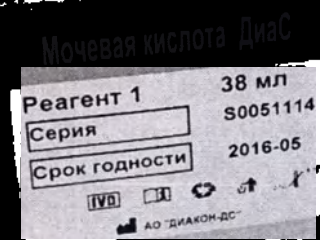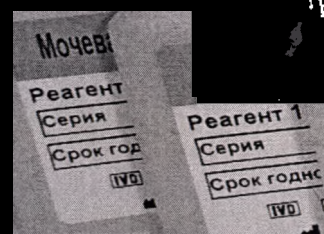

Внешний вид

Набора реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДиаС)

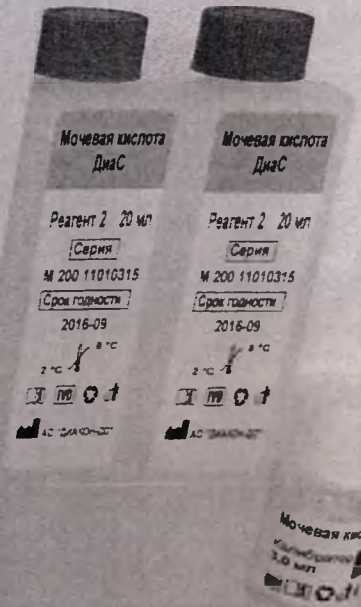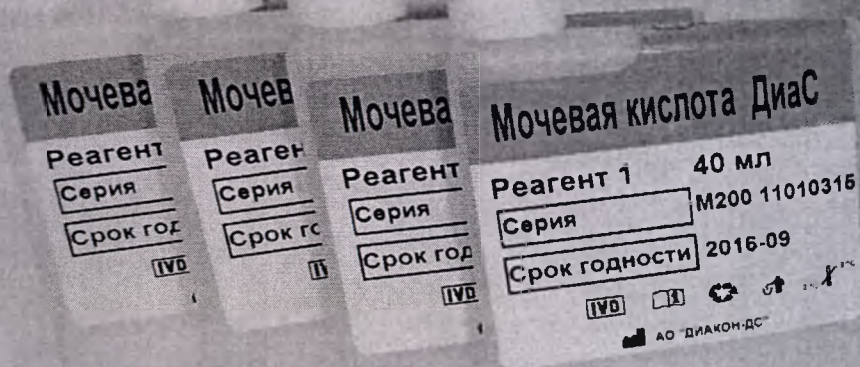


Набора реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДиаС)




Внешний вид

Набора реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДиаС)

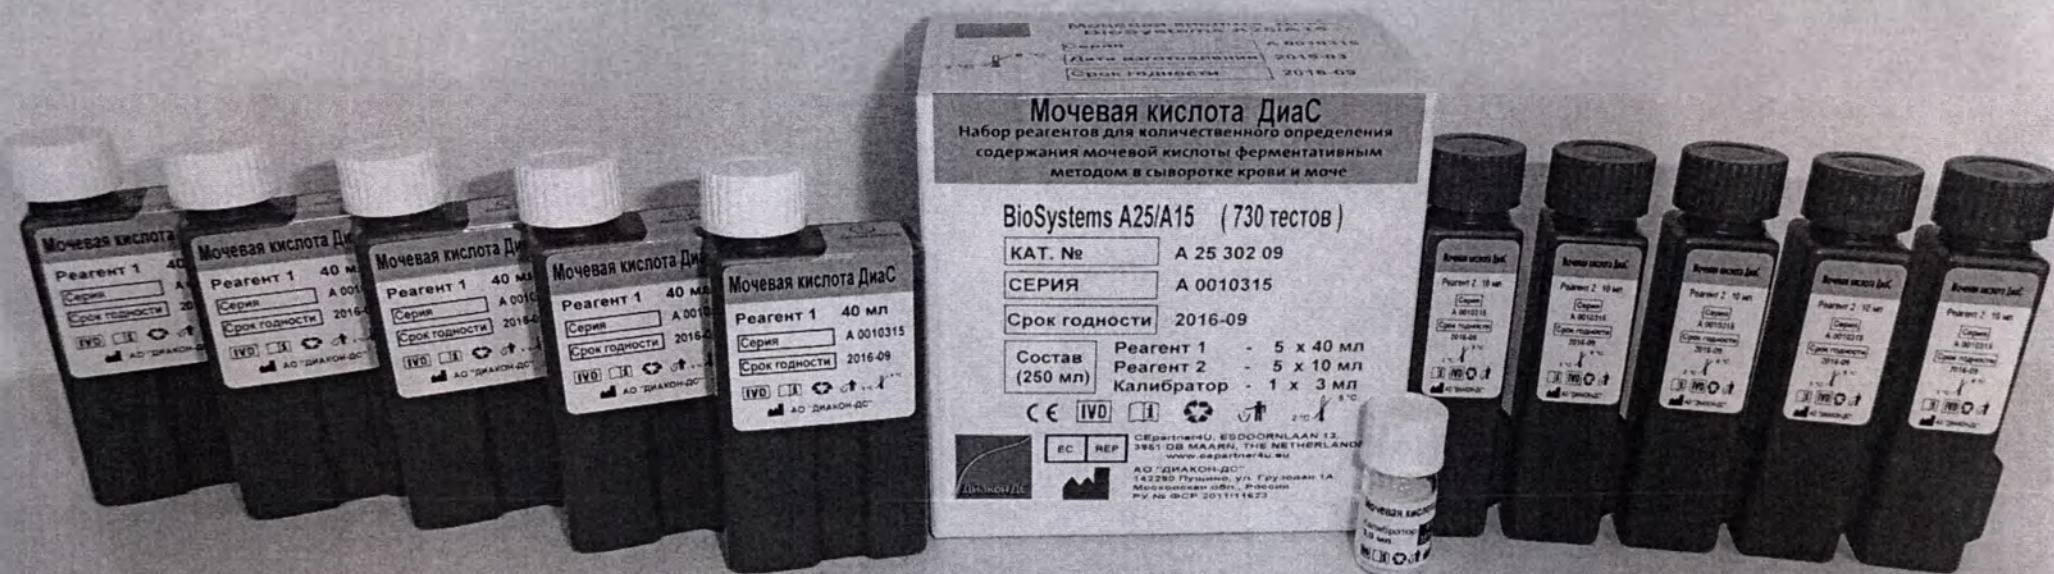


Внешний вид

Набора реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДиаС)

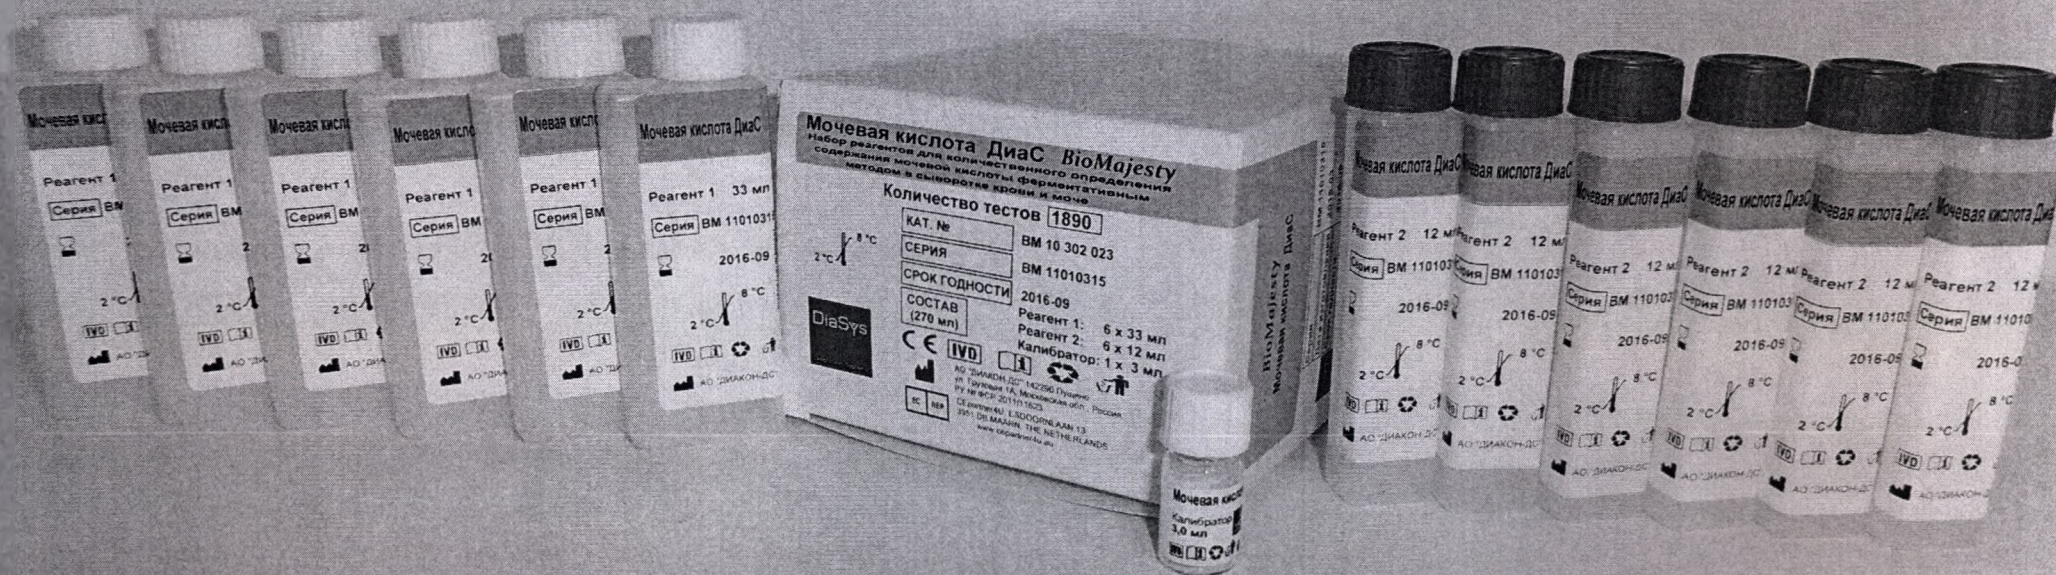


Набора реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДиаС)

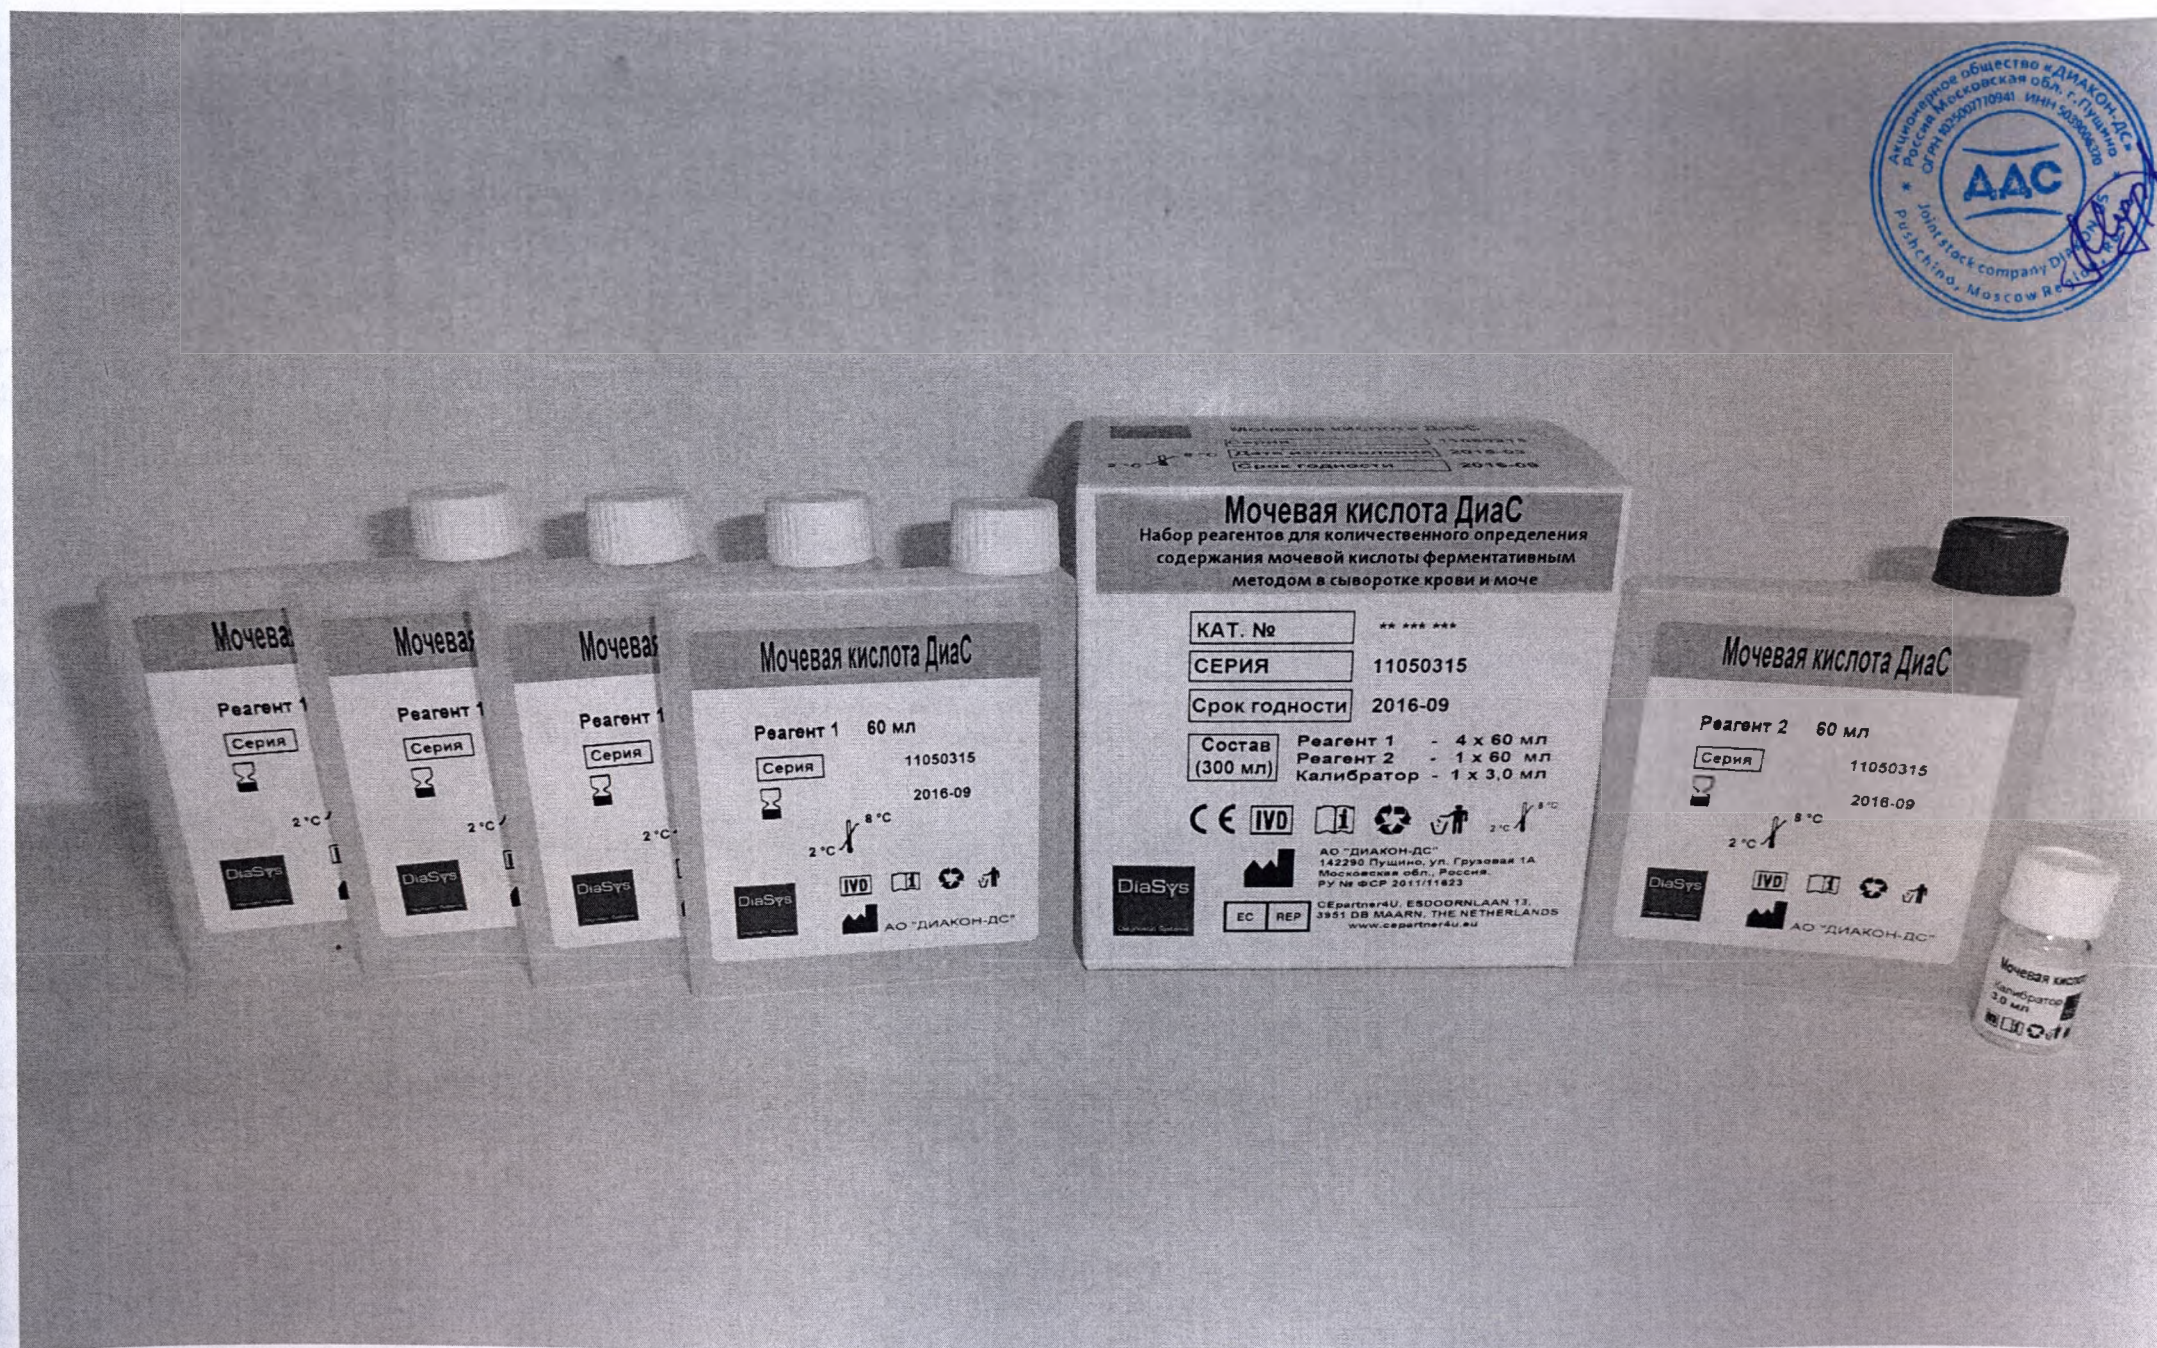


Внешний вид
Набора реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДиаС)




Внешний вид
Набора реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДиаС)

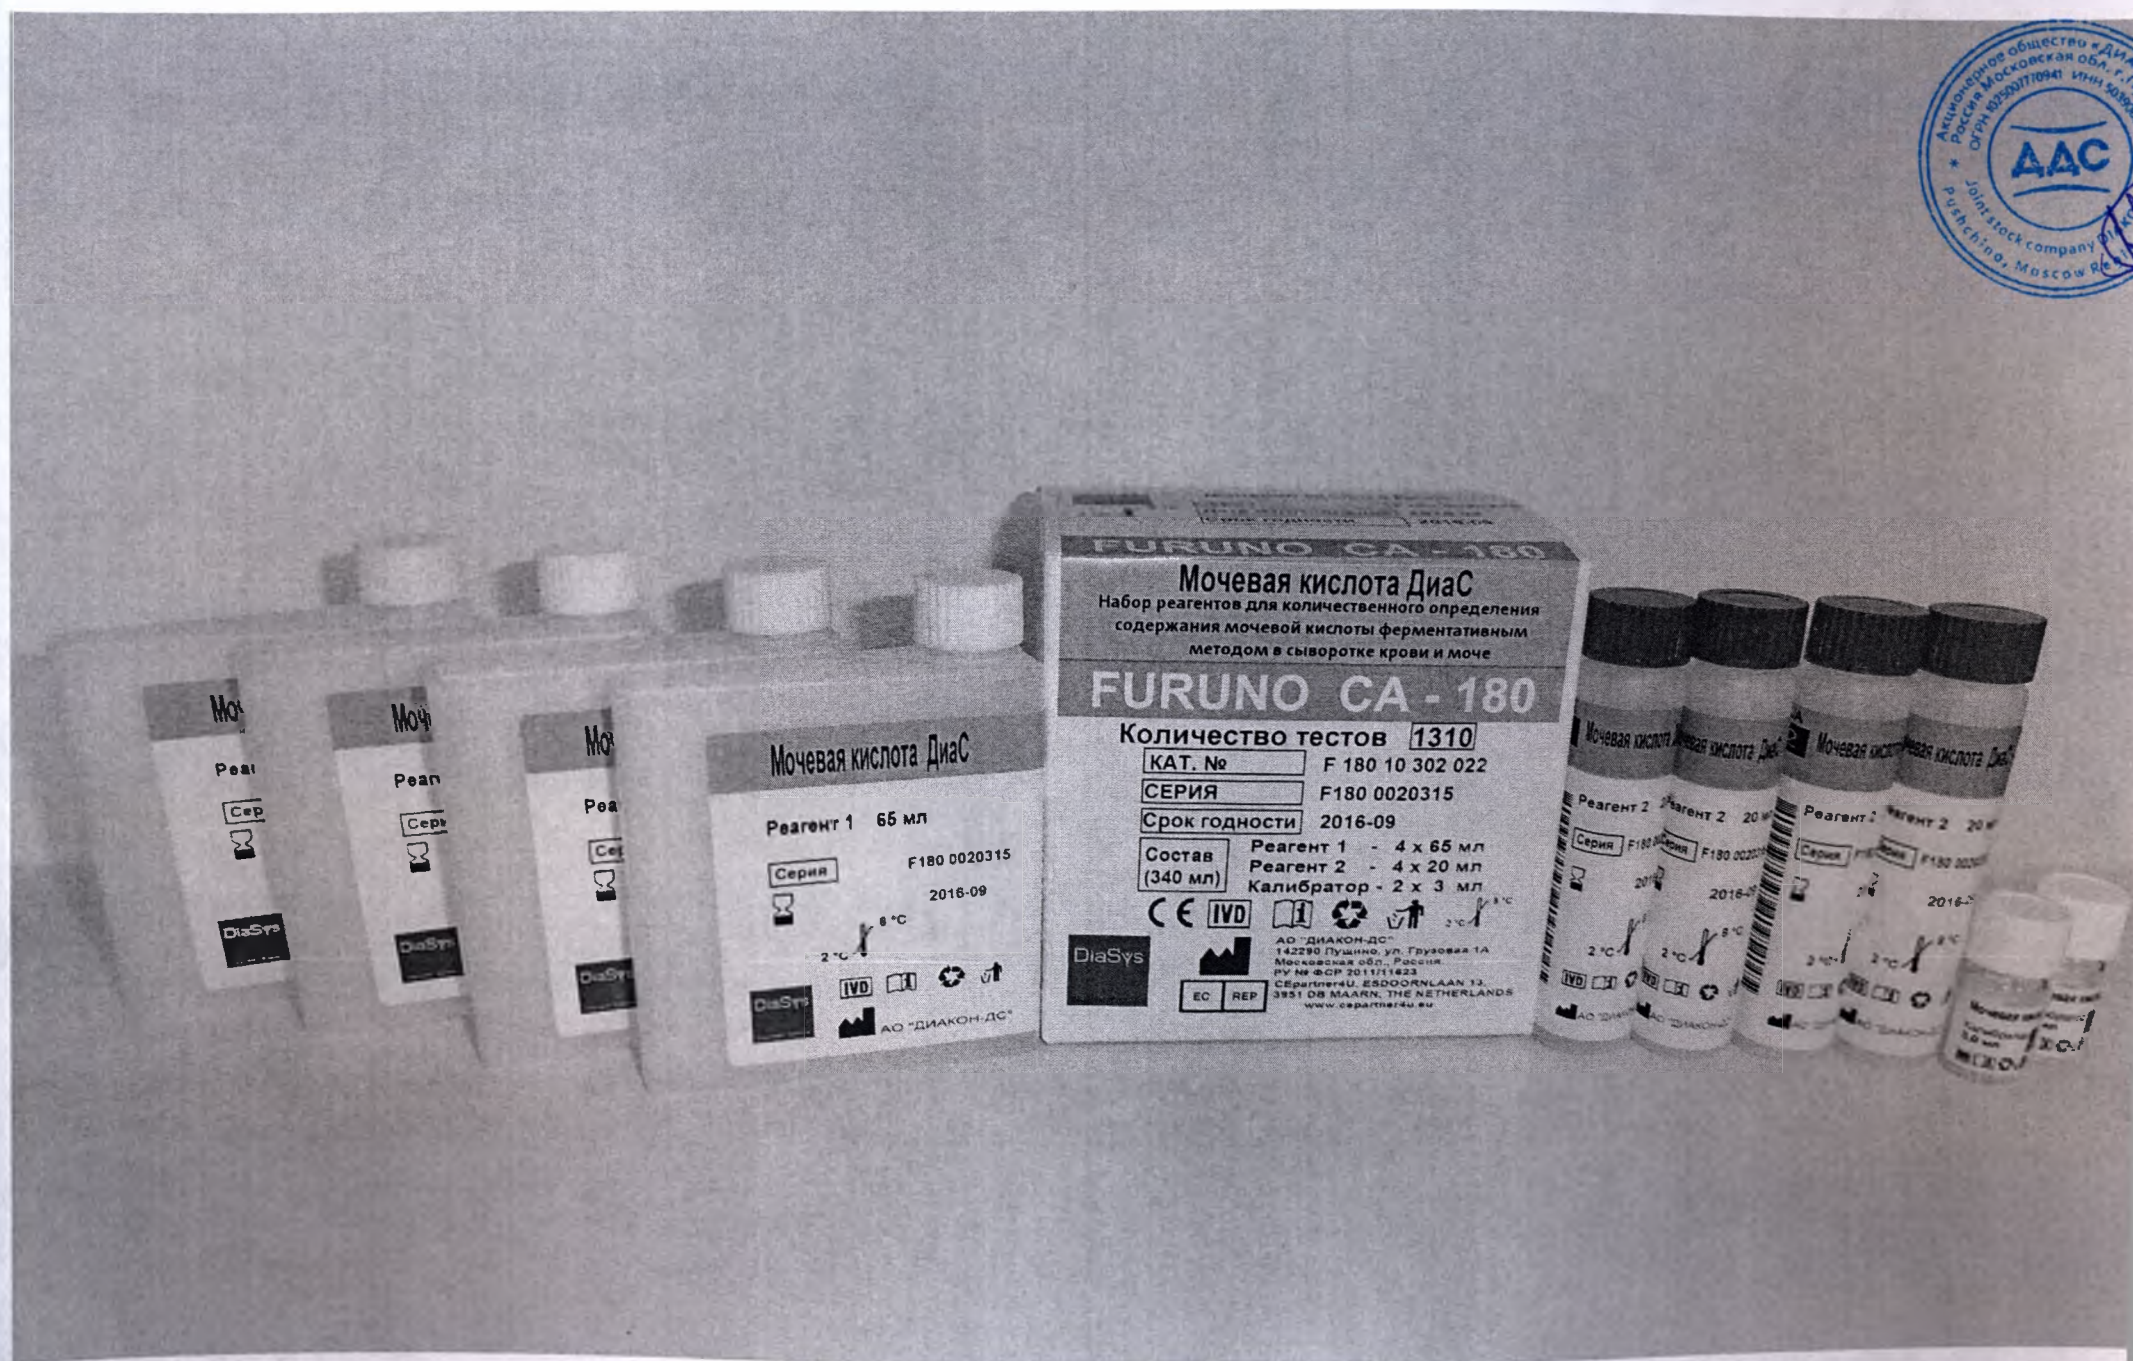

**Набора реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДиаС)**

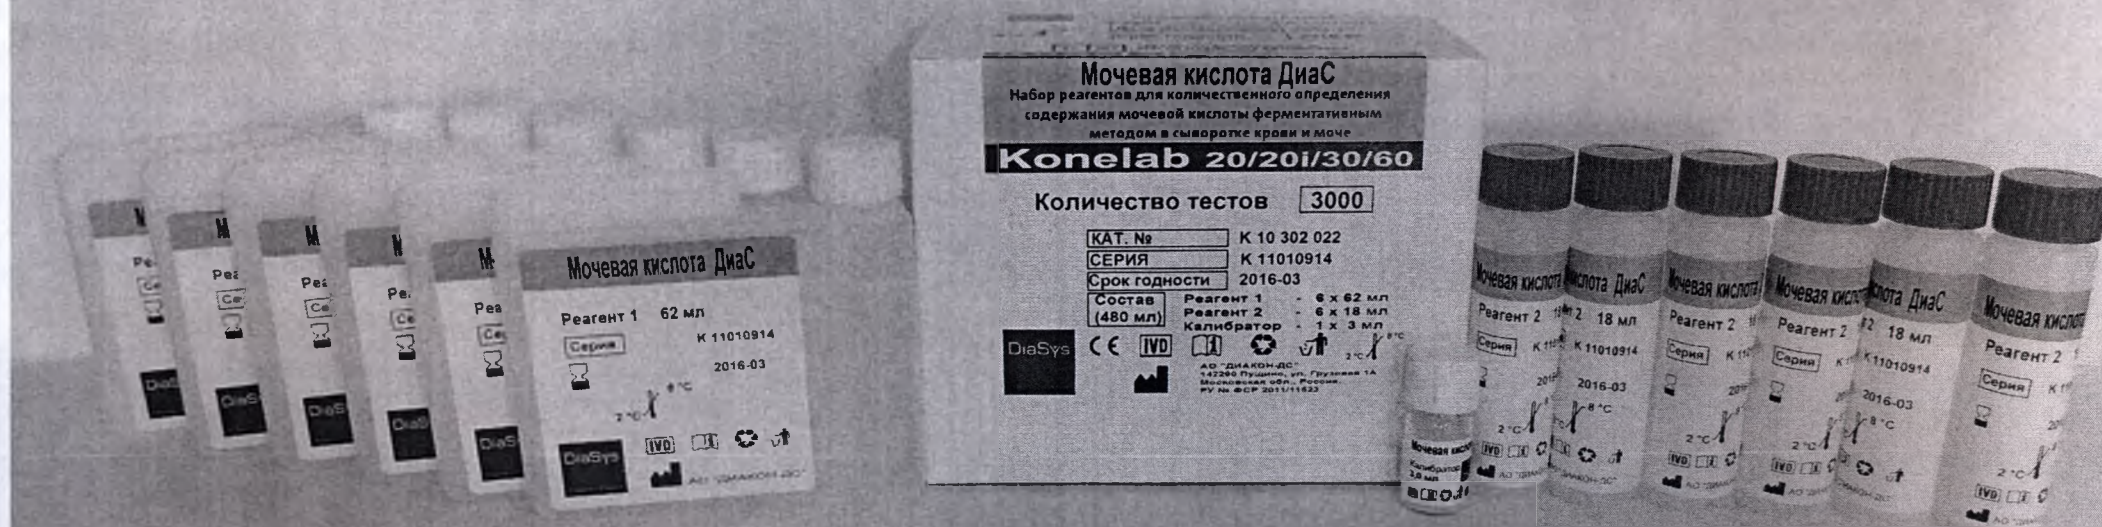


Внешний вид
Набора реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДиаС)

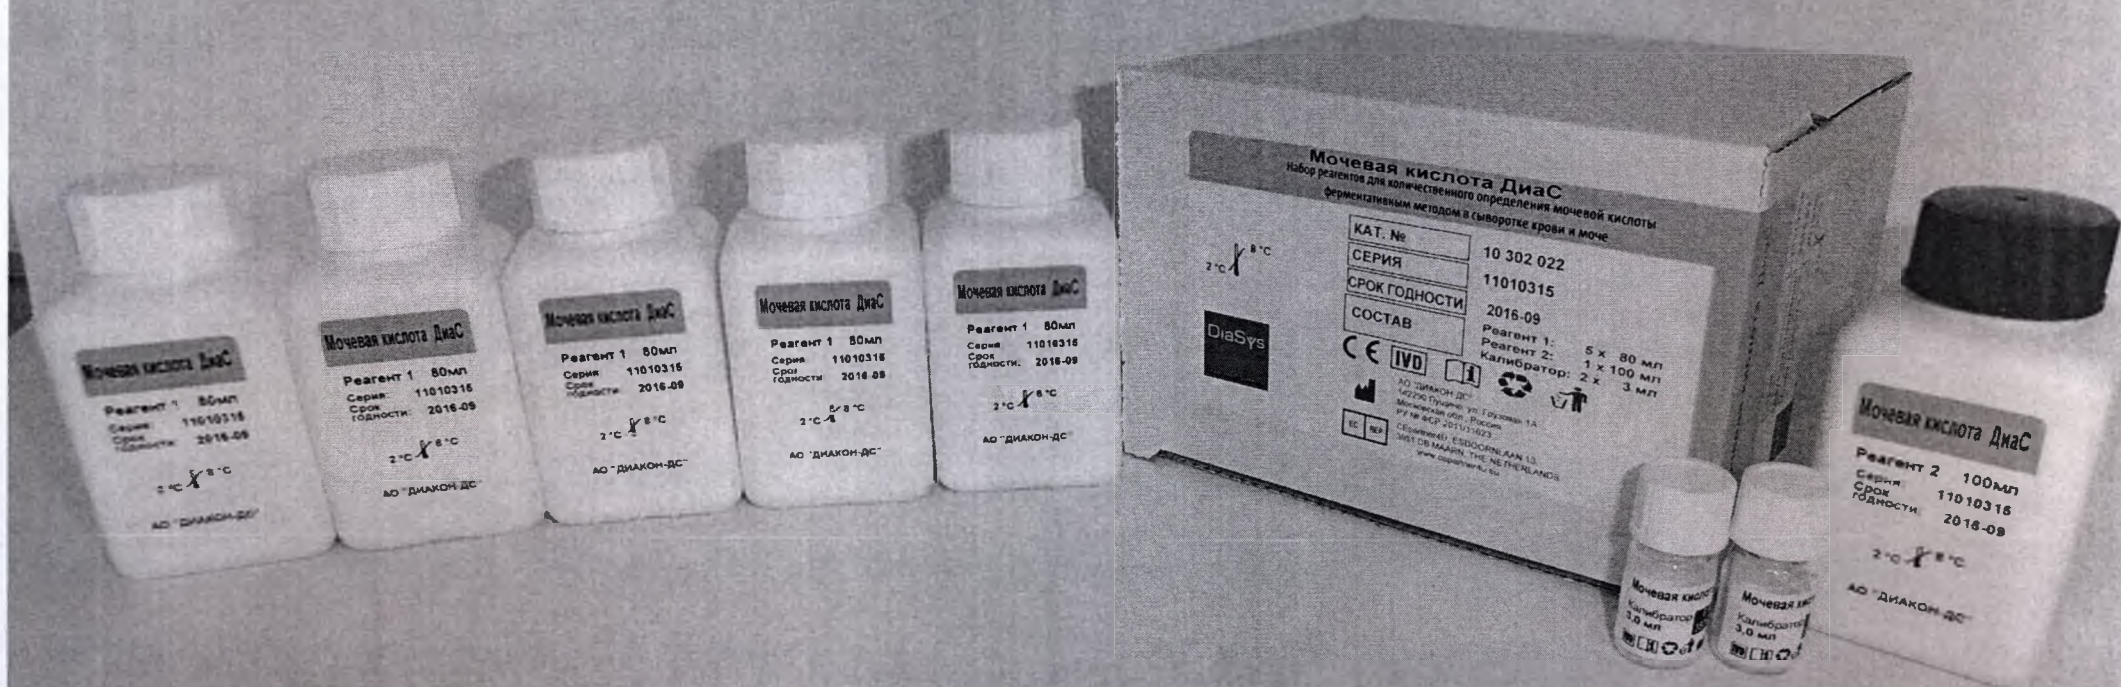

Внешний вид
Набора реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДиаС)



Набора реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче (МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДиаС)

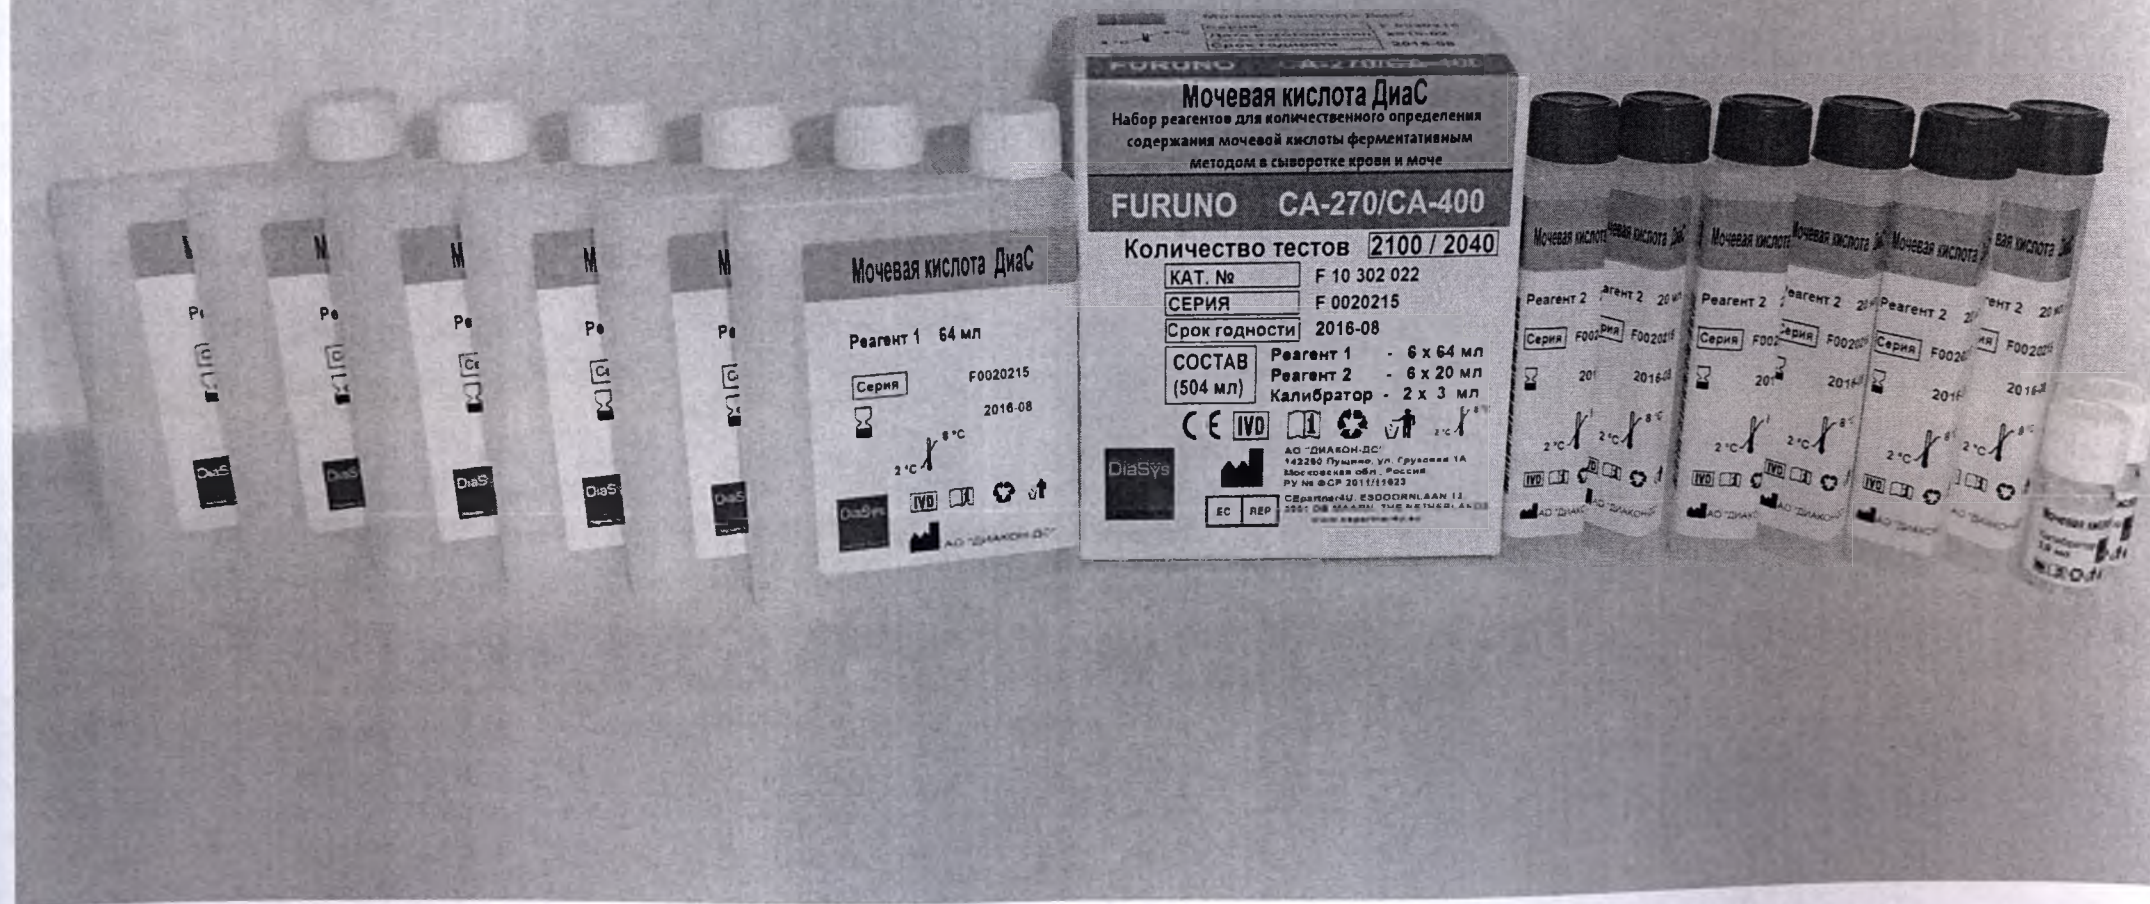

Набора реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДиаС)



Мочевая кислота ДиаС
Набор реагентов для количественного определения
содержания мочевой кислоты ферментативным
методом в сыворотке крови и моче

КАТ. №	SB 10 302 022
СЕРИЯ	SB 11040315
Срок годности	2016-09
СОСТАВ (510 мл)	Реагент 1 - 6 x 68 мл Реагент 2 - 6 x 17 мл Калибратор - 2 x 3 мл


CE IVD

Д.О. «ДИАКОН-ДС»
142280 Пушкино, ул. Грузовая 1А
Московская обл., Россия.
ру № ФСР 2011/11823


SCHOTT GLASS TECHNOLOGY
SCHOTT GLASS B.V. 5800 DH MAASTRICHT THE NETHERLANDS
www.schott.com

Внешний вид

Набора реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче (МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДиаС)

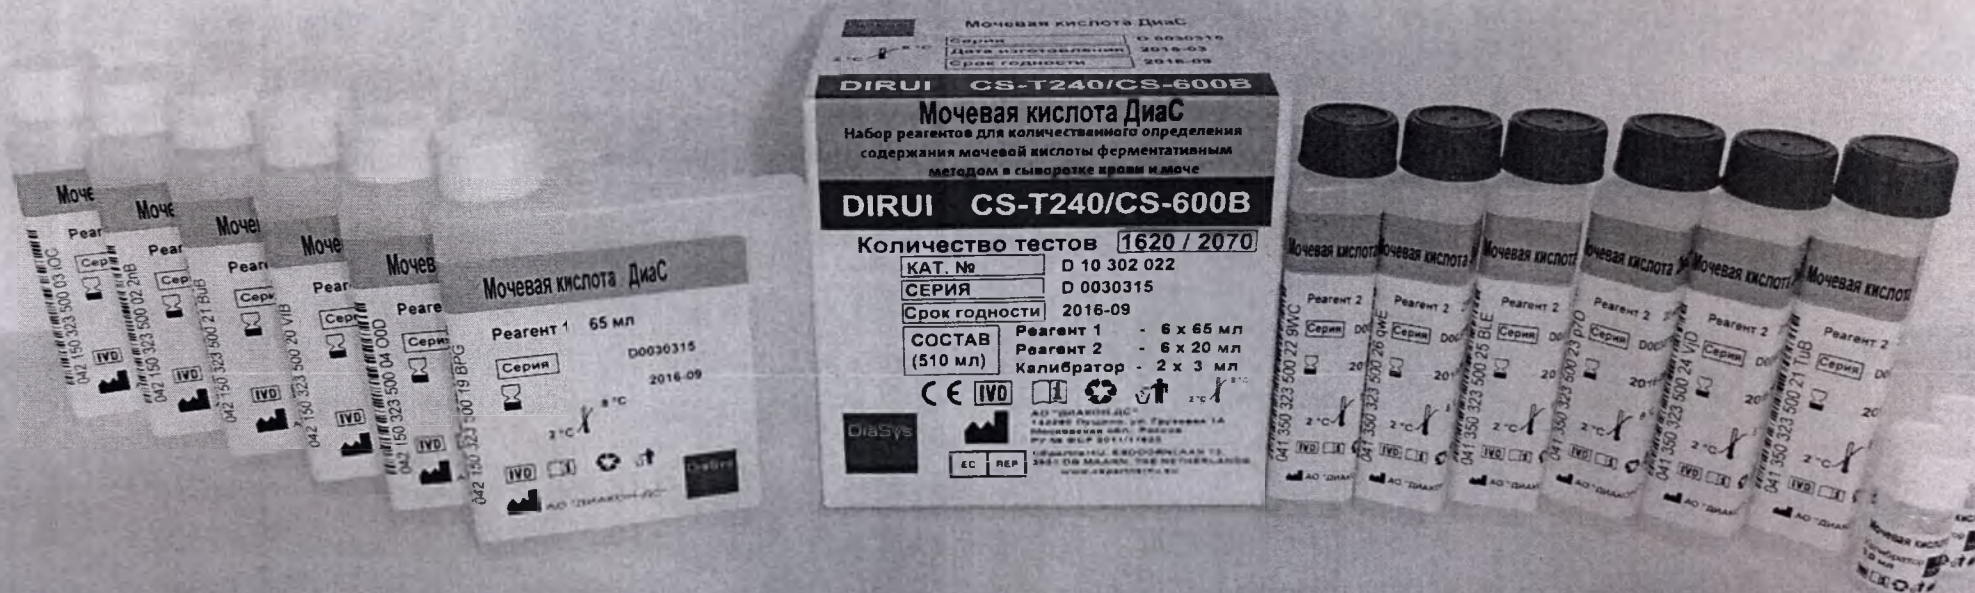


Внешний вид
Набора реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДиаС)

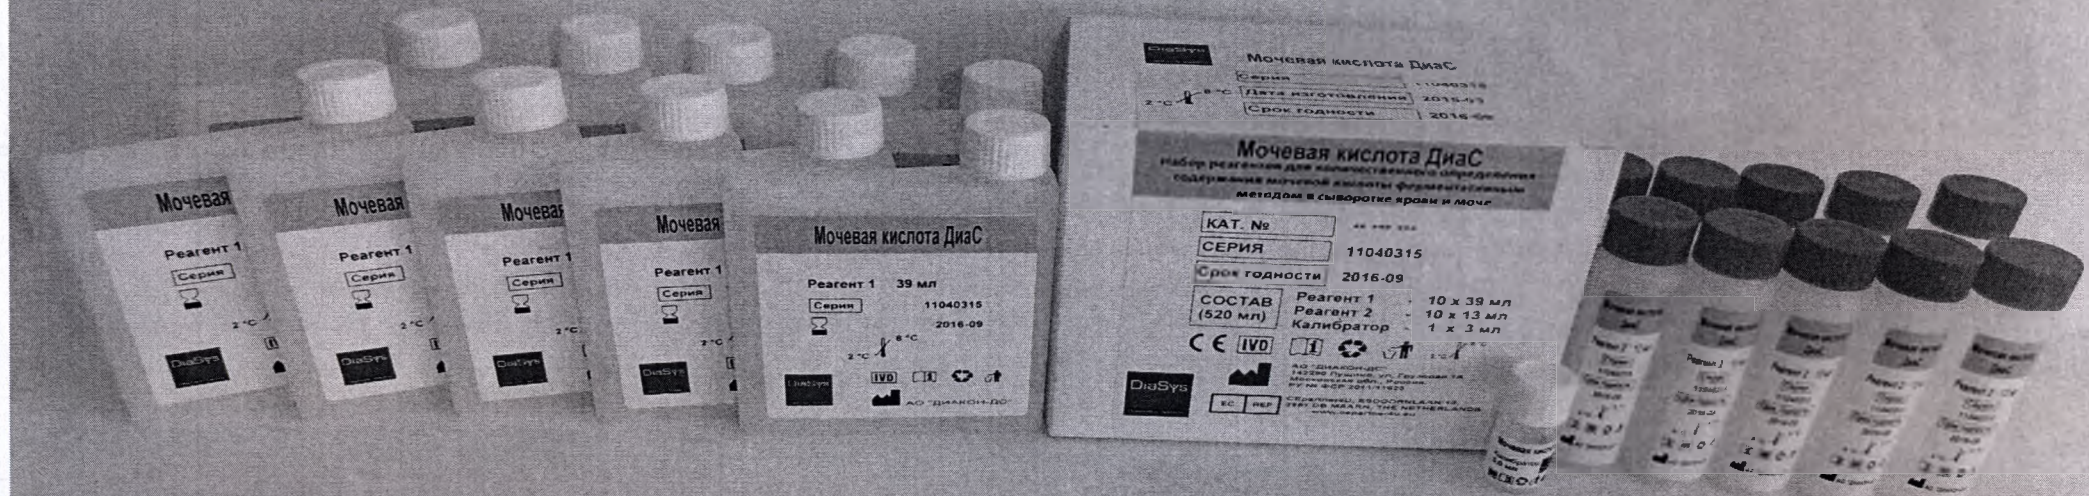

Внешний вид

Набора реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче (МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДиаС)

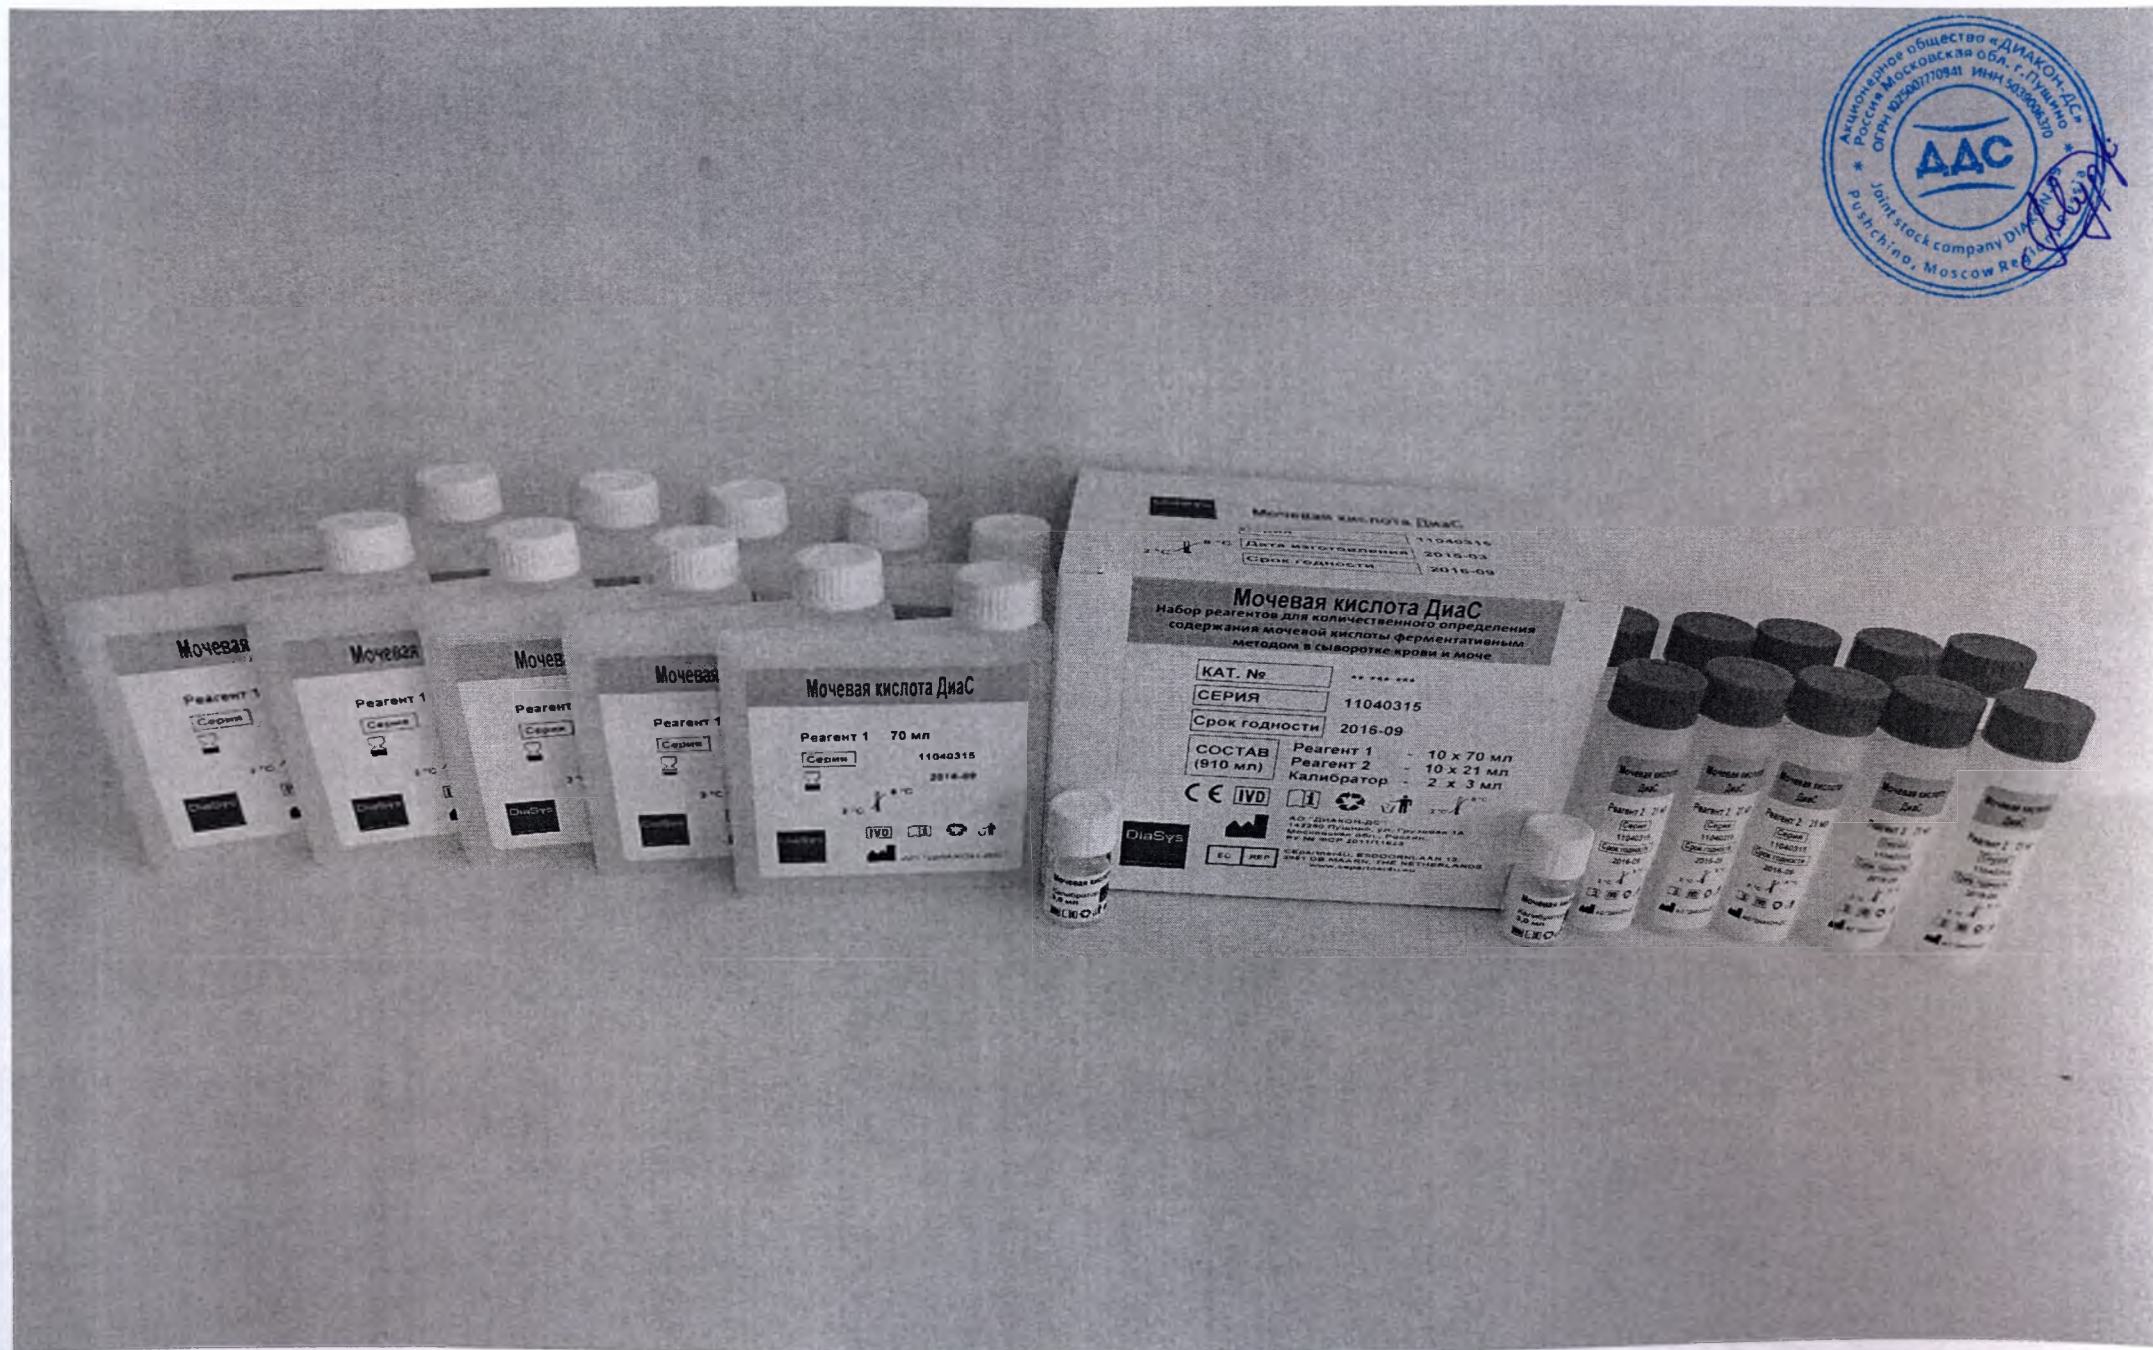

Набора реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДиаС)