




Набора реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови
(ХОЛЕСТЕРИН ДиаС)

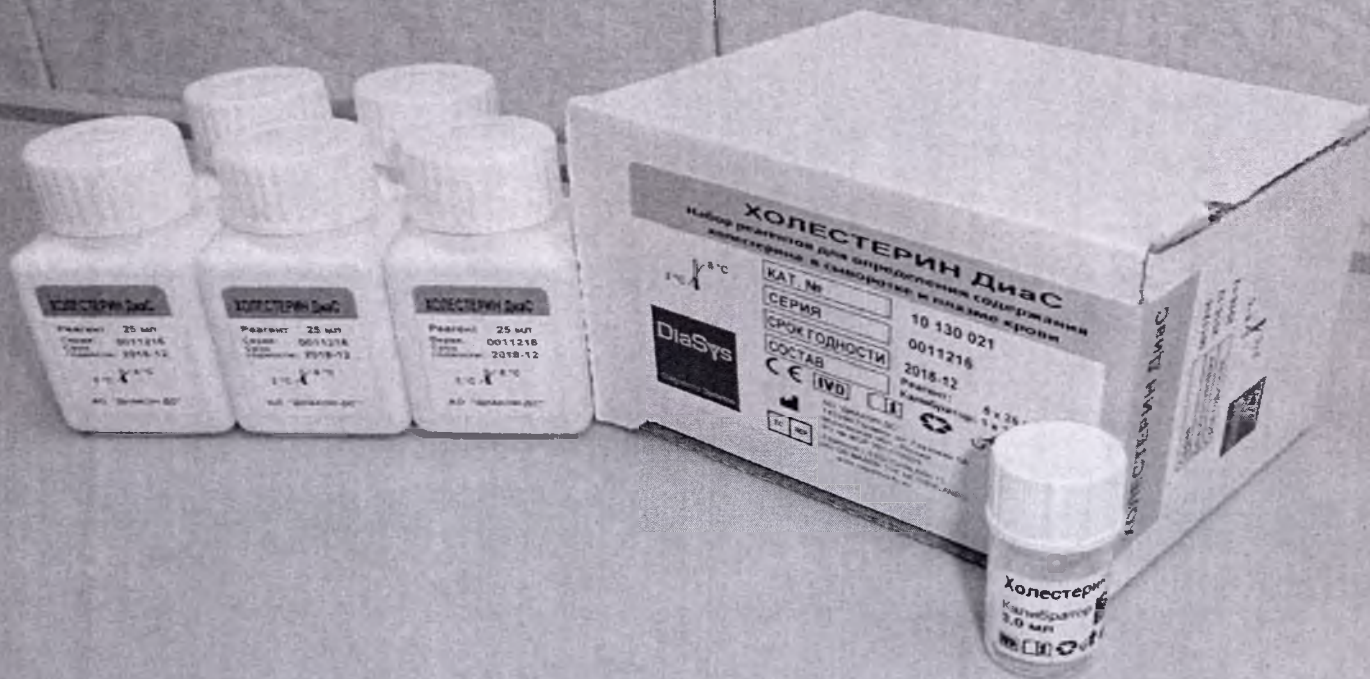

Набор реактивов для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови
(ХОЛЕСТЕРИН ДиаС)

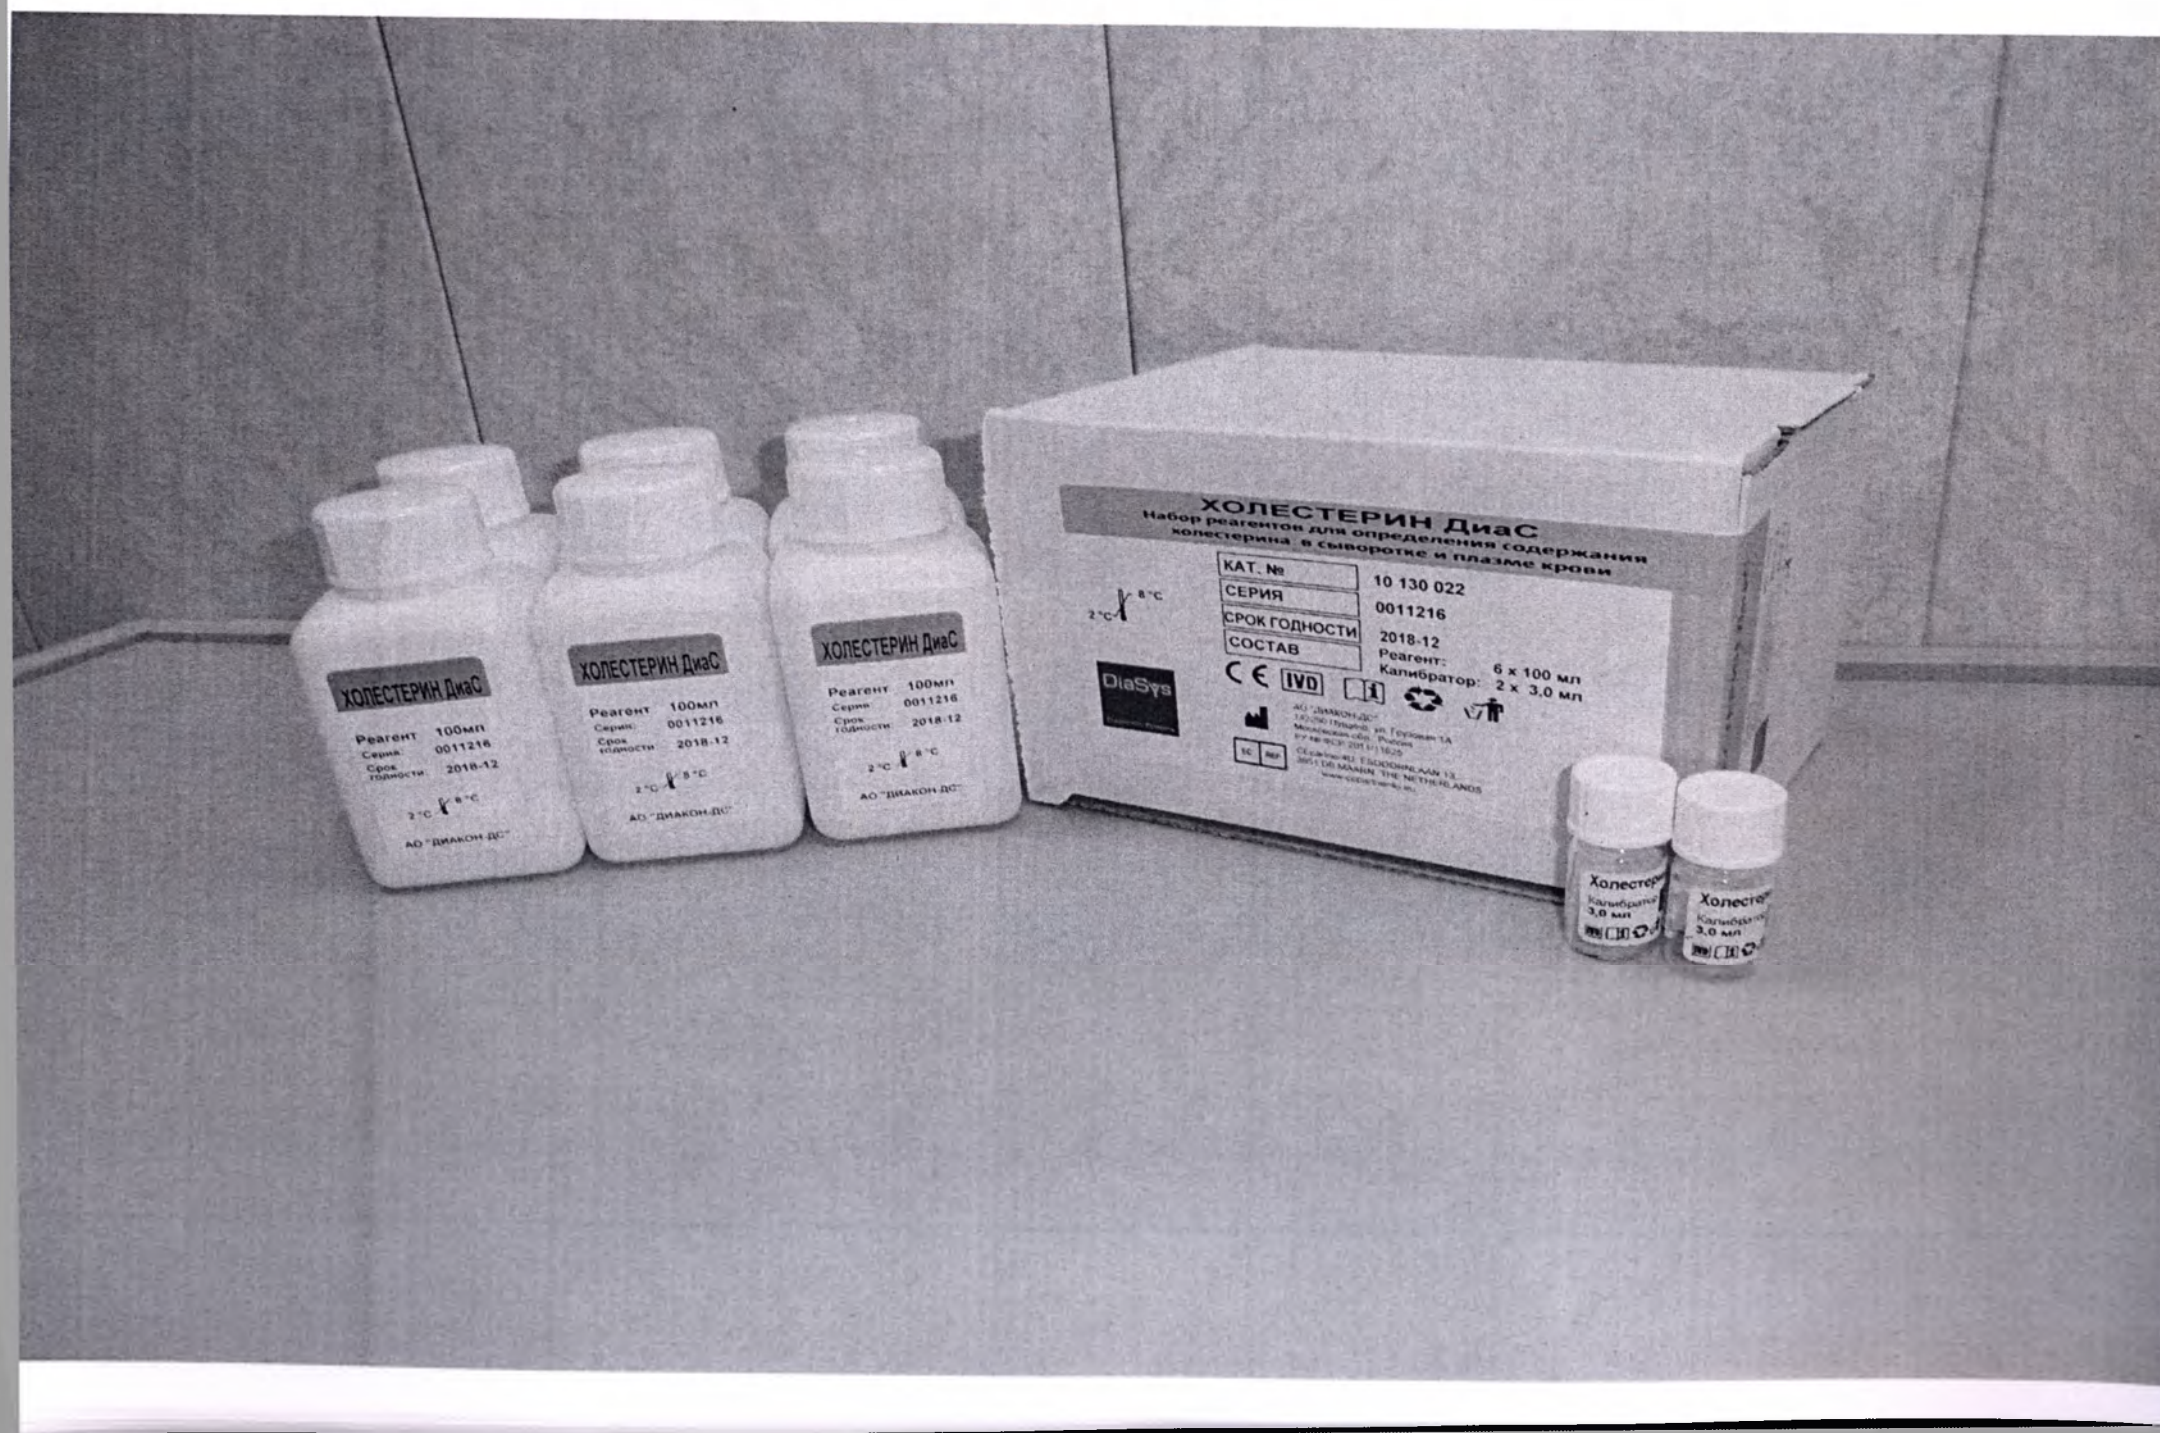


Набора реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови
(ХОЛЕСТЕРИН ДиаС)

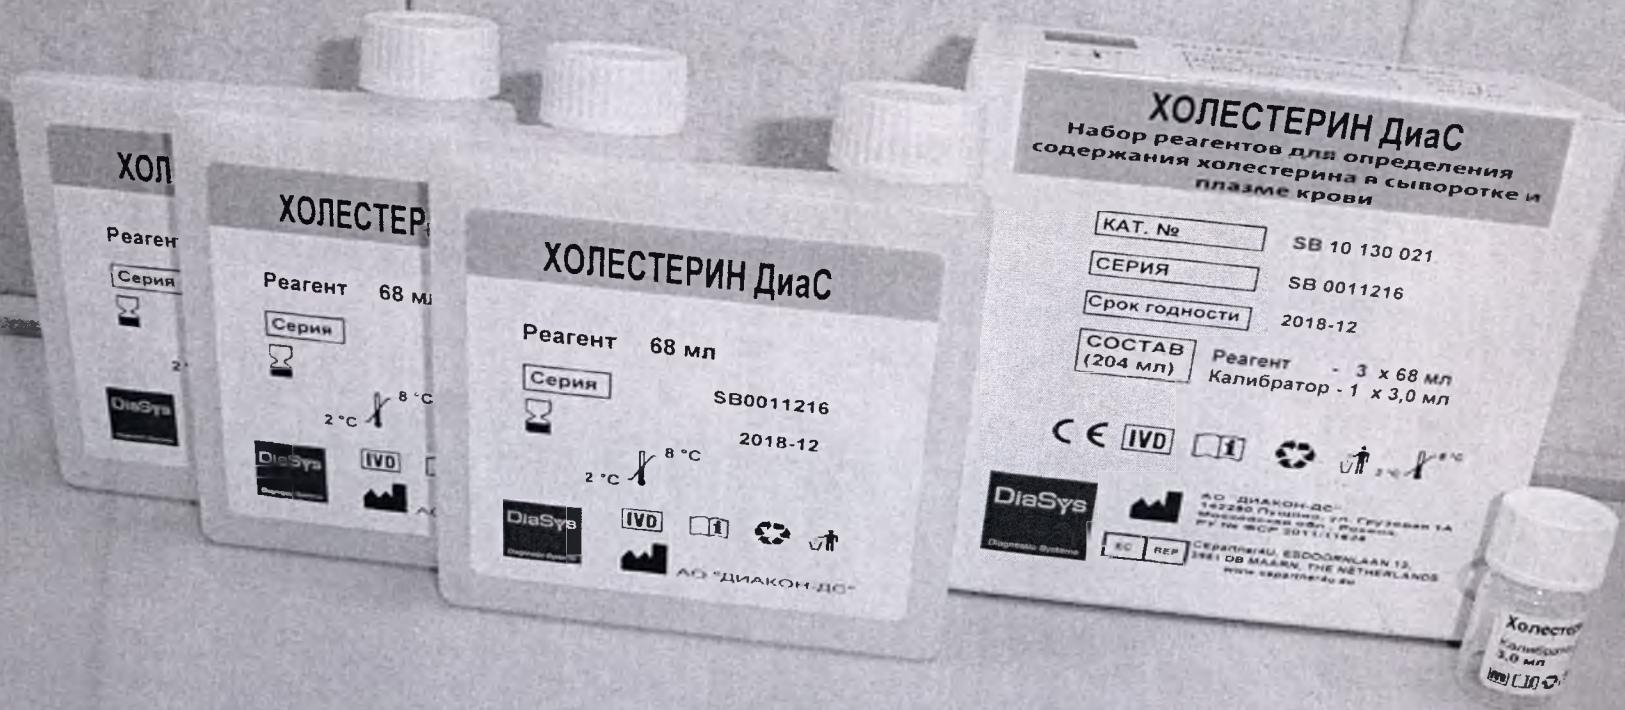


**Набора реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови
(ХОЛЕСТЕРИН ДиаС)**




Набора реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови
(ХОЛЕСТЕРИН ДиаС)

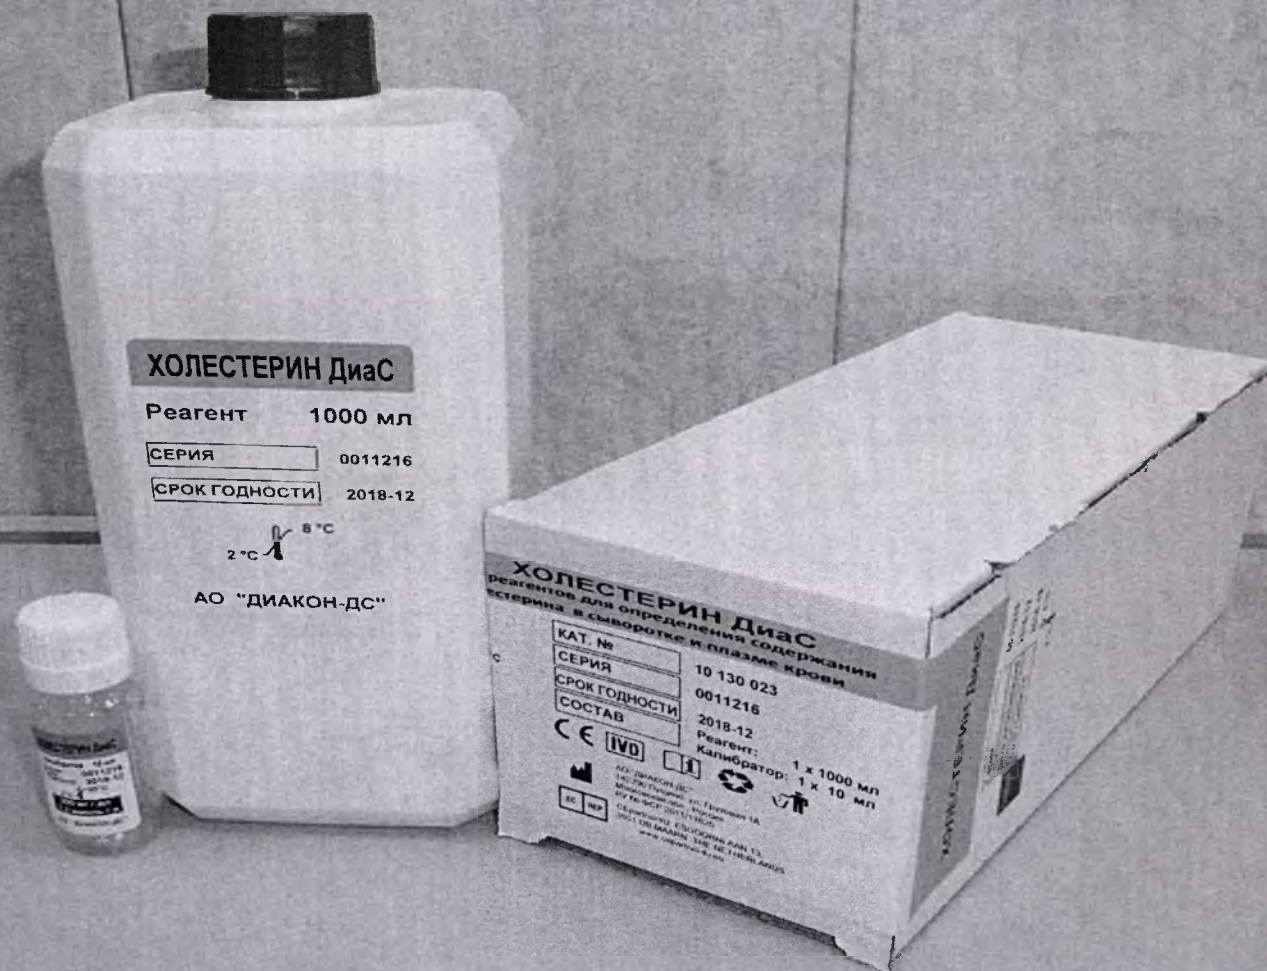

набора реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови
(ХОЛЕСТЕРИН ДиаС)

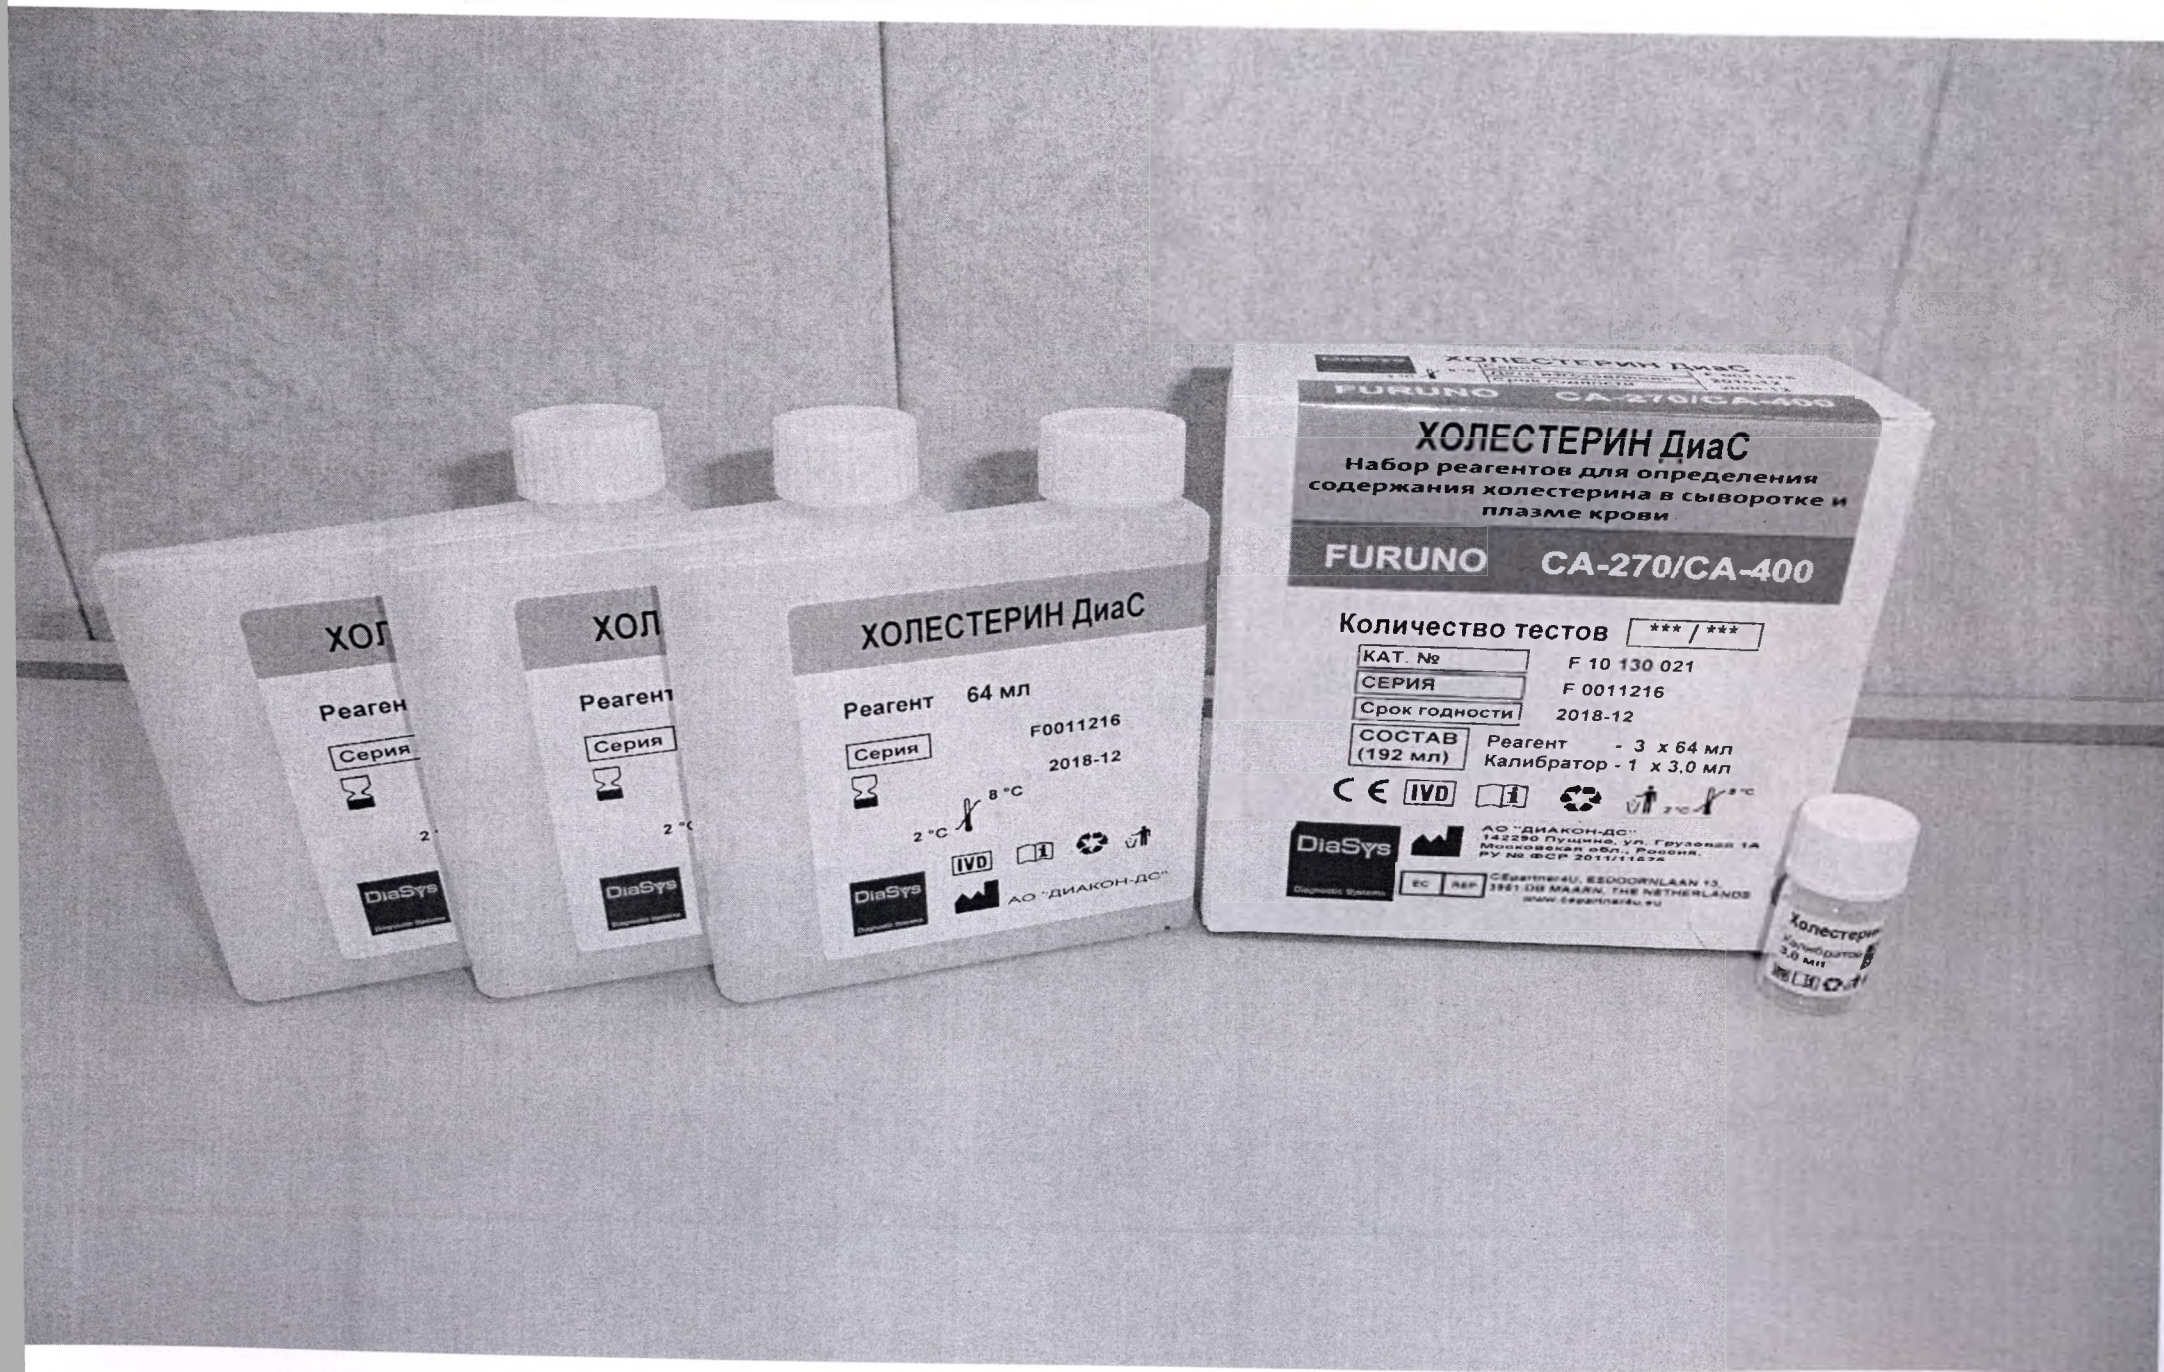

Набора реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови
(ХОЛЕСТЕРИН ДиаС)

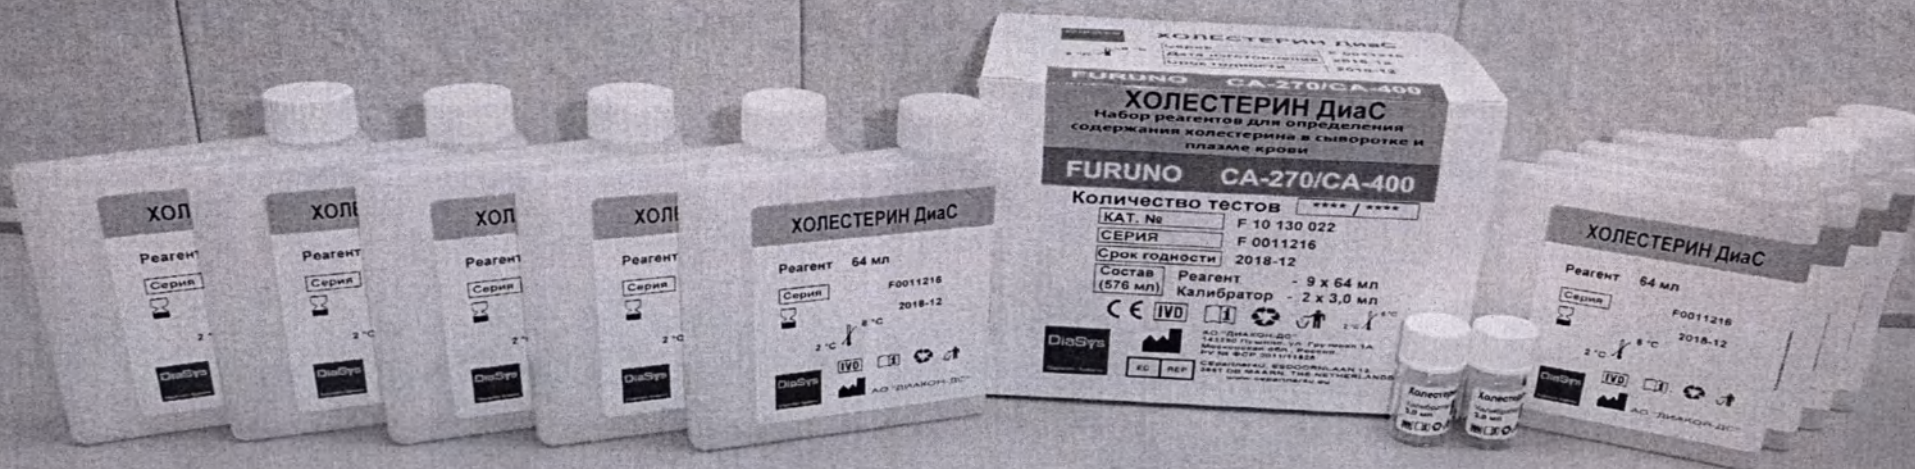

Набора реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови
(ХОЛЕСТЕРИН ДиаС)




Набора реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови
(ХОЛЕСТЕРИН ДиаС)




Набора реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови
(ХОЛЕСТЕРИН ДиаС)



Набора реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови
(ХОЛЕСТЕРИН ДиаС)

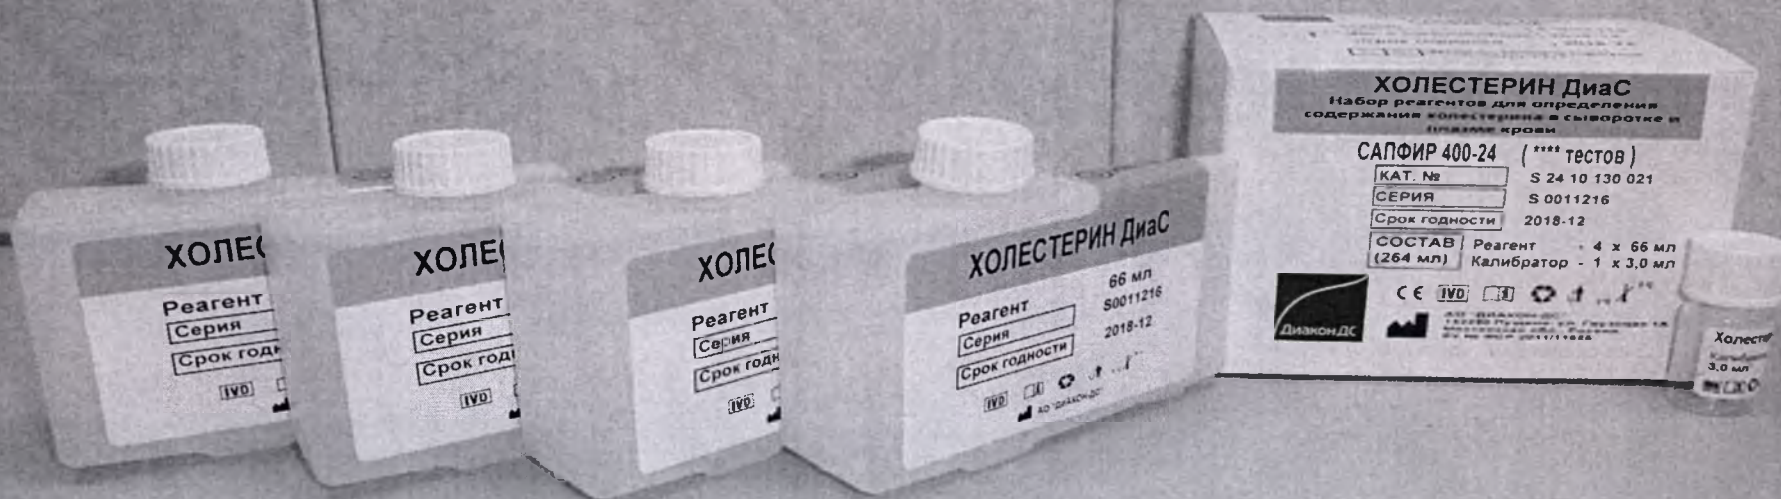

Набора реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови
(ХОЛЕСТЕРИН ДиаС)

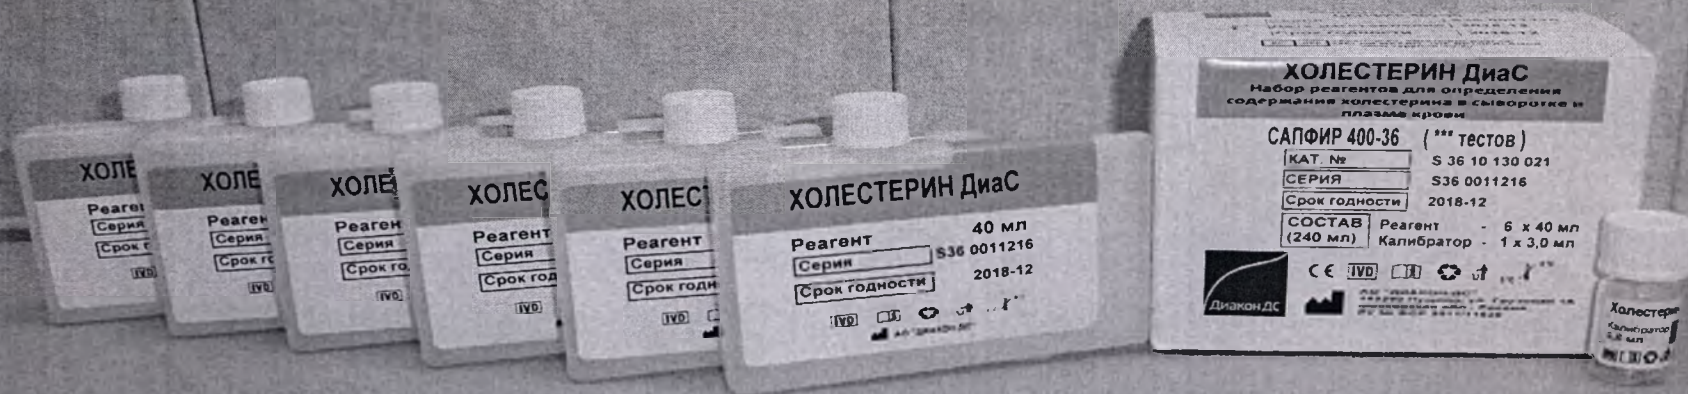




Набора реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови
(ХОЛЕСТЕРИН ДиаС)




Набора реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови
(ХОЛЕСТЕРИН ДиаС)

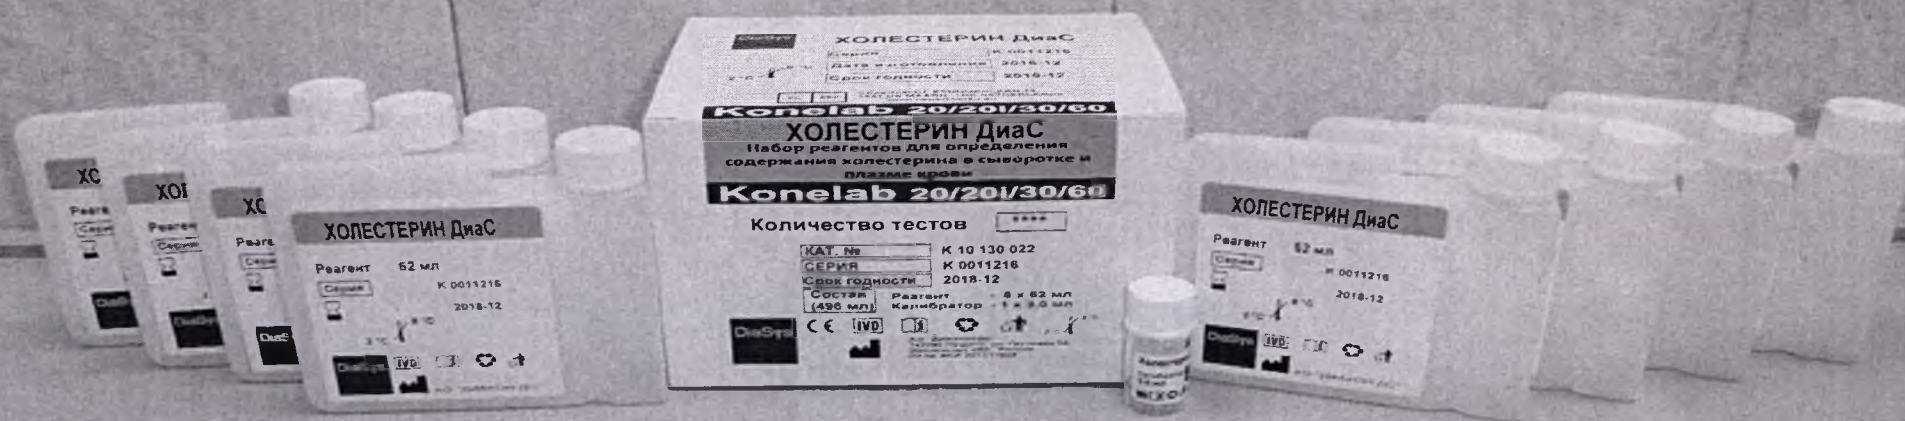

Набор реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке крови
(ХОЛЕСТЕРИН ДиаС)




(ХОЛЕСТЕРИН Диас)



Набора реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови
(ХОЛЕСТЕРИН ДиаС)




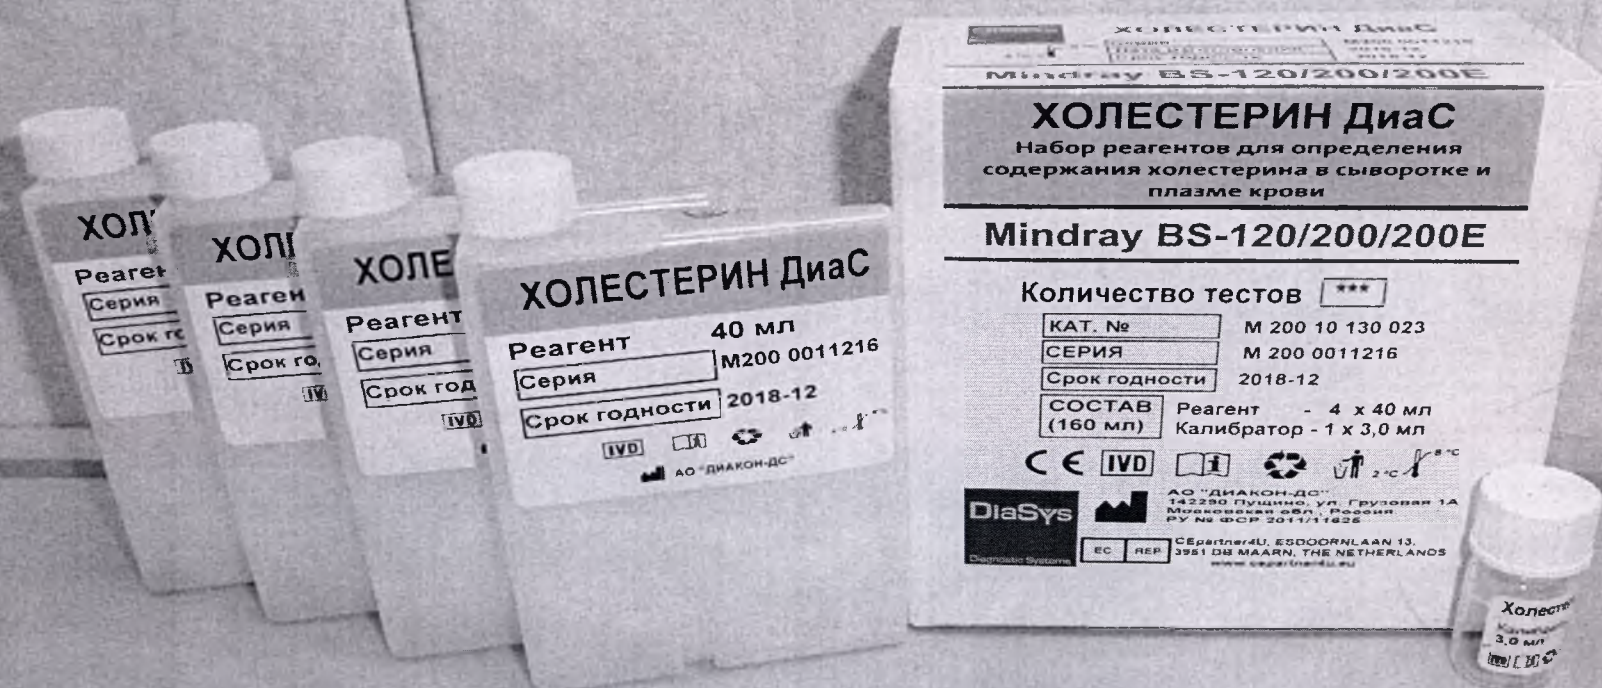

Набора реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови
(ХОЛЕСТЕРИН ДиаС)



(ХОЛЕСТЕРИН ДиаС)

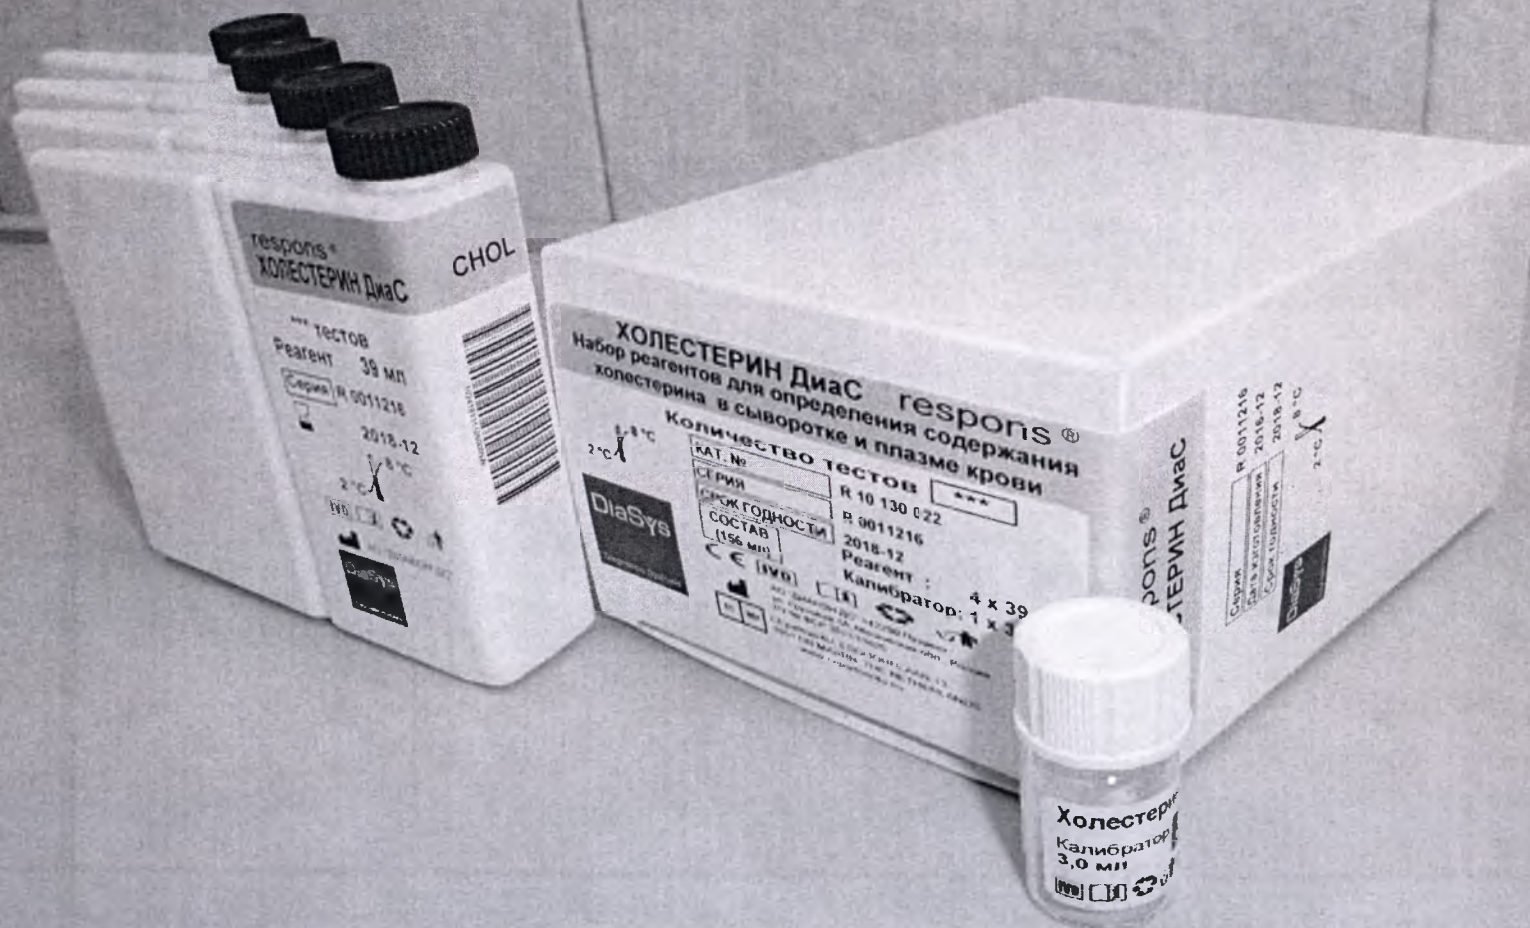

Набора реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке
(ХОЛЕСТЕРИН ДиаС)




Набора реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови
(ХОЛЕСТЕРИН ДиаС)




Набора реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке крови
(ХОЛЕСТЕРИН ДиаС)



Набора реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови
(ХОЛЕСТЕРИН ДиаС)

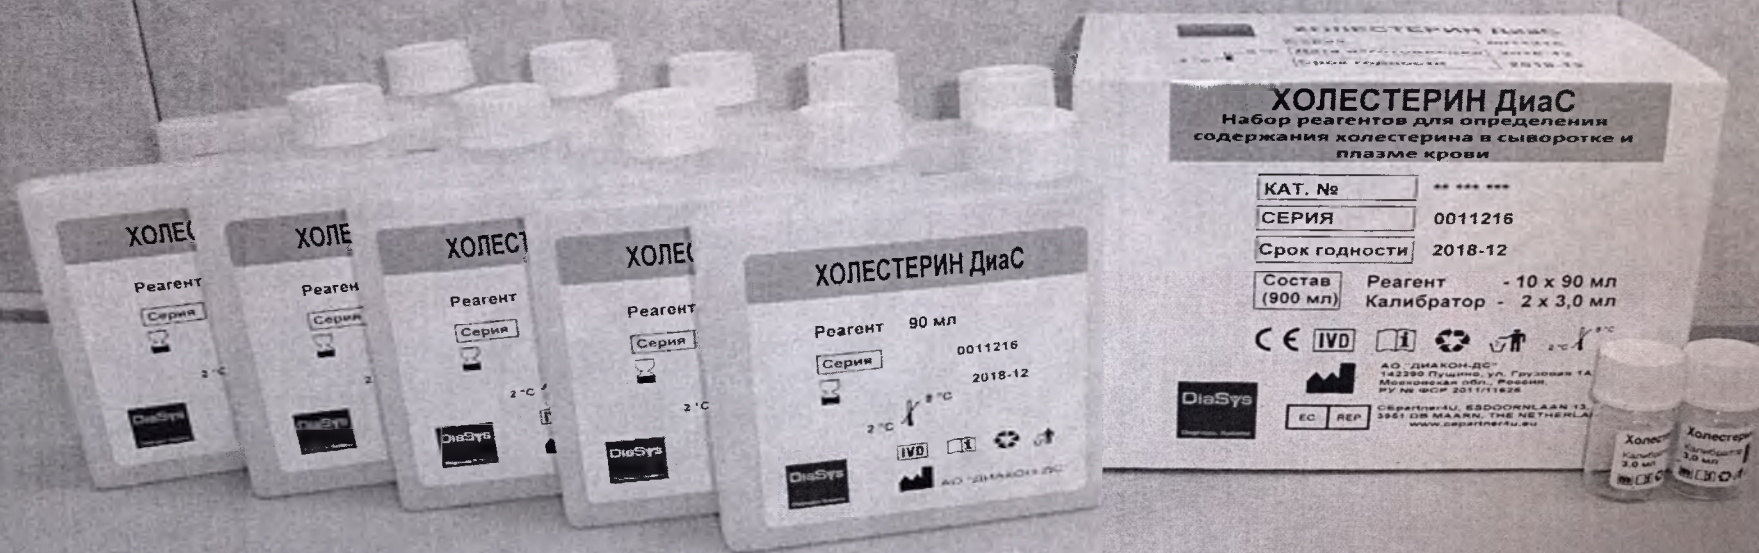

Набора реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови
(ХОЛЕСТЕРИН ДиаС)

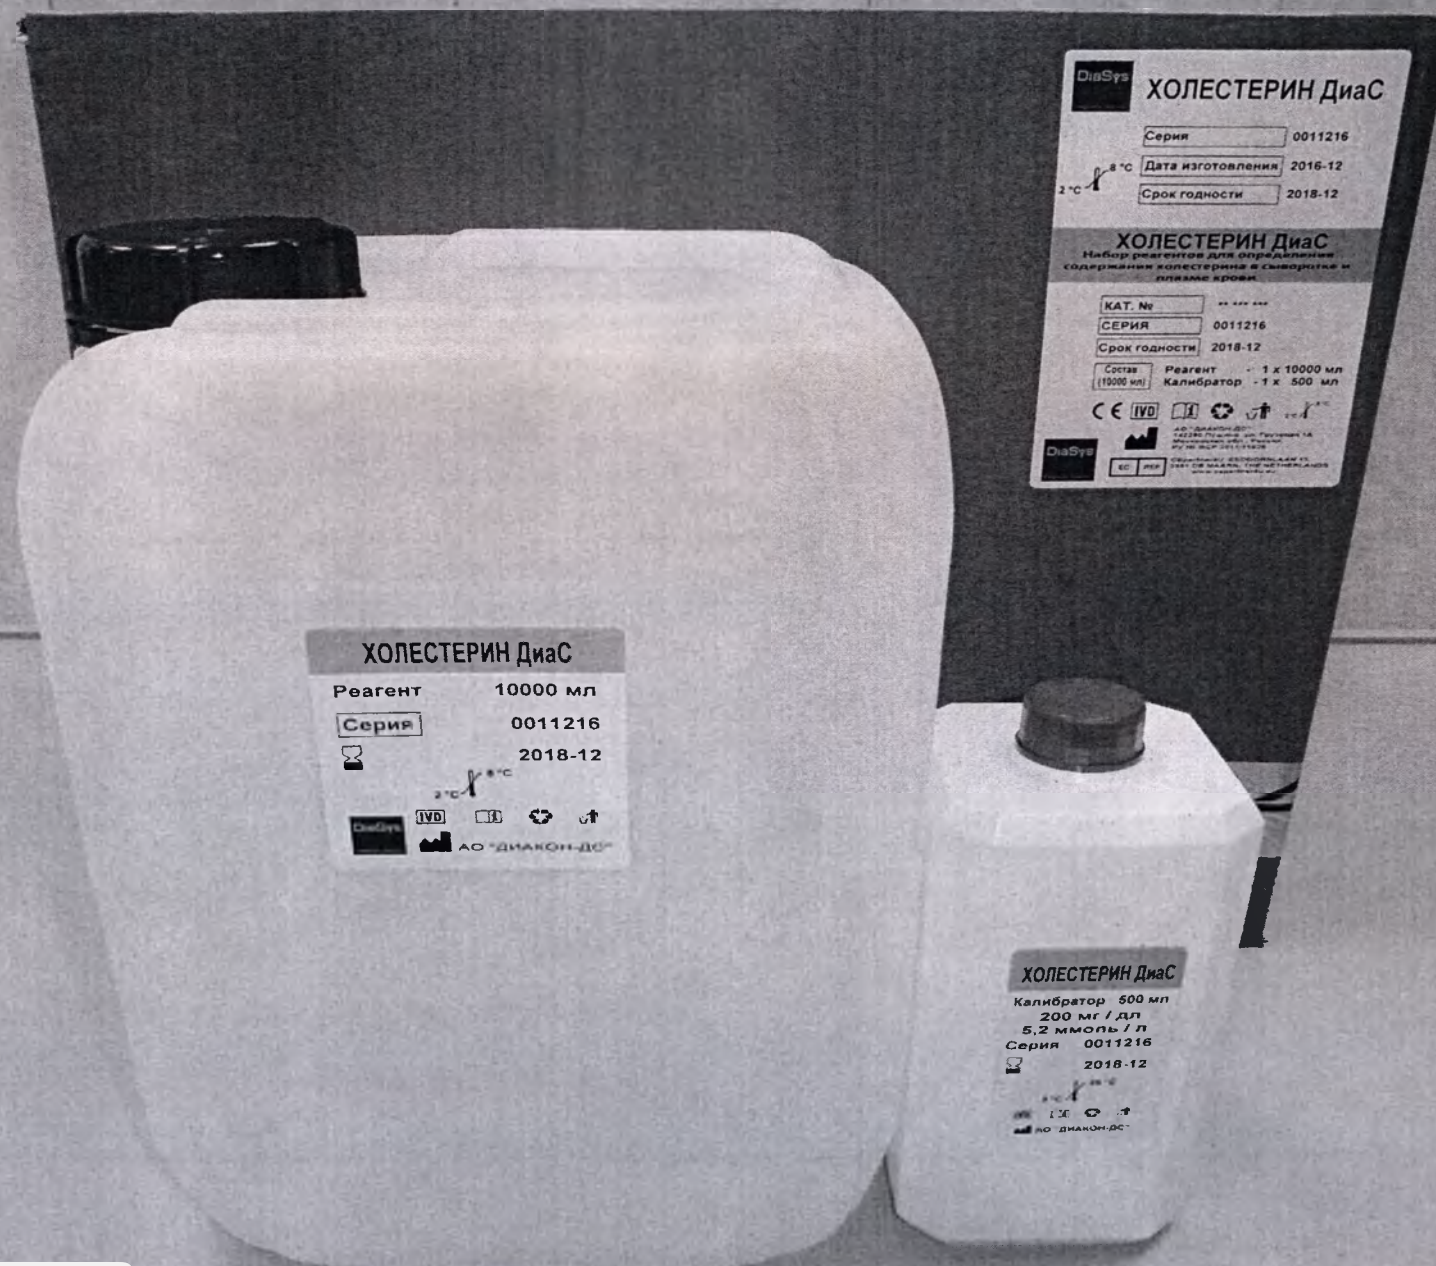

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 26 лист(ов)

Генеральный директор
АО «ДИАКОН-ДС»

Смирнов А.В.

