



Набора реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови  
(ОБЩИЙ БЕЛОК ДиаС)


Вариант 1

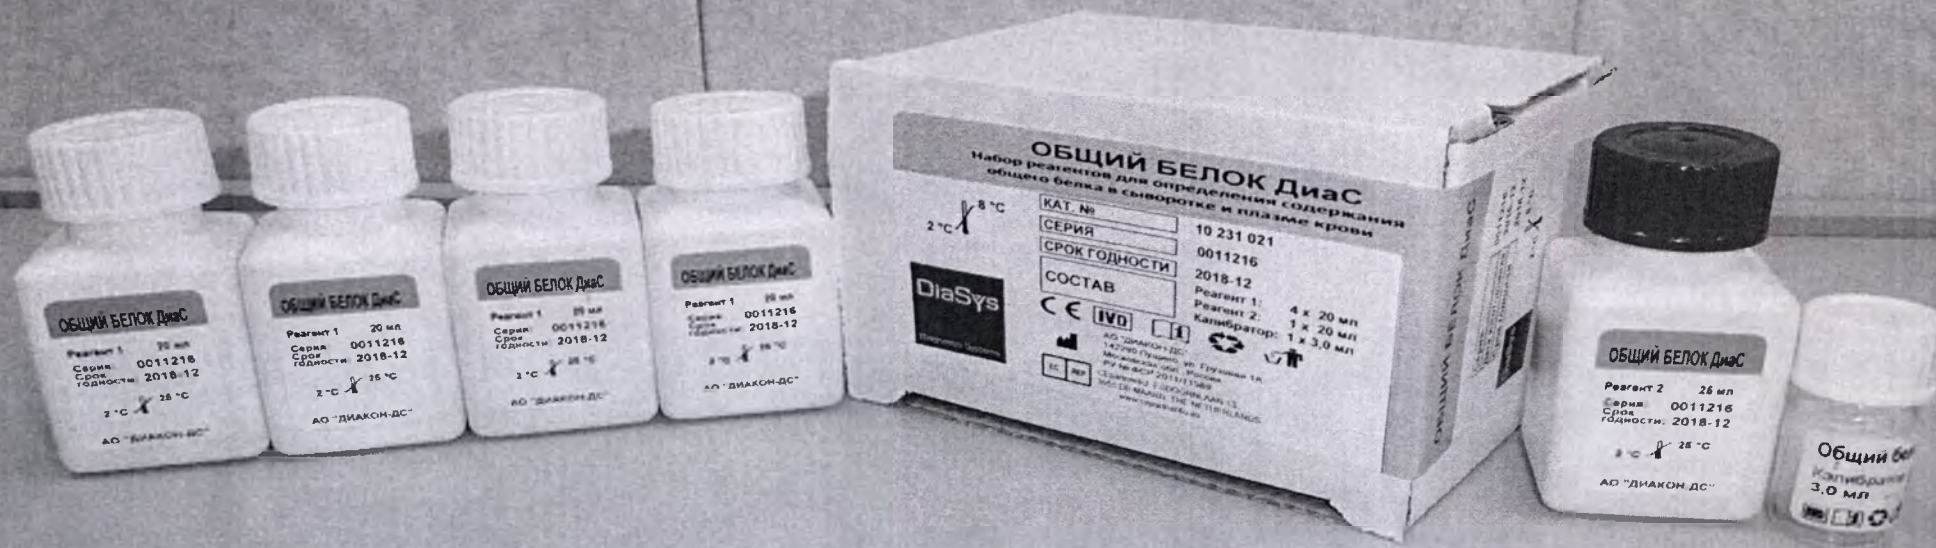


набора реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови  
(ОБЩИЙ БЕЛОК ДнаС)

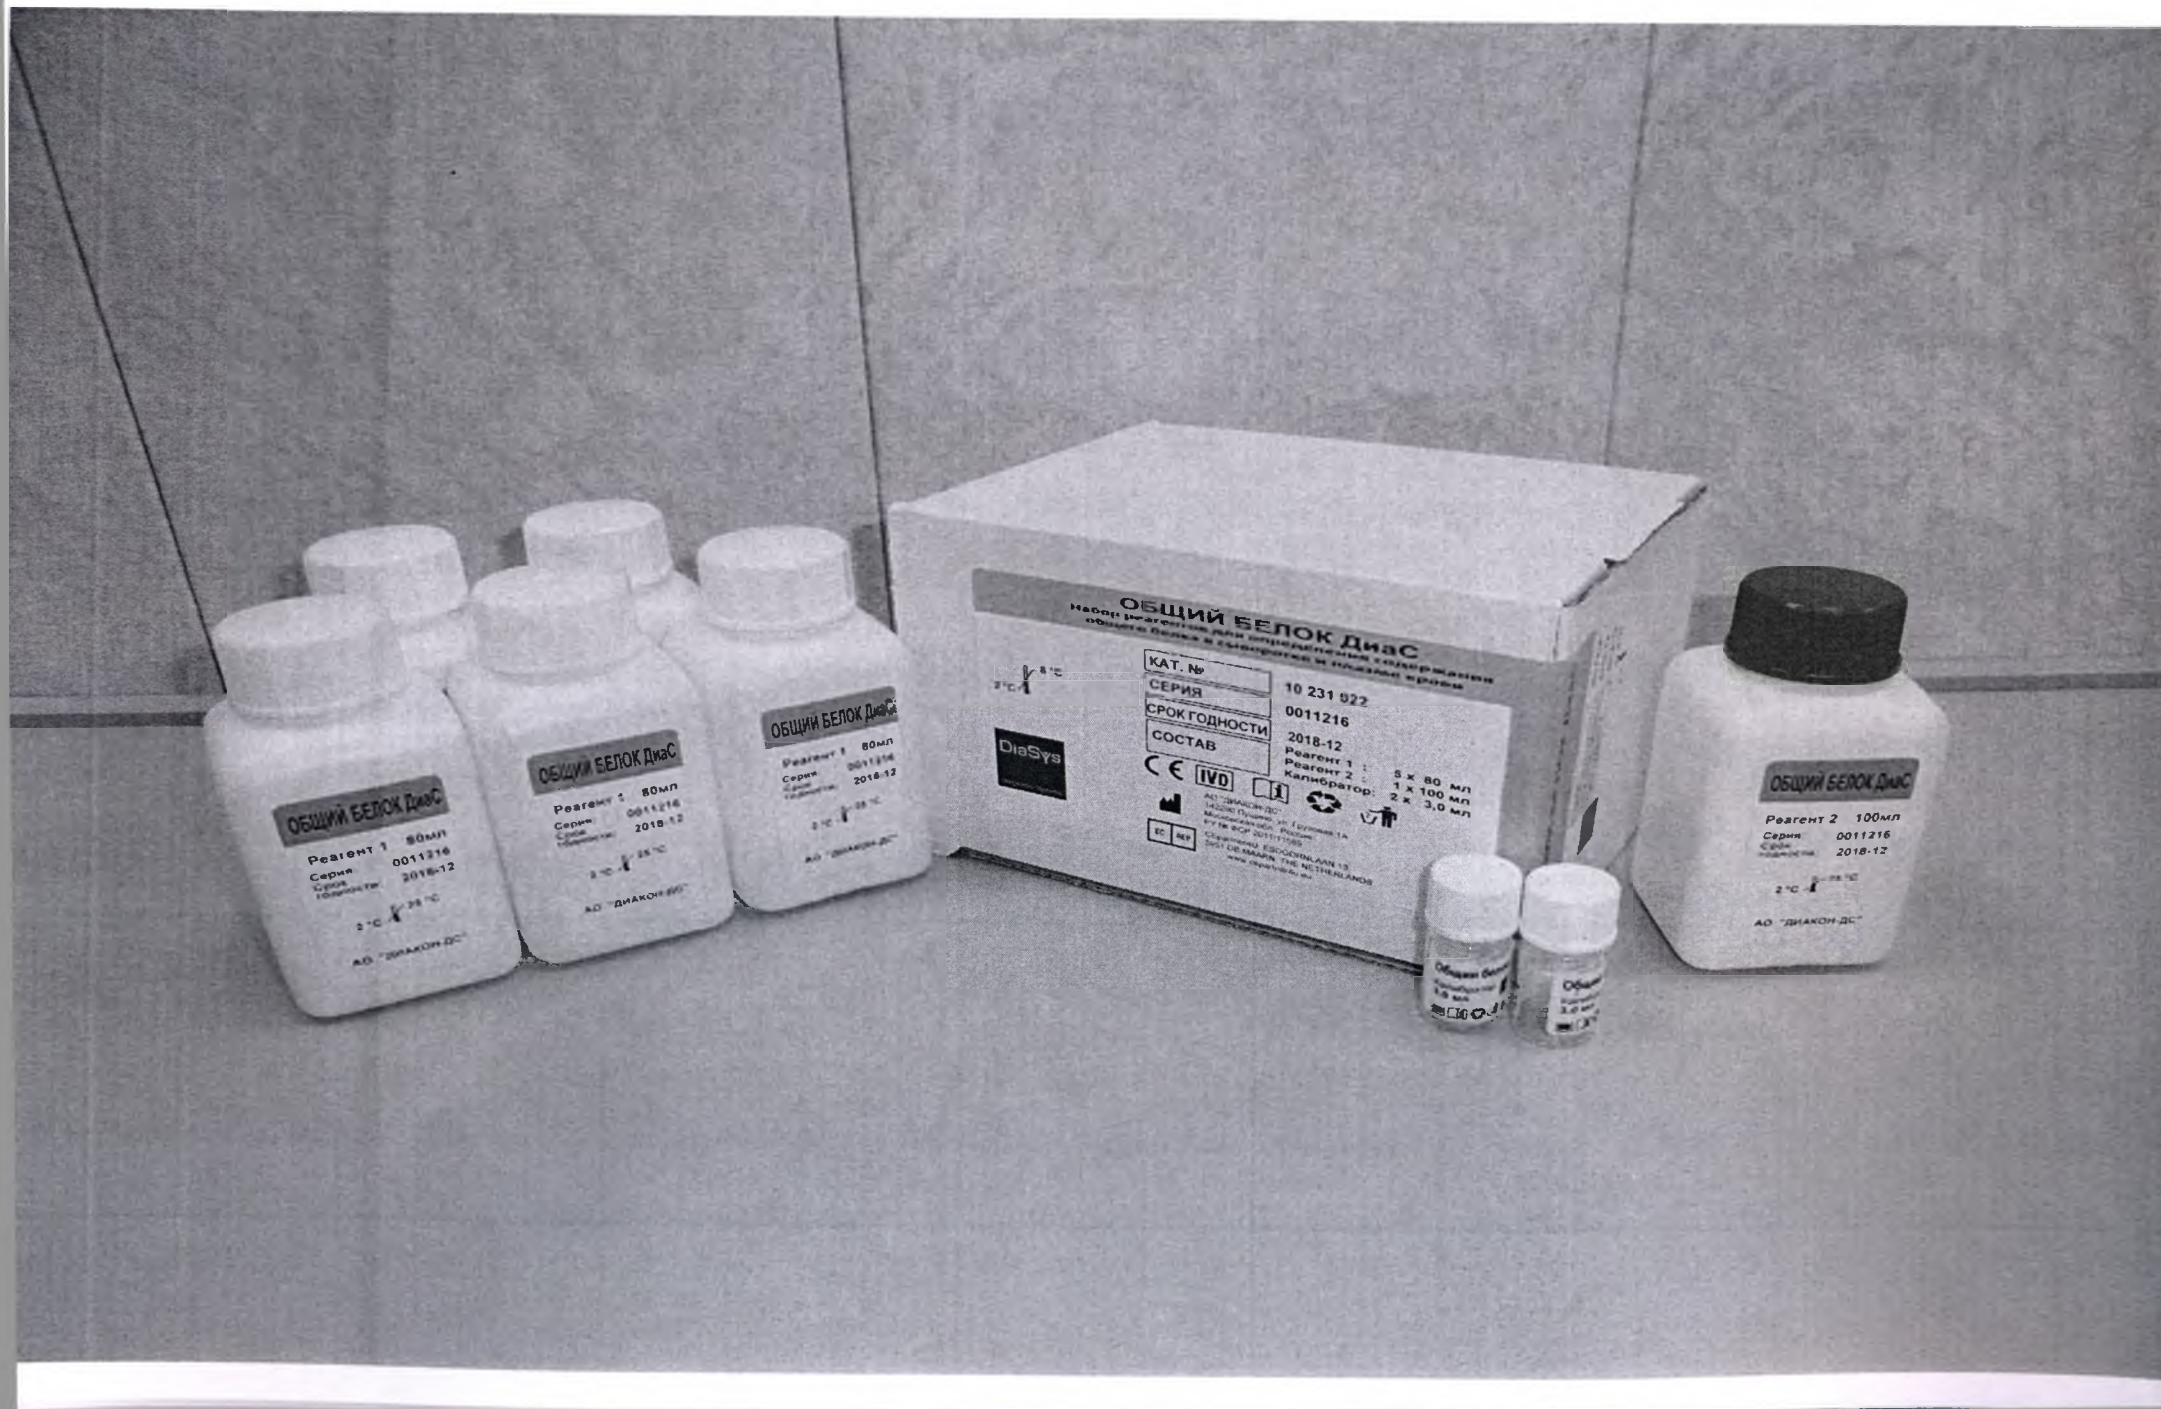


Определение общего белка в сыворотке и плазме крови  
(ОБЩИЙ БЕЛОК ДиаС)

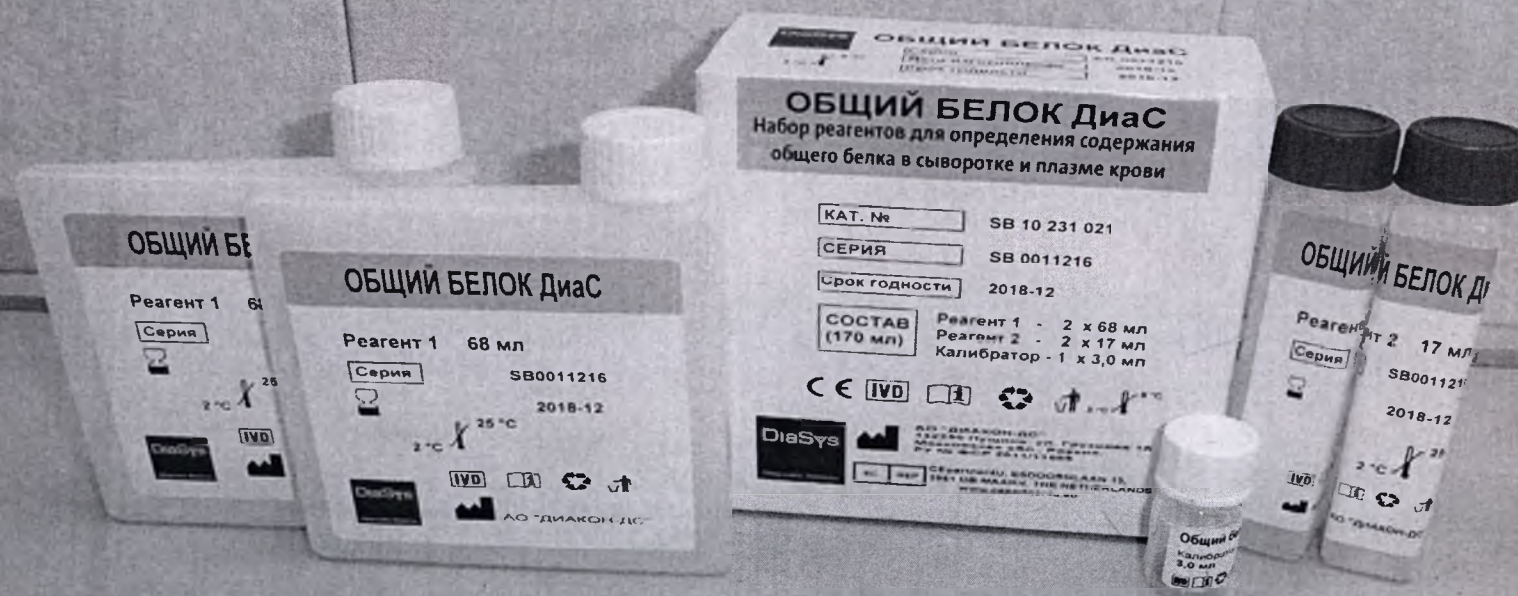


**Набора реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови  
(ОБЩИЙ БЕЛОК ДиаС)**

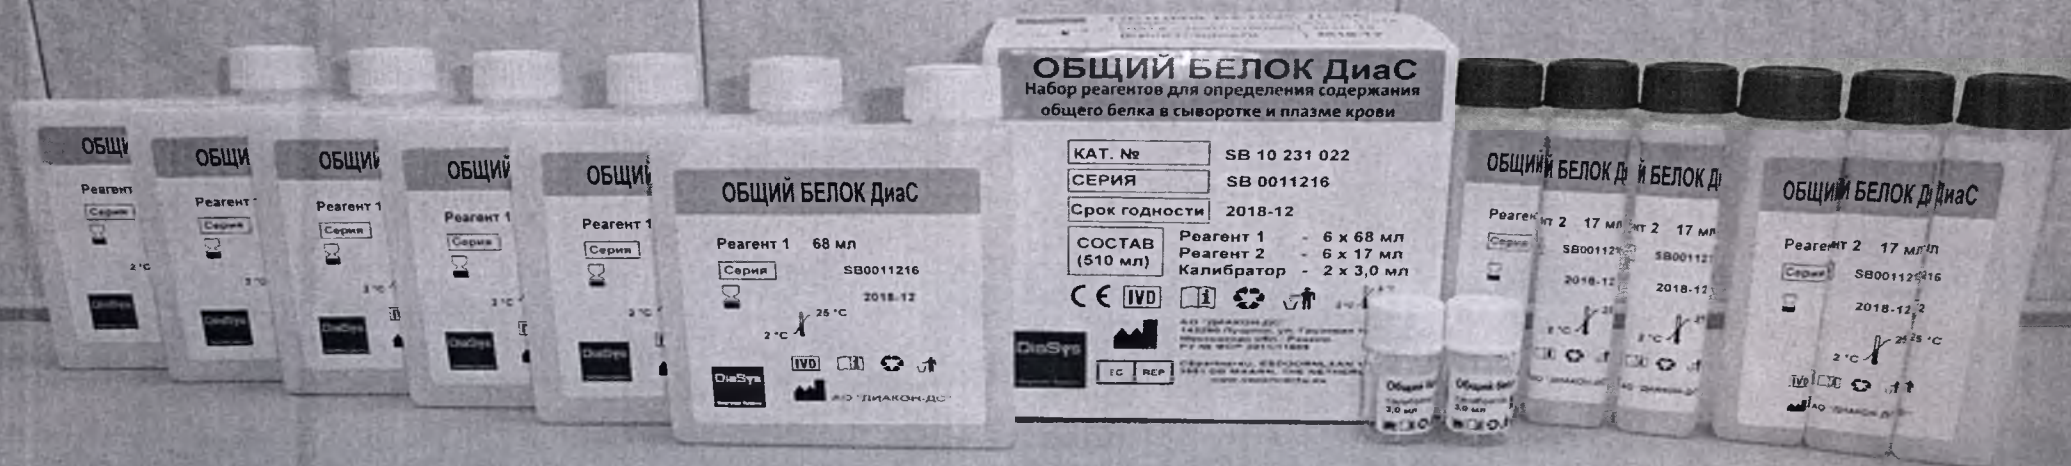


Набор реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови  
(ОБЩИЙ БЕЛОК ДиаС)

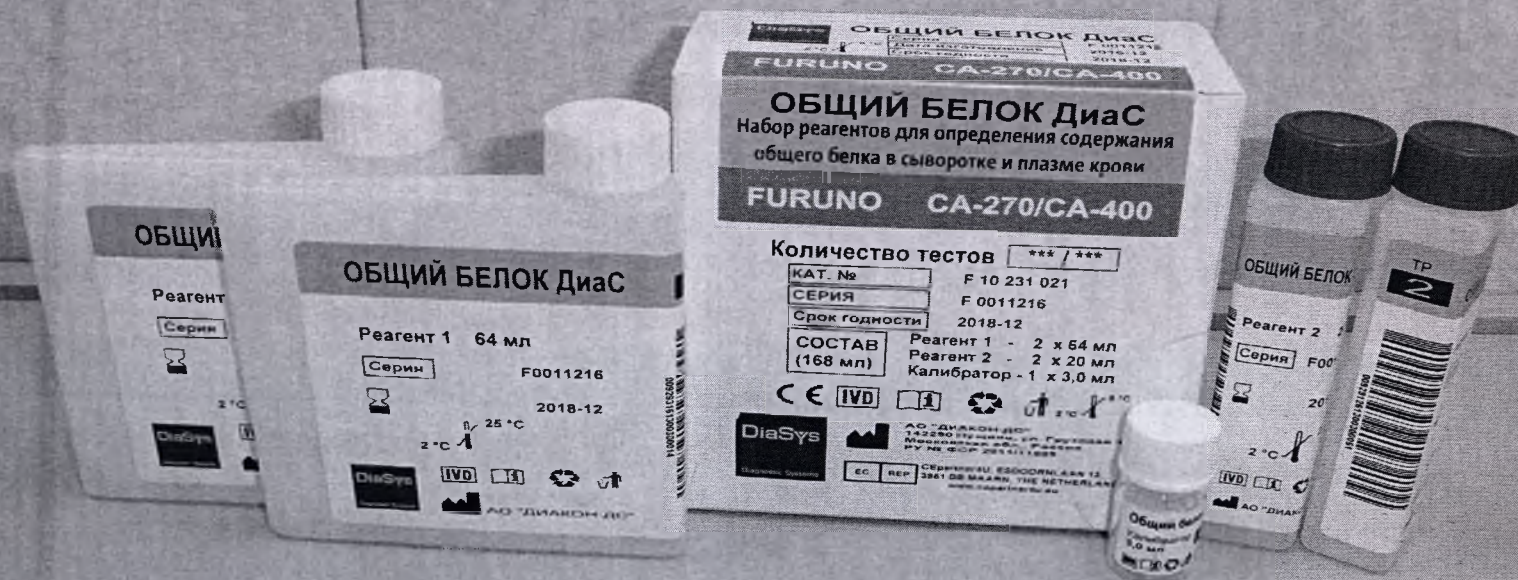


**Набора реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови  
(ОБЩИЙ БЕЛОК ДиаС)**

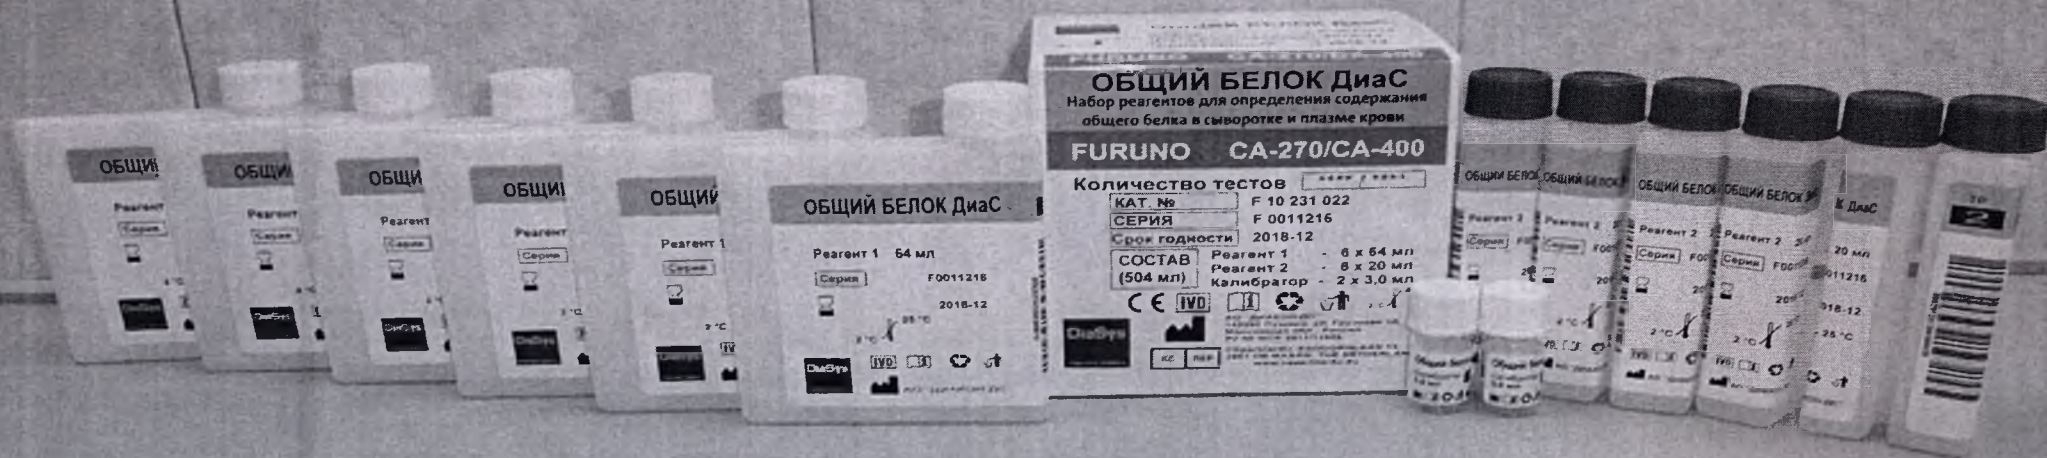


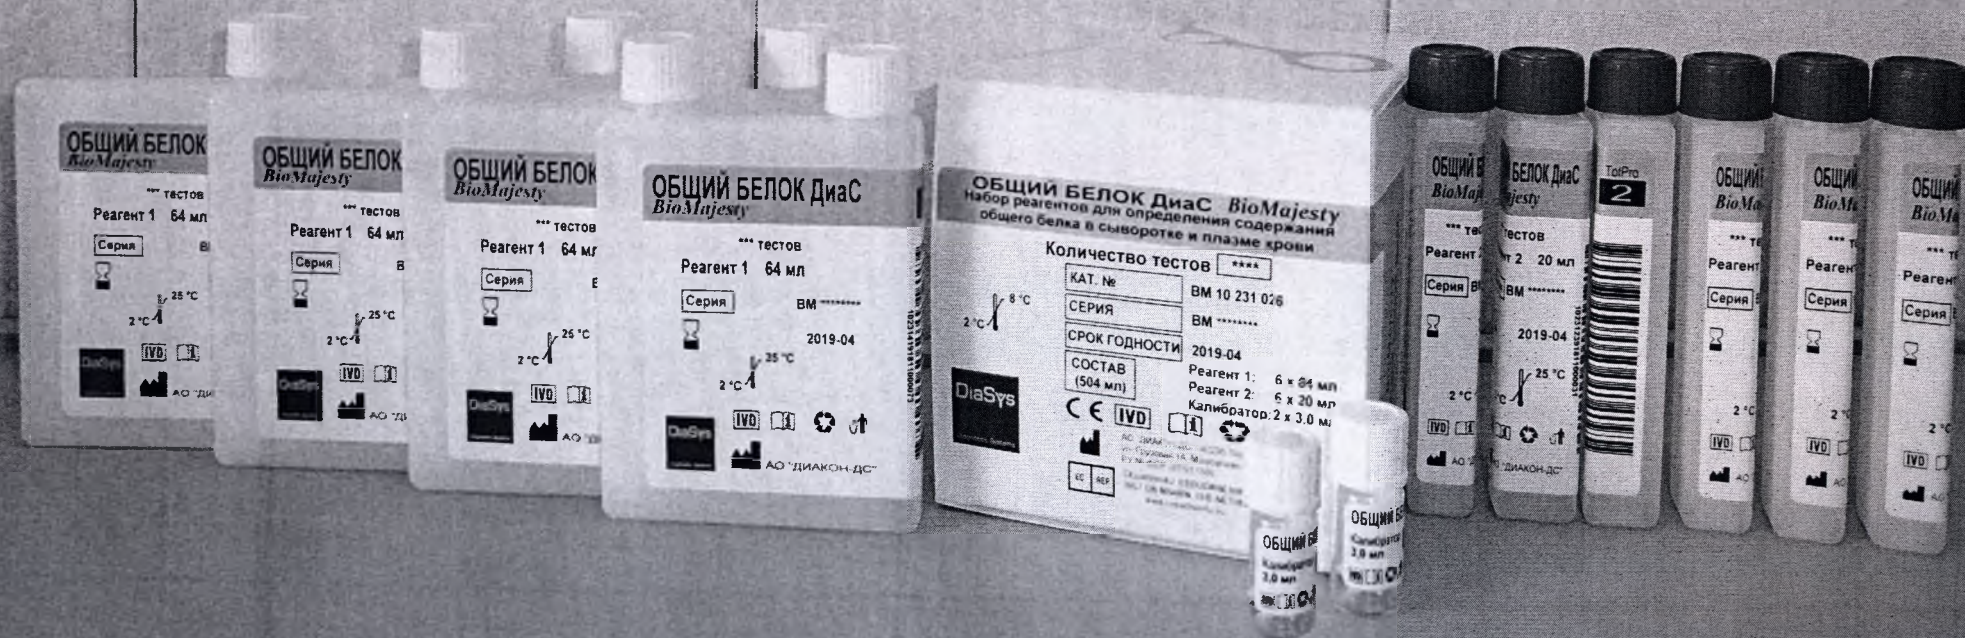


Набора реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови  
(ОБЩИЙ БЕЛОК ДиаС)

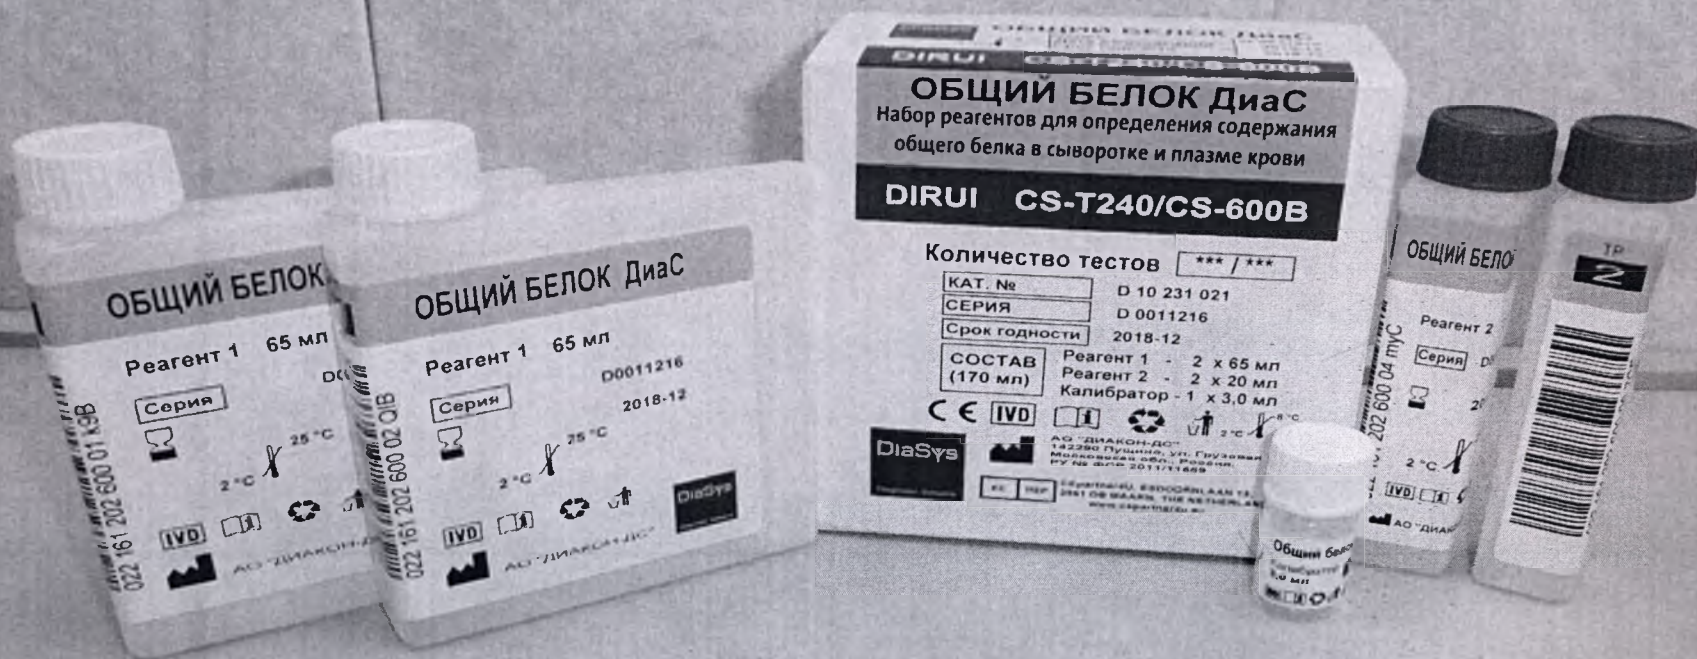


Определение содержания общего белка в сыворотке и плазме крови  
(ОБЩИЙ БЕЛОК ДиаС)

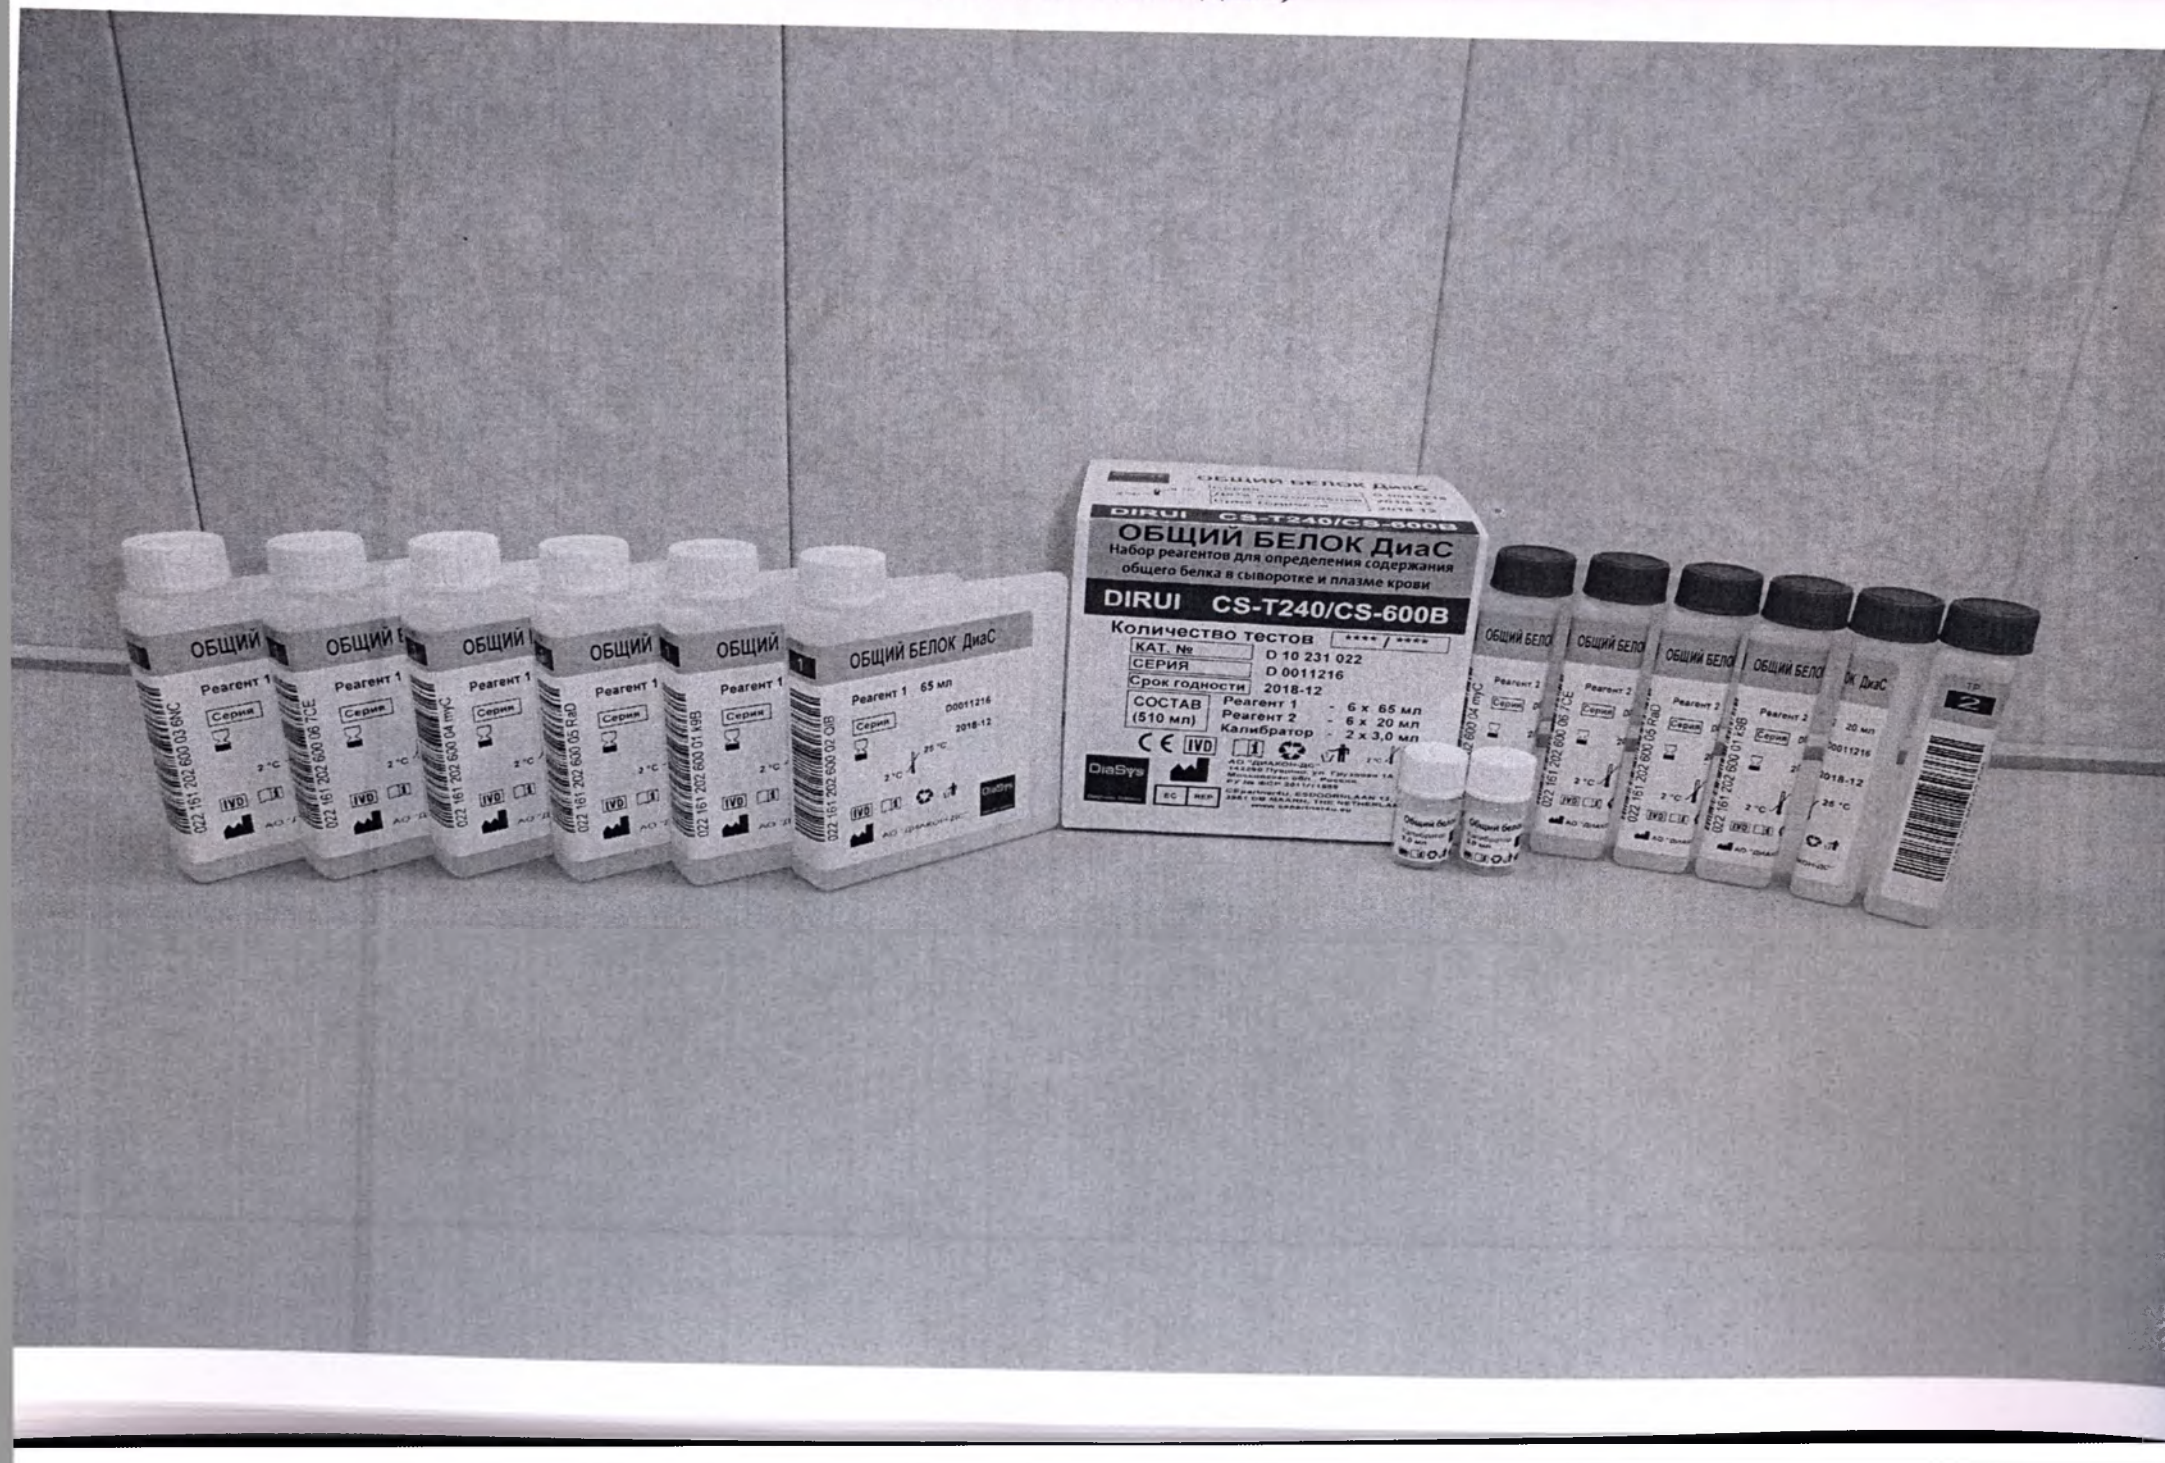


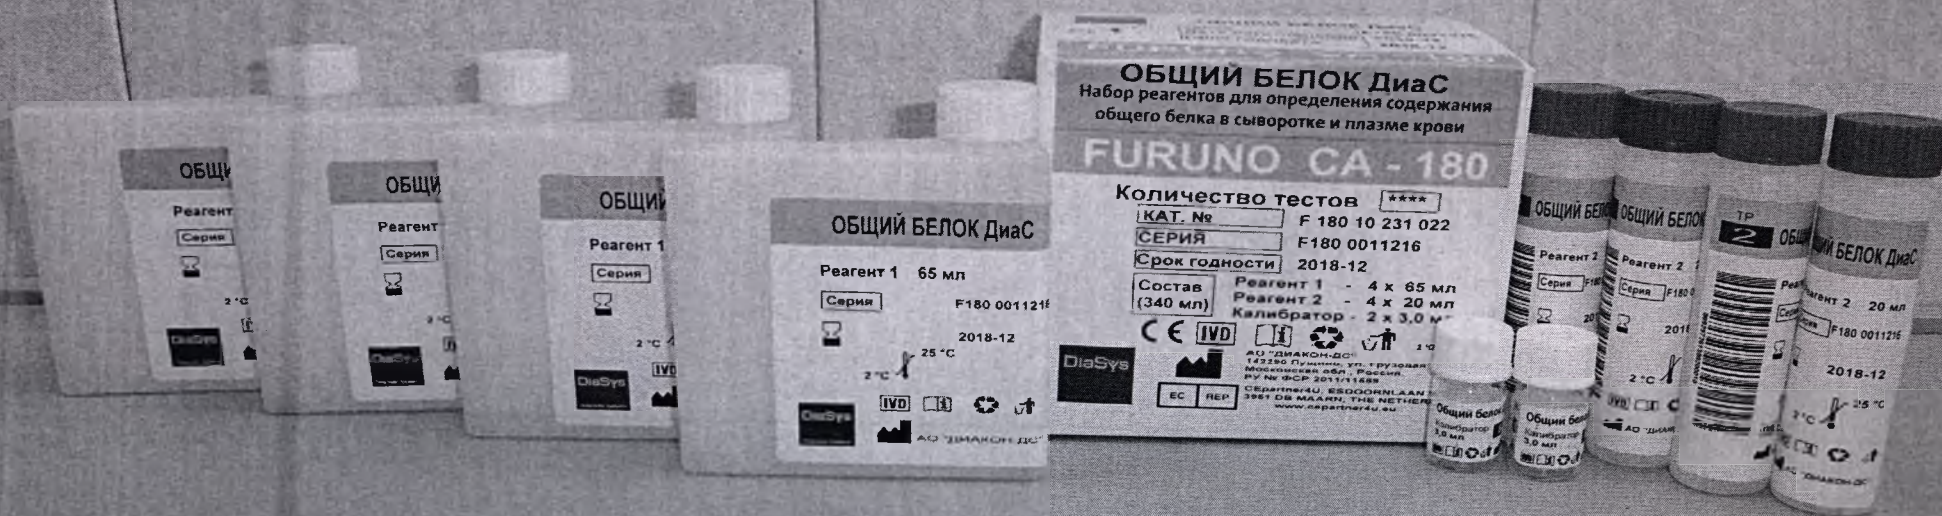


Набора реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови  
(ОБЩИЙ БЕЛОК ДиаС)

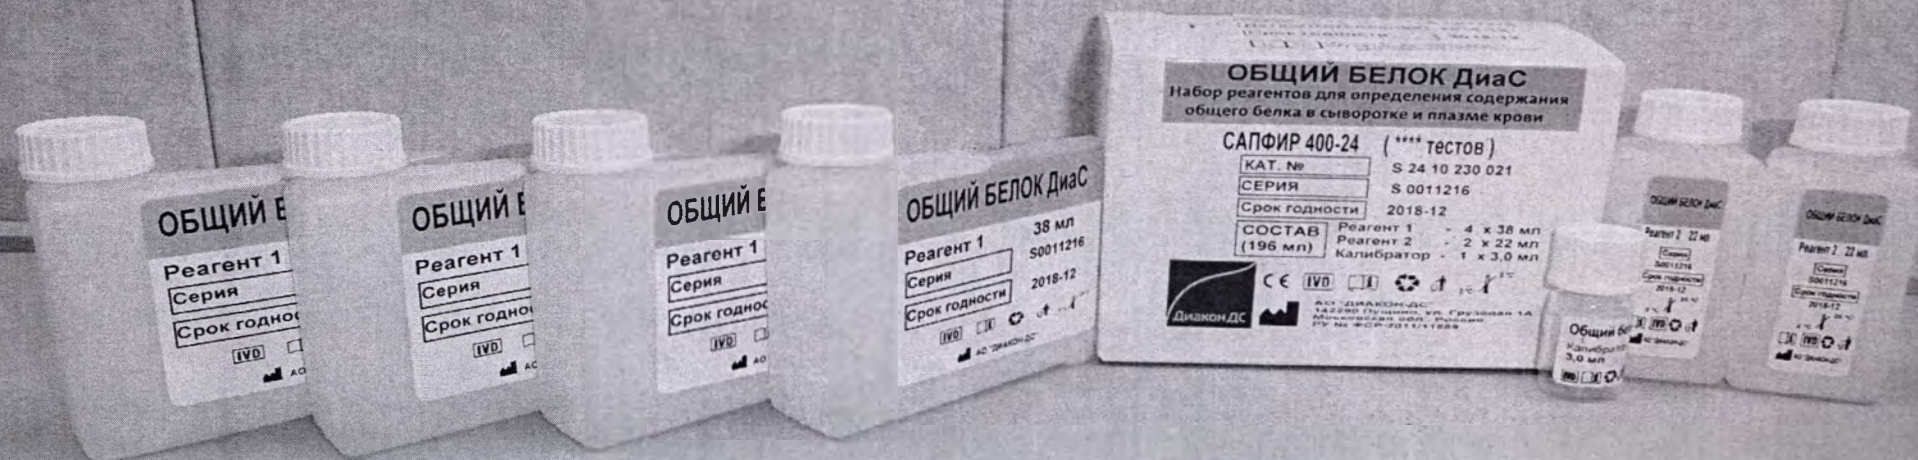

Набора реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови  
(ОБЩИЙ БЕЛОК ДиаС)

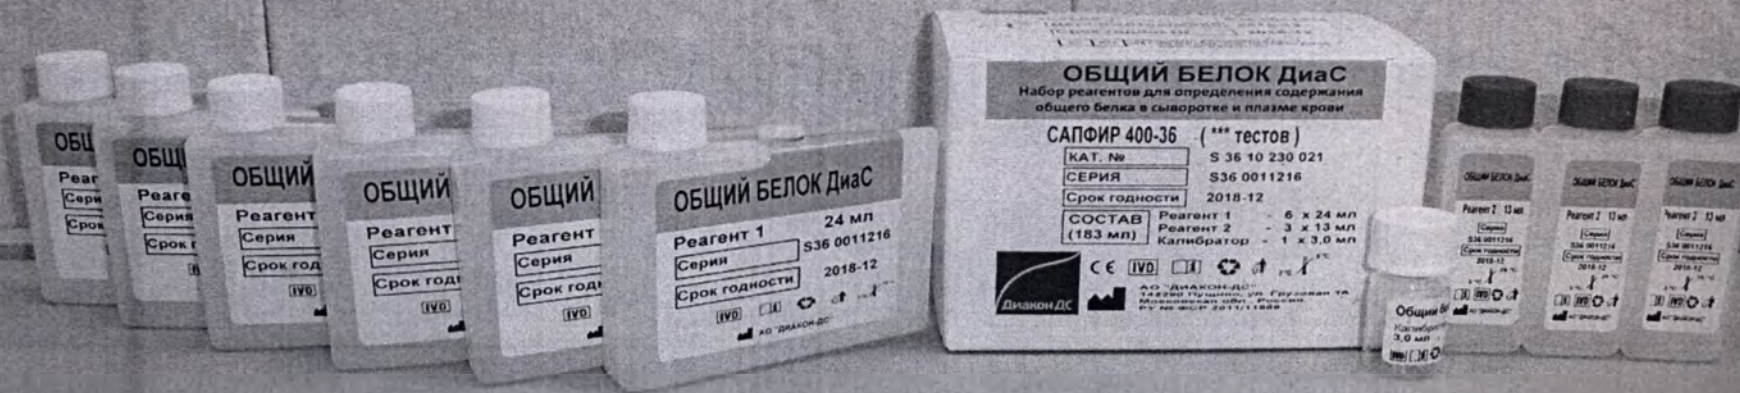


Набора реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови  
(ОБЩИЙ БЕЛОК ДиаС)

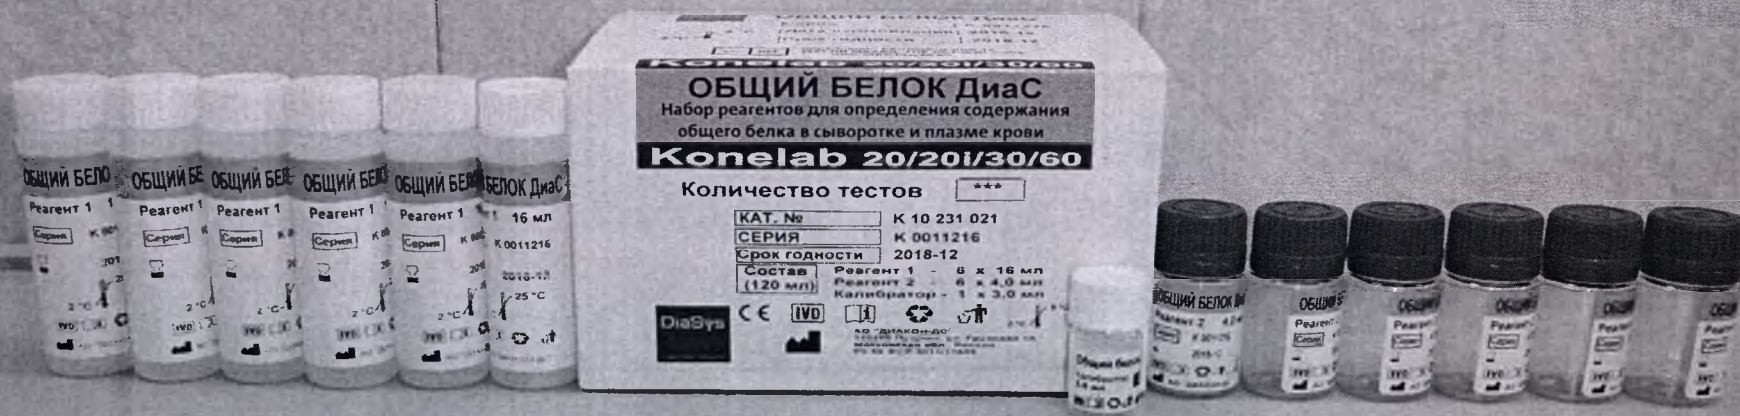



Набора реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови  
(ОБЩИЙ БЕЛОК ДиаС)





**Набора реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови  
(ОБЩИЙ БЕЛОК ДиаС)**

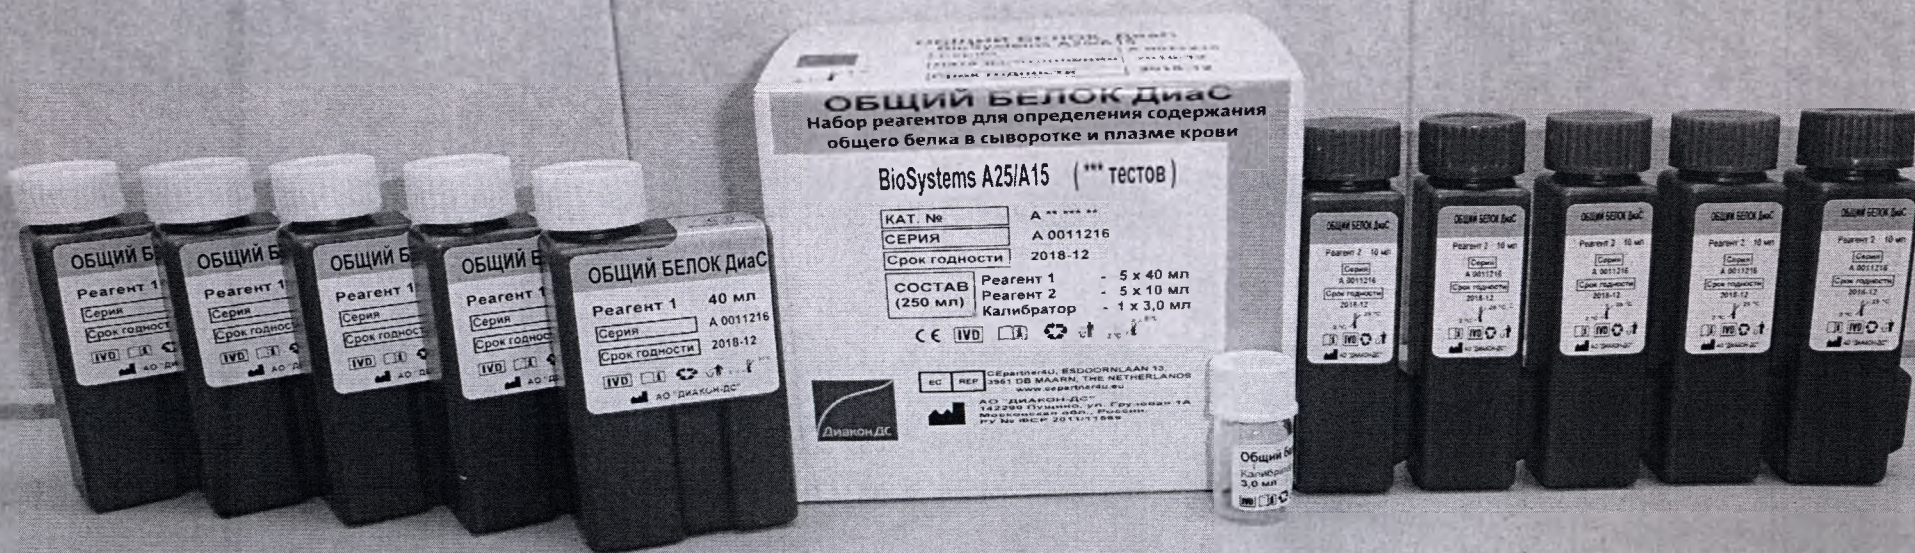

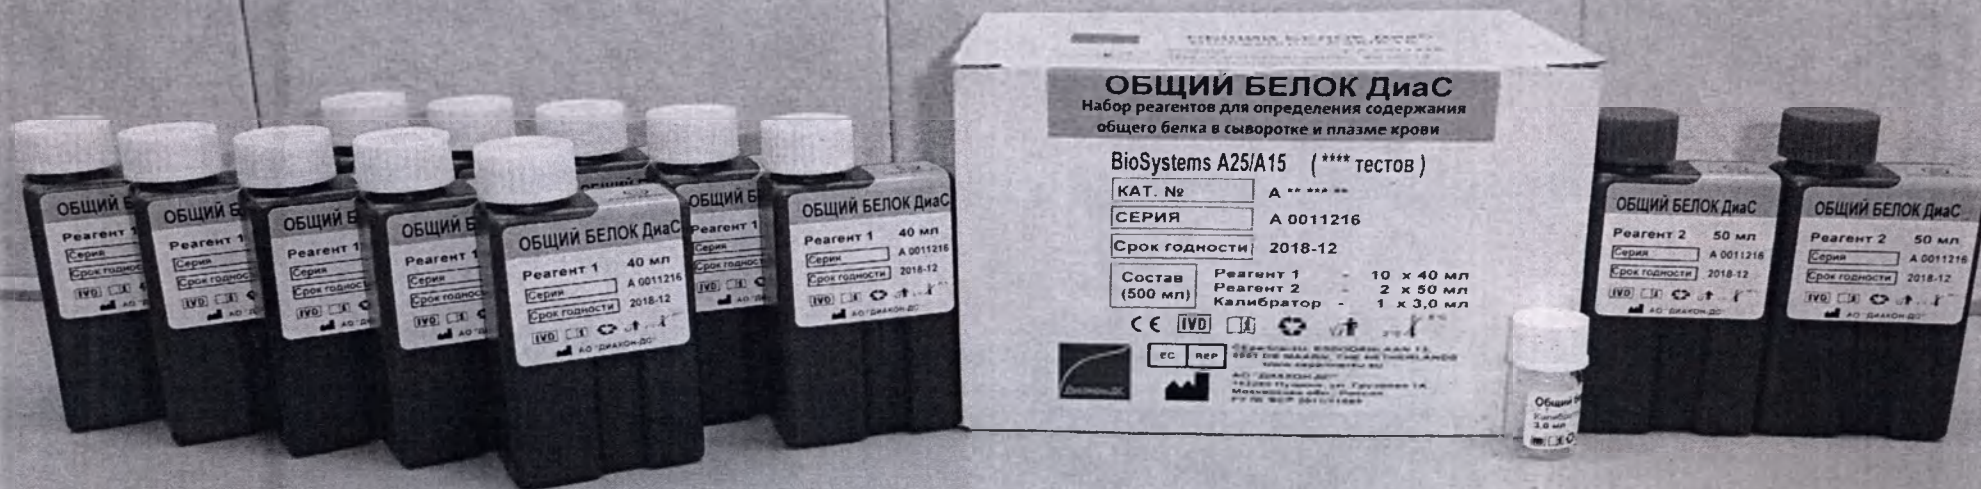

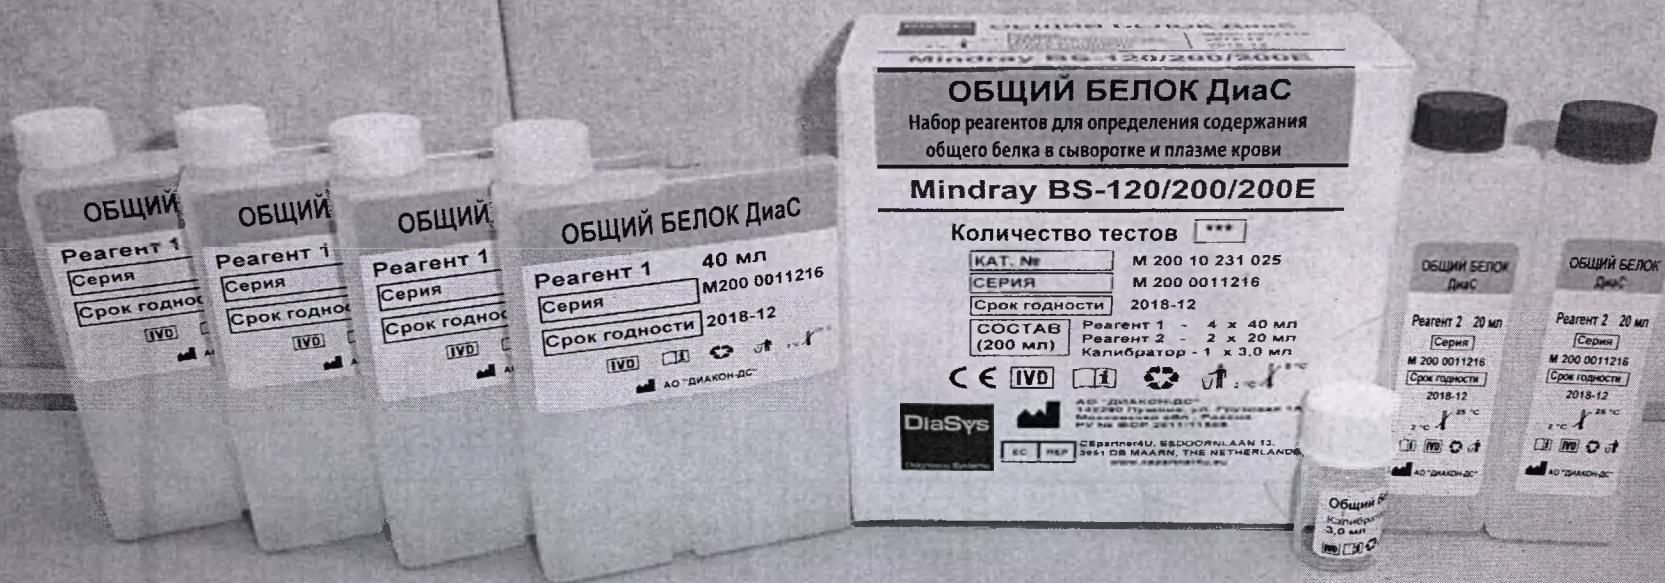


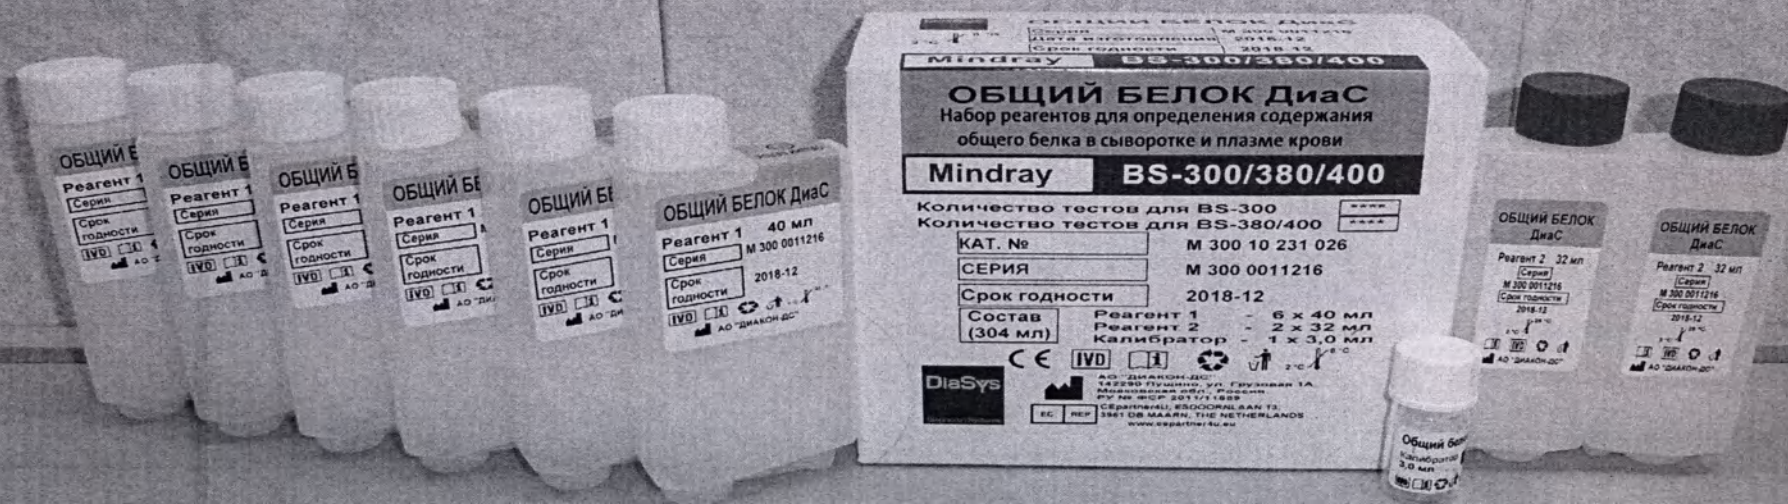

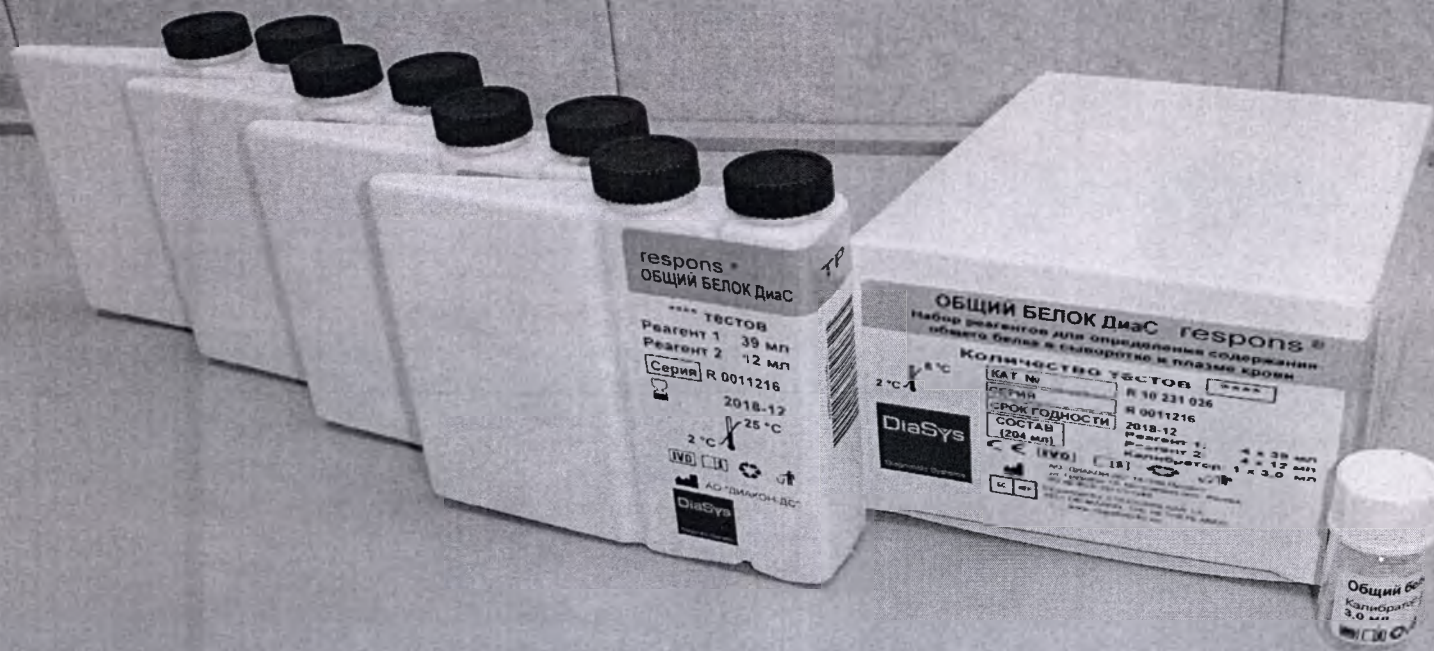





(ОБЩИЙ БЕЛОК ДИАС)

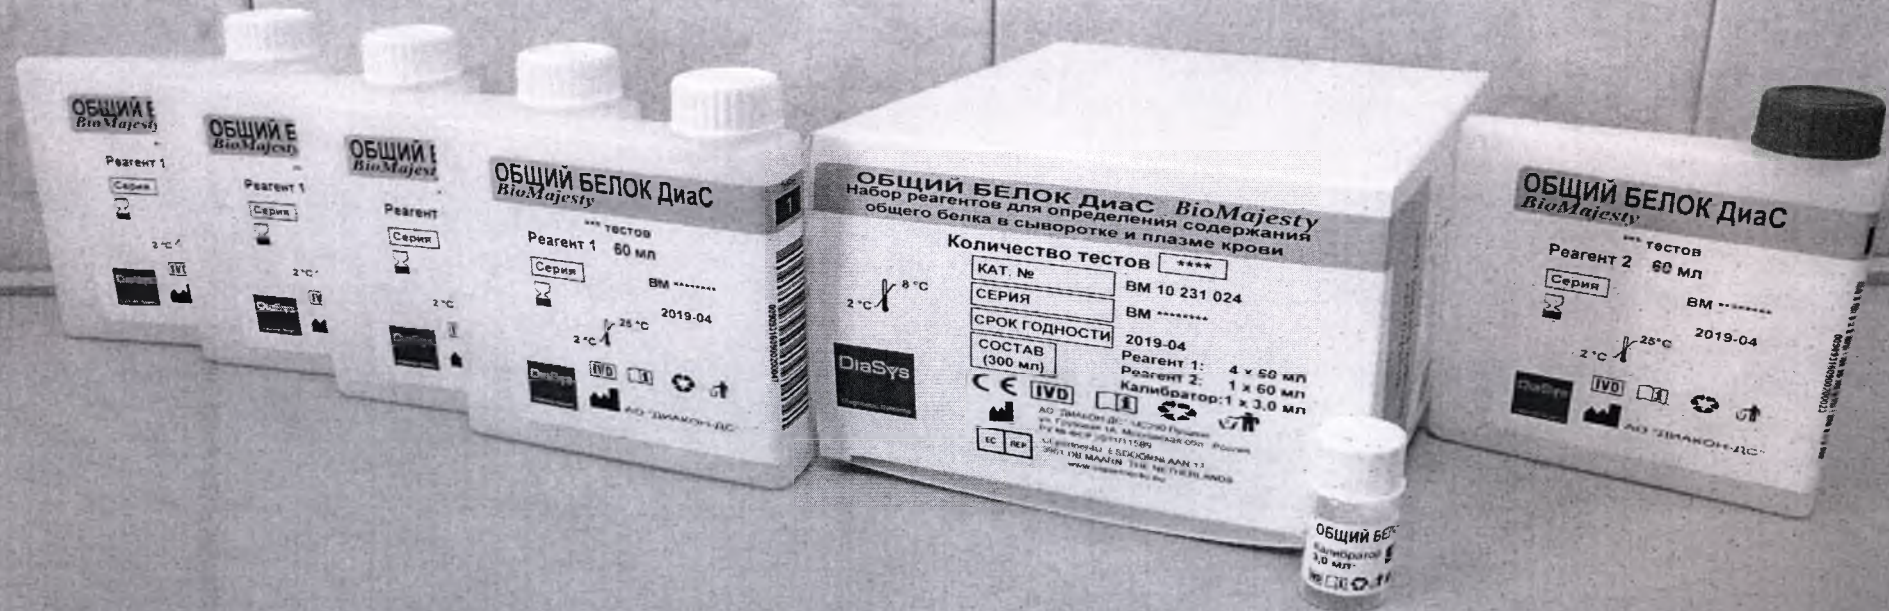


(ОБЩИЙ БЕЛОК ДиаС)

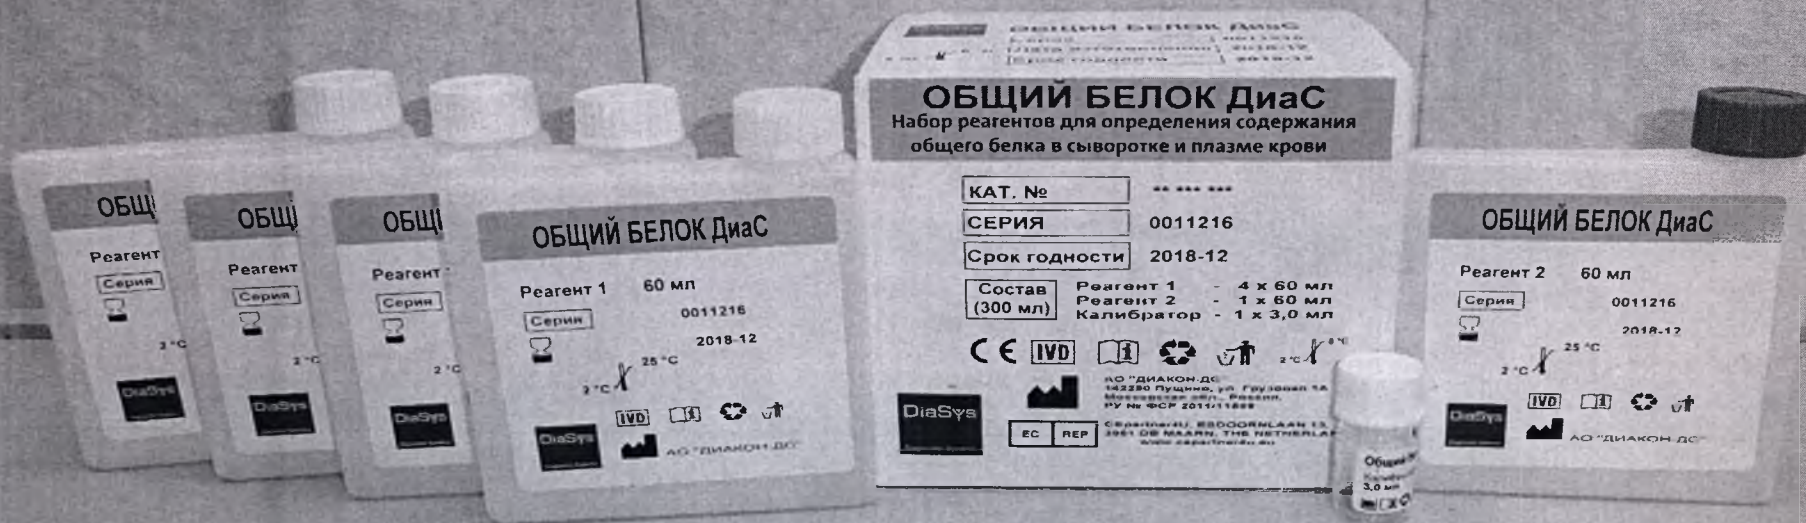


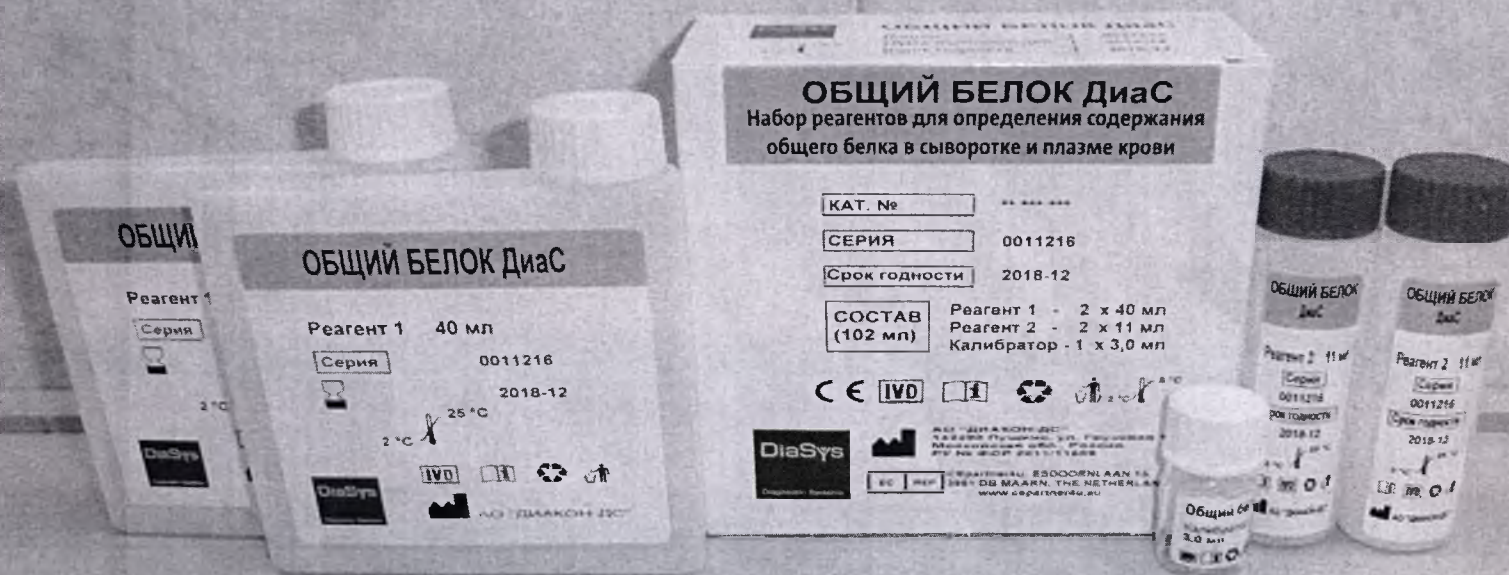

(ОБЩИЙ БЕЛОК ДиаС)

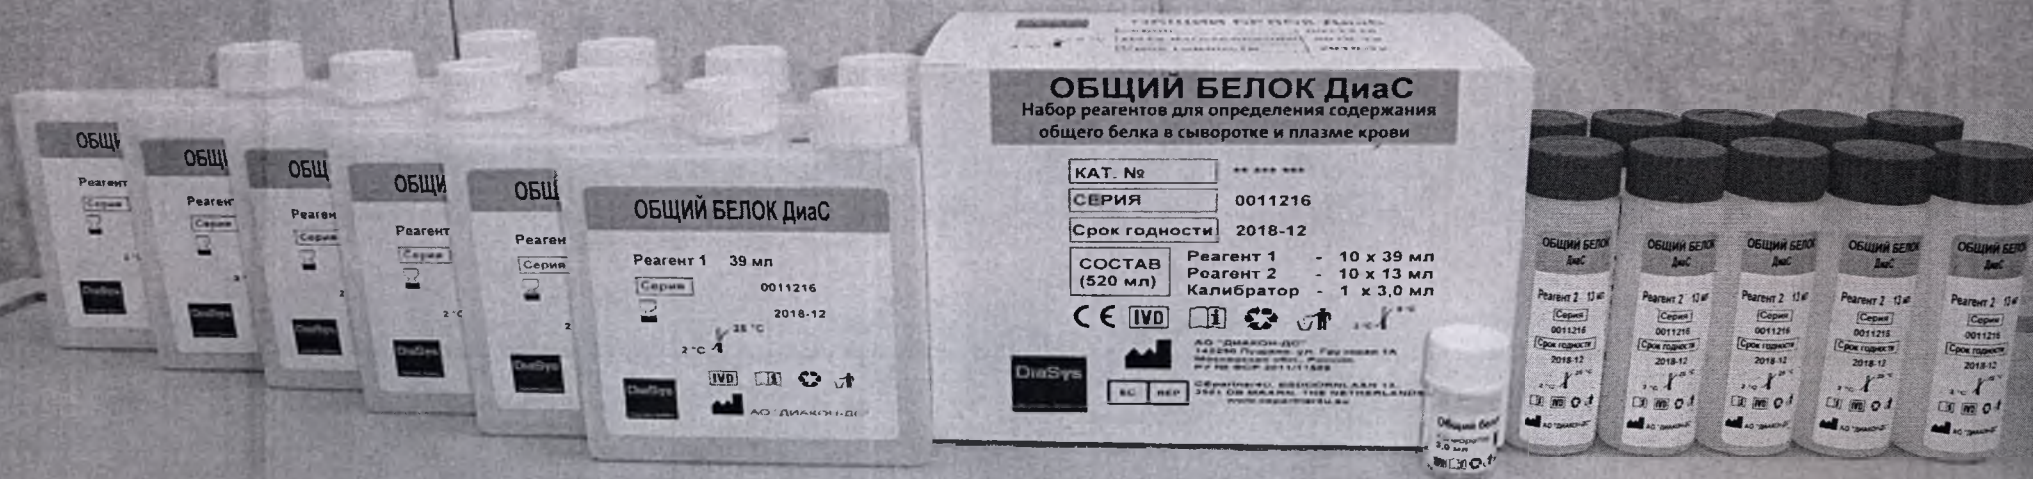

(ОБЩИЙ БЕЛОК ДиаС)

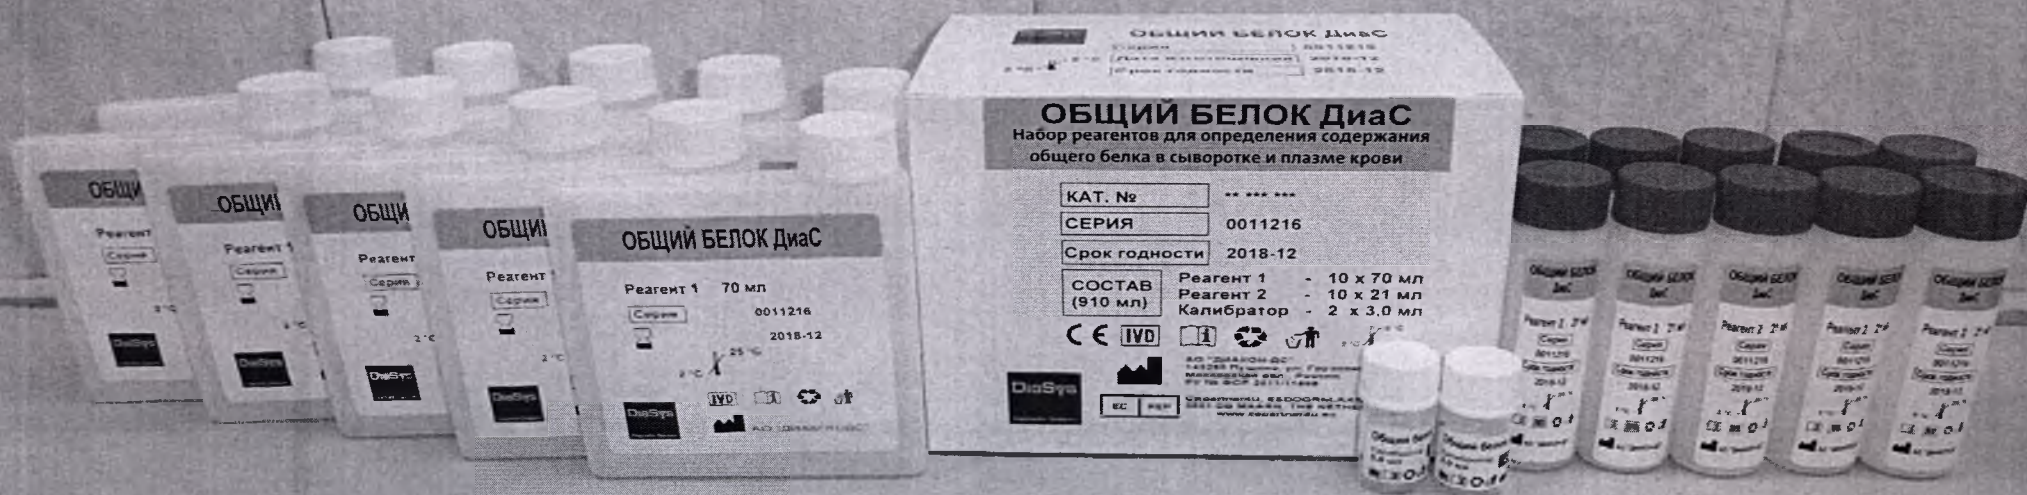

**Общий белок ДиаС**

Серия 0011216  
Дата изготовления 2016-12  
Срок годности 2018-12

**ОБЩИЙ БЕЛОК ДиаС**  
Набор реактивов для определения содержания  
общего белка в сыворотке и плазме крови

КАТ. № 0011216  
СЕРИЯ 0011216  
СРОК ГОДНОСТИ 2018-12

Состав: Реагент 1 - 1 x 10000 мл  
Реагент 2 - 1 x 2500 мл  
Калибратор - 1 x 500 мл

CE IVD


АО "ДИАКОН-ДС"  
142300, Подольск, ул. Рабочая, 1а  
Тел: (495) 336-11-00  
E-mail: info@diakon-ds.ru

**ОБЩИЙ БЕЛОК ДиаС**

Реагент 1 10000 мл

Серия 0011216

2018-12




**ОБЩИЙ БЕЛОК ДиаС**

Реагент 2 2500 мл

Серия 0011216

2018-12




**ОБЩИЙ БЕЛОК ДиаС**


Калибратор 500 мл

5 г / дл




Серия 0011216



2018-12




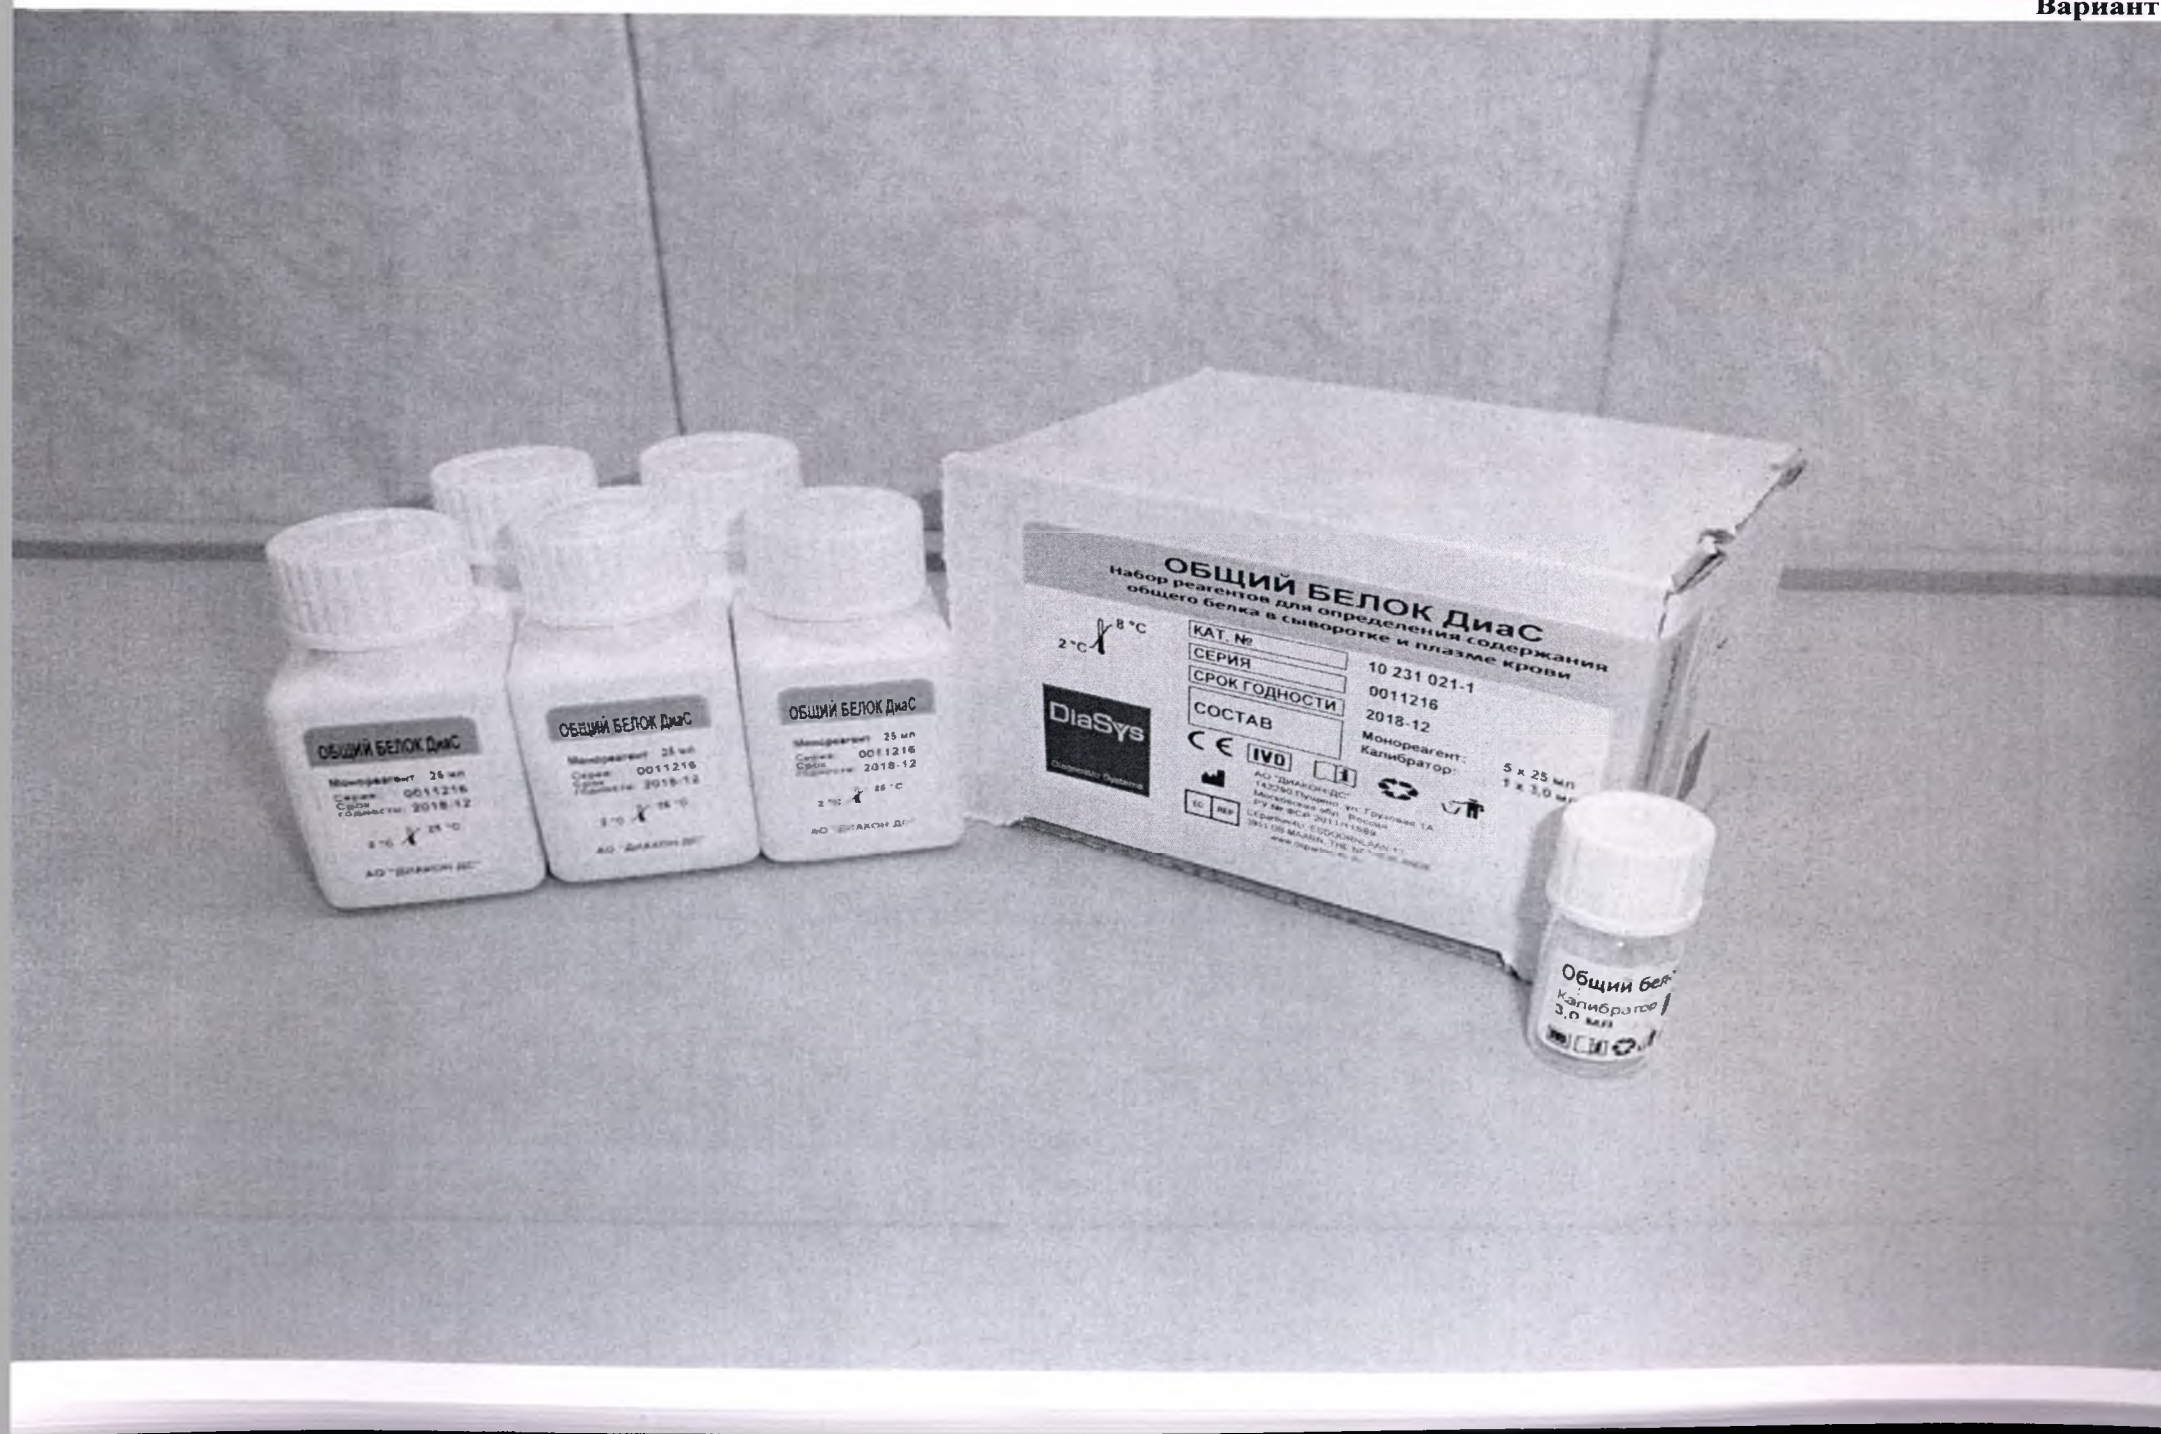


Набора реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови  
(ОБЩИЙ БЕЛОК ДИАС)

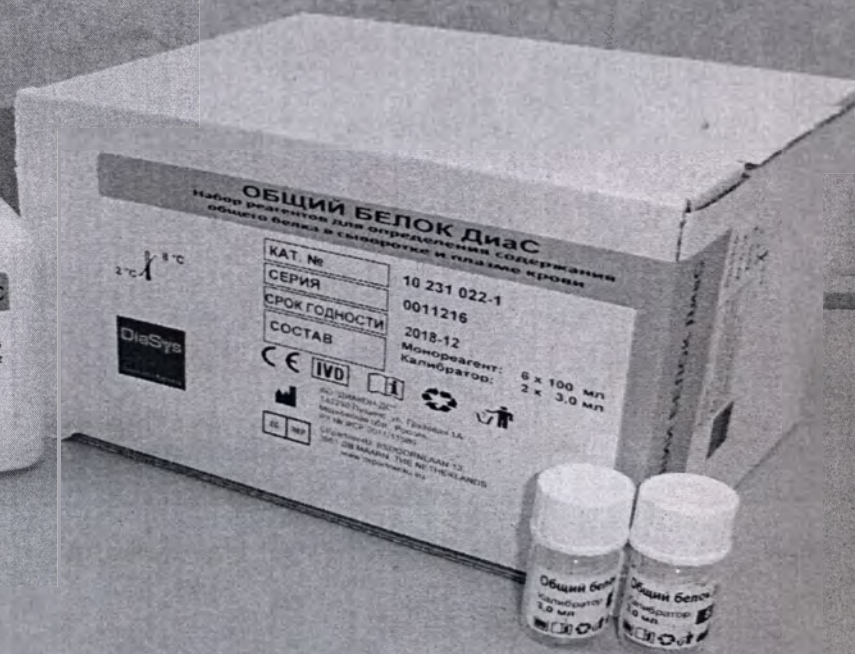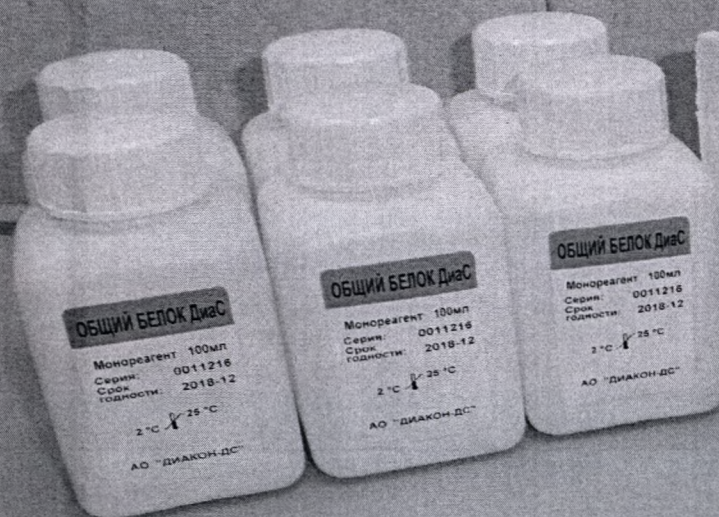


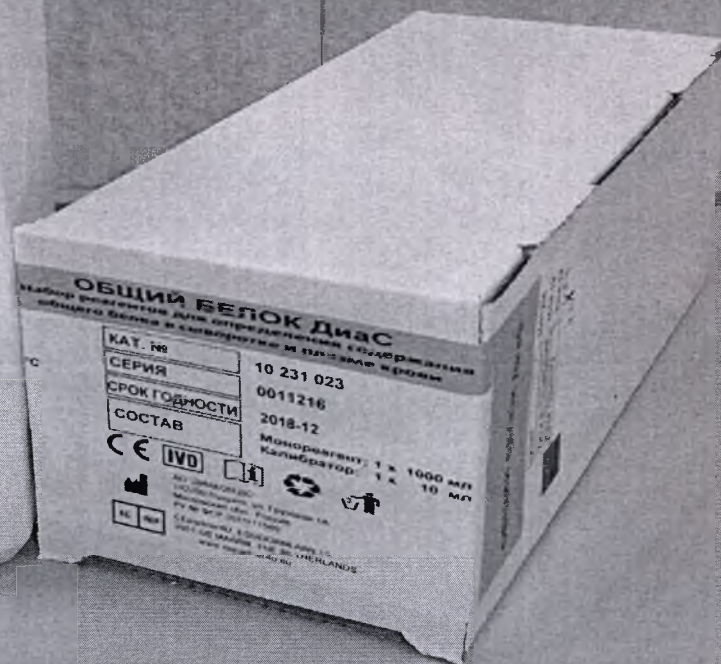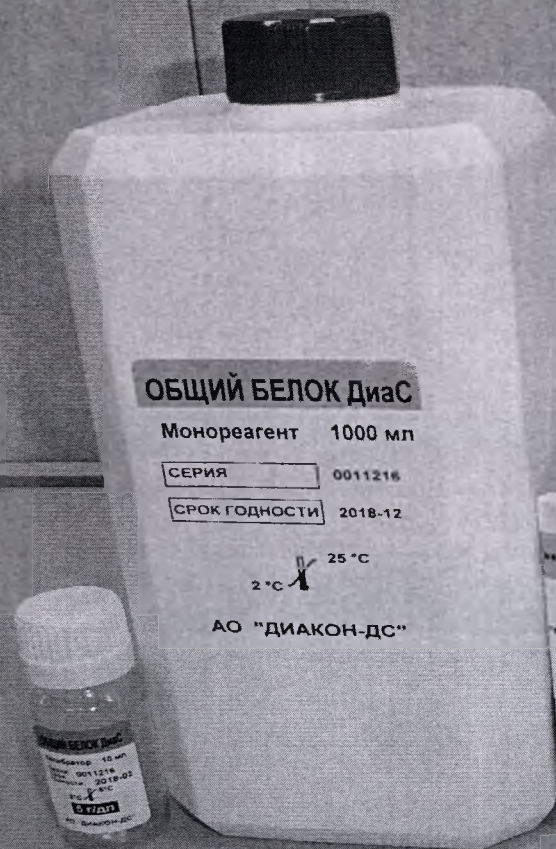


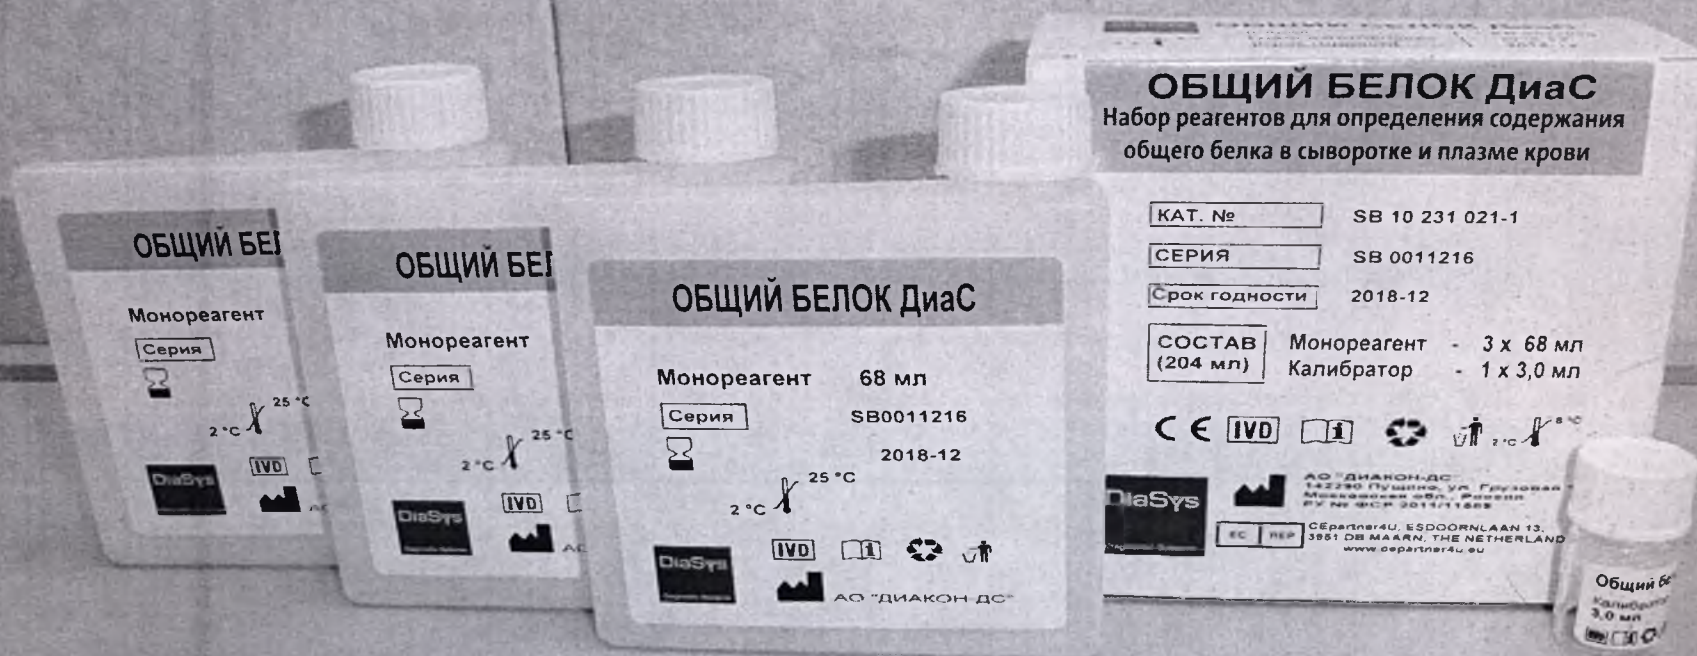

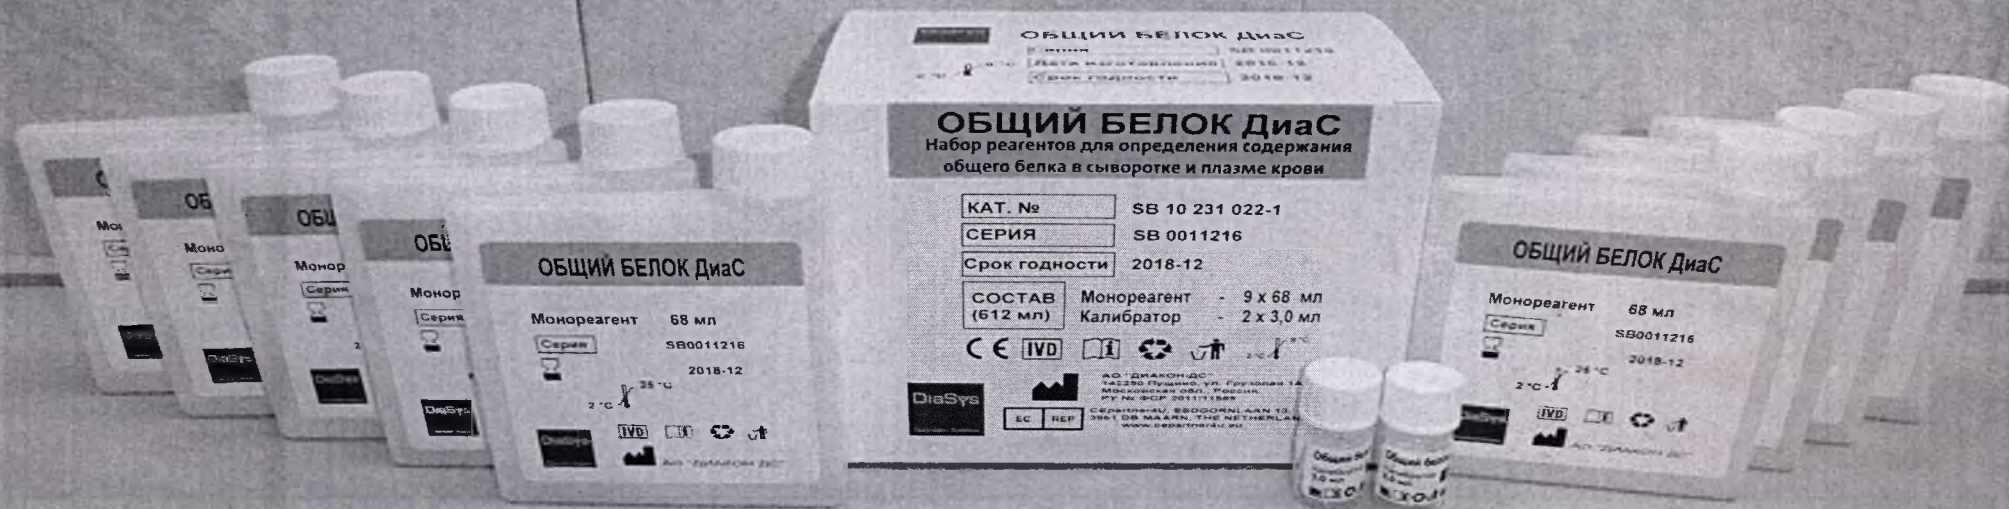




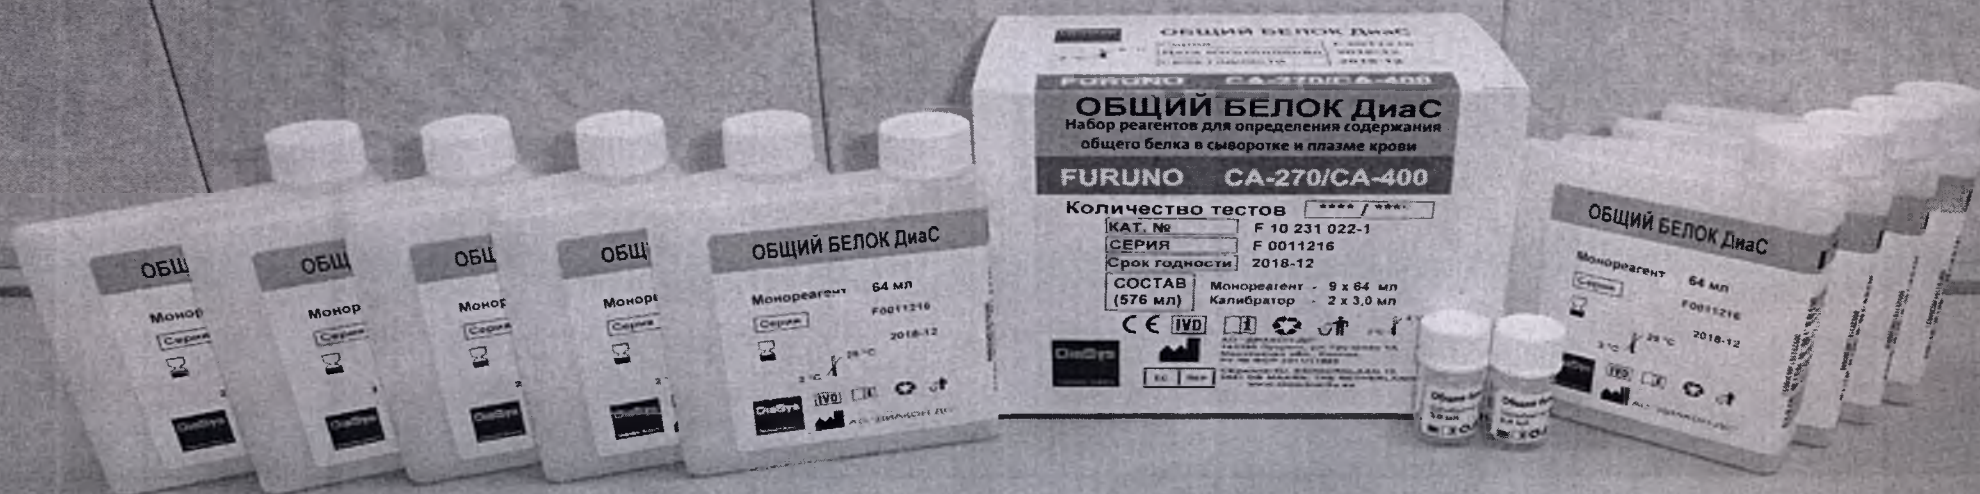

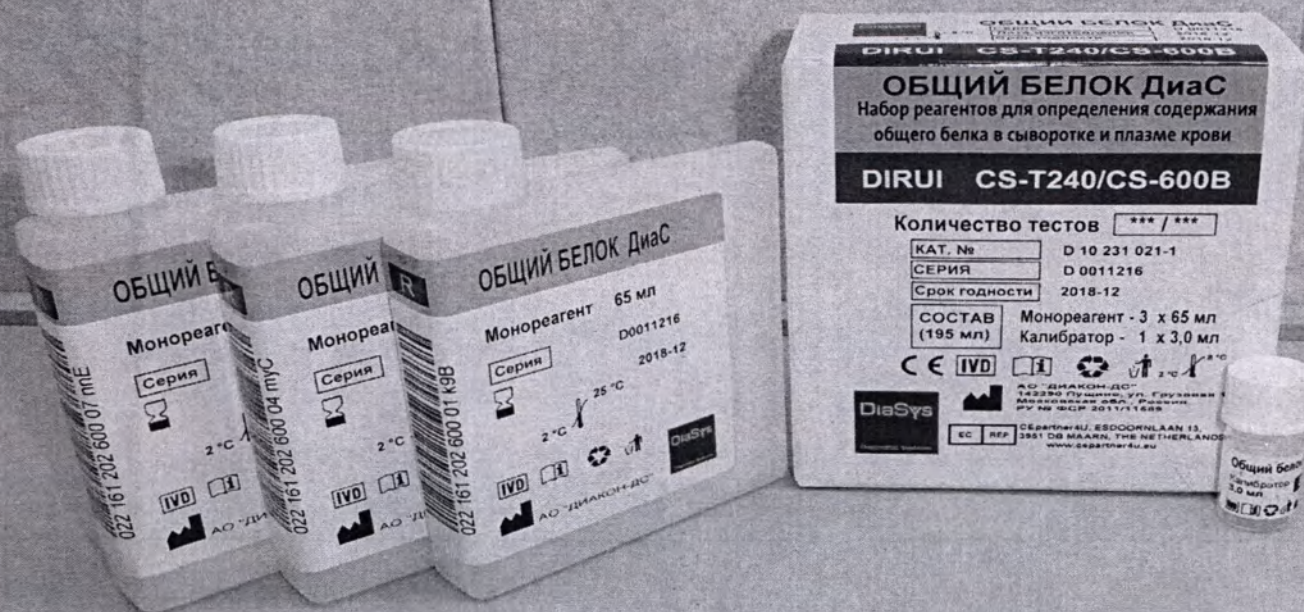


Набора реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке крови  
(ОБЩИЙ БЕЛОК ДИАС)

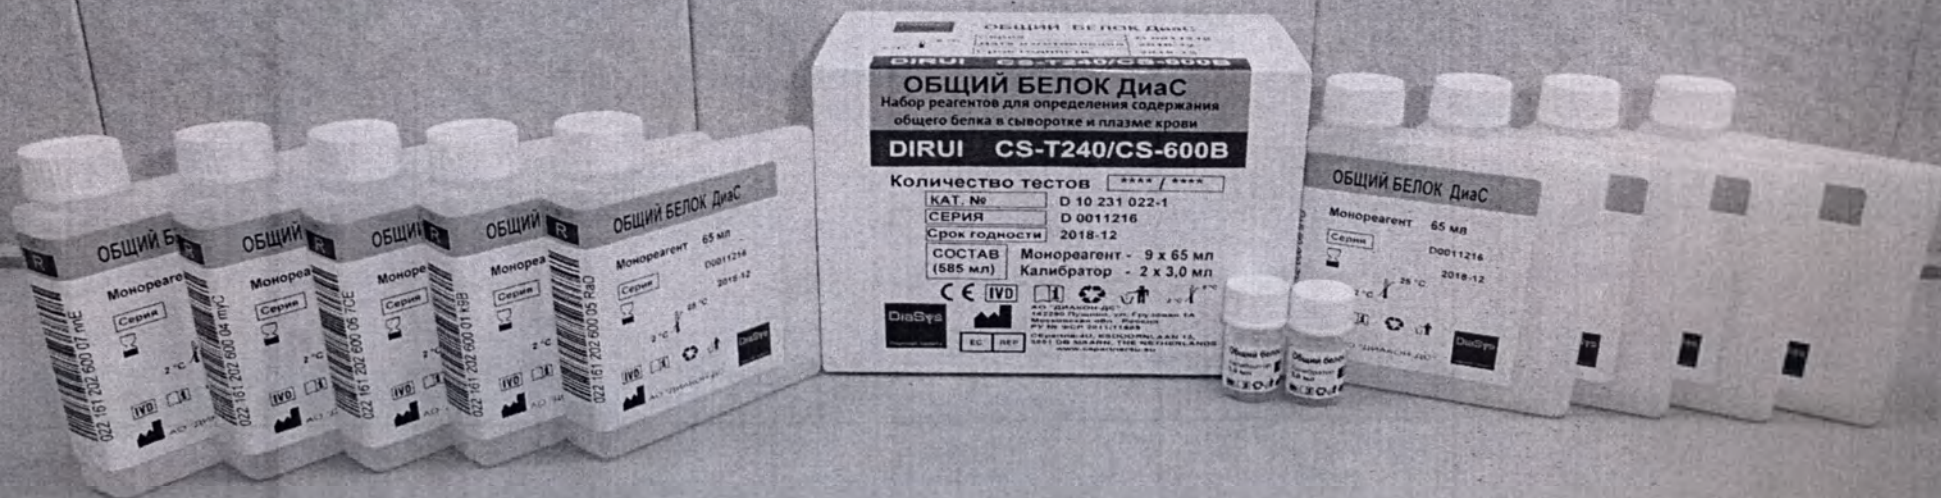

Набора реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови  
(ОБЩИЙ БЕЛОК ДиаС)



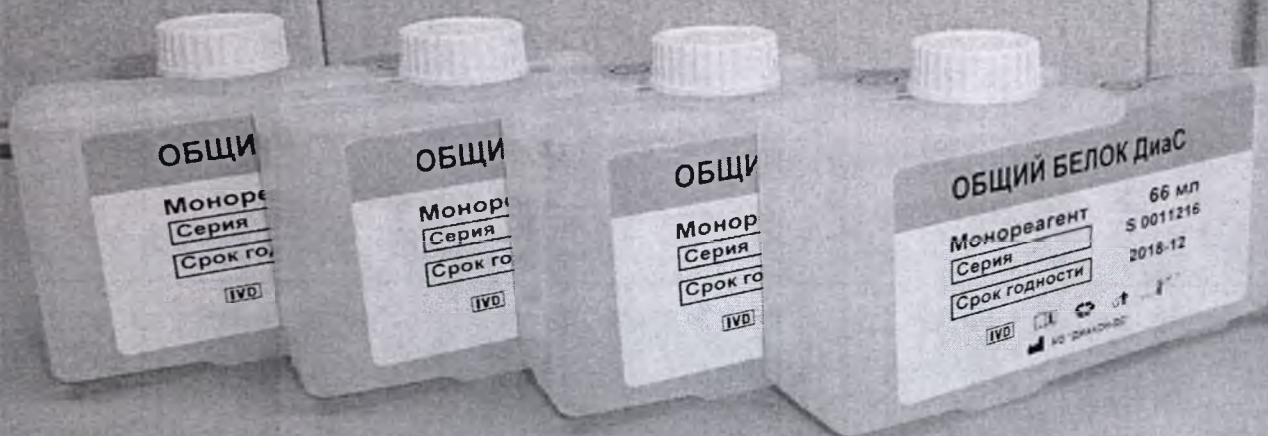


Набора реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови  
(ОБЩИЙ БЕЛОК ДИАС)





Набора реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови  
(ОБЩИЙ БЕЛОК ДиаС)


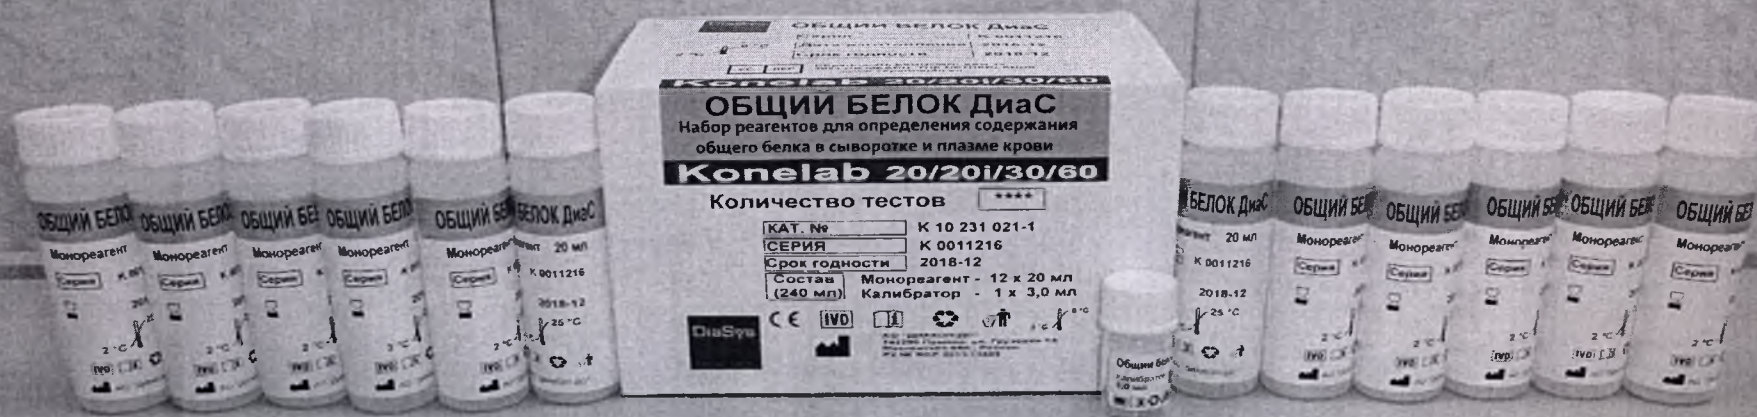


**Набора реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови  
(ОБЩИЙ БЕЛОК ДиаС)**





Набор реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови  
(ОБЩИЙ БЕЛОК ДиаС)



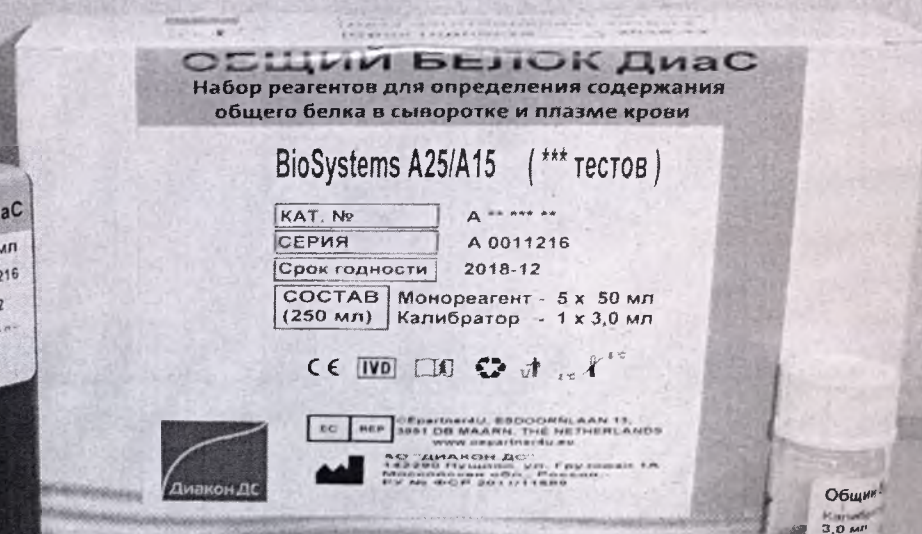


Набора реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови  
(ОБЩИЙ БЕЛОК ДиаС)

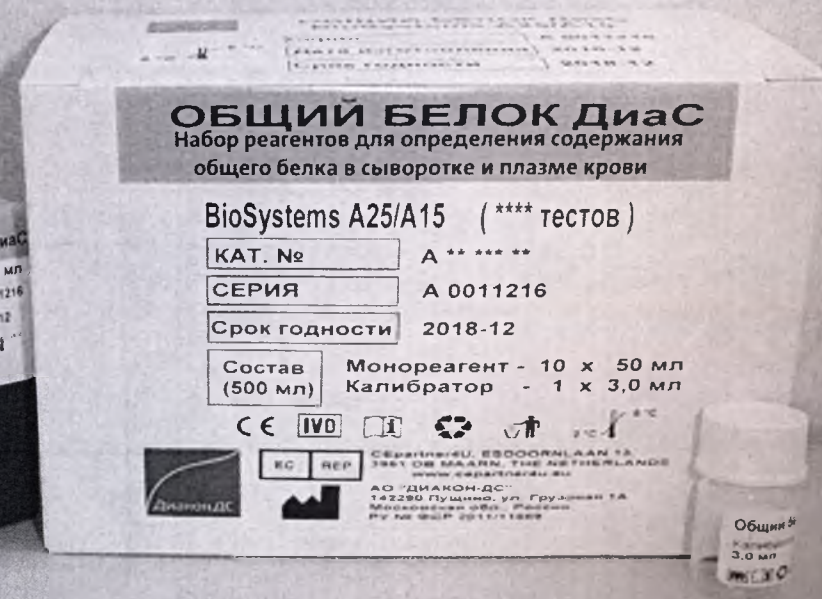


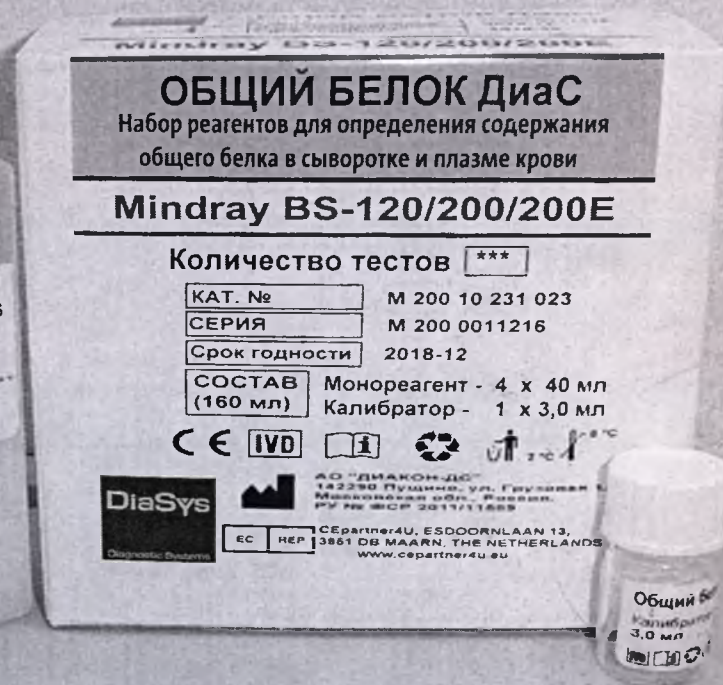


Набора реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови  
(ОБЩИЙ БЕЛОК ДиаС)

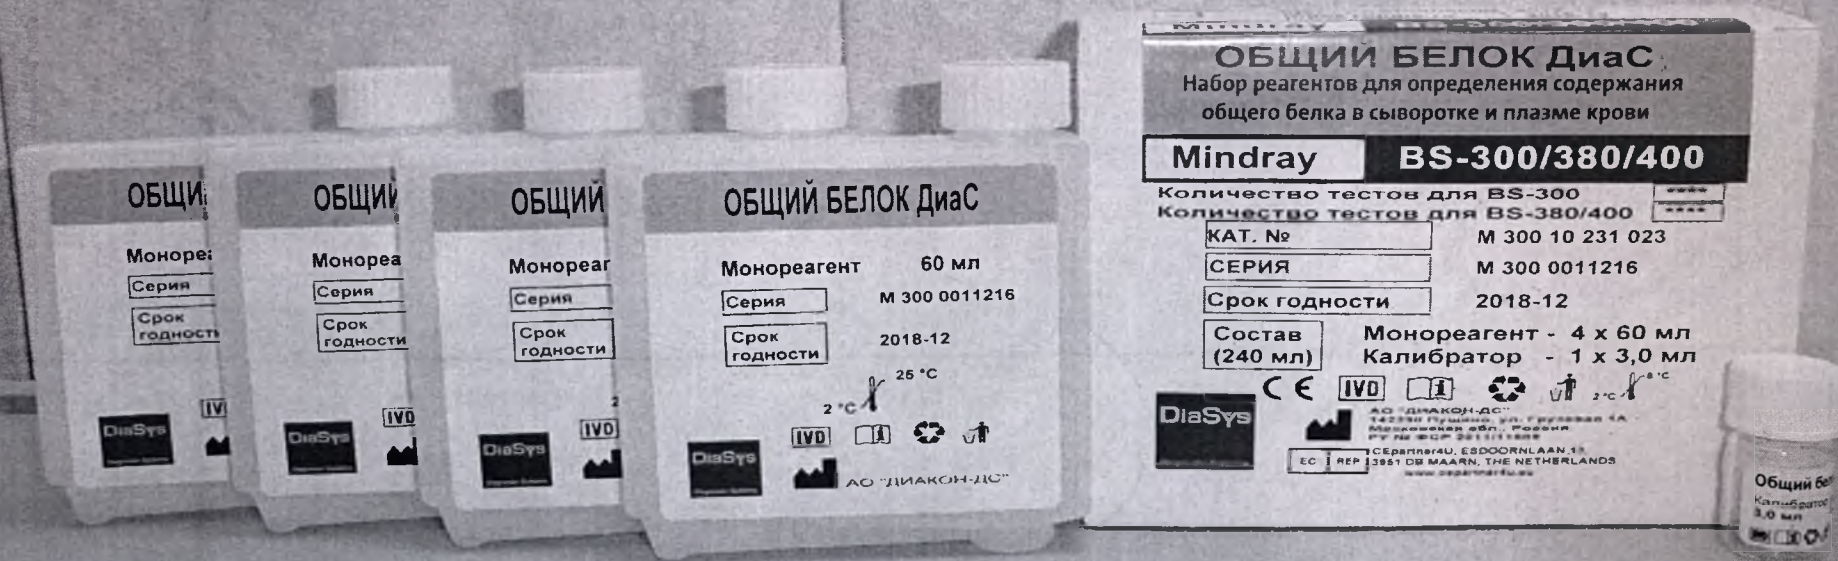


Набора реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови  
(ОБЩИЙ БЕЛОК ДИАС)

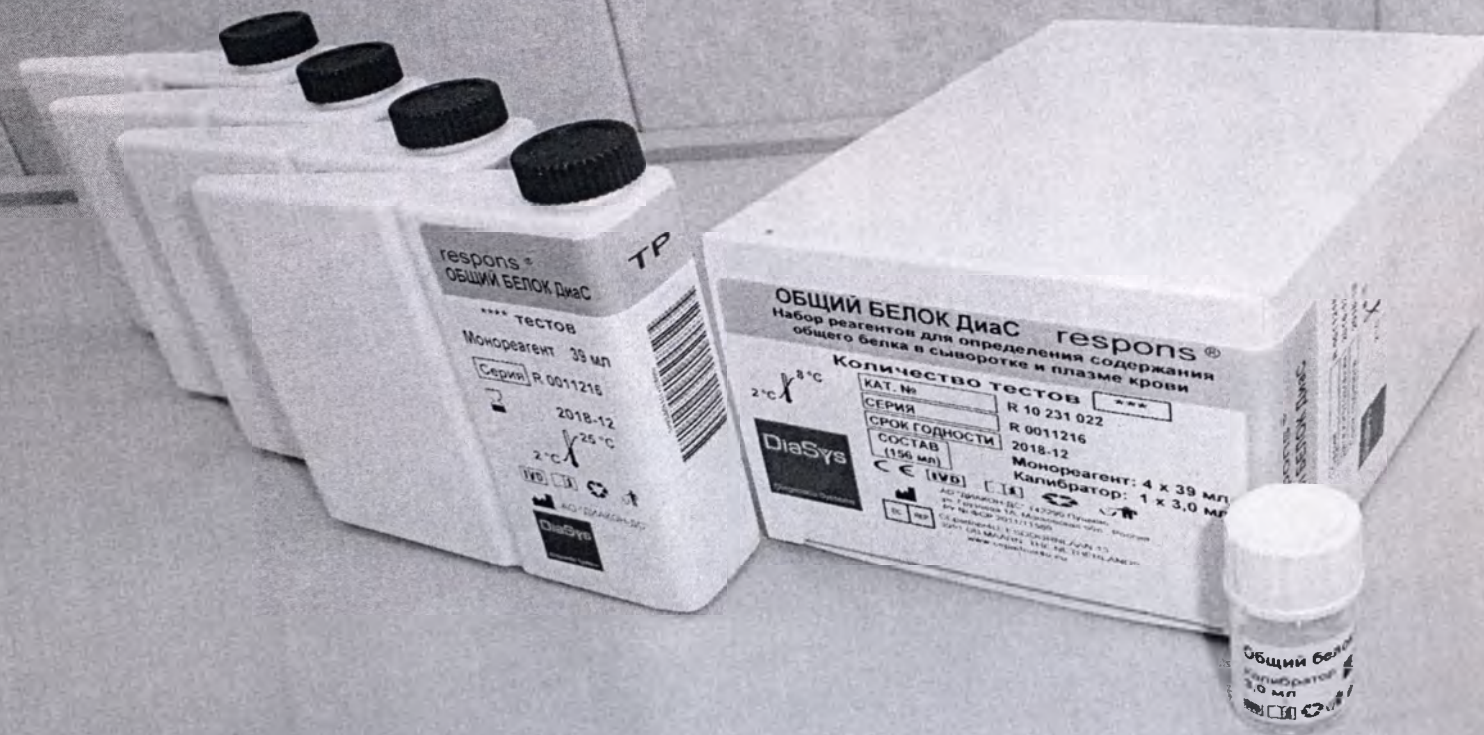

**Набора реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови  
(ОБЩИЙ БЕЛОК ДиаС)**

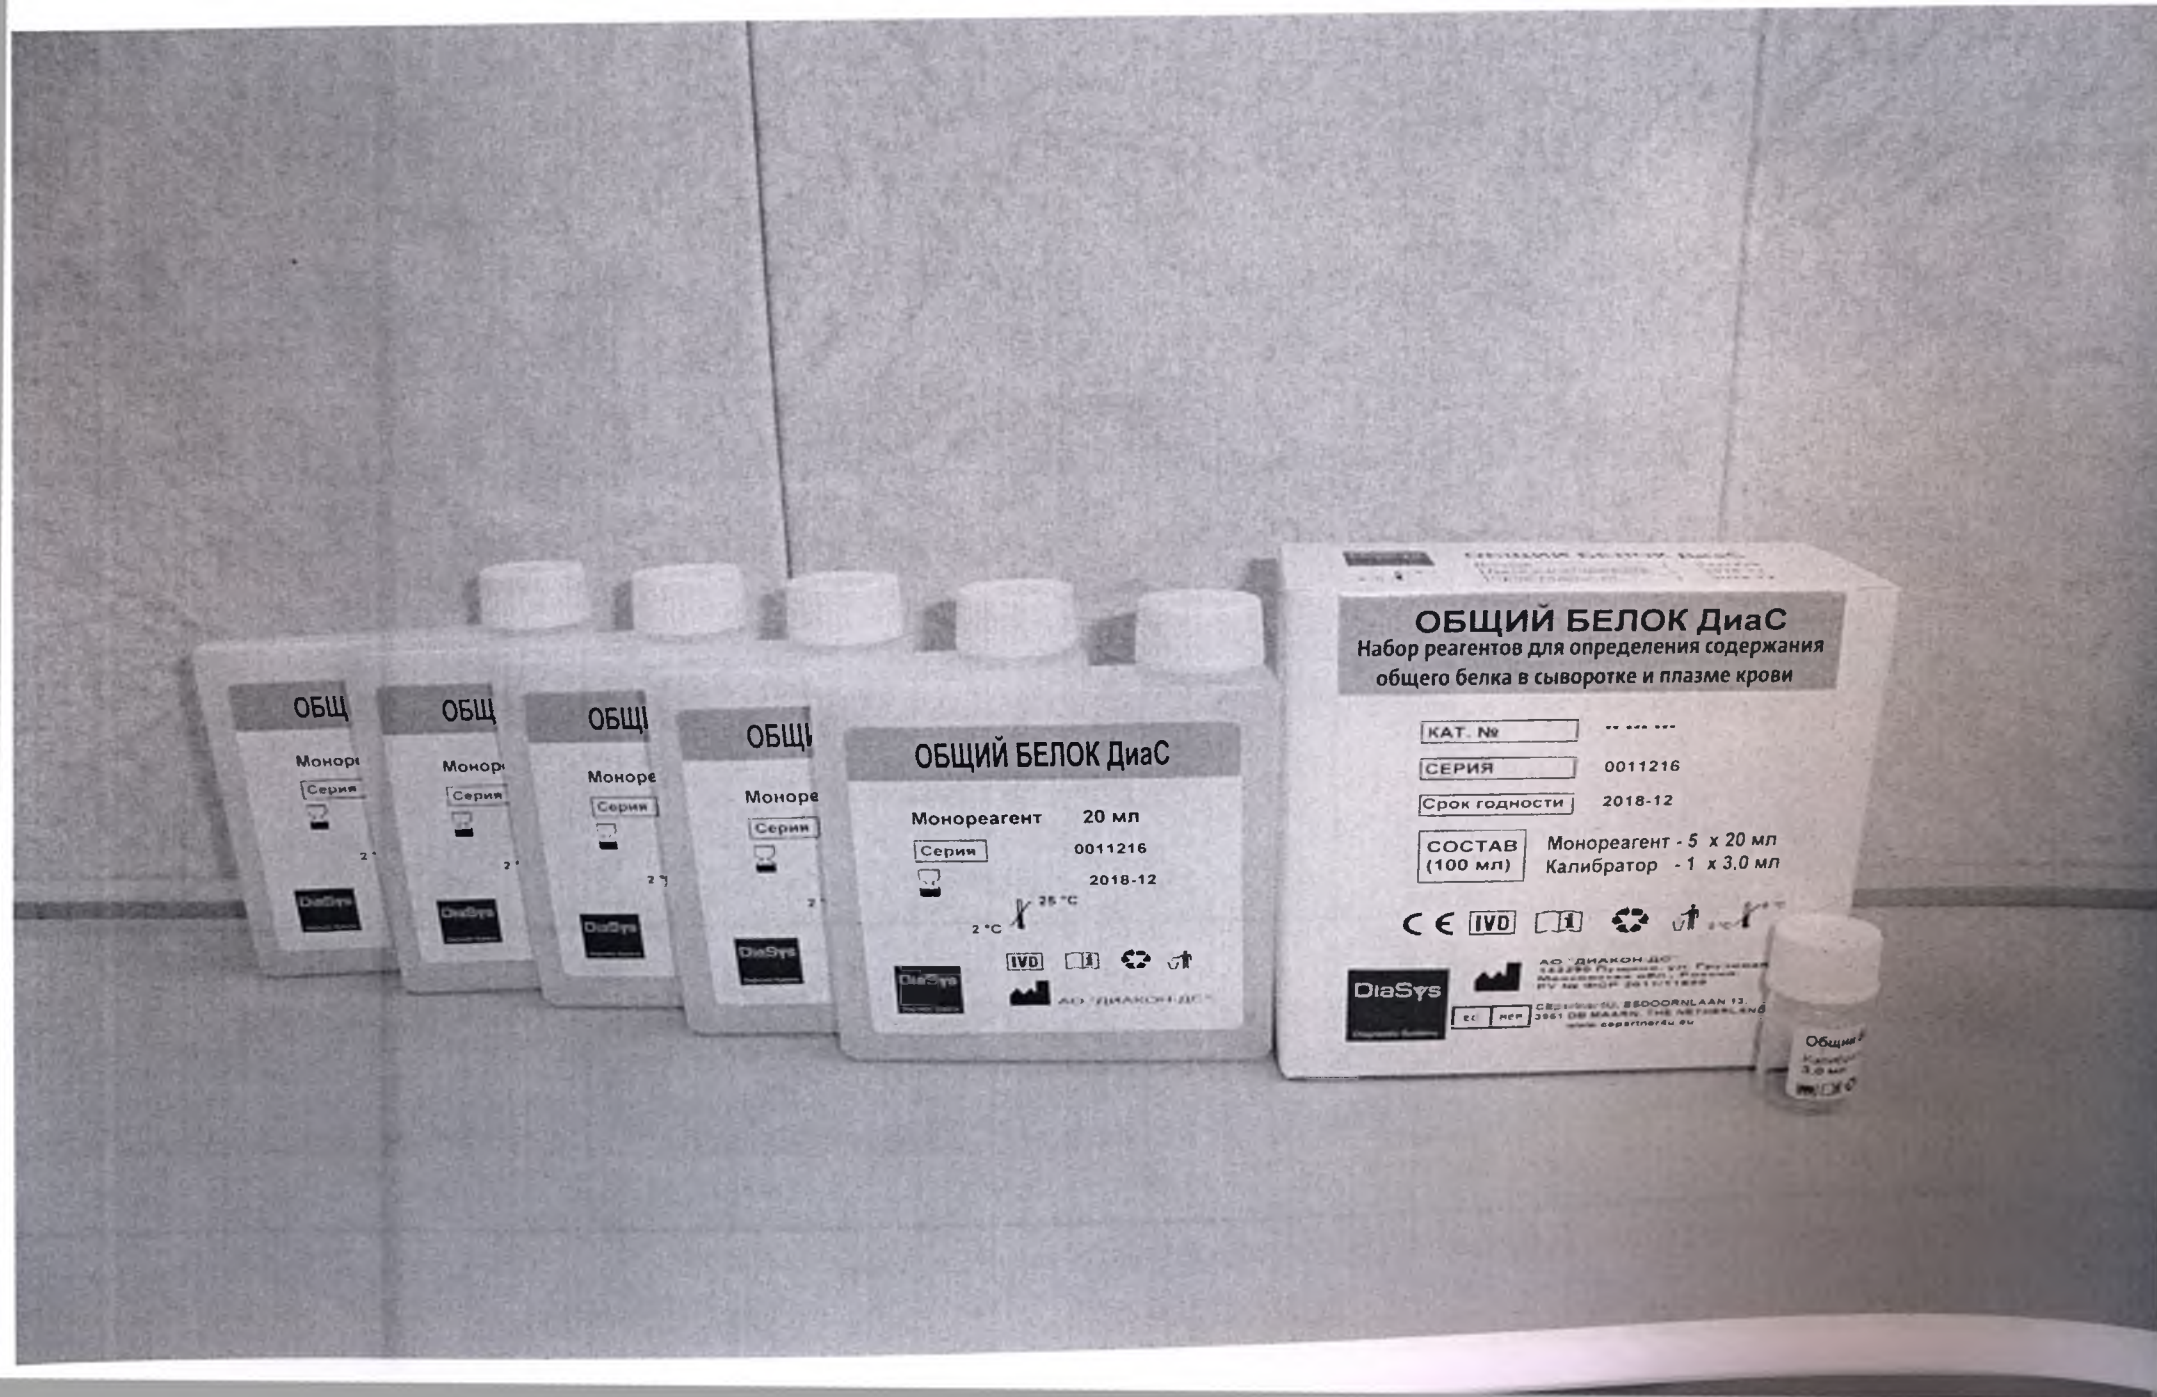

**(ОБЩИЙ БЕЛОК ДнаС)**



АО "ДИАКОН-ДС"  
142250 Пушкино, ул. Грузовая 1А  
Московская обл., Россия  
РУ № ФСР 2011/11589

**DiaSys**

EC REP

CEpartnert4U, ESDOORNLAAN 13,  
3961 DB MAARN, THE NETHERLANDS  
[www.cepartnert4u.eu](http://www.cepartnert4u.eu)


Набора реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови  
(ОБЩИЙ БЕЛОК ДиаС)





Внешний вид

**Набора реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови  
(ОБЩИЙ БЕЛОК ДиаС)**

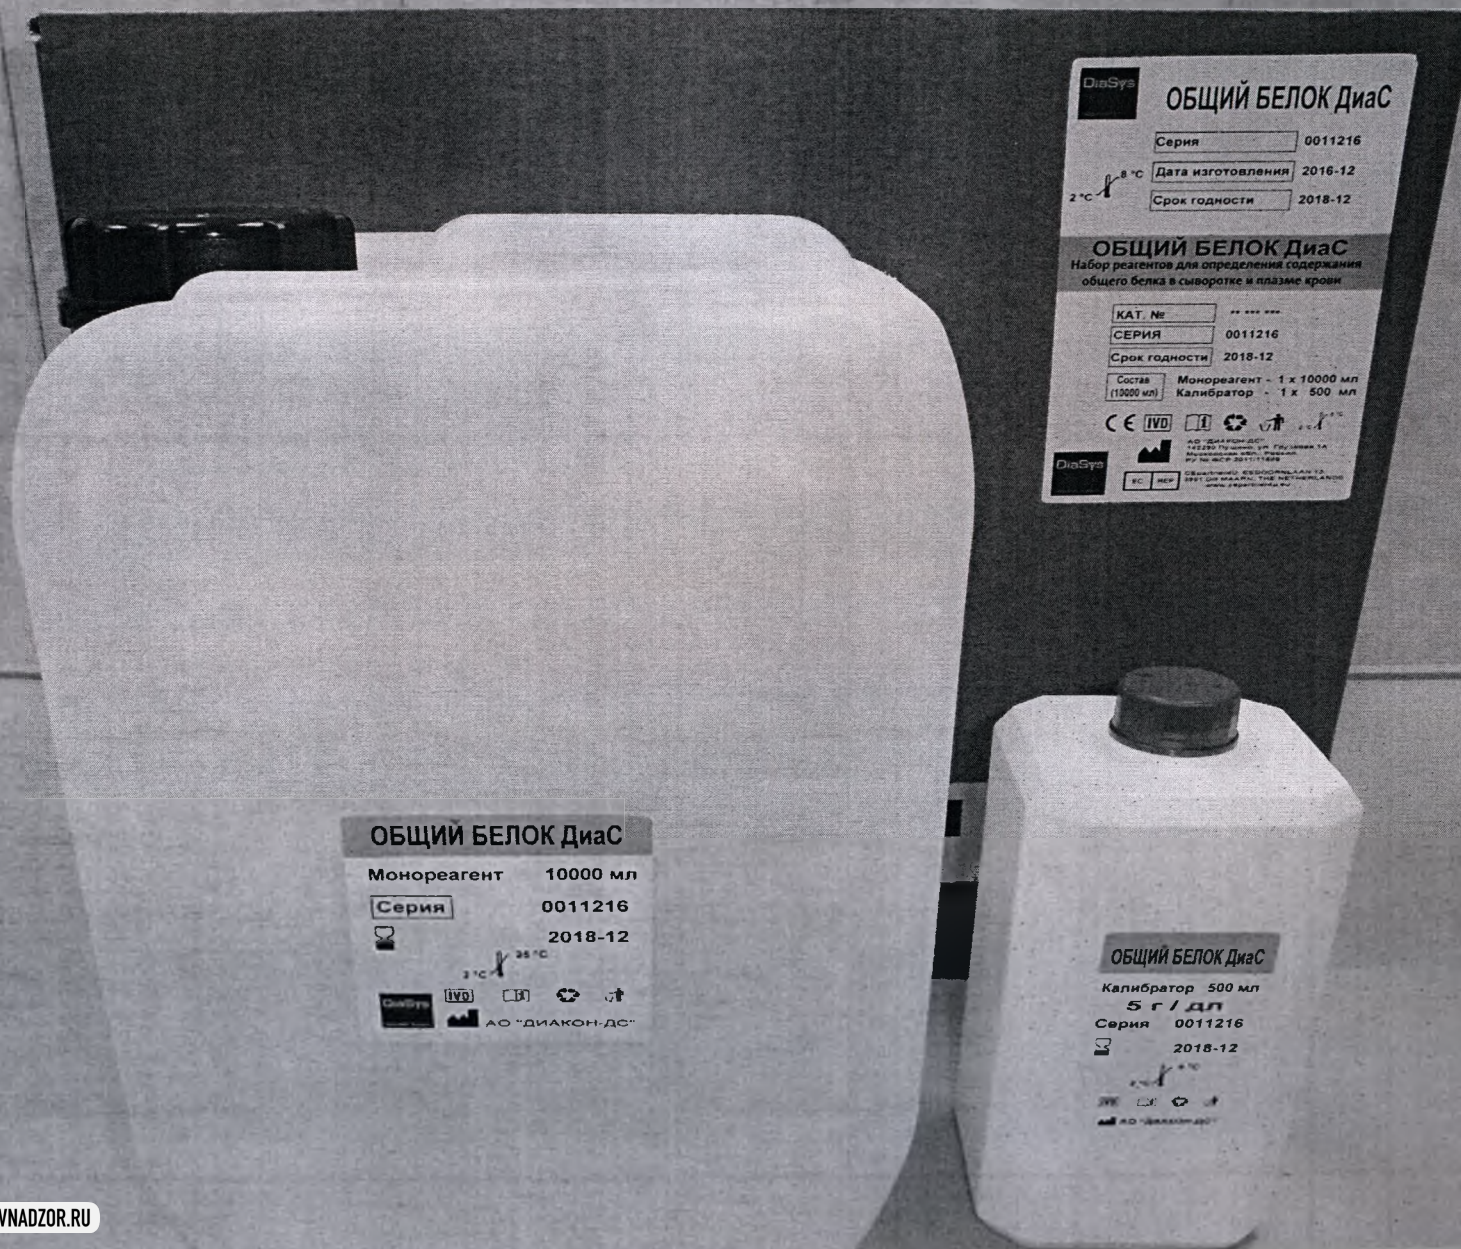



Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 52 листа  
Генеральный директор  
АО «ДИАКОН-ДС»

Смирнов А.В.