

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ


ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

I. Аппарат наркозный IntelliSave AX700 в составе:


1. Блок аппарата основной:




1.1. Ротаметр встроенный;

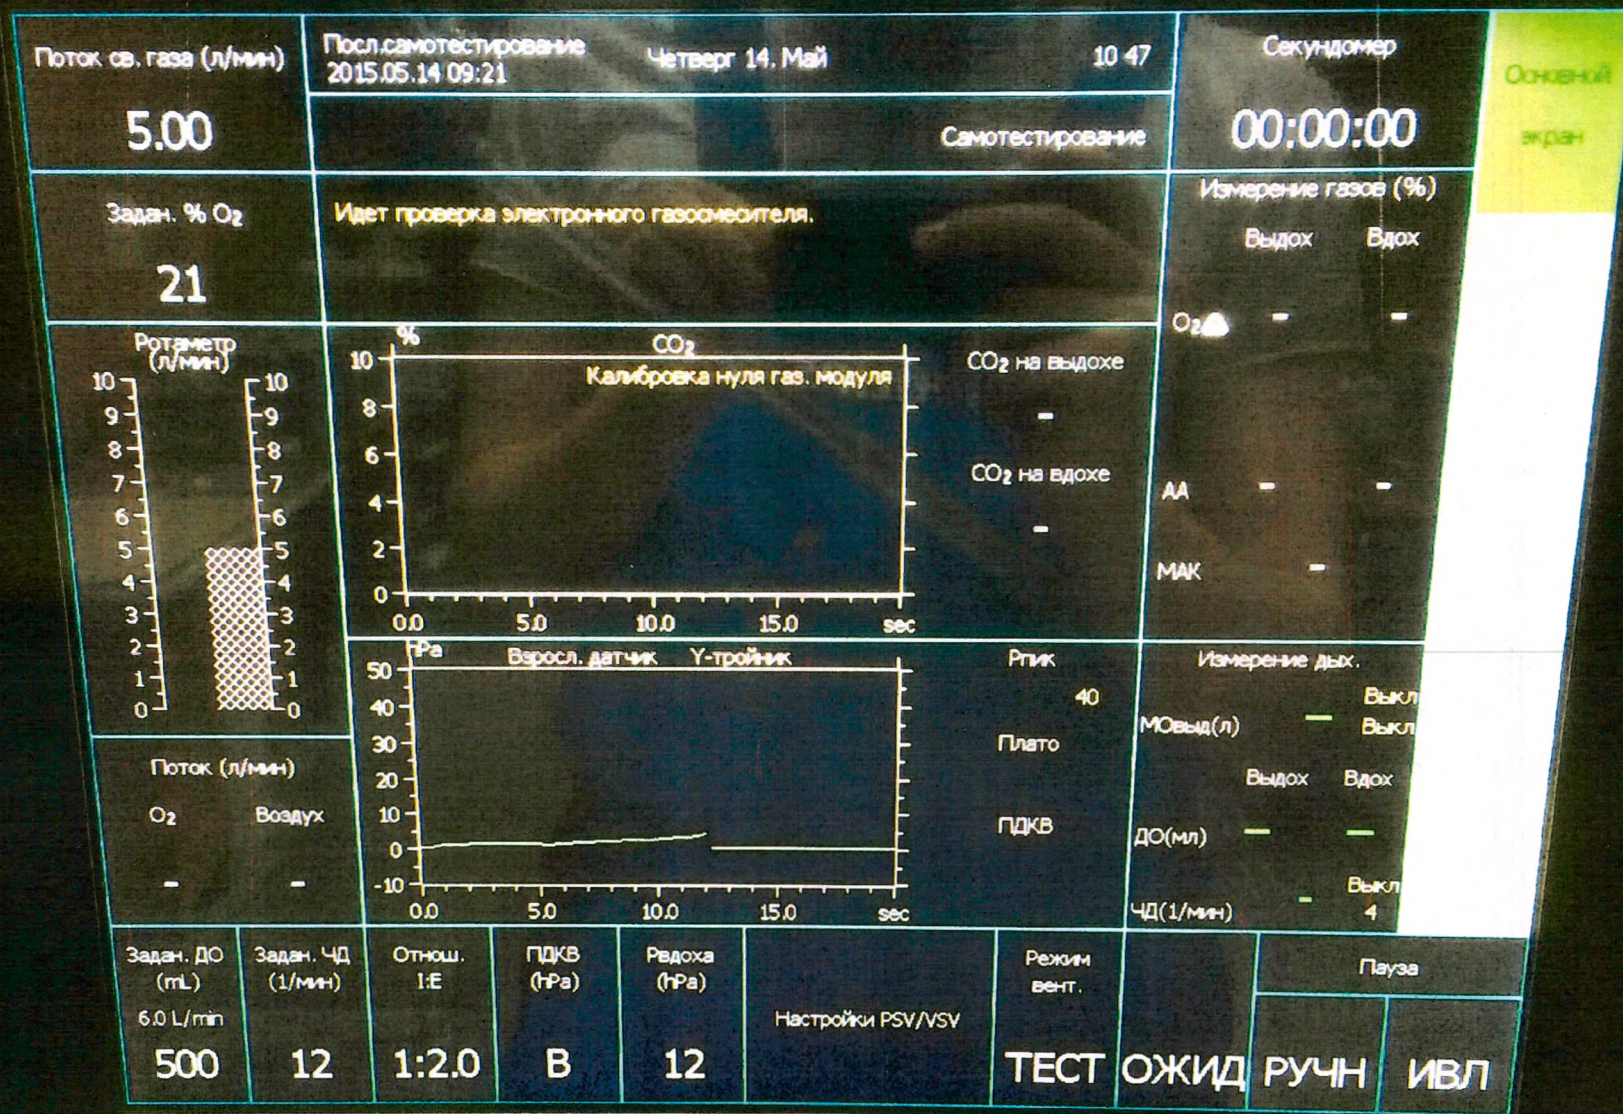


1.2. Блок ИВЛ встроенный;

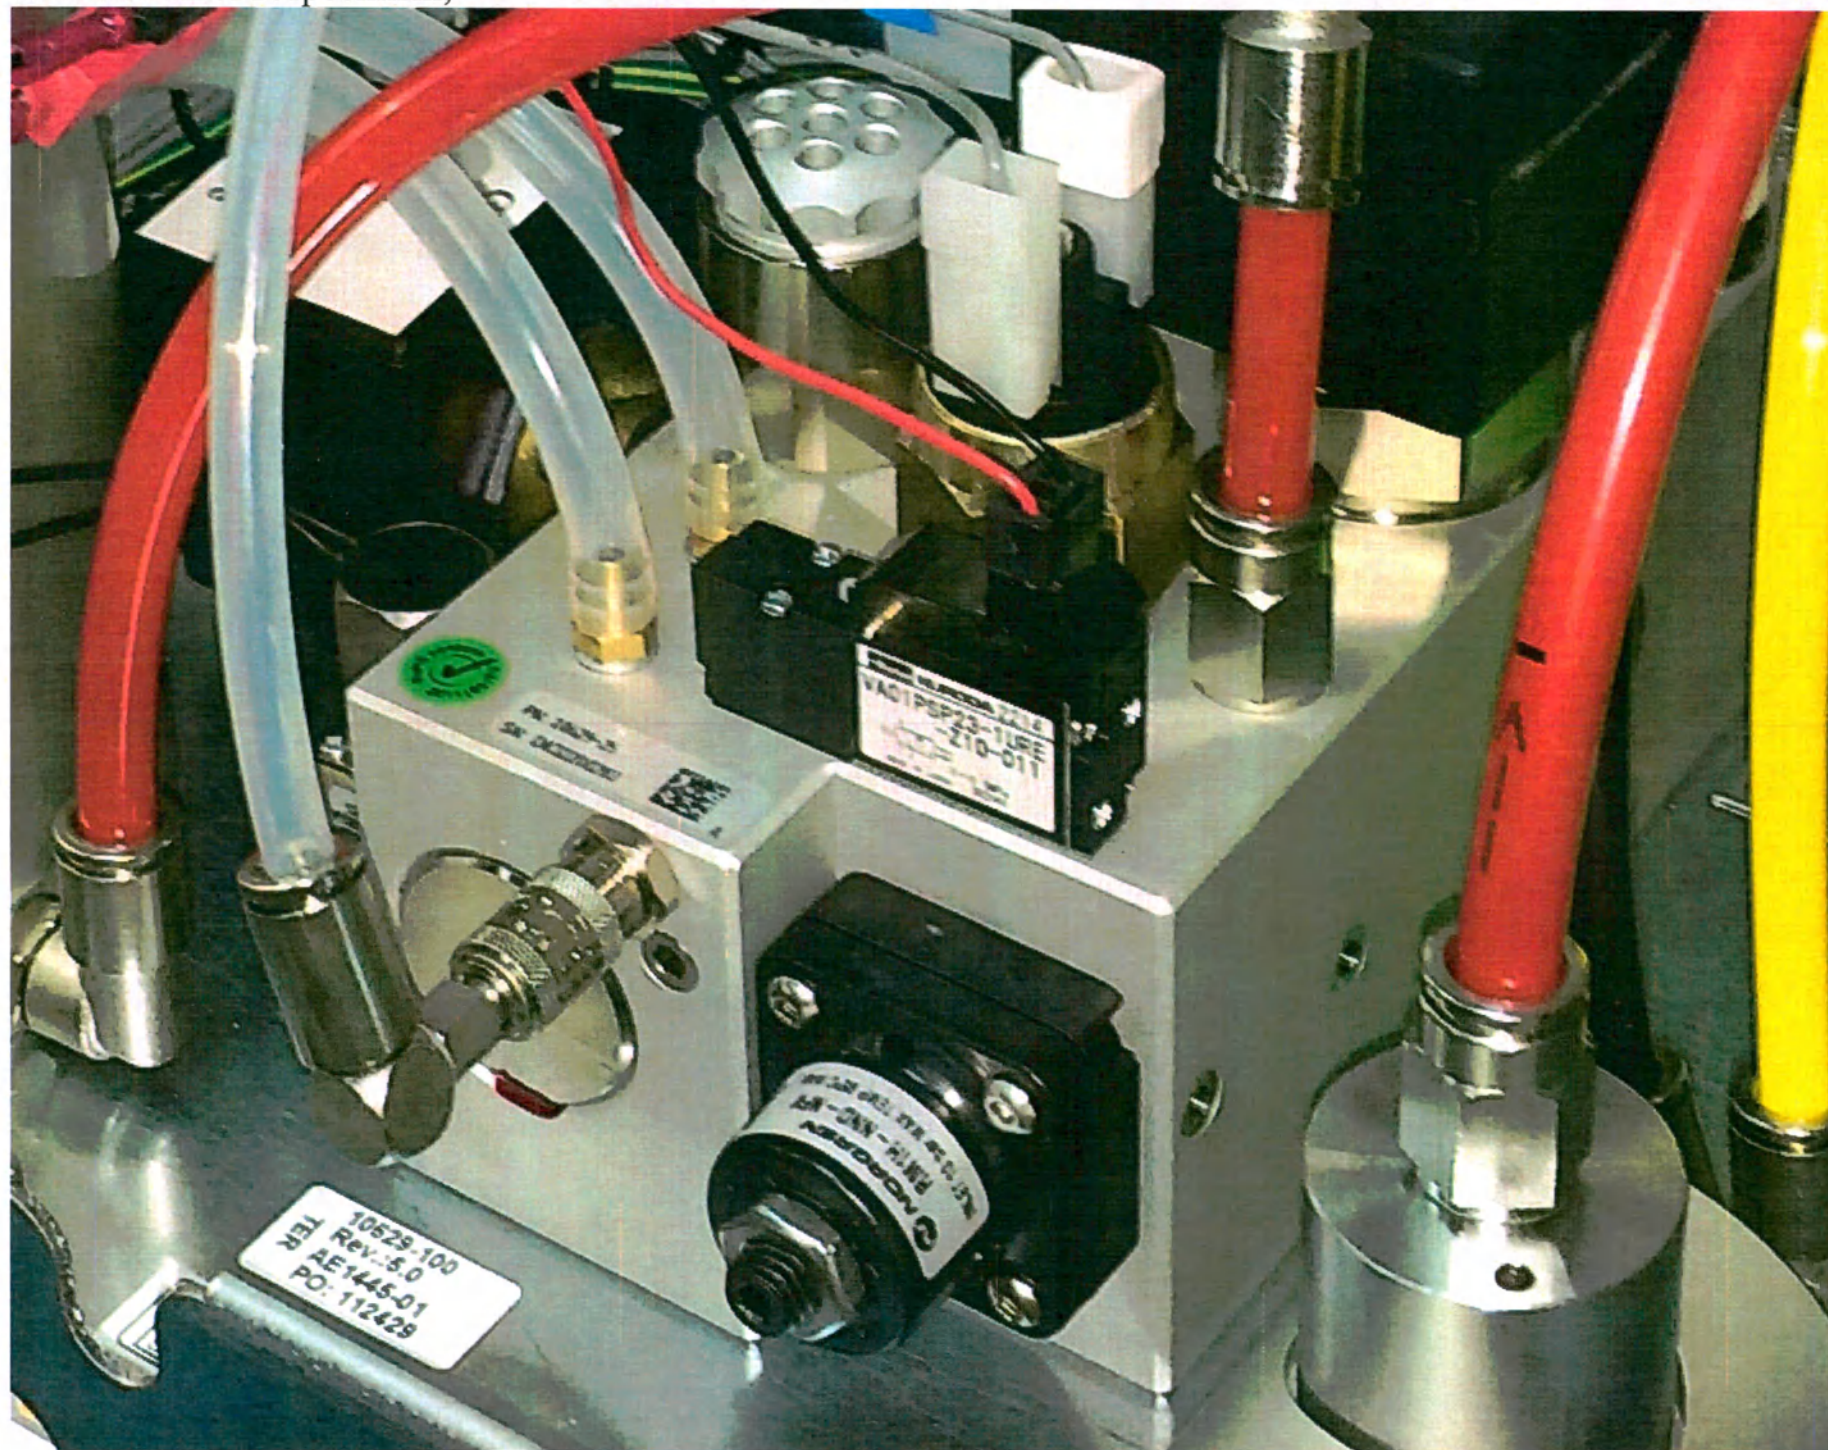


1.3. Панель для испарителей (не более 2 шт.);

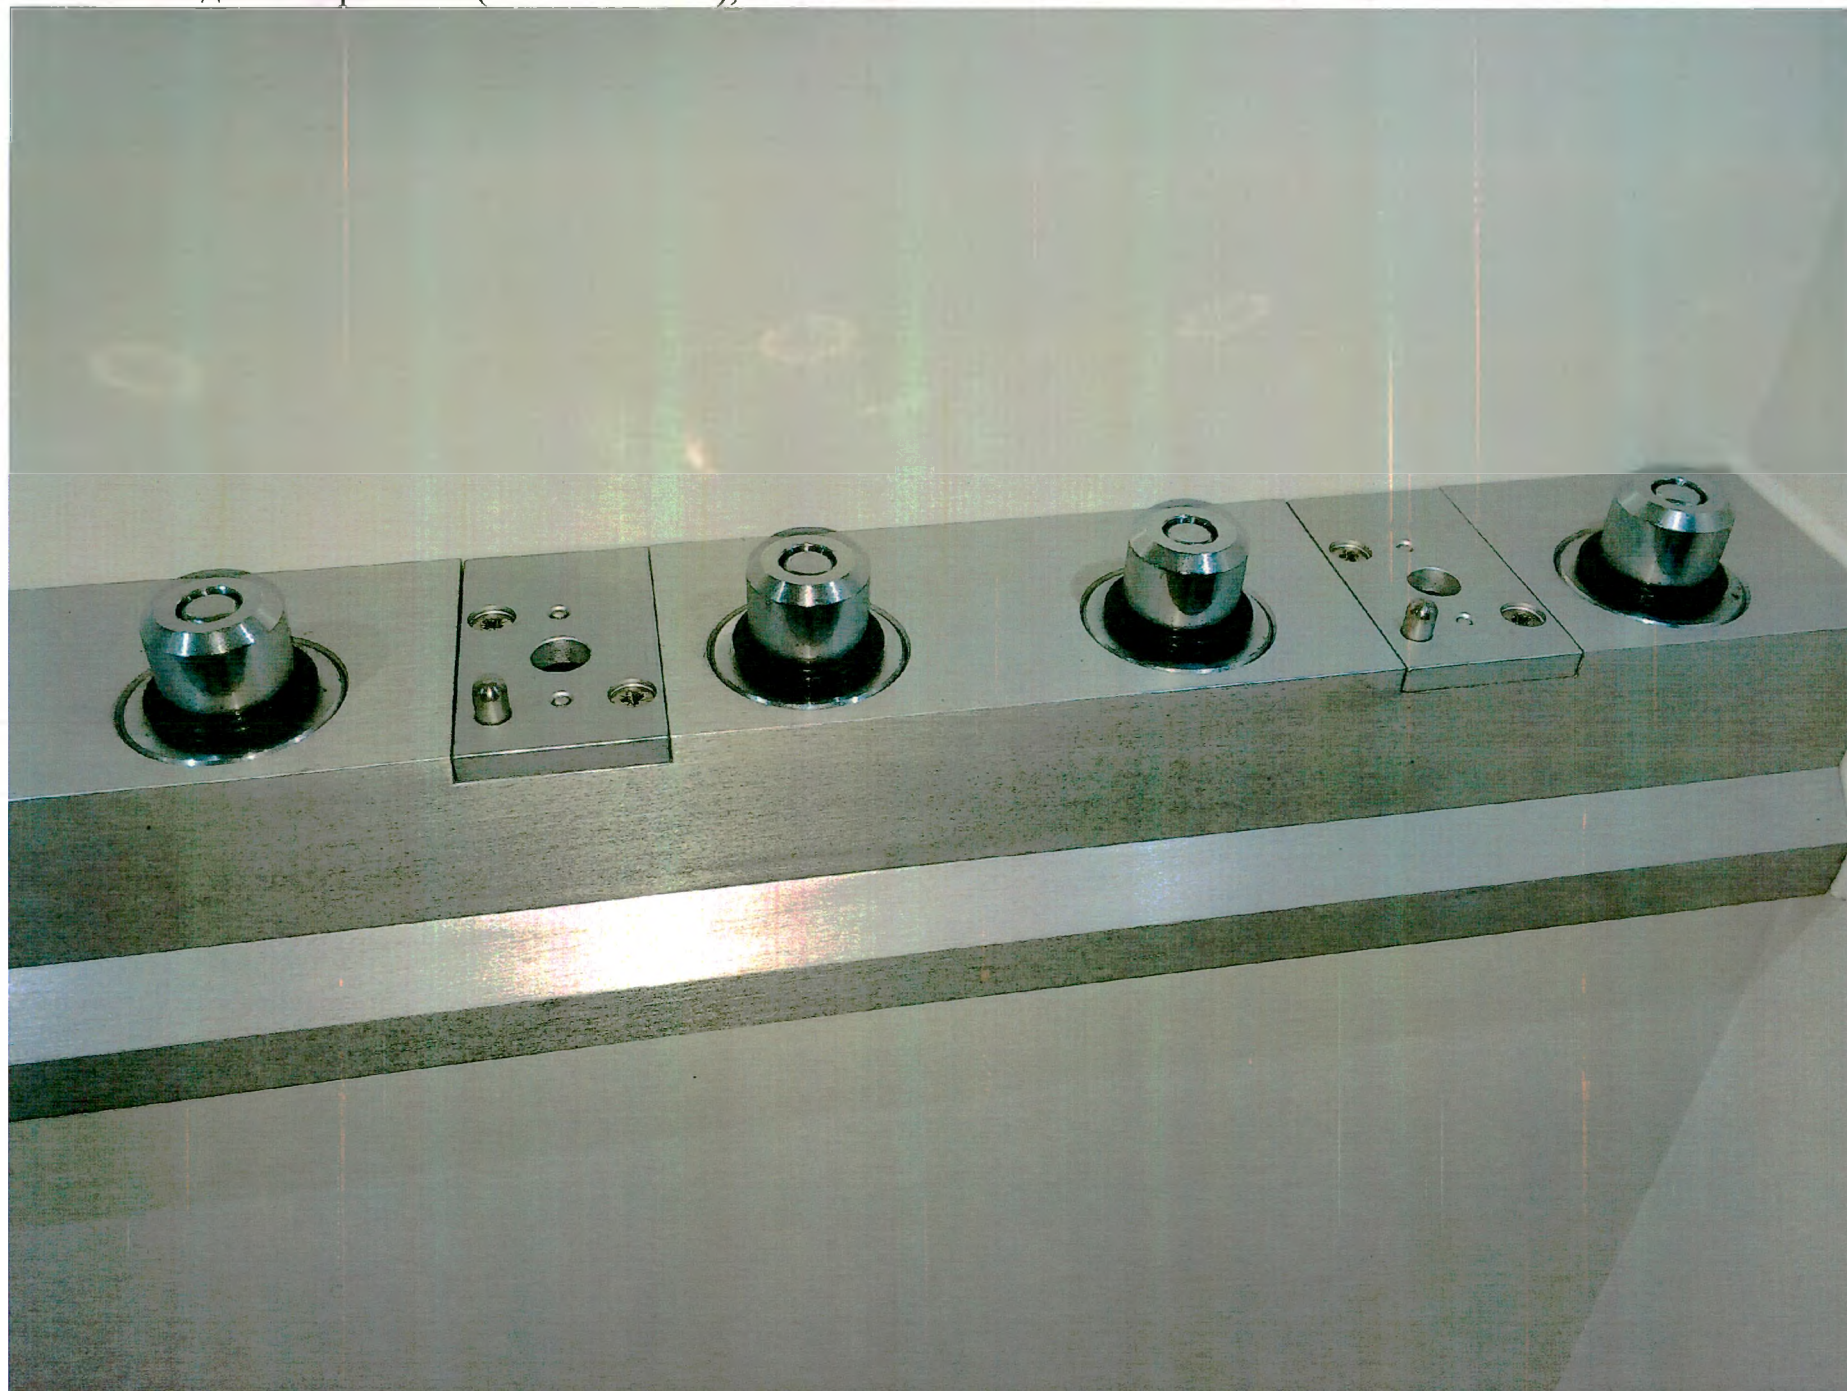

1.4. Аспираторы AGSS встроенные (не более 2 шт.);

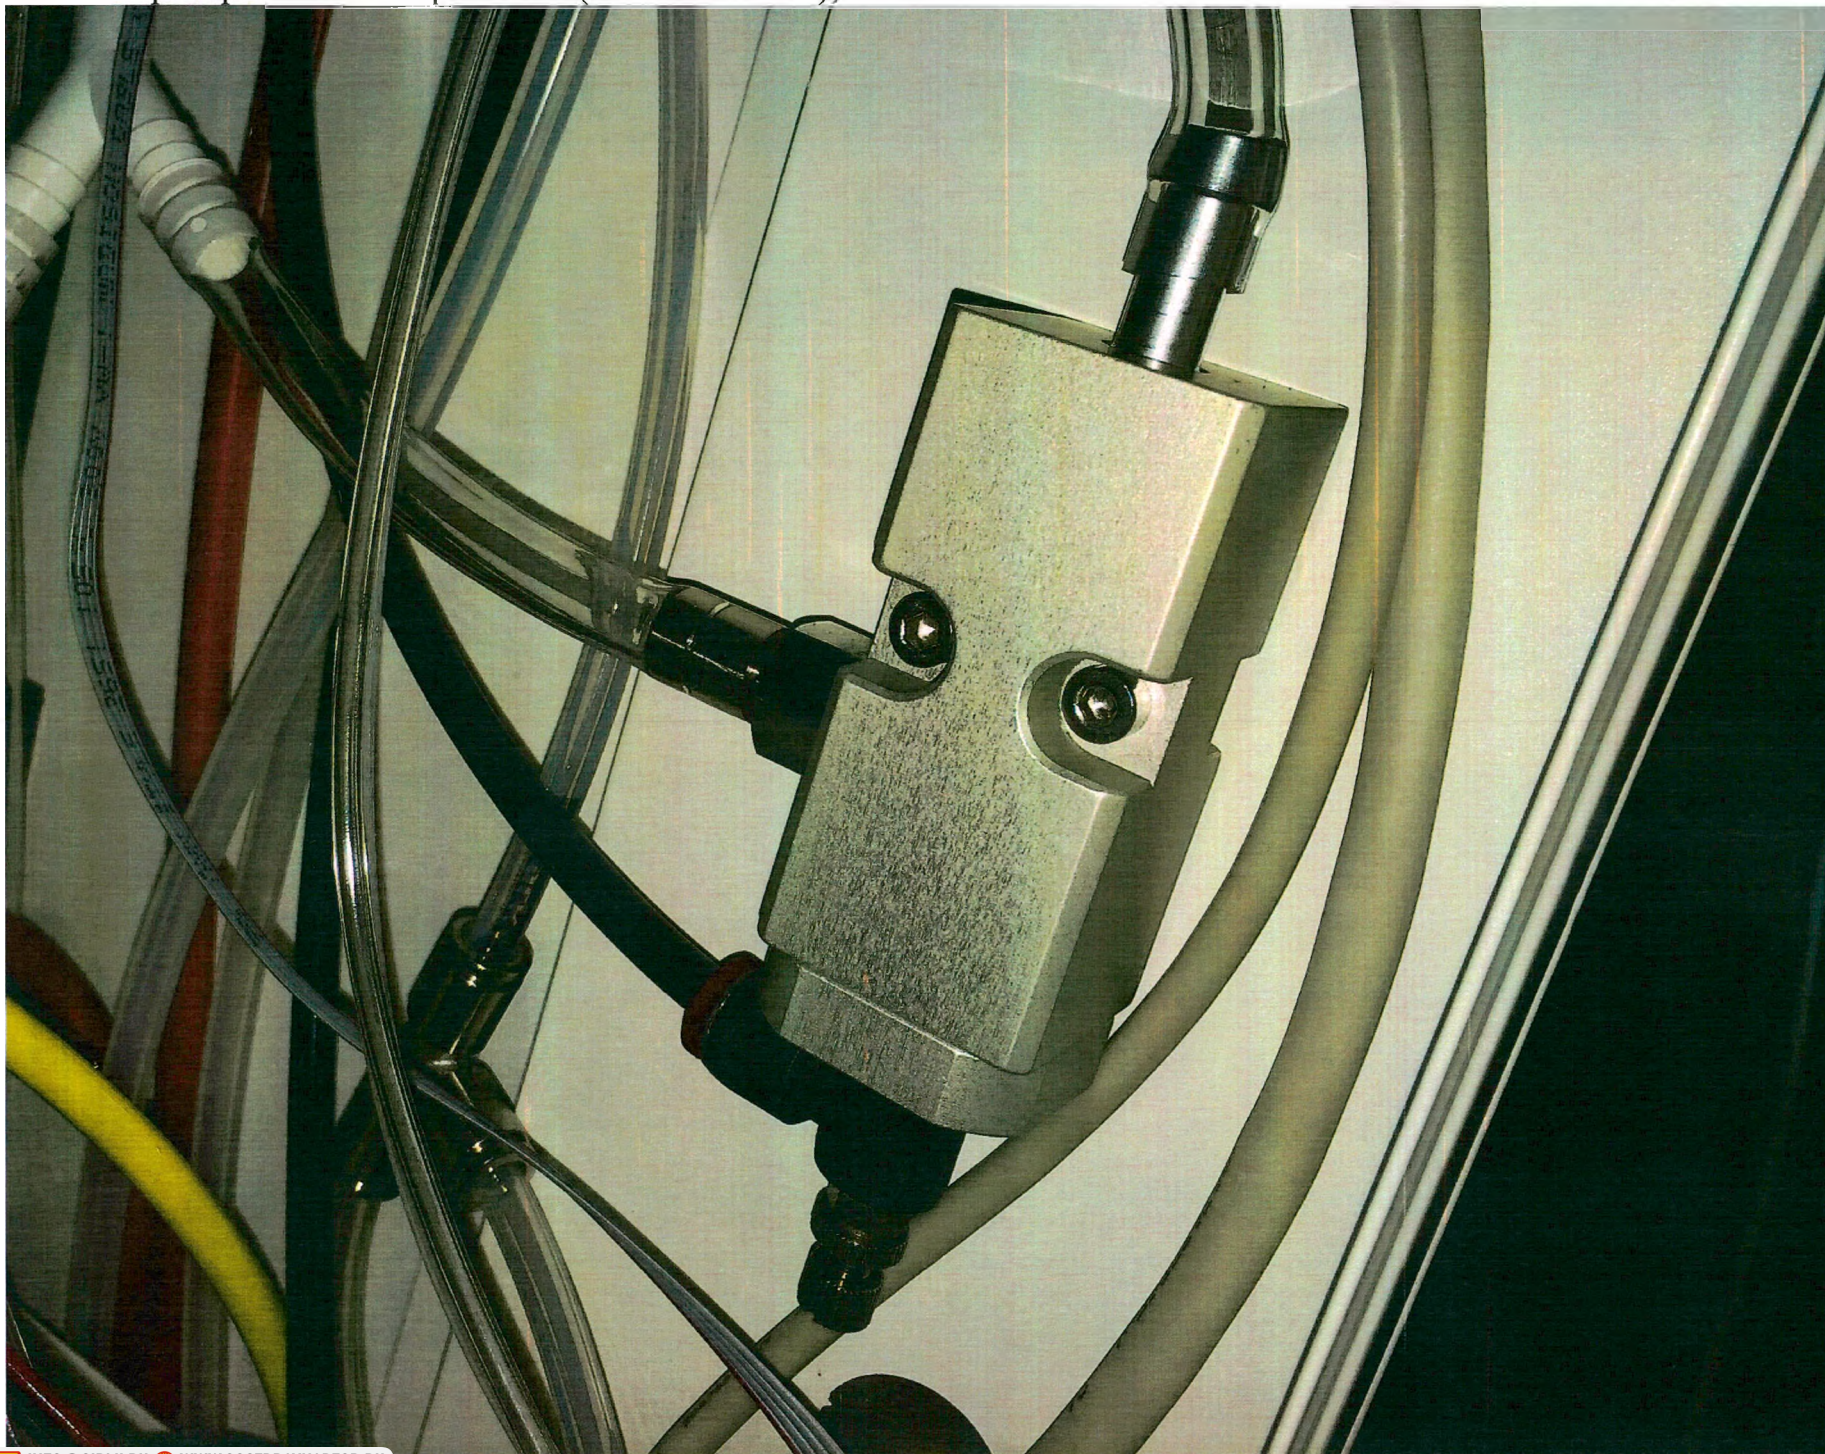


1.5. Разъемы газовые для подключения шлангов;

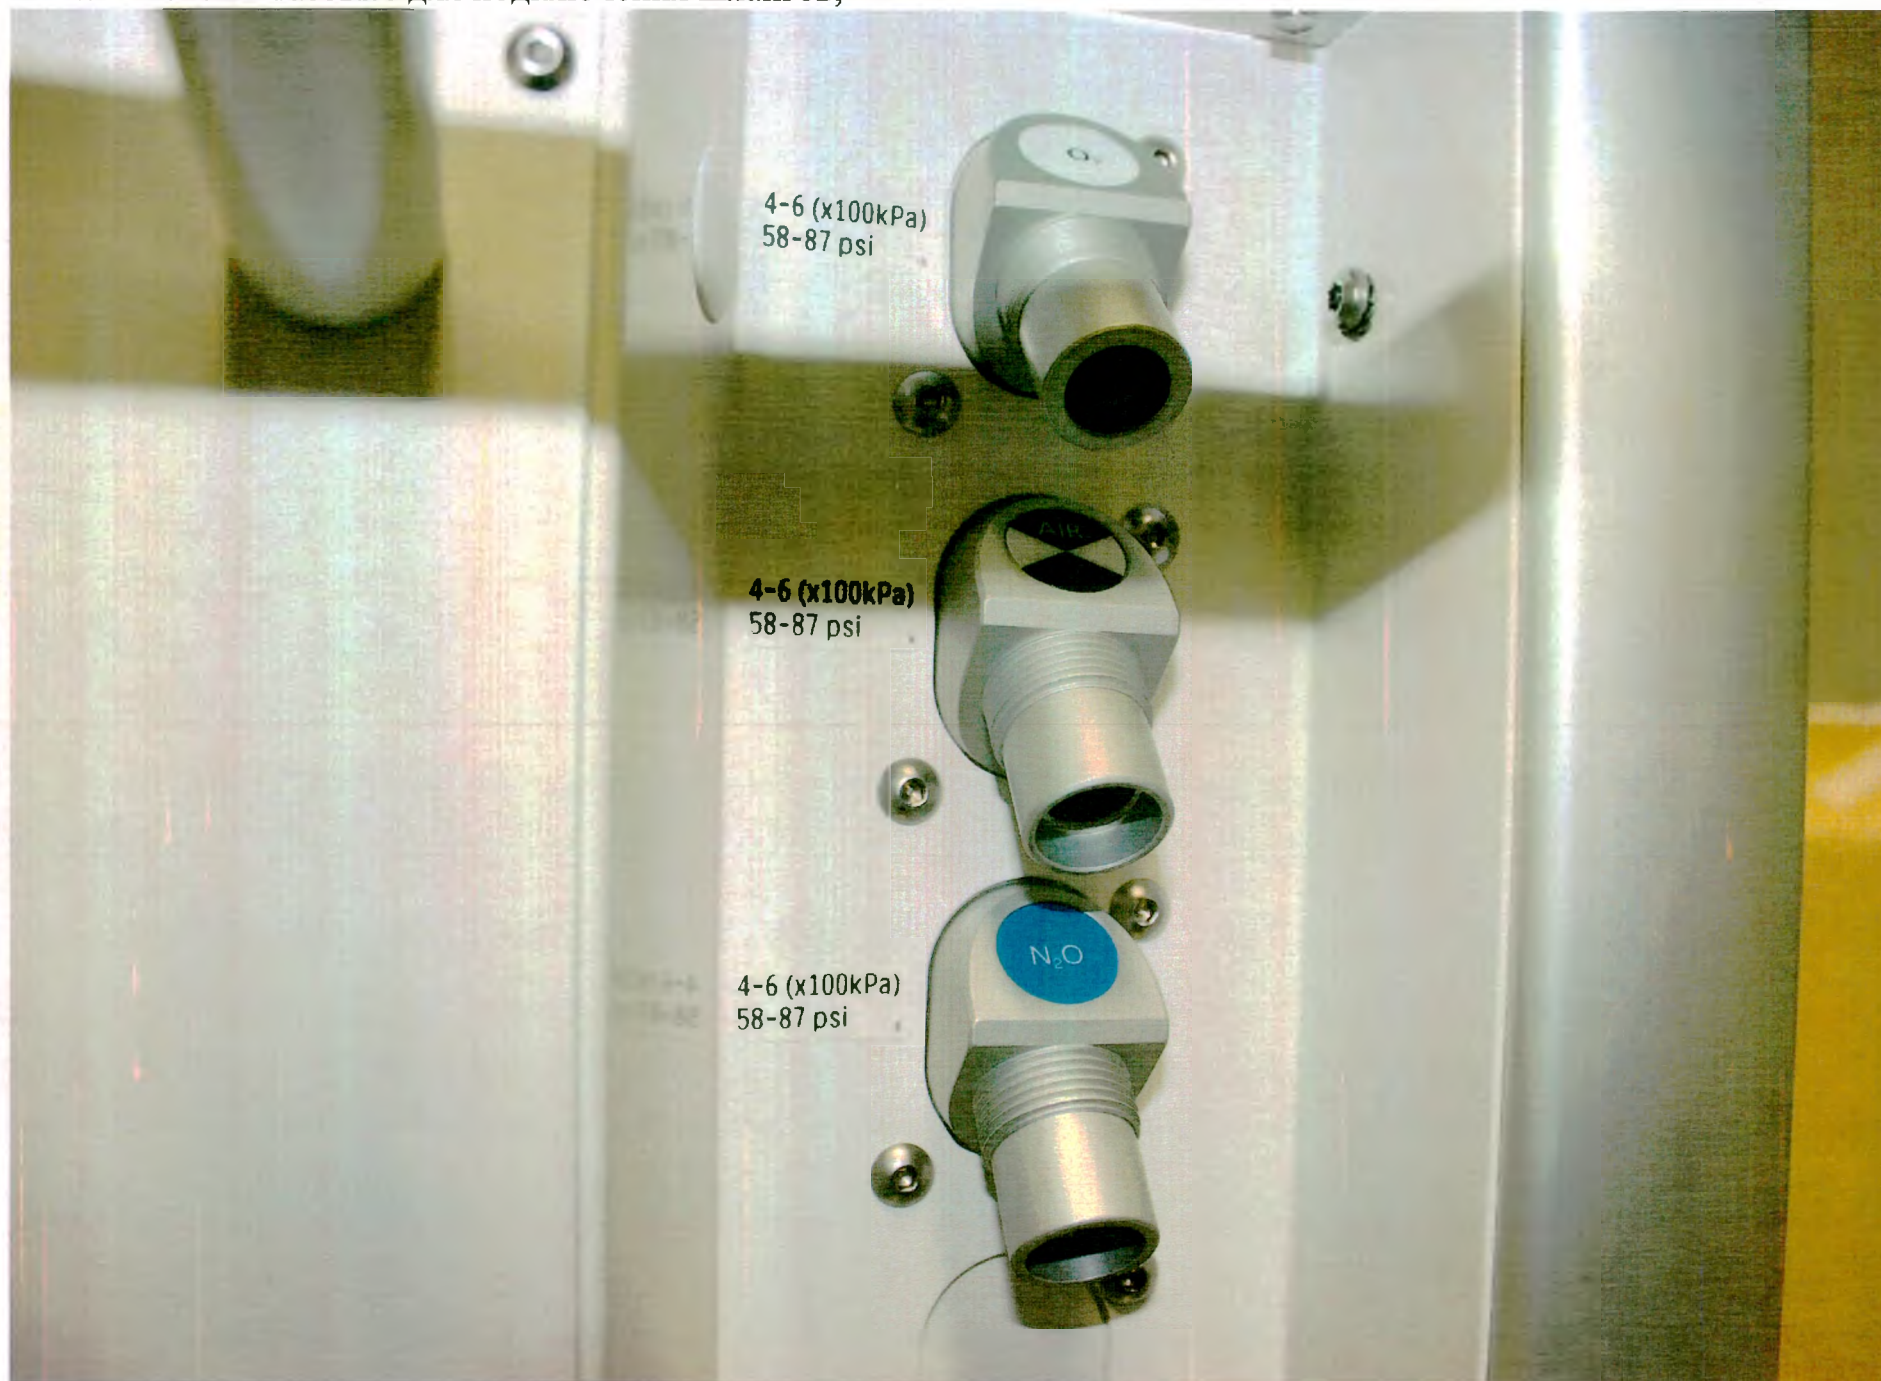


1.6. Аспиратор пациента встроенный;



1.7. Разъем для подключения газовых баллонов (не более 3 шт);

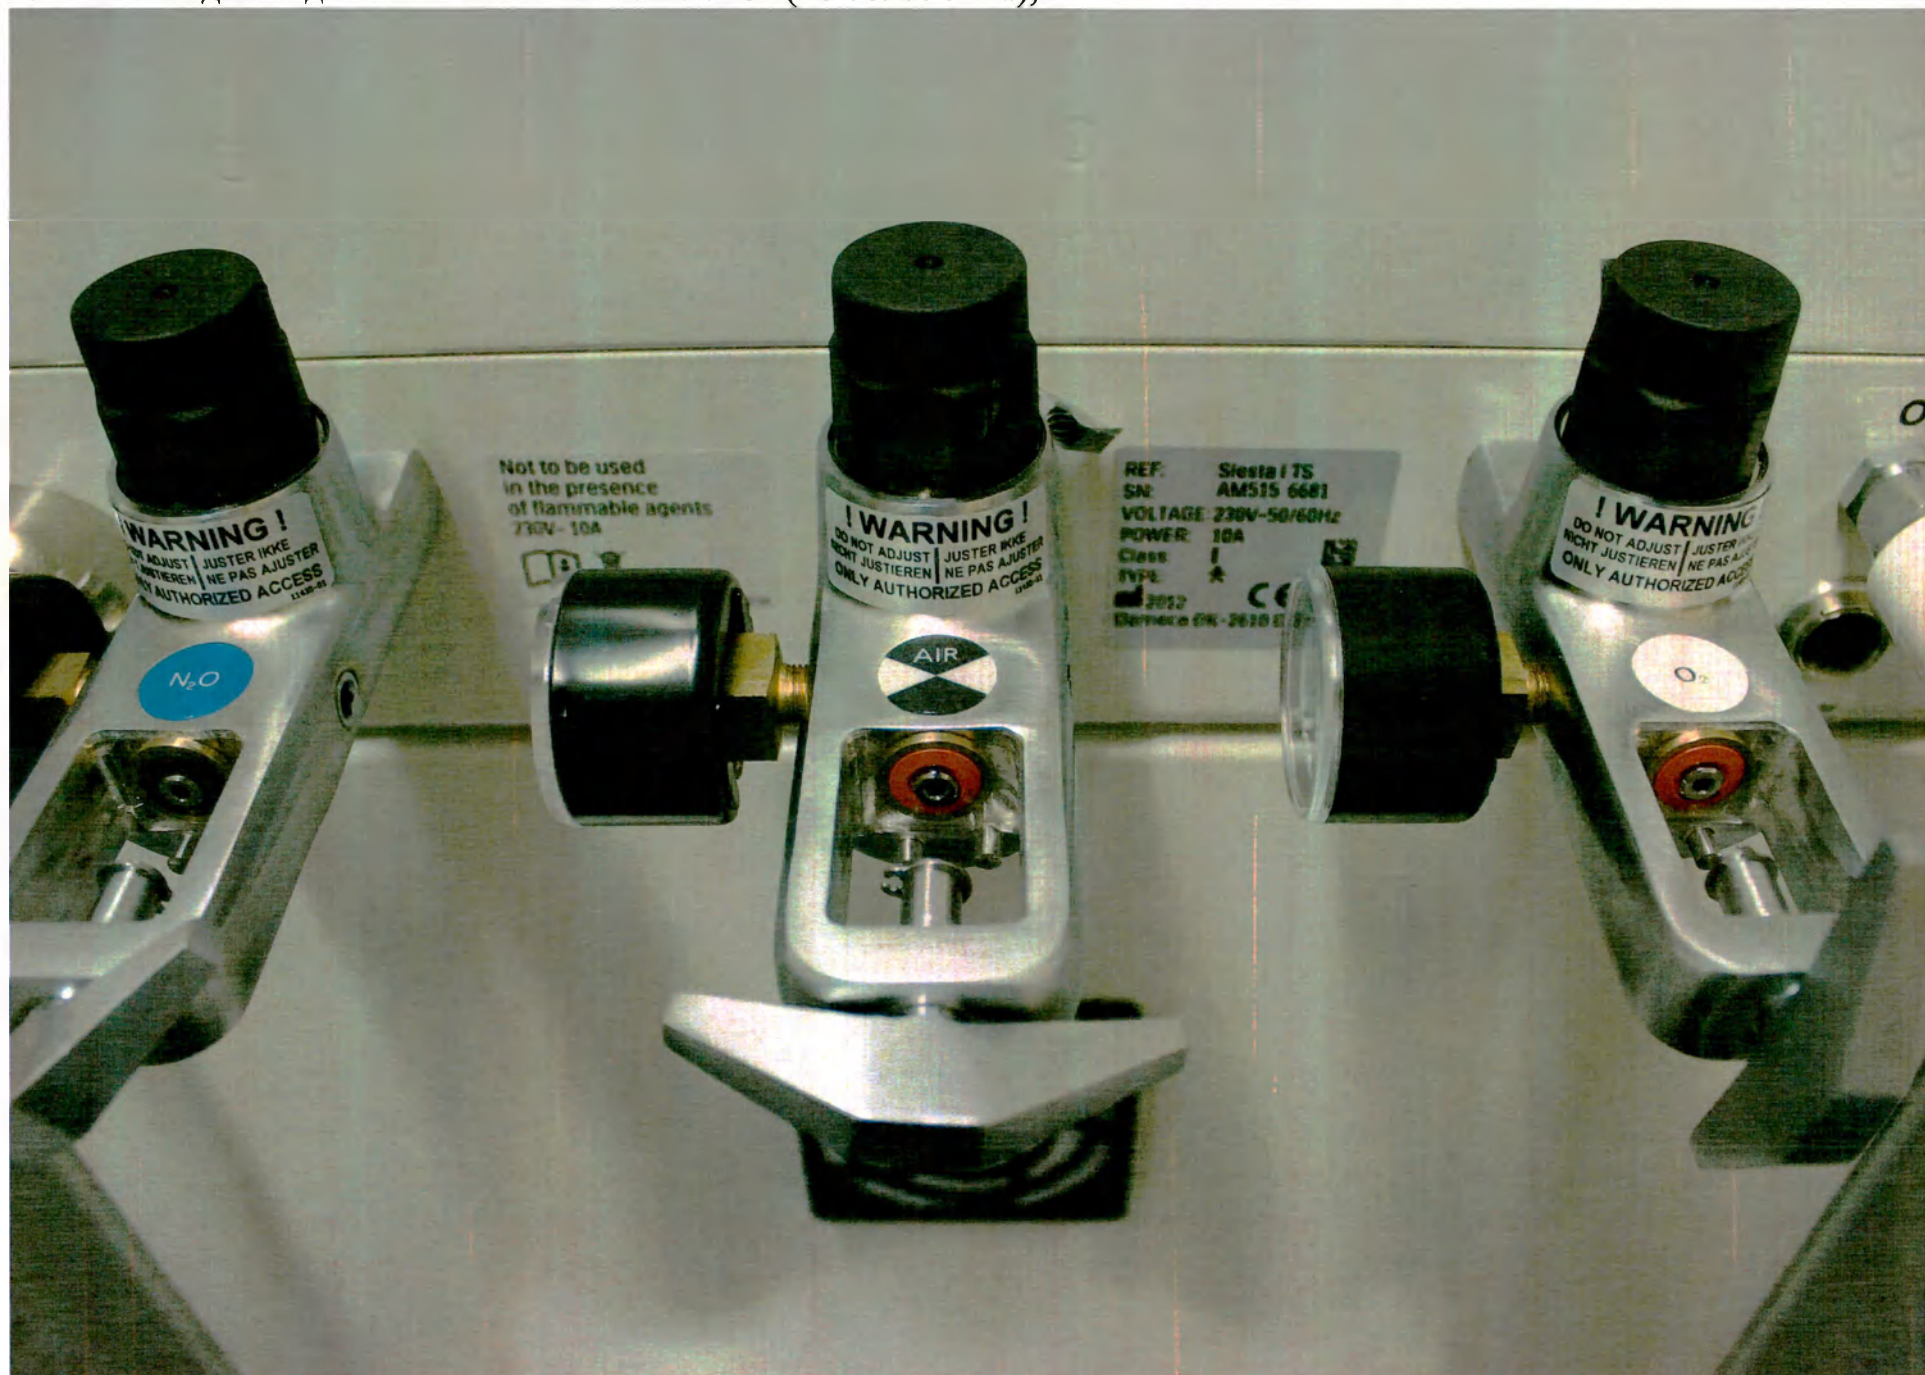


1.8. Модуль мультигазовый встроенный;

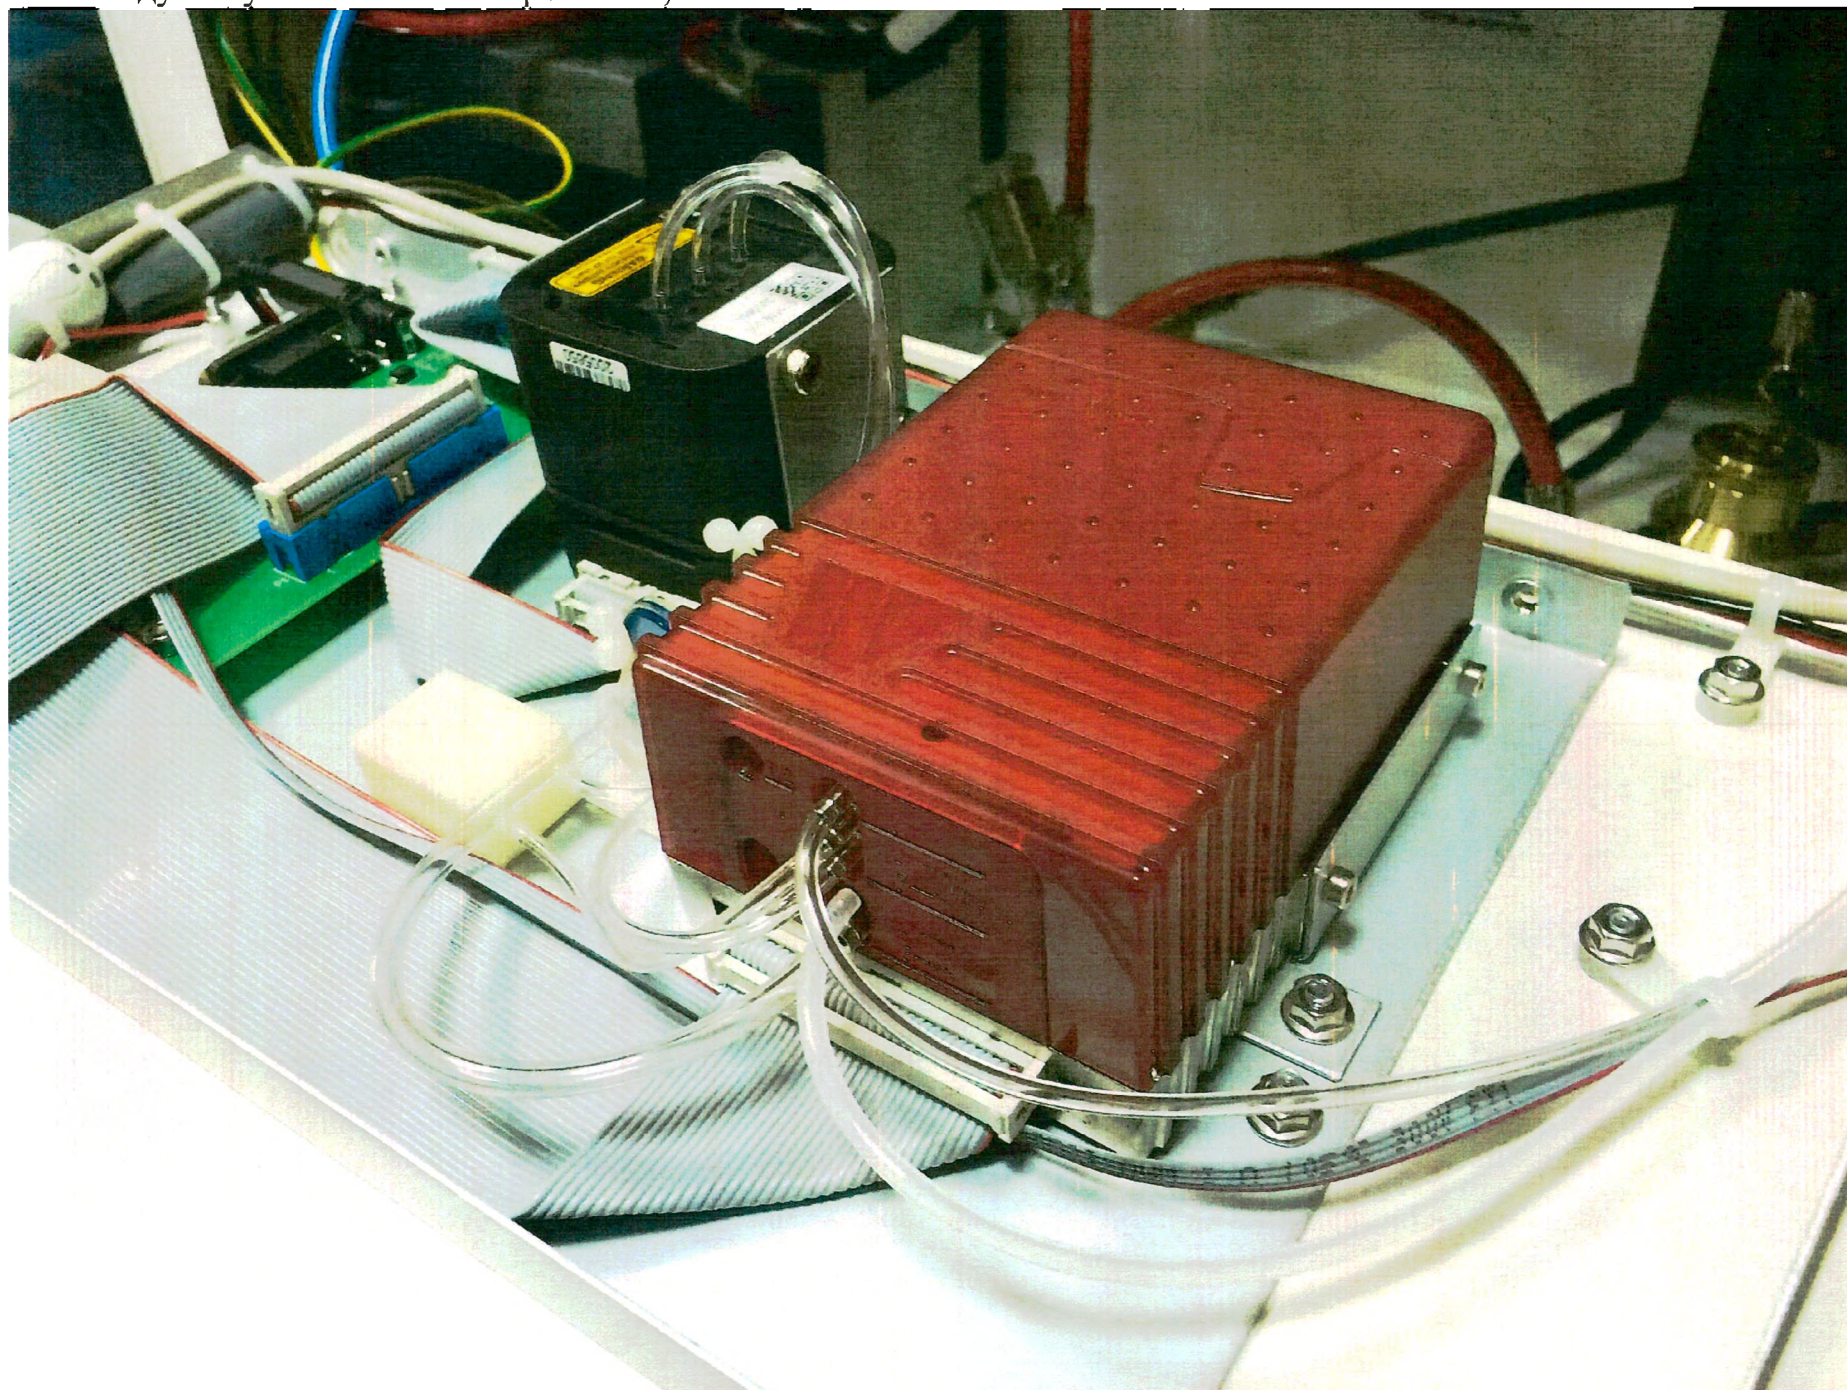


1.9. Гнезда электропитания встроенные (не более 4 шт);



1.10. Регистратор SmartLog;

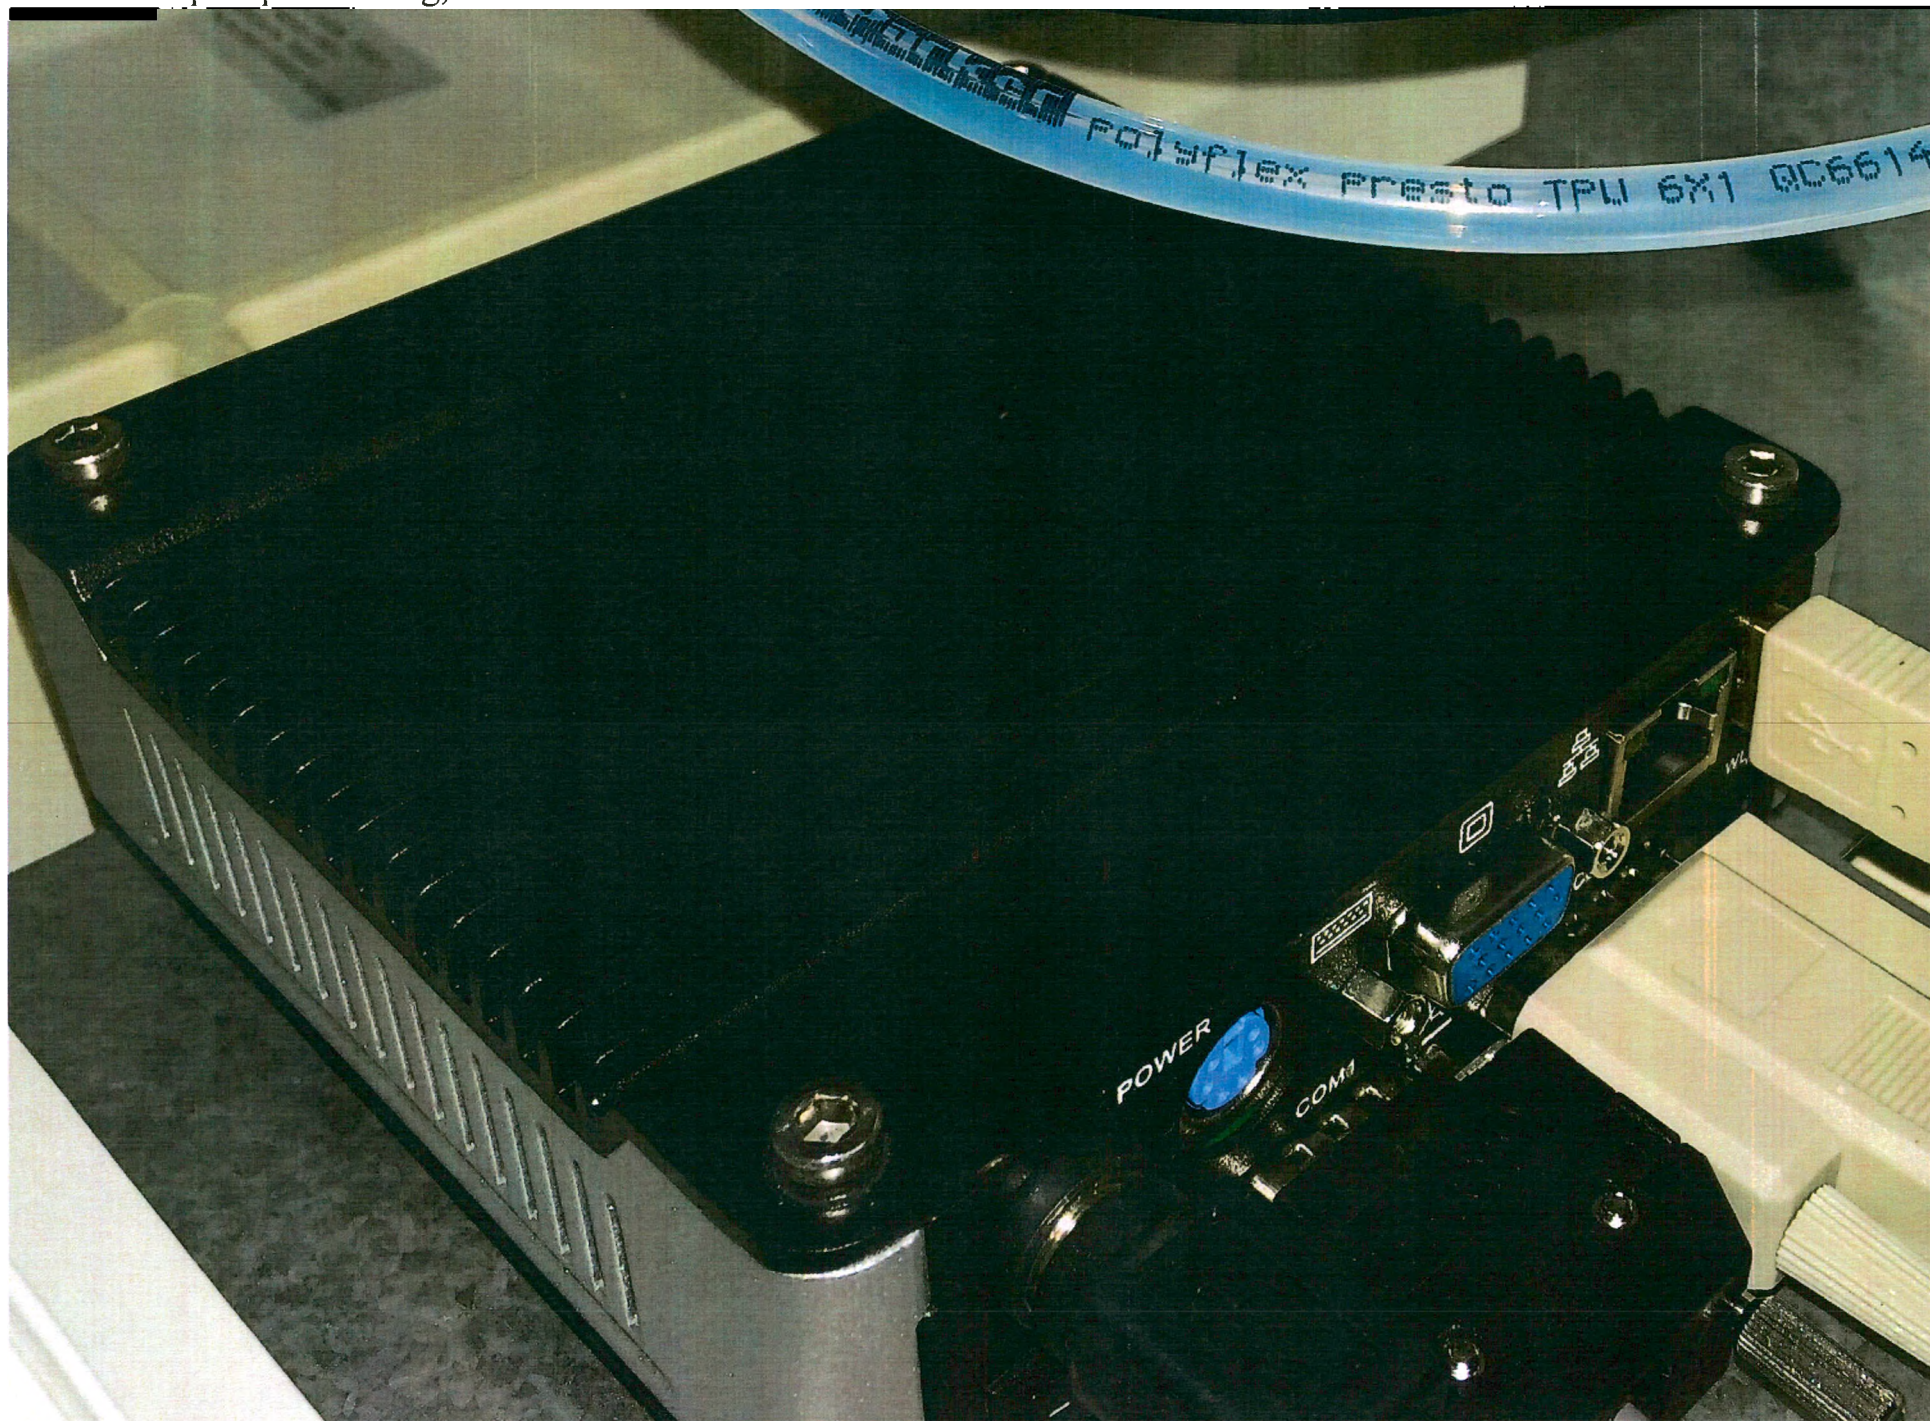

1.11. Газосмеситель электронный.

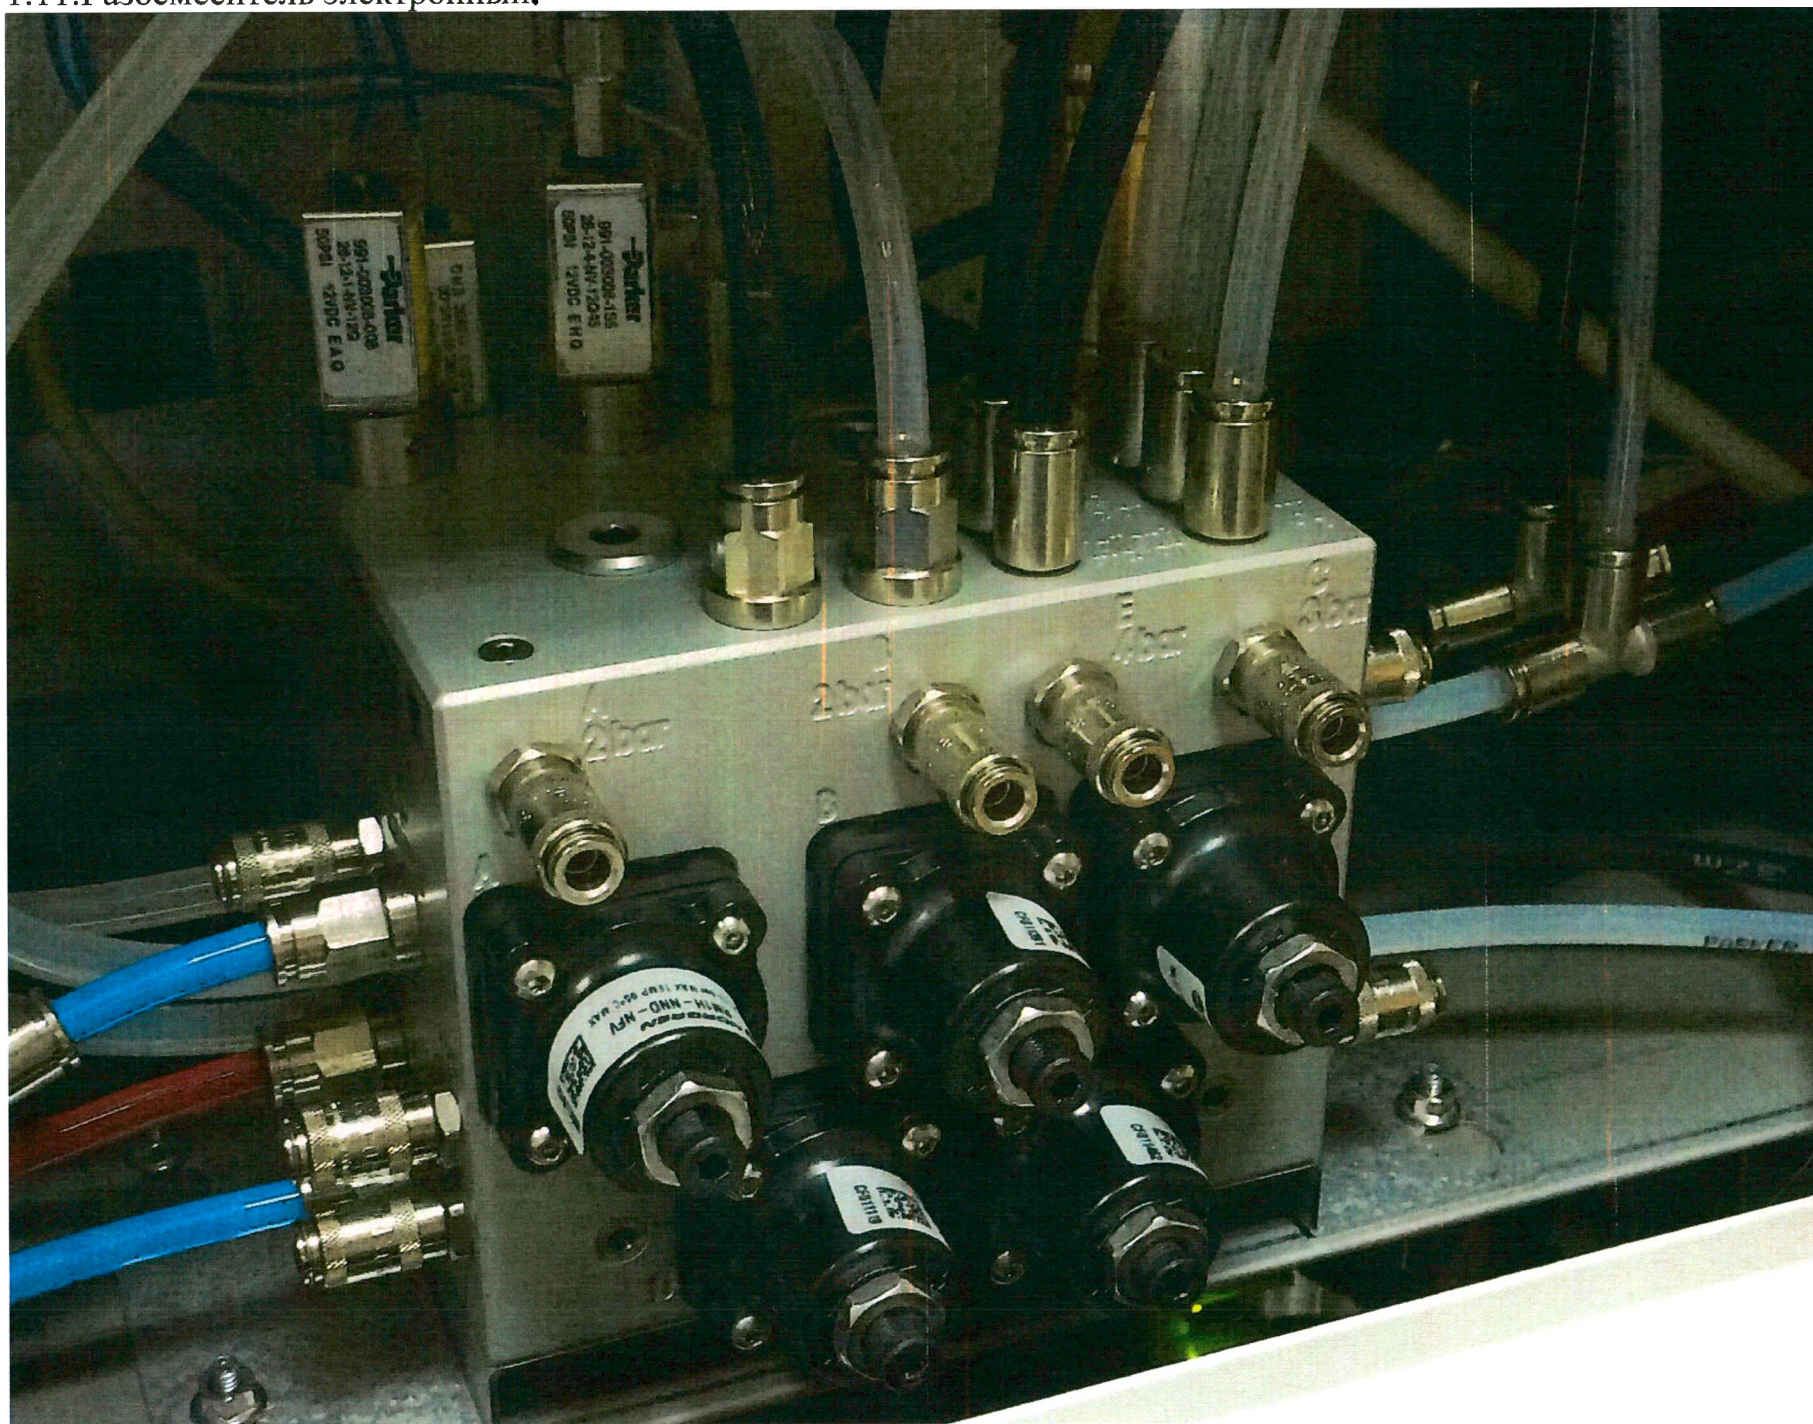

1.12. Основание мобильное.




1.12. Основание подвесное.



IntelliSave AX700

Dorte Thulstrup
Regulatory Affairs Manager
Dorte Thulstrup
12-05-2015

Philips Anesthesia Care A/S
Islevej 211
DK-2810 Roskilde
Denmark
Phone: +45 4450 8990

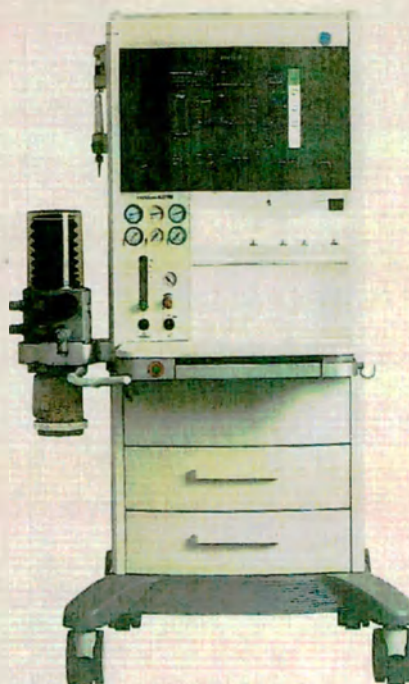

Руководство по эксплуатации

Наркозный аппарат IntelliSave AX700


Анестезия

Номер по каталогу 10623RU-90 53 122013


PHILIPS

II. Принадлежности:

1. Шланги для подключения аппарата к газовой сети (не более 10 шт.).

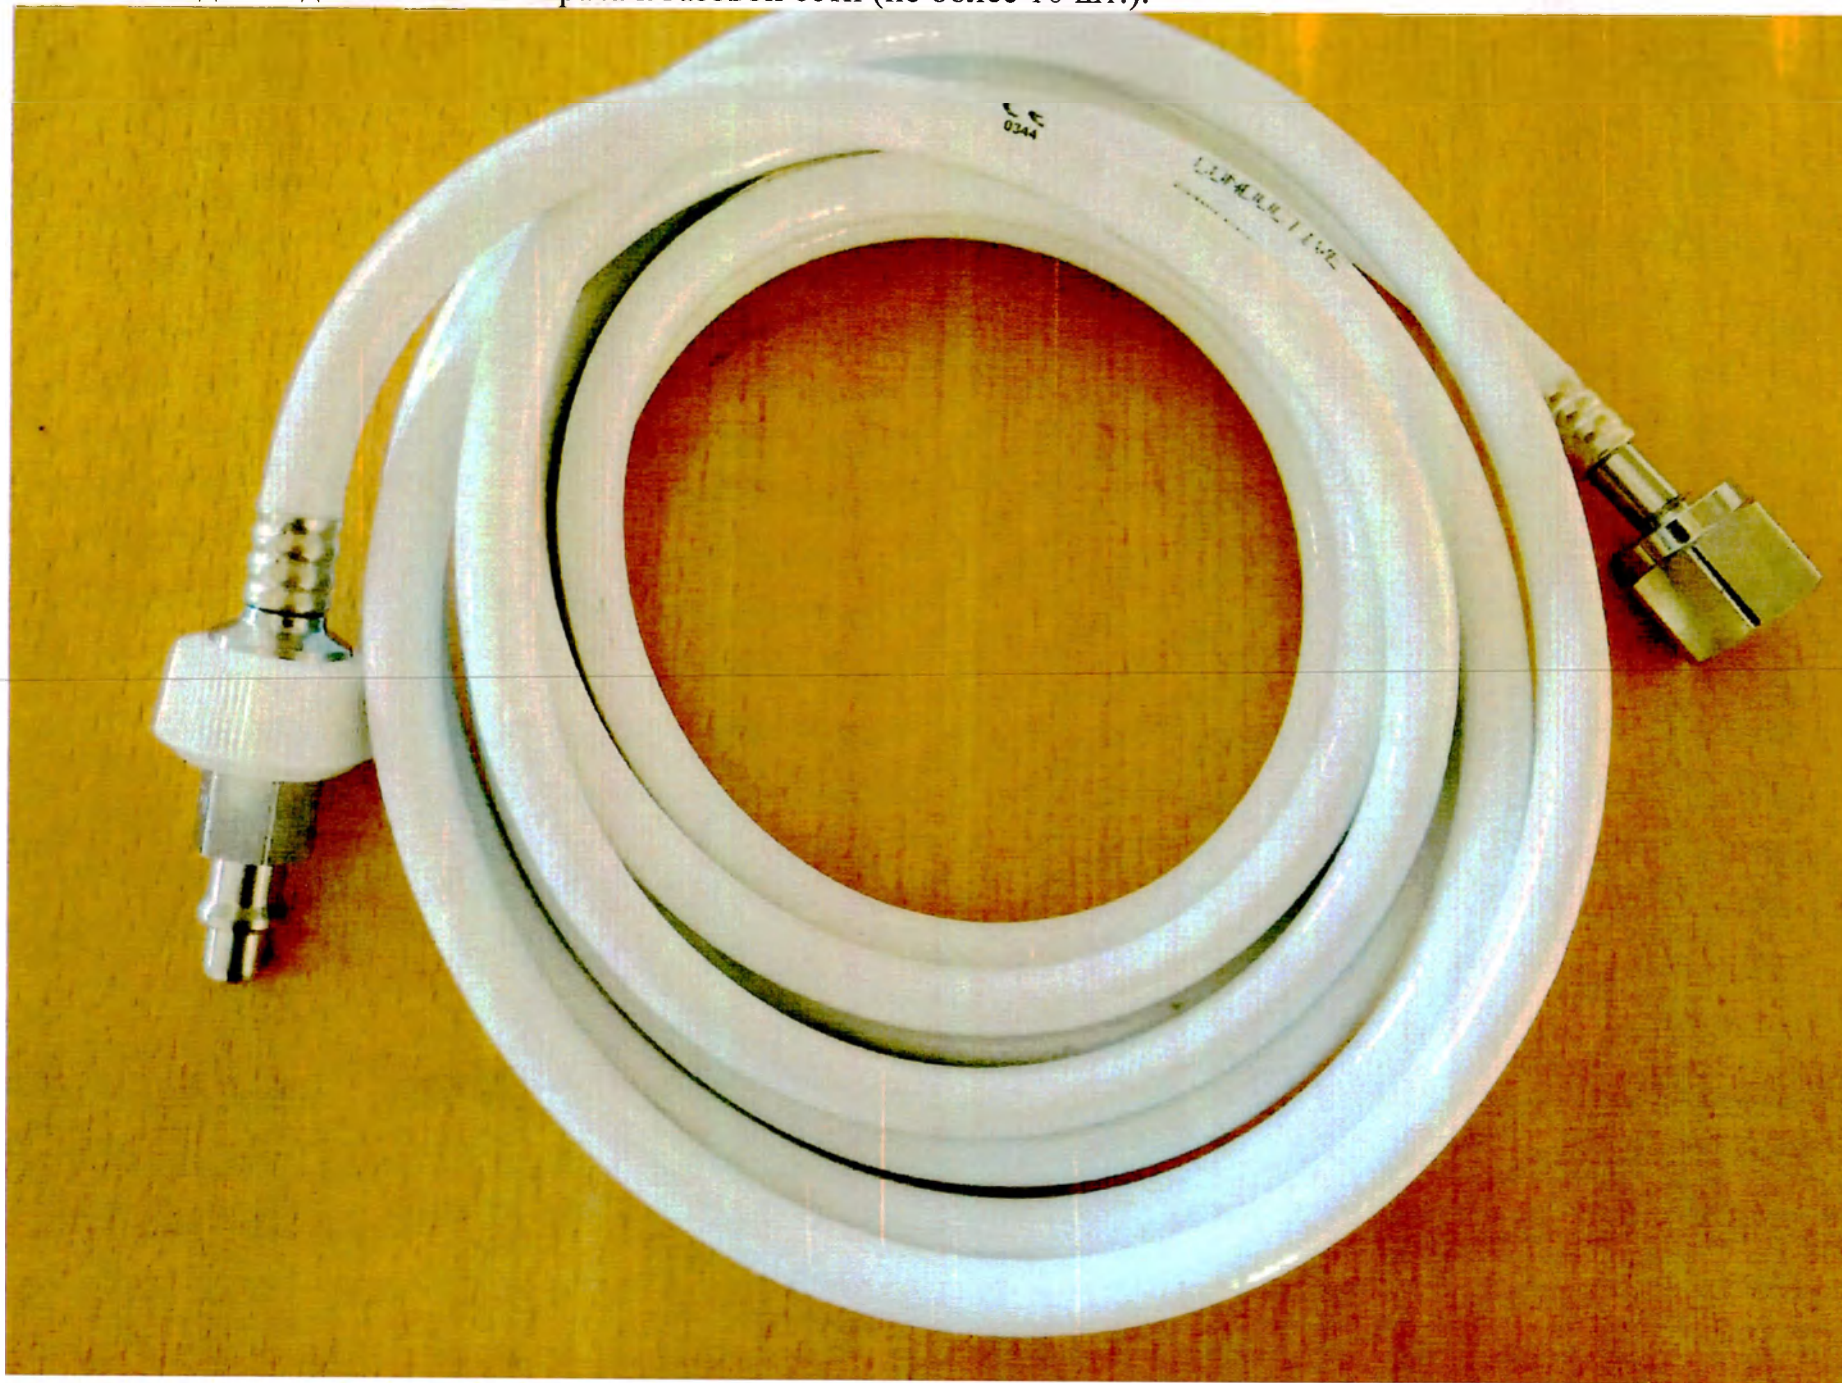

1. Шланги для подключения аппарата к газовой сети (не более 10 шт.).

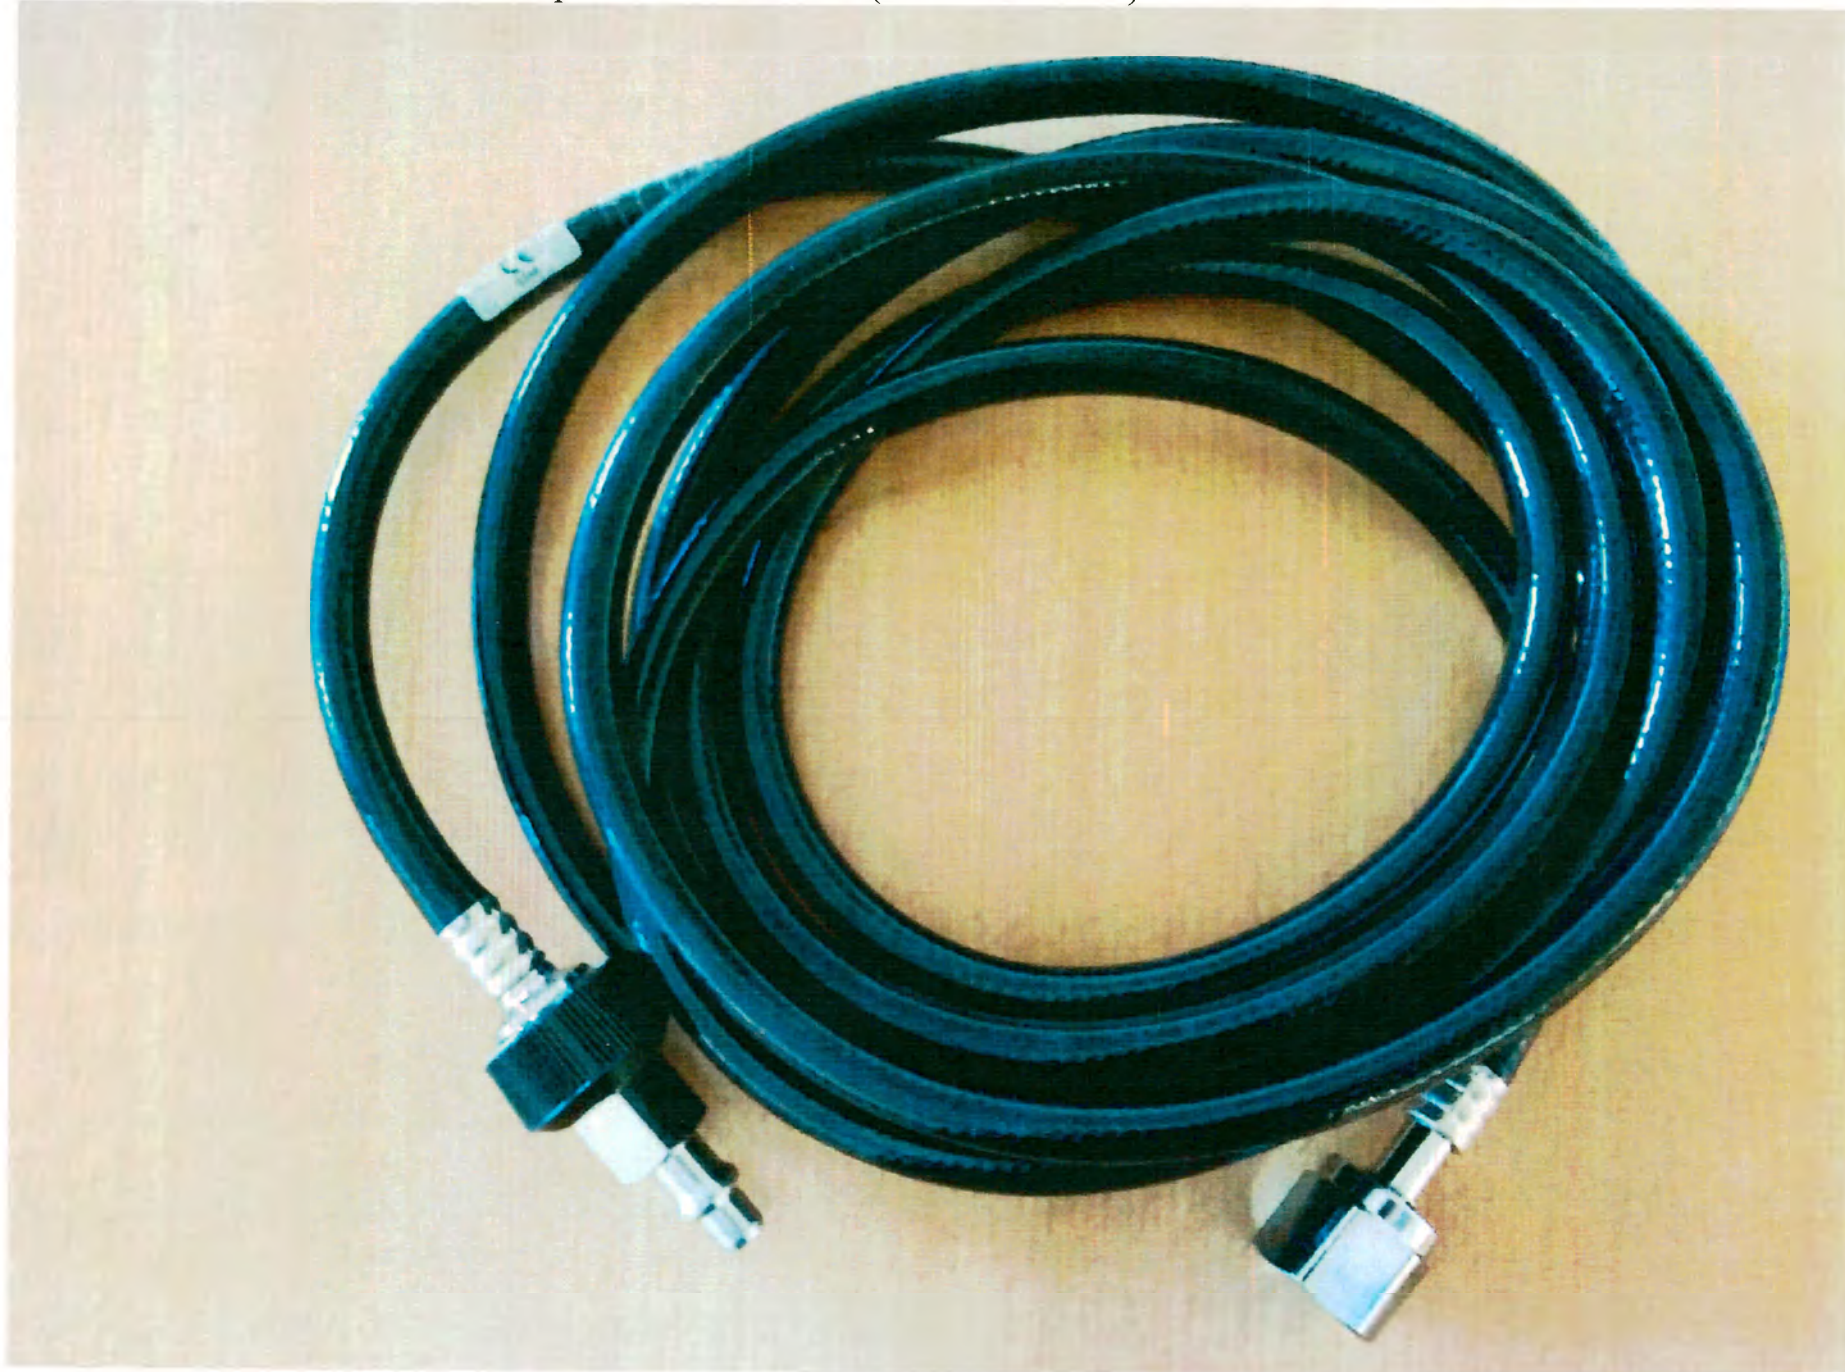


1. Шланги для подключения аппарата к газовой сети (не более 10 шт.).



1. Шланги для подключения аппарата к газовой сети (не более 10 шт.).



1. Шланги для подключения аппарата к газовой сети (не более 10 шт.).

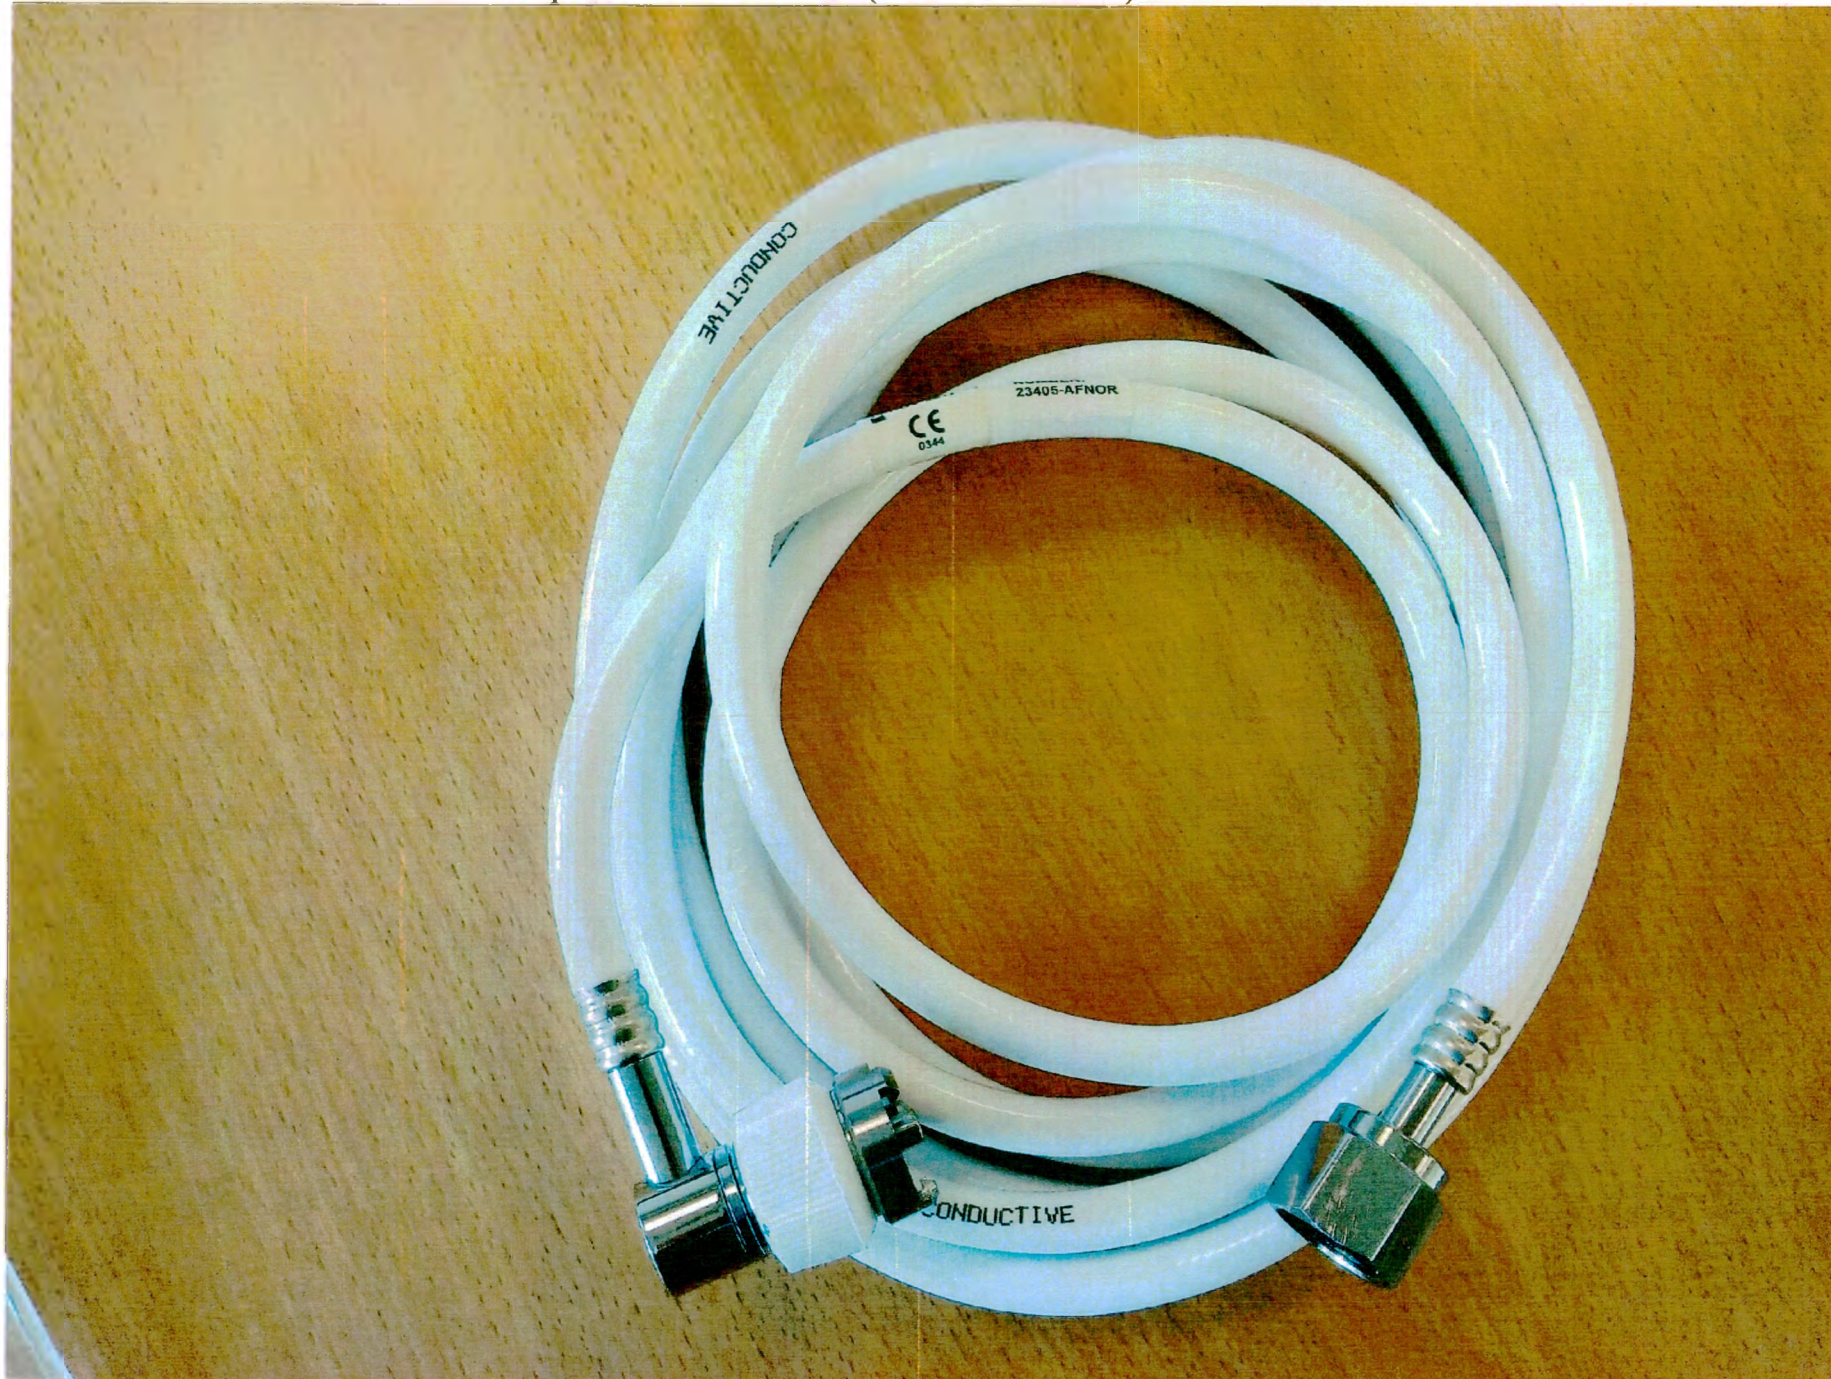

1. Шланги для подключения аппарата к газовой сети (не более 10 шт.).



1. Шланги для подключения аппарата к газовой сети (не более 10 шт.).



1. Шланги для подключения аппарата к газовой сети (не более 10 шт.).



1. Шланги для подключения аппарата к газовой сети (не более 10 шт.).




1. Шланги для подключения аппарата к газовой сети (не более 10 шт.).




2. Испаритель для анестетика севофлуран.



3. Испаритель для анестетика галотан.

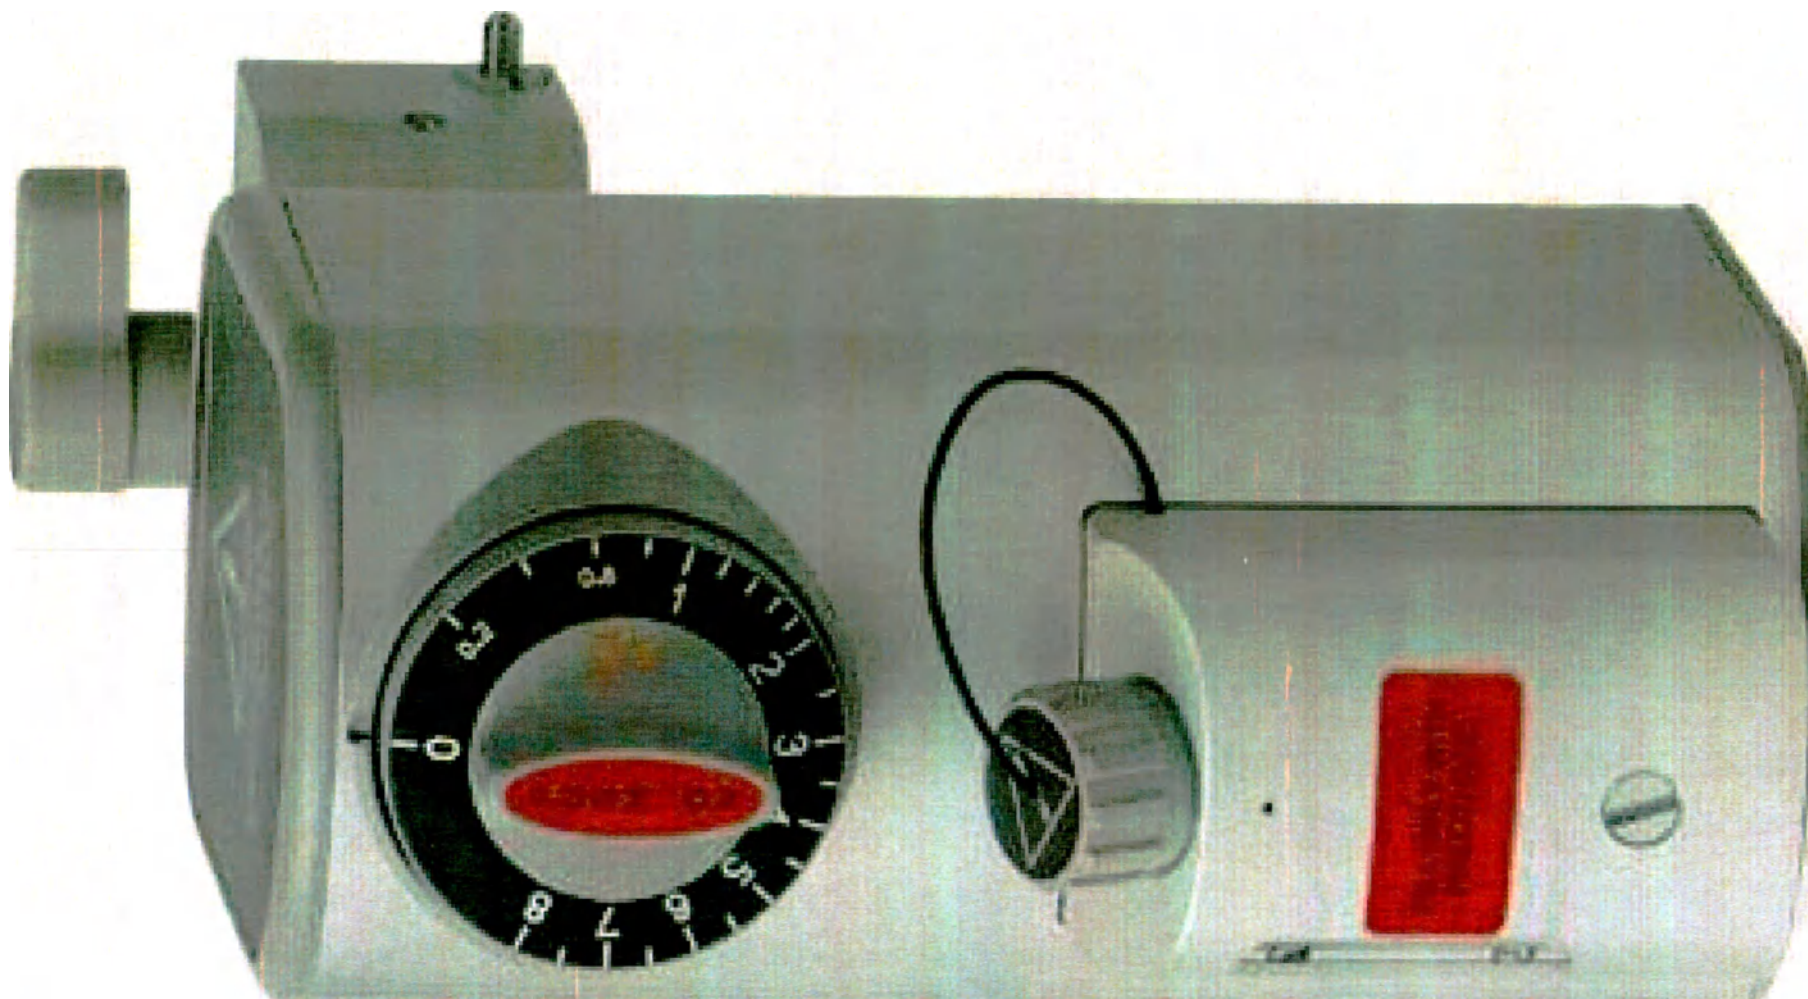

4. Испаритель для анестетика энфлюран.

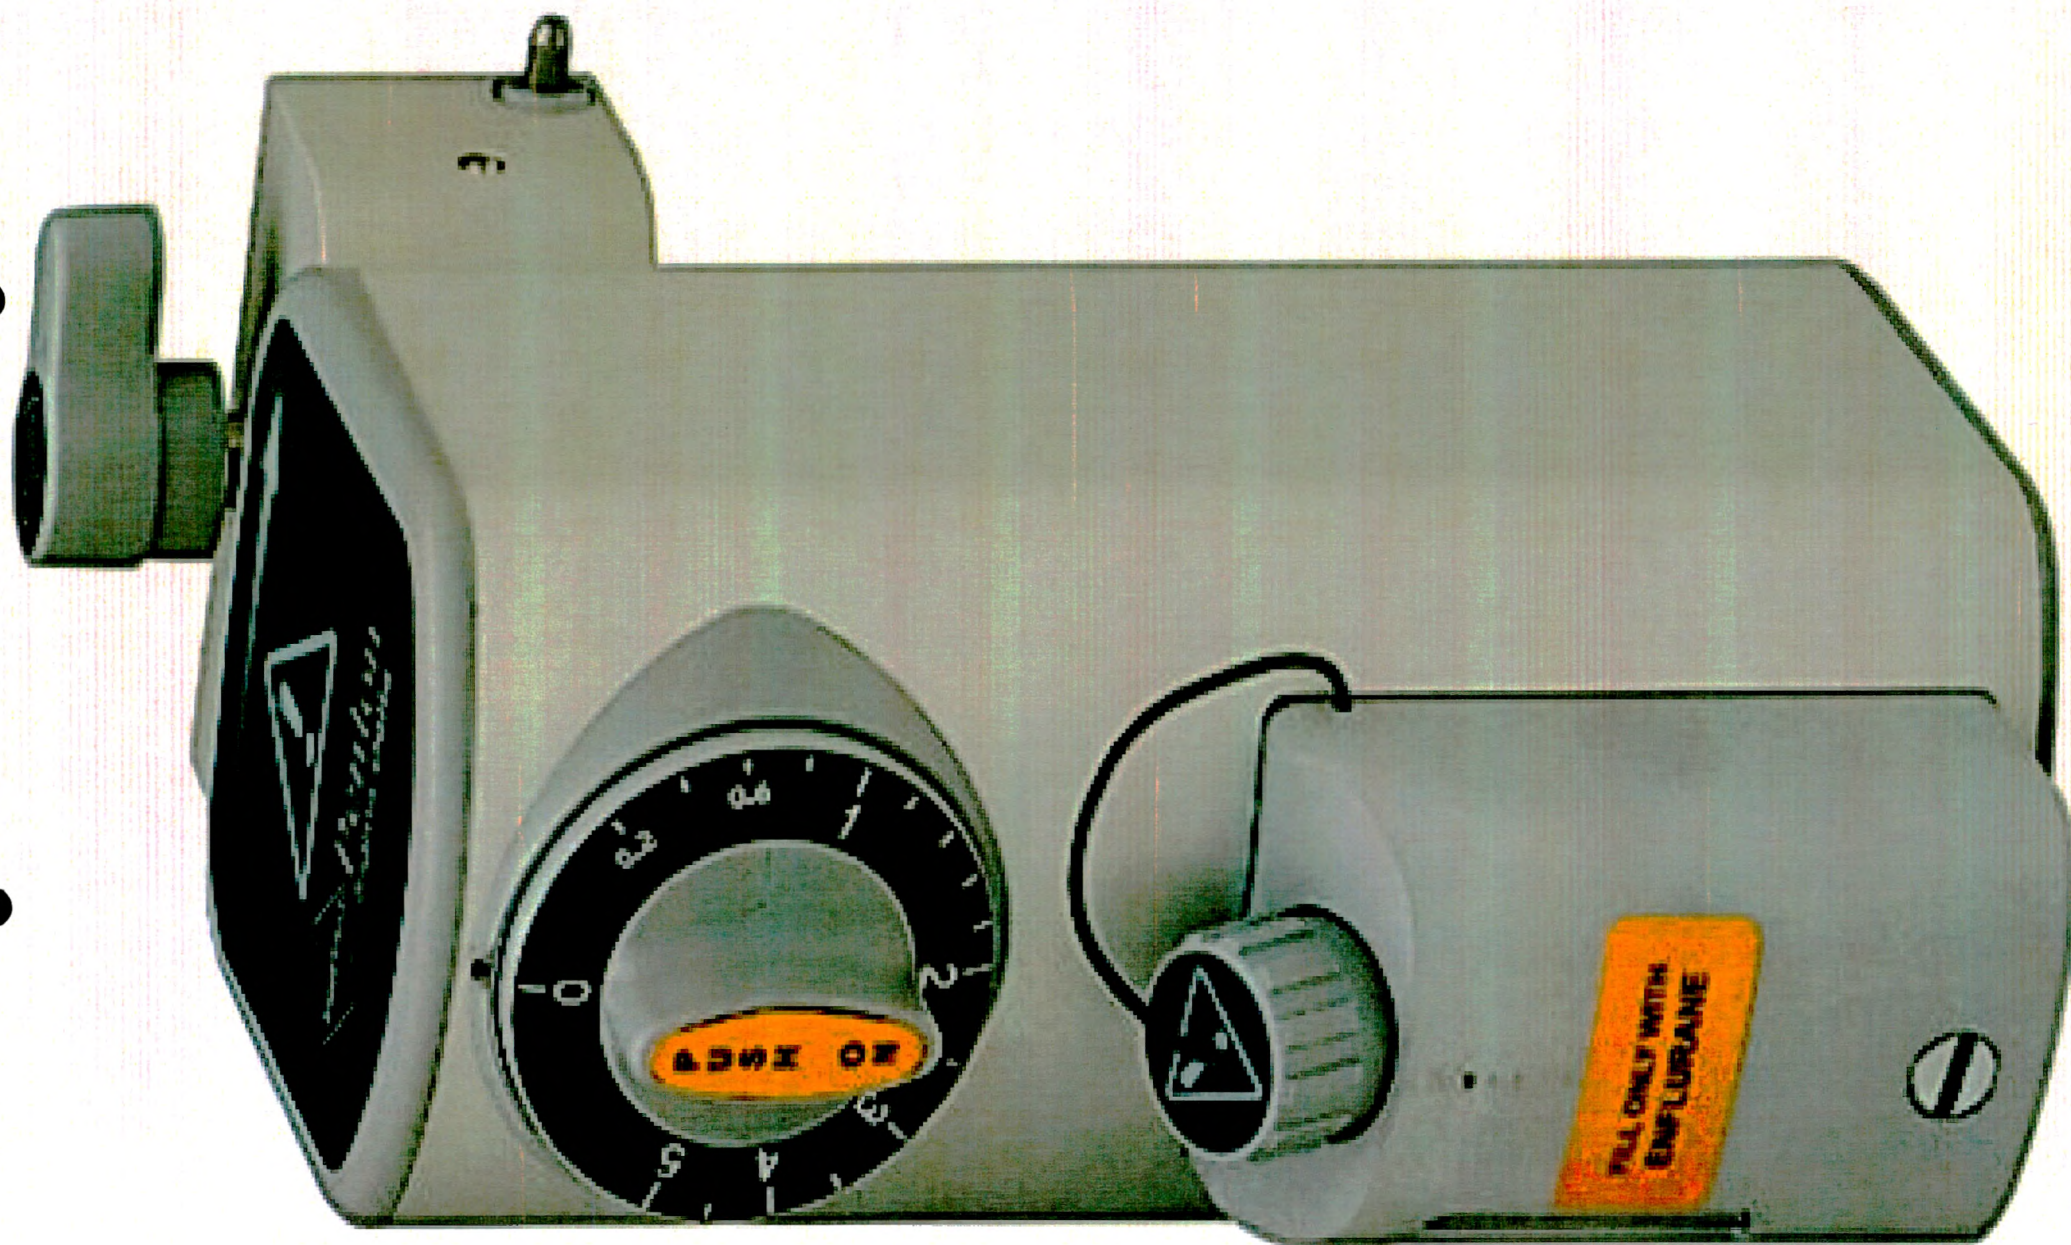

5. Испаритель для анестетика изофлюран.




6. Набор для спирометрии:


6.1. Трубки для спирометрии, 2 м (не более 25 шт.);



6.2. Датчики потока для взрослых (не более 2 шт.);

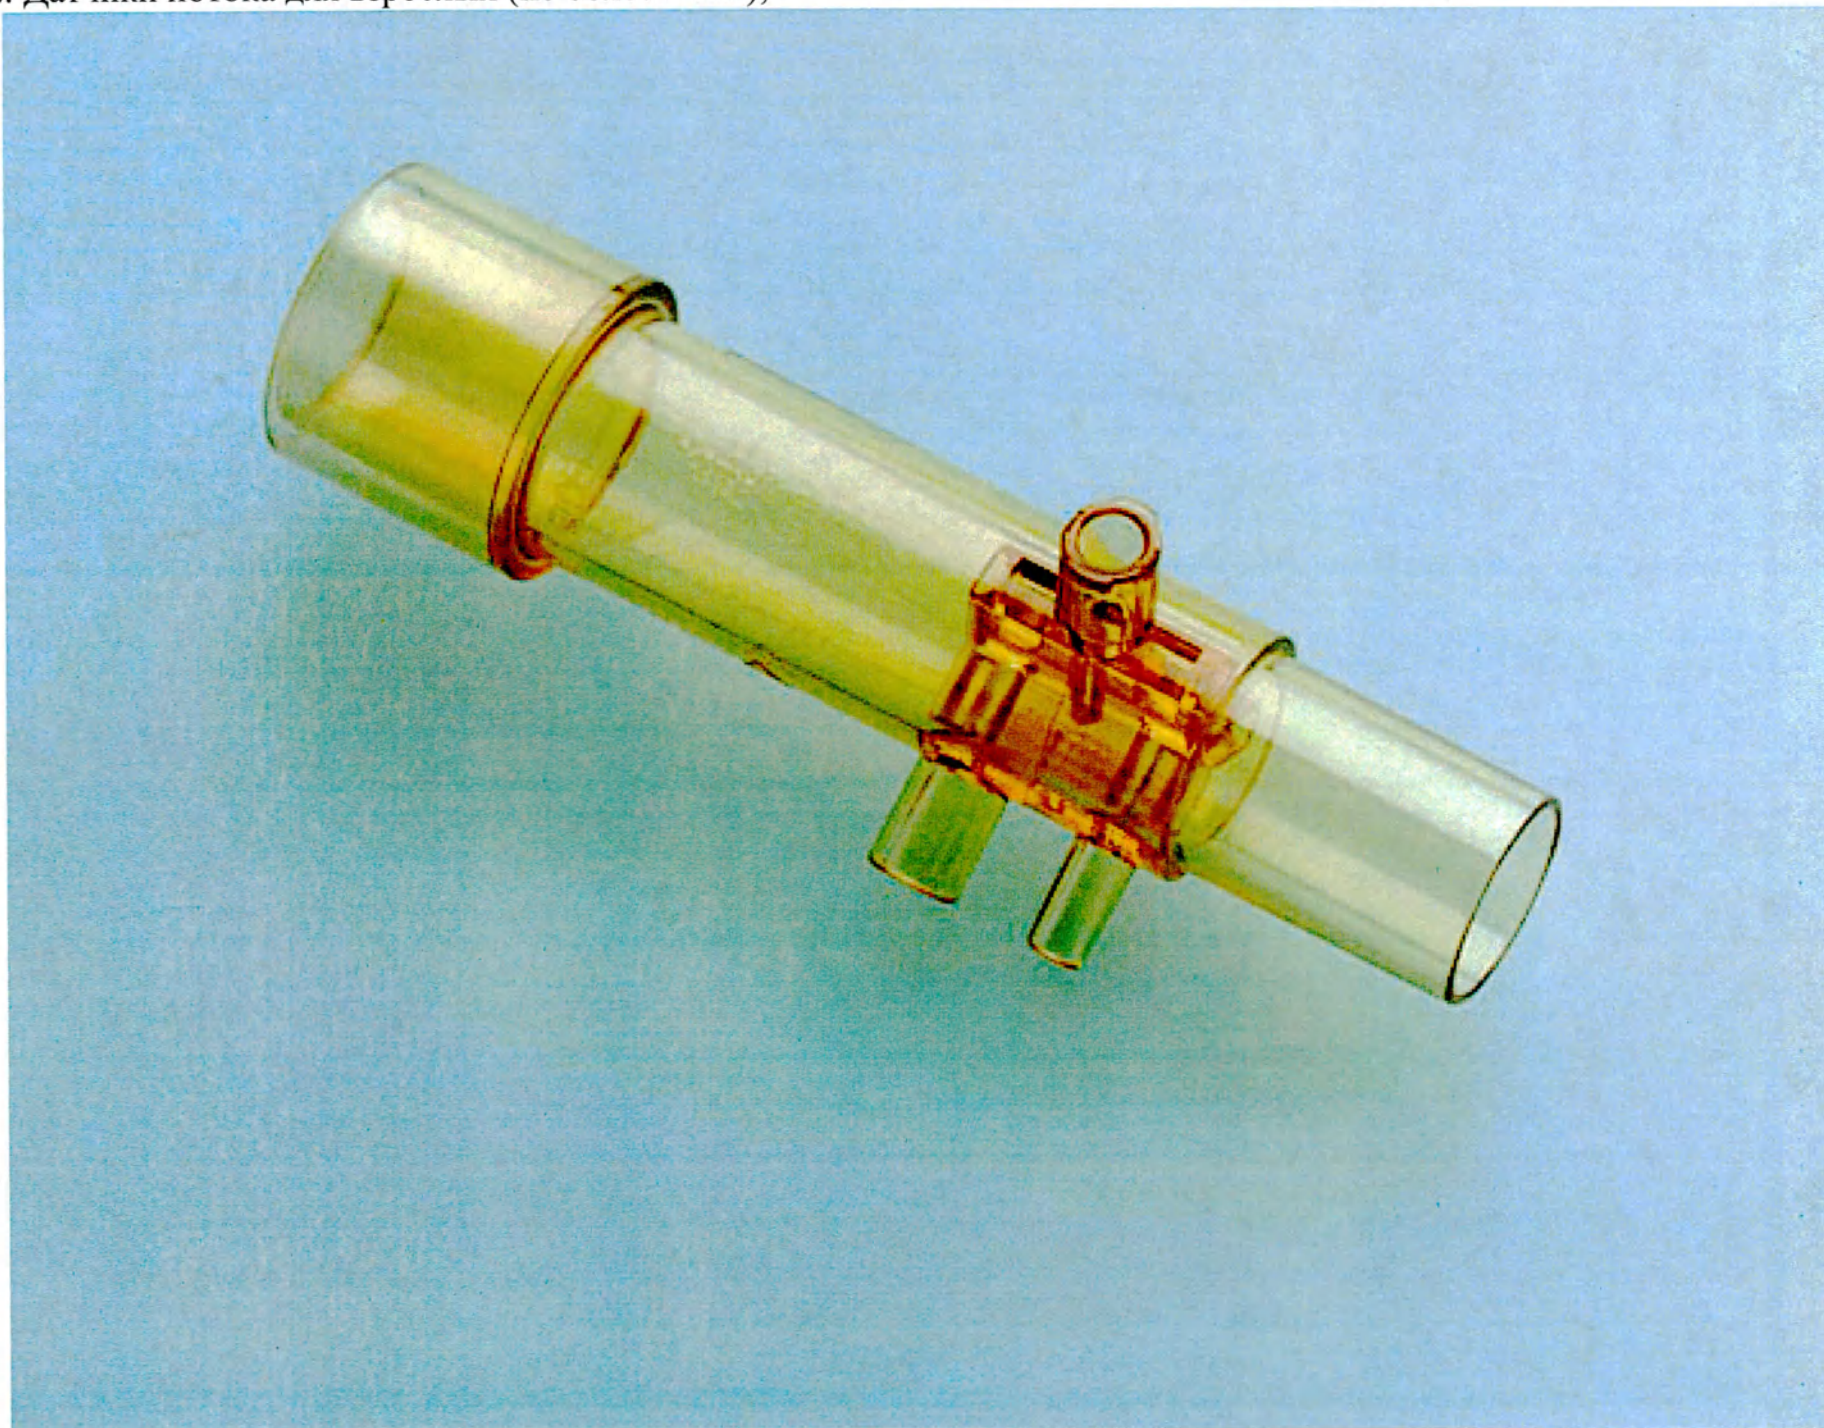

6.3. Датчик потока для детей;

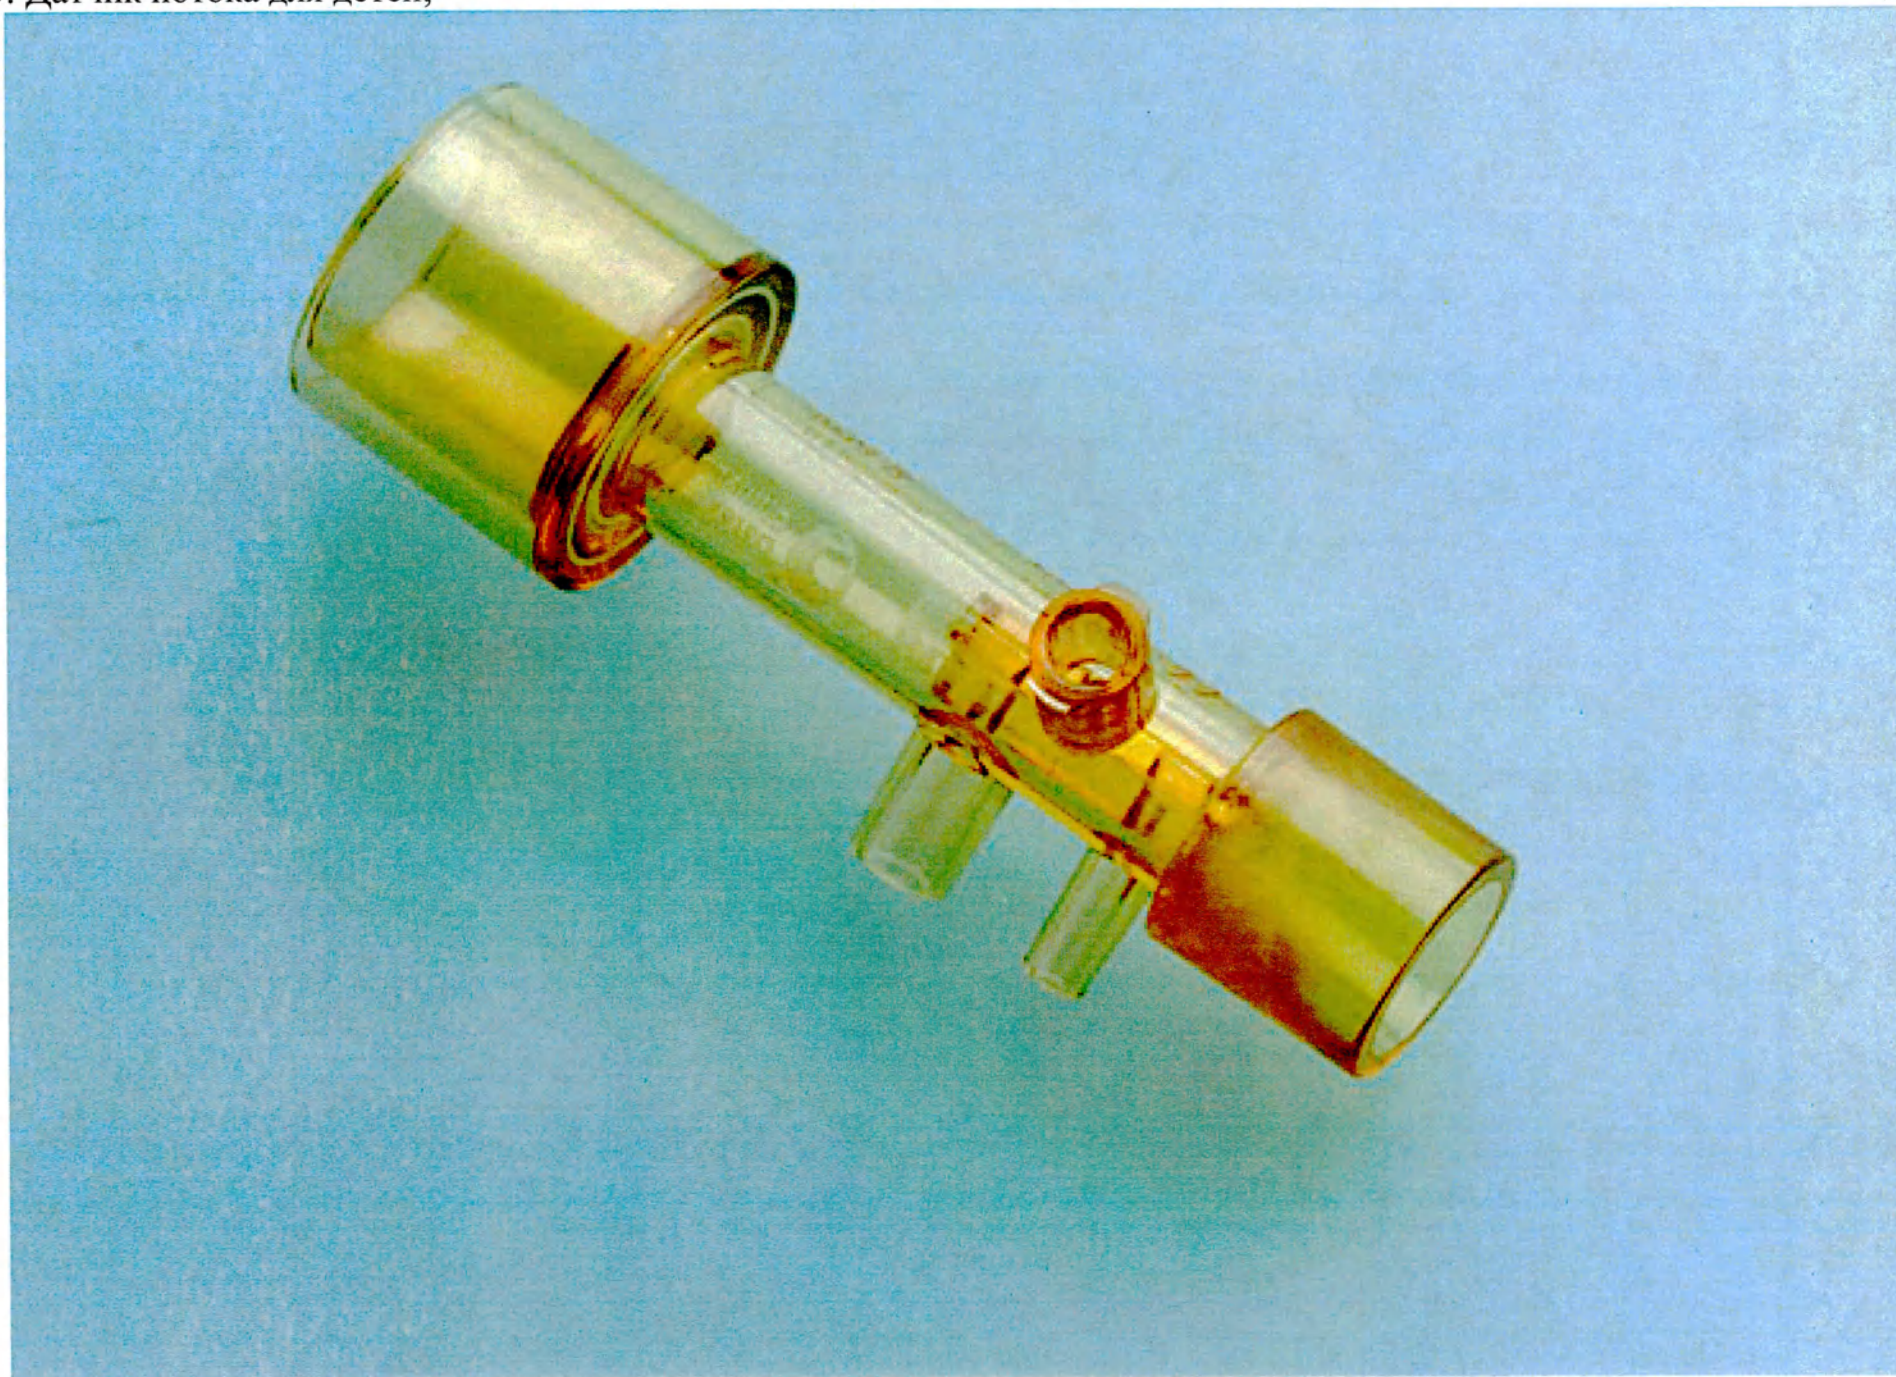

6.4. Фильтры бактериальные, одноразовые (не более 100 шт.).




7. Набор расходных материалов для мультигазового модуля:


7.1. Трубки для спирометрии, 2 м (не более 25 шт.);



7.2. Датчики потока для взрослых (не более 2 шт.);

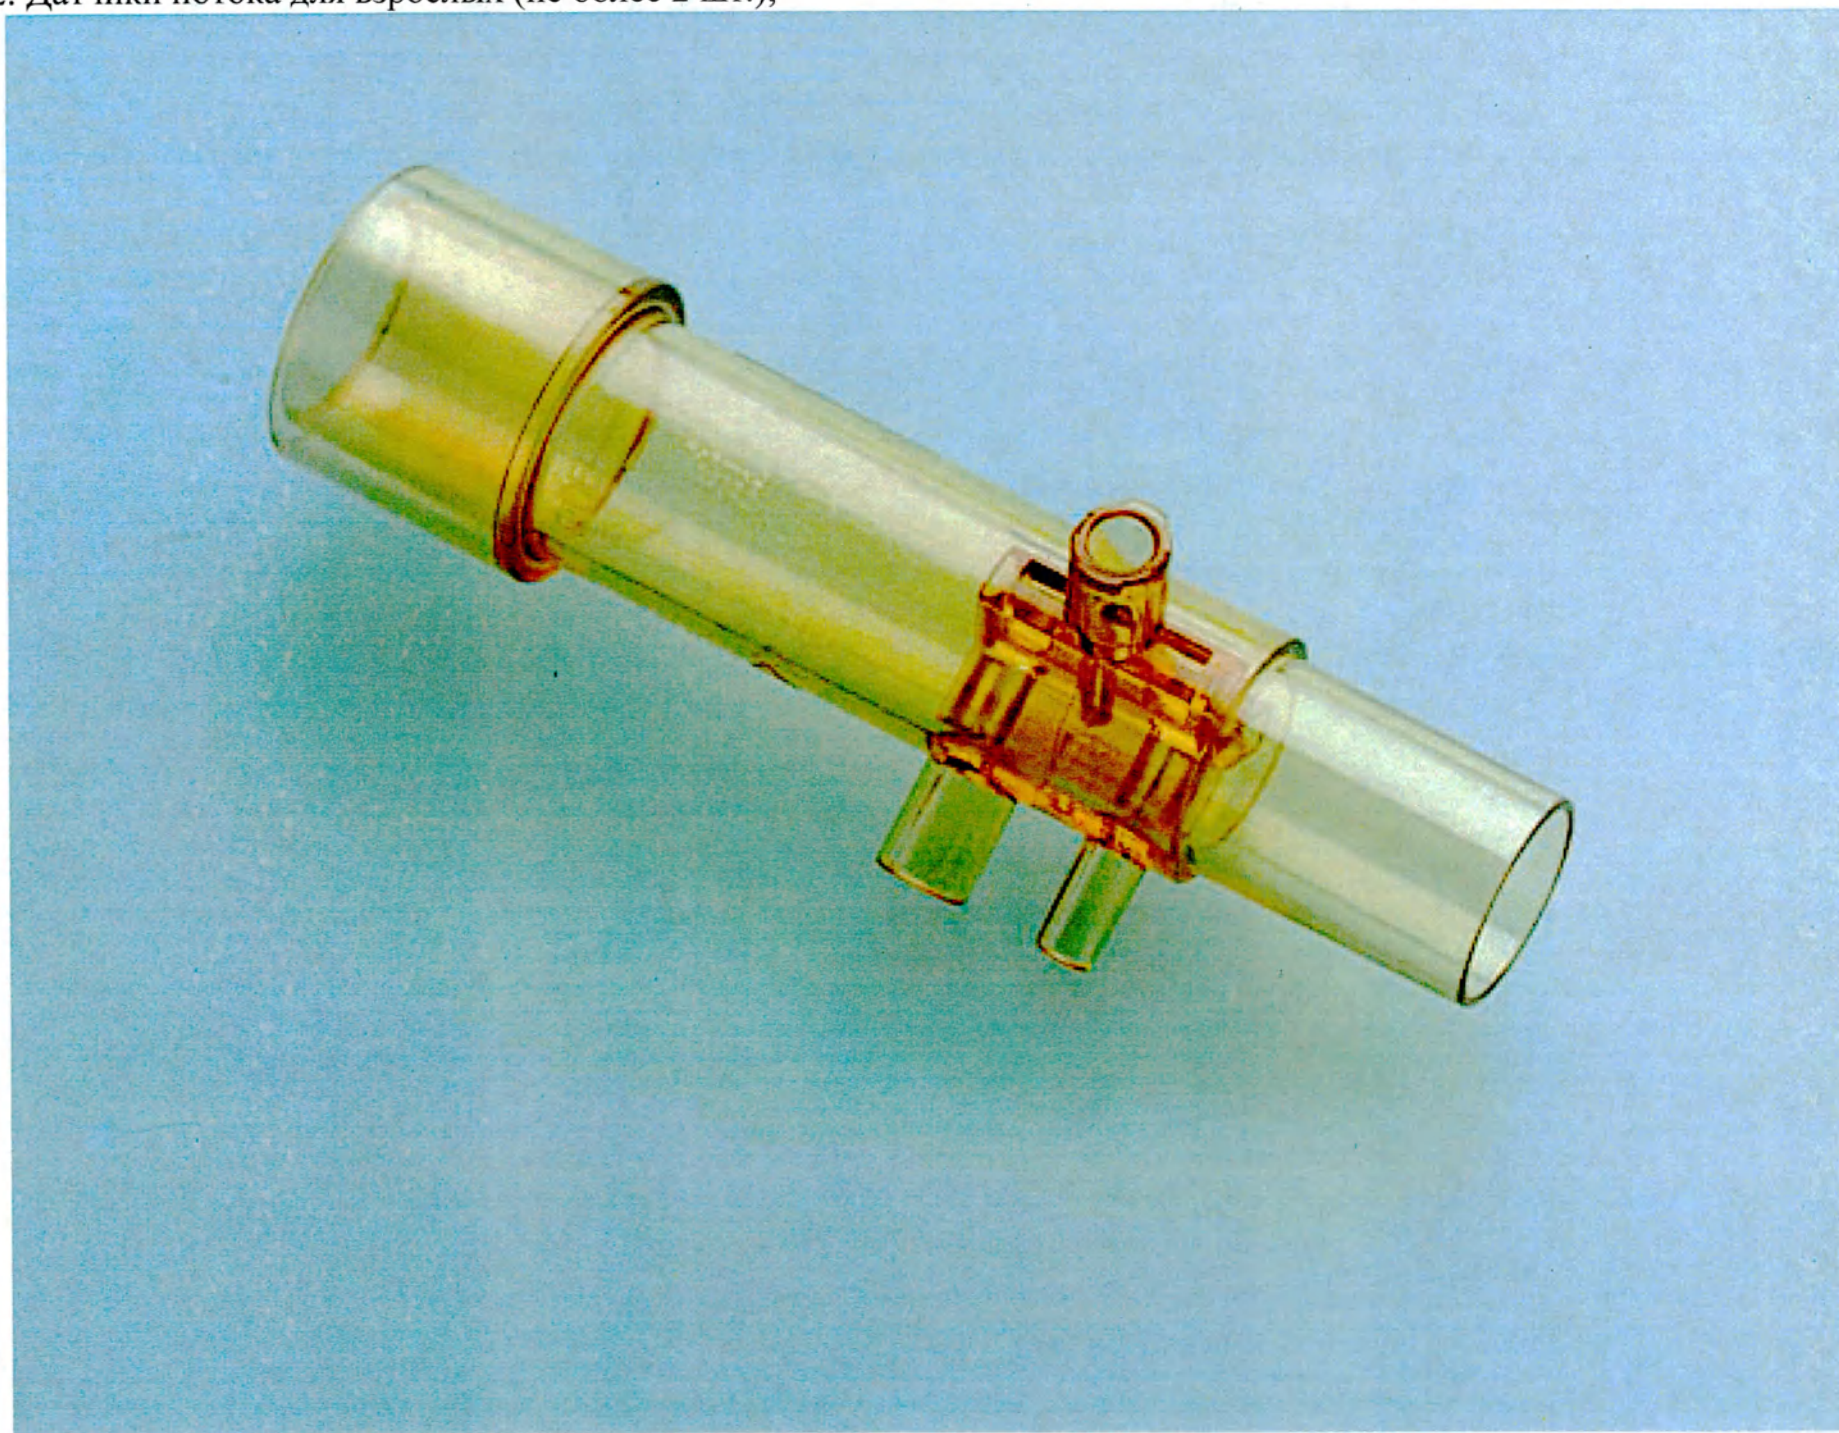


7.3. Датчик потока для детей;

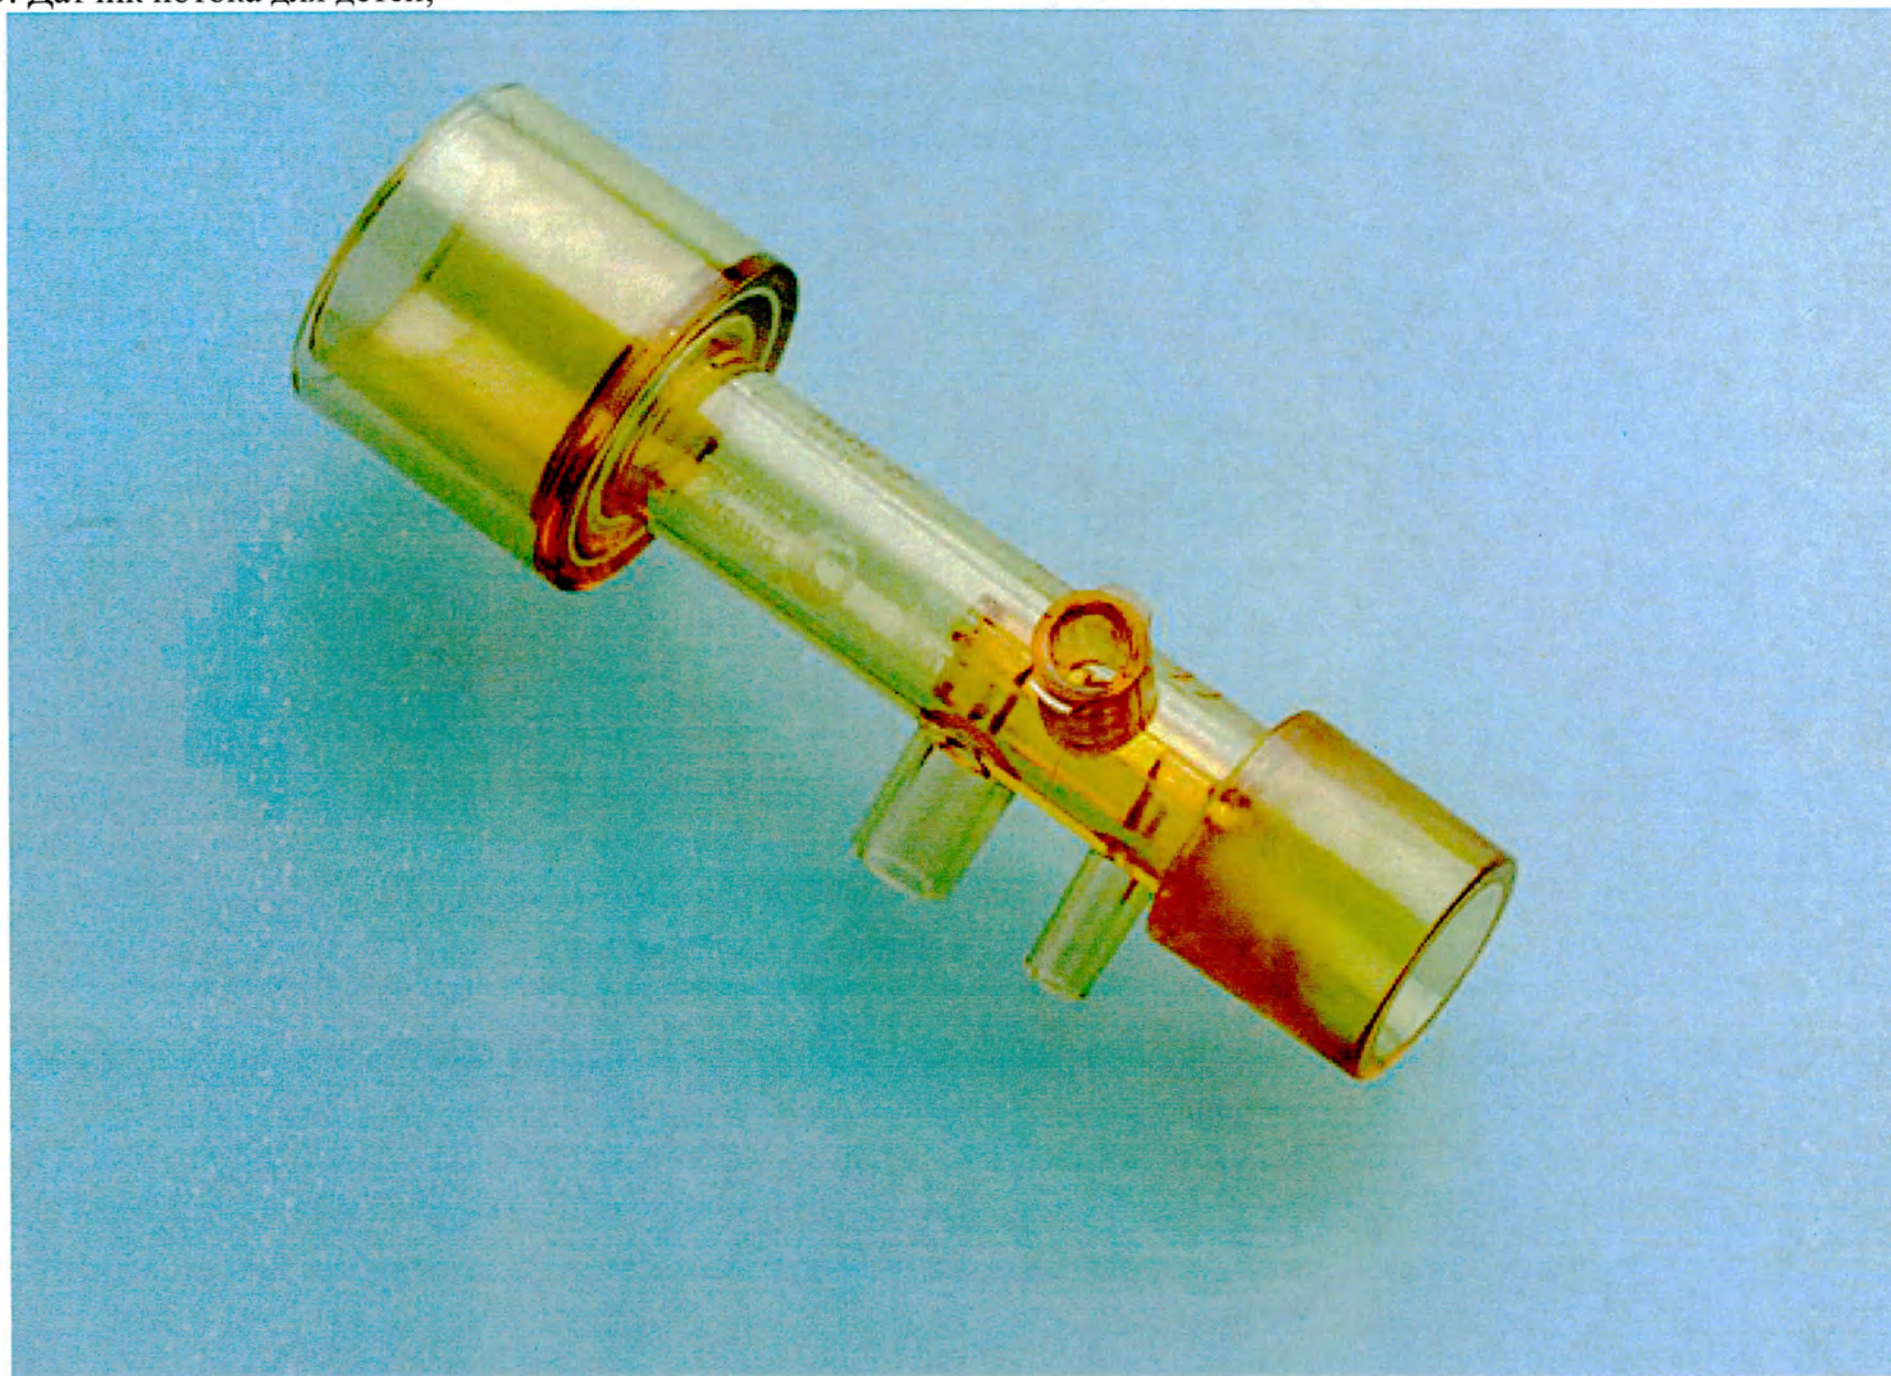


7.4. Фильтры бактериальные, одноразовые (не более 100 шт.);



7.5. Водосборники с фильтрами, многоразовые (не более 2 шт.);

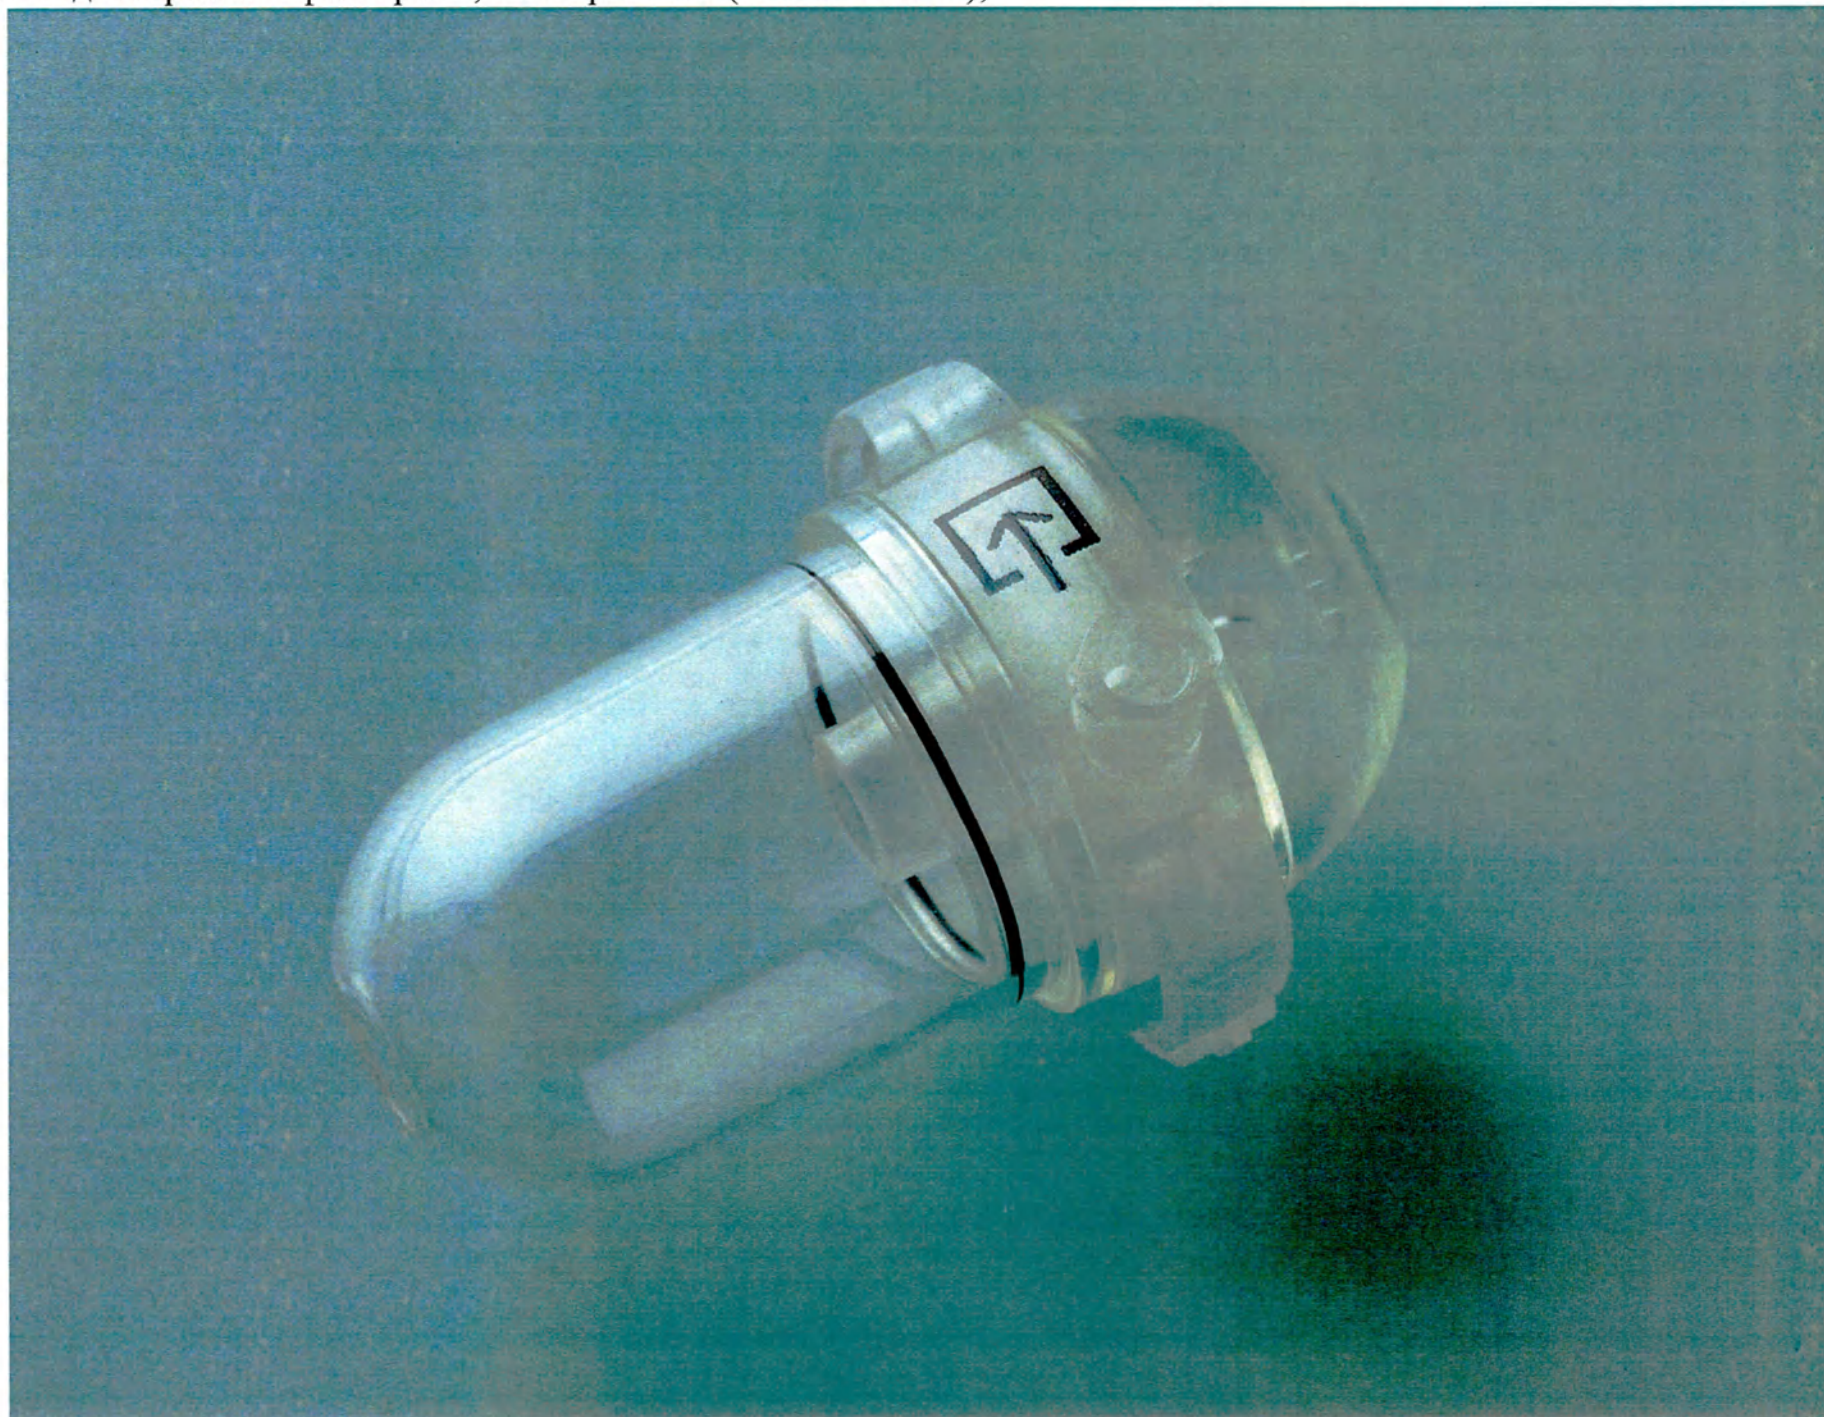

7.6. Трубки для газоанализа, 2 м (не более 100 шт.).

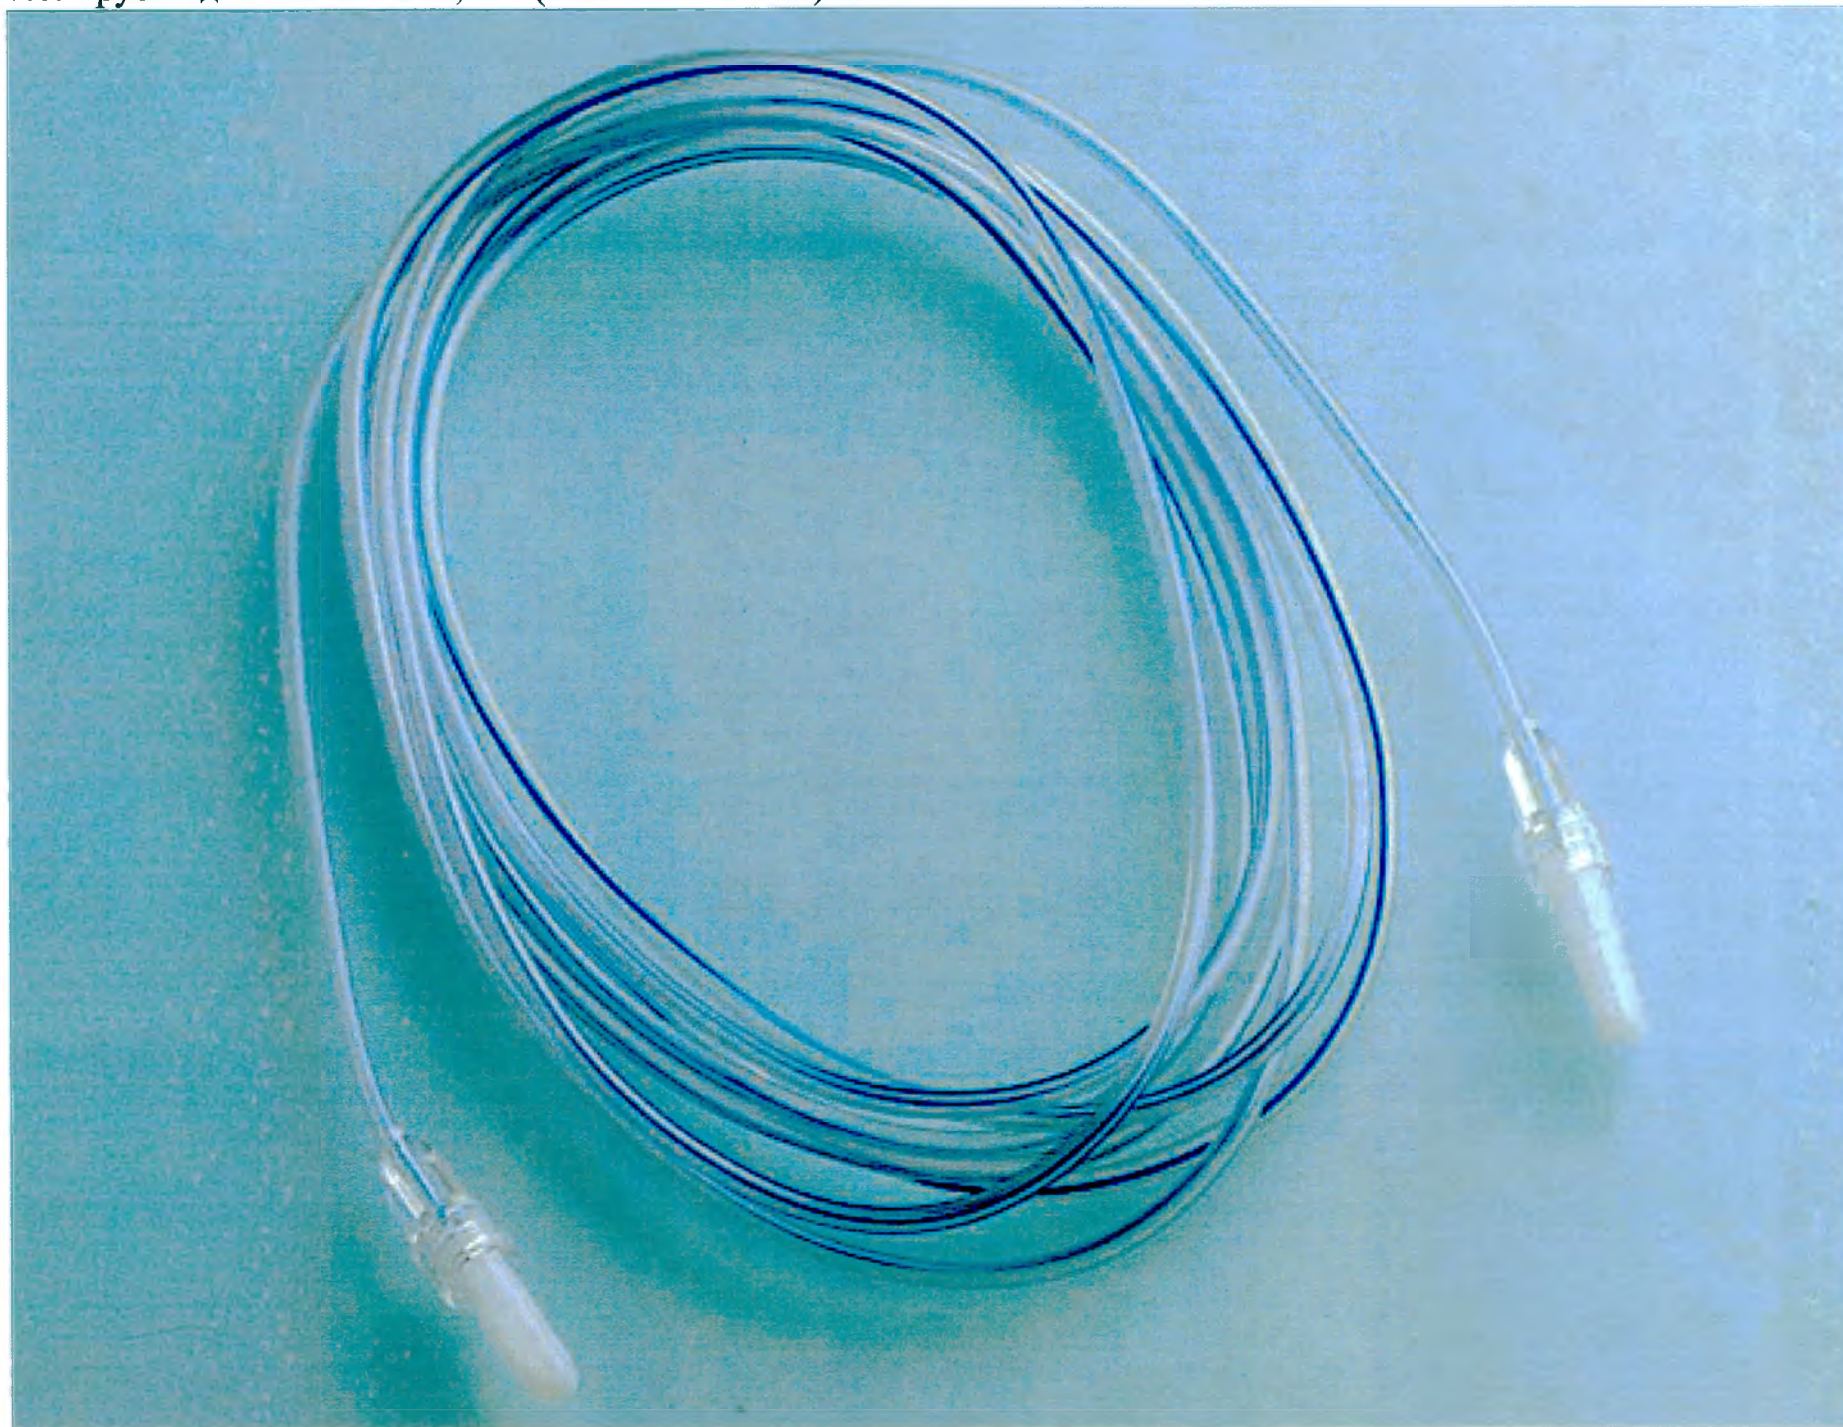

8. Датчики кислородные (не более 5 шт.).




9. Абсорберы для дыхательной системы i-SORB одноразовые (не более 2 уп./8 шт. в уп.).



10. Абсорберы для дыхательной системы i-SORB многоразовые (не более 3 шт.).




11. Кронштейны для монитора типа GCX (не более 8 шт.).

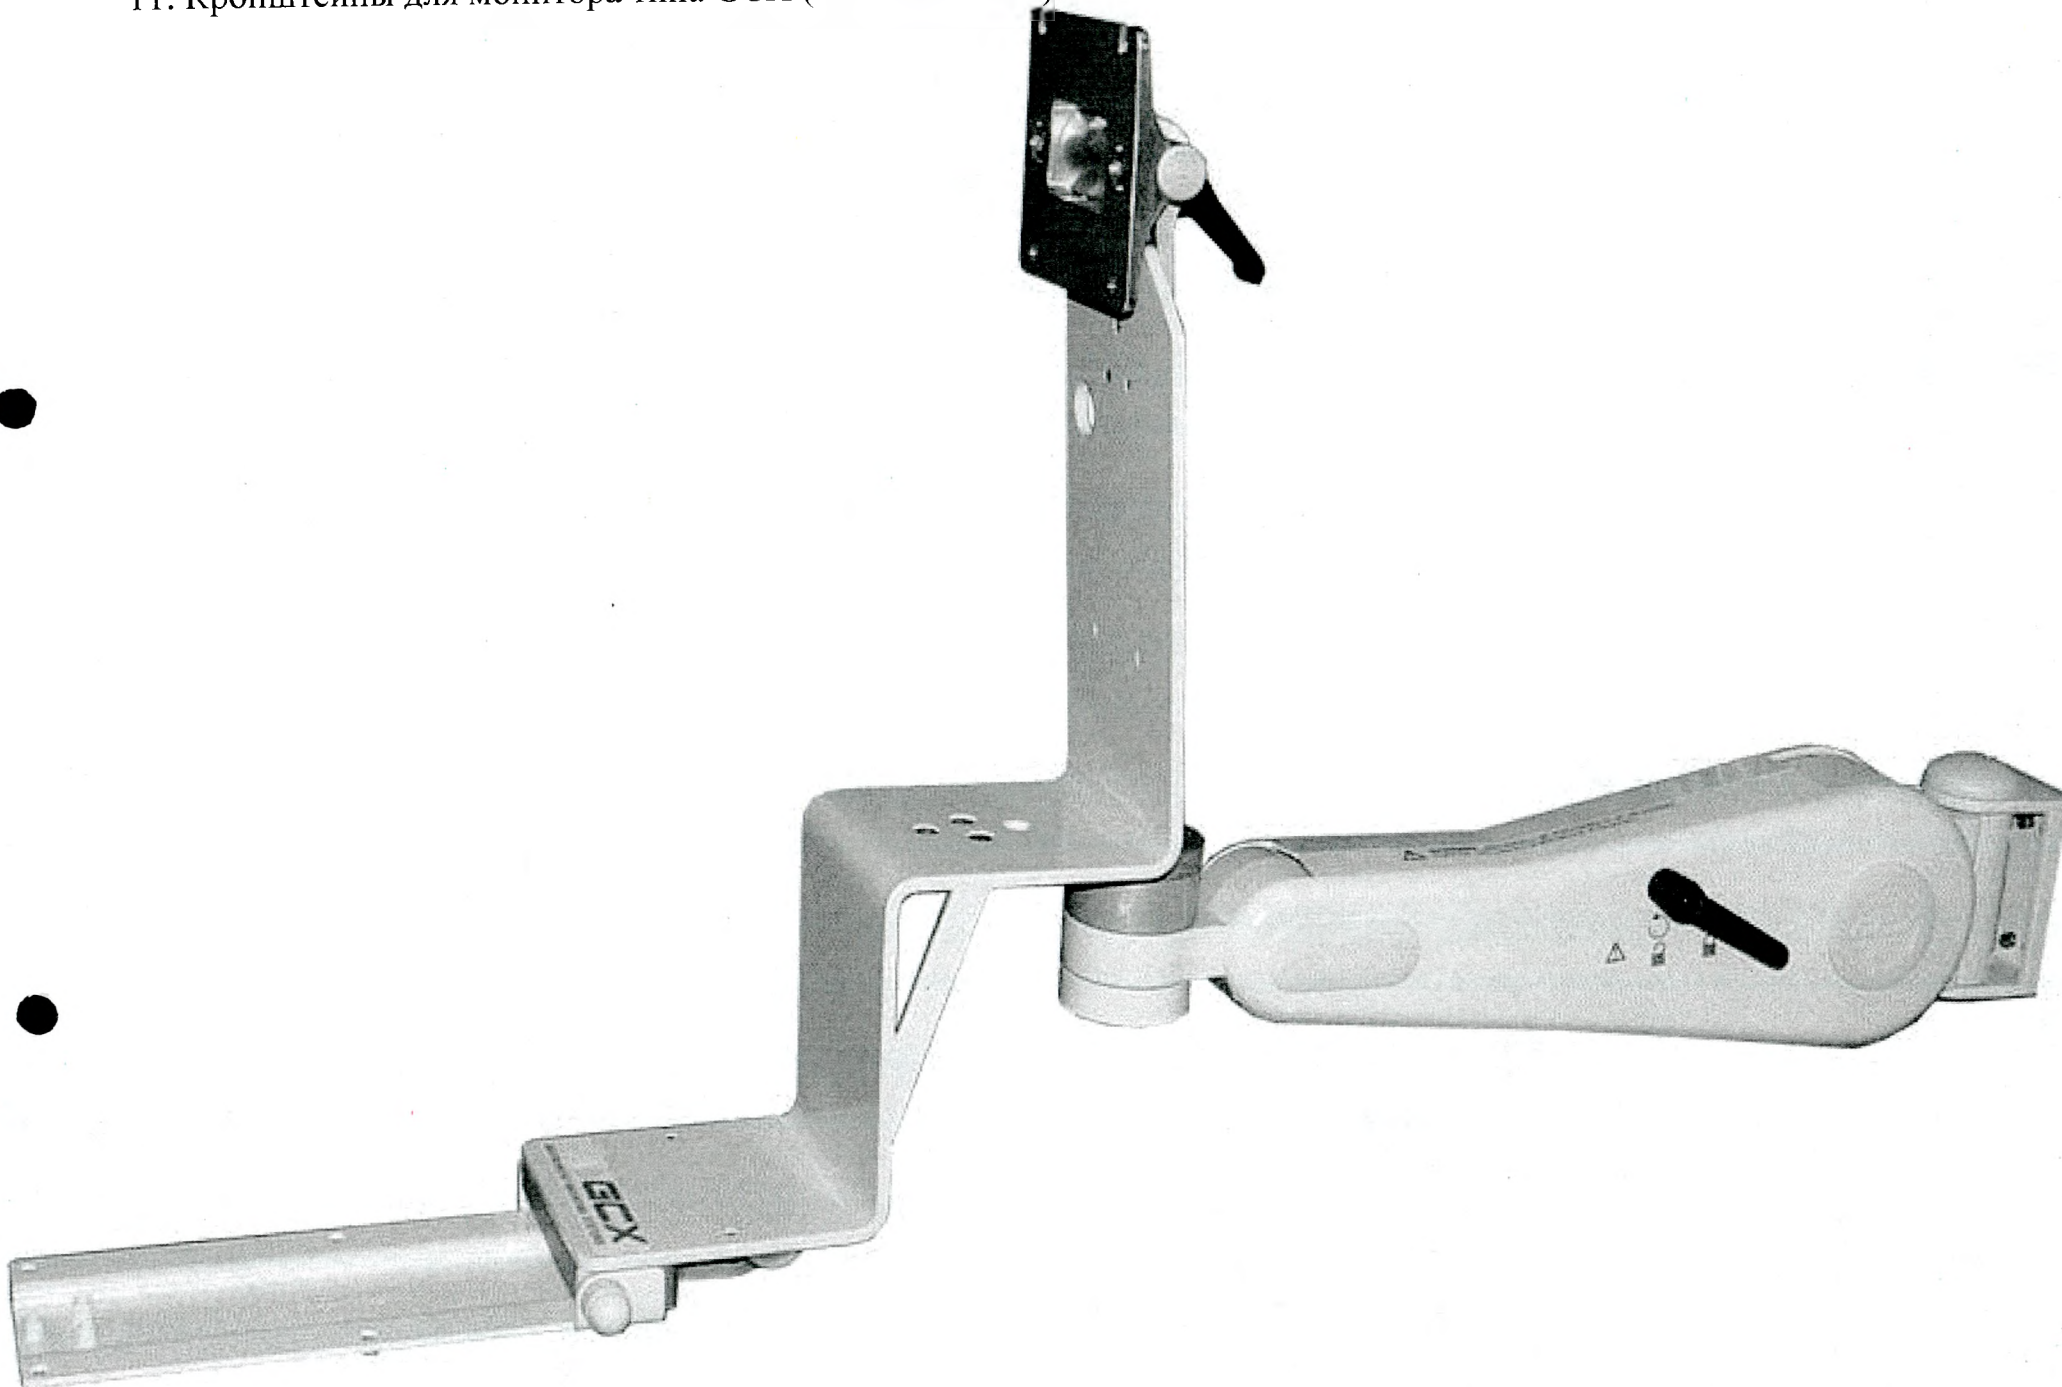

12. Системы дыхательные интегрированные (не более 2 шт.):




12.1. Камера;

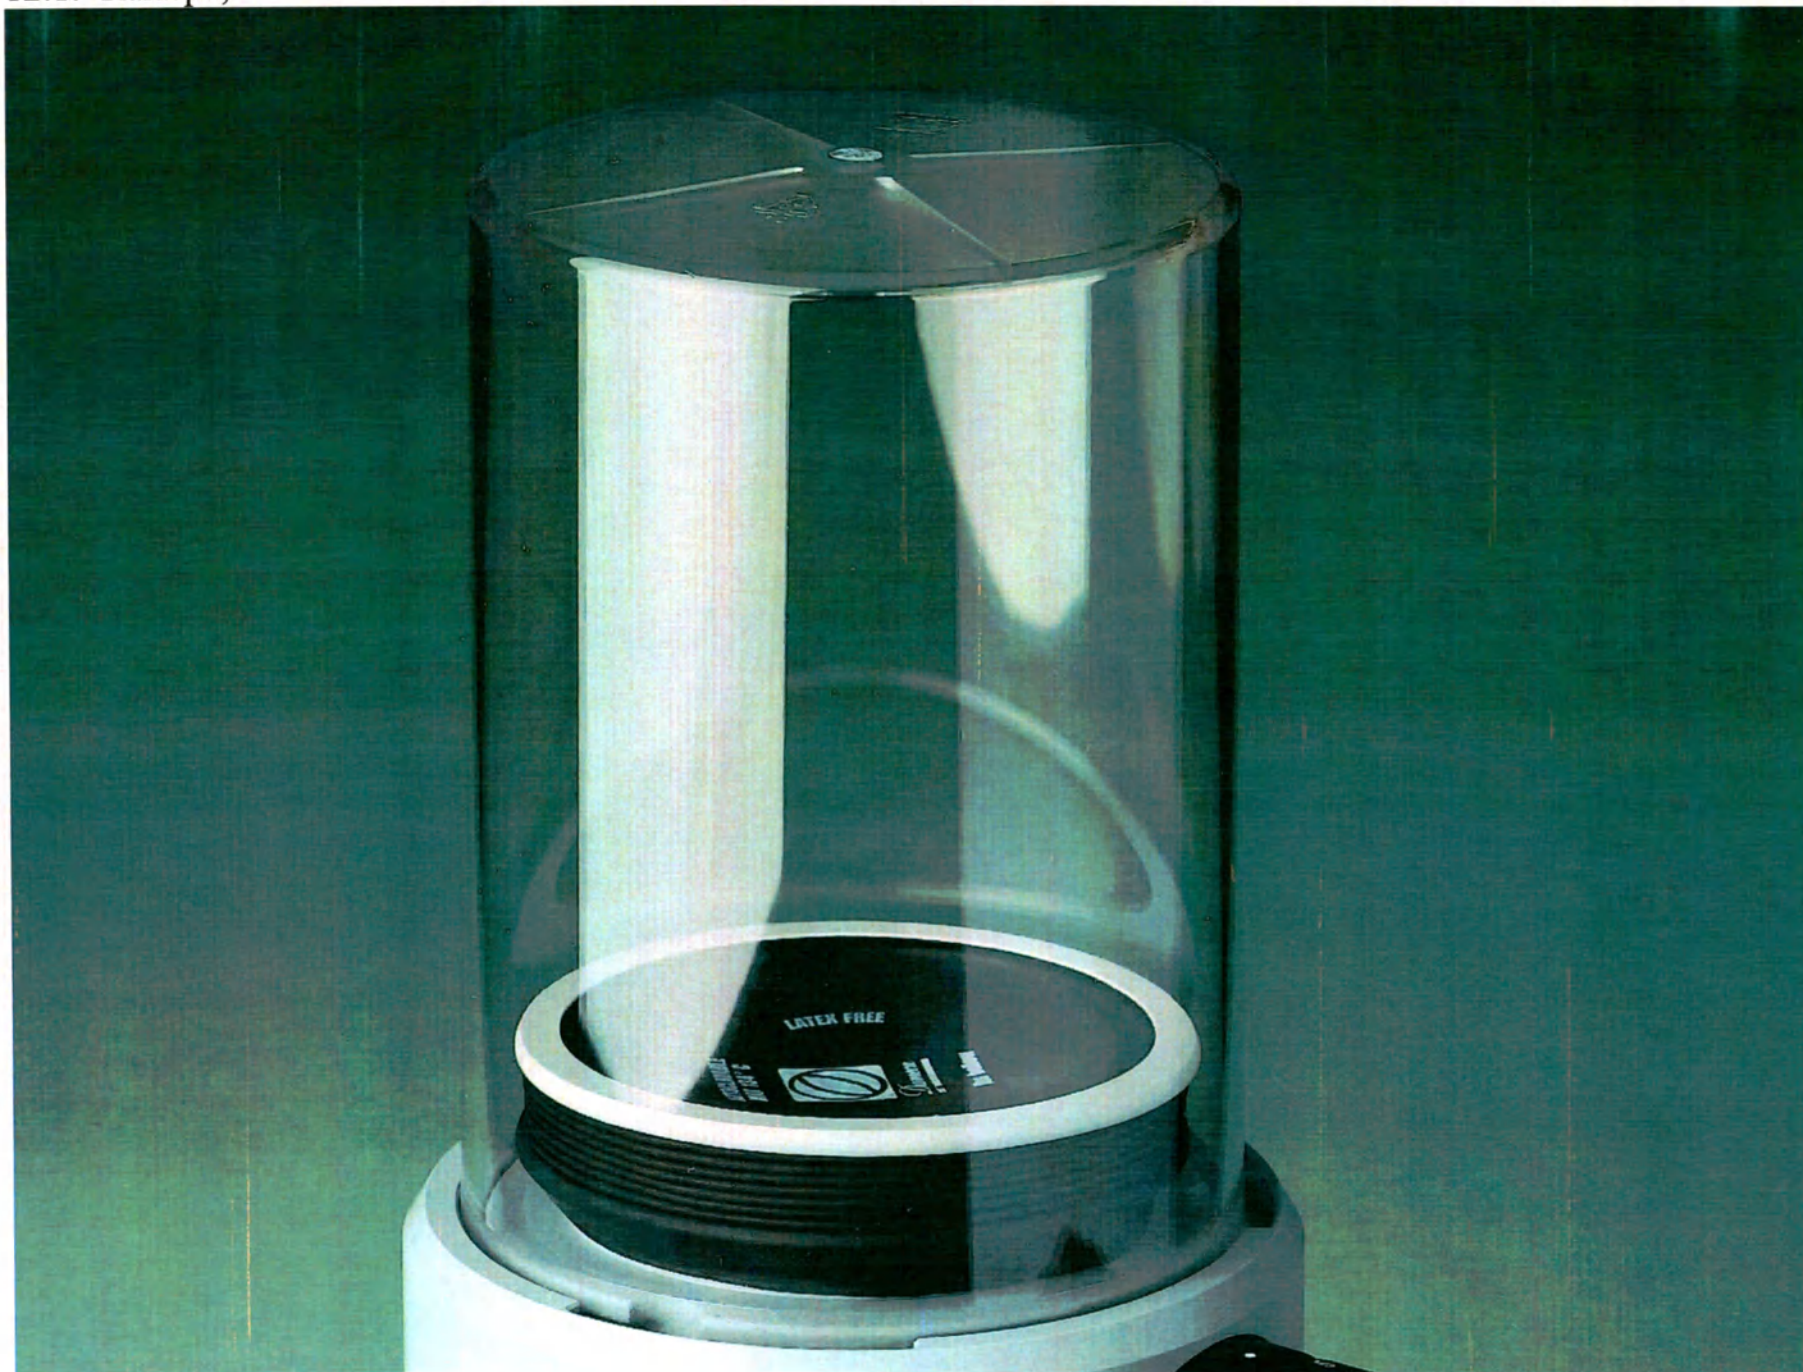

12.2. Mex;




12.3. Клапан предохранительный (APL);

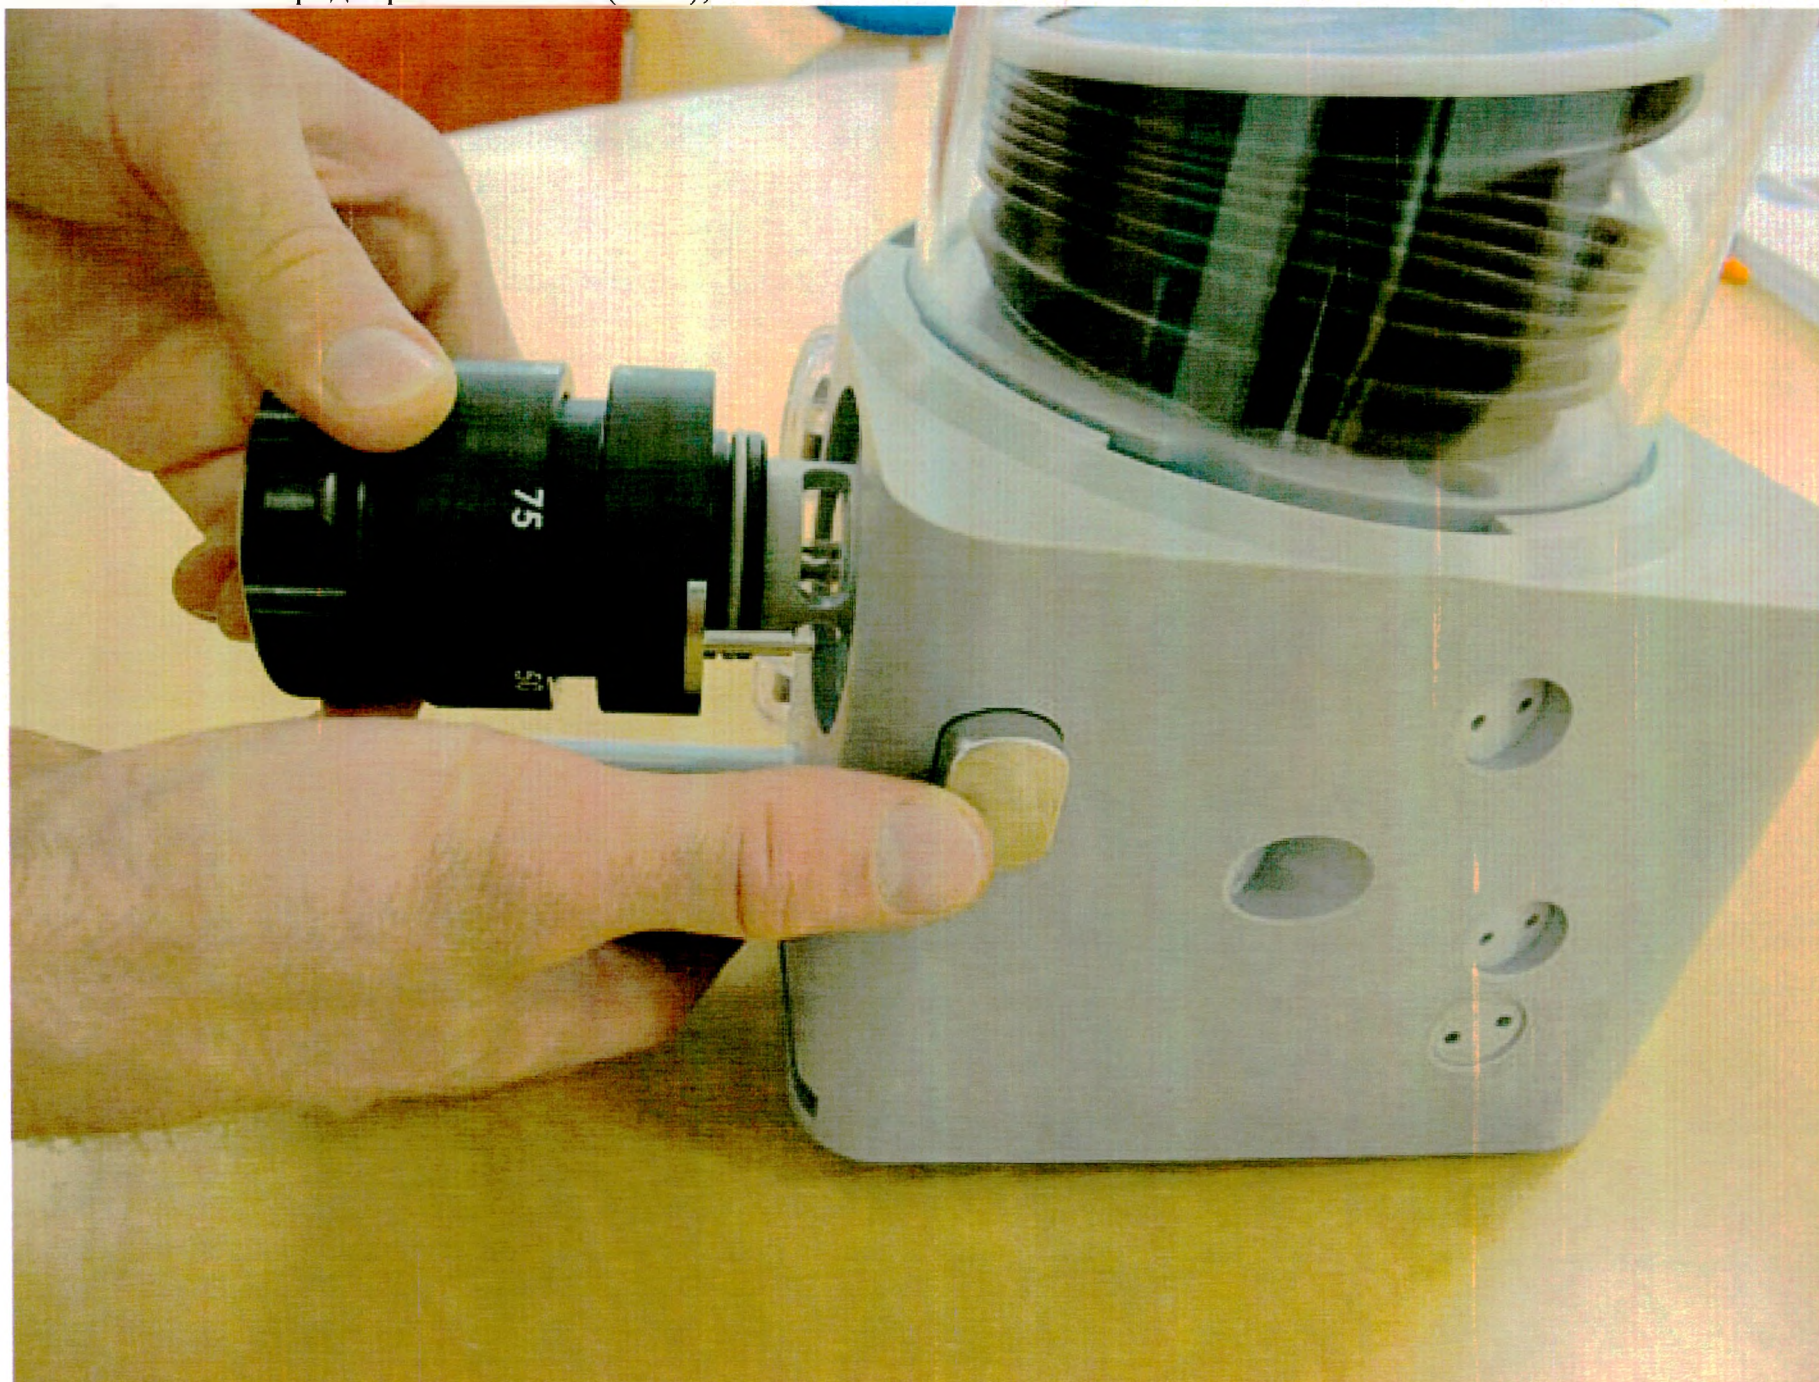


12.4. Клапан выхода для абсорбера.




12.Контейнеры для принадлежностей автоклавируемый (не более 3 шт.).

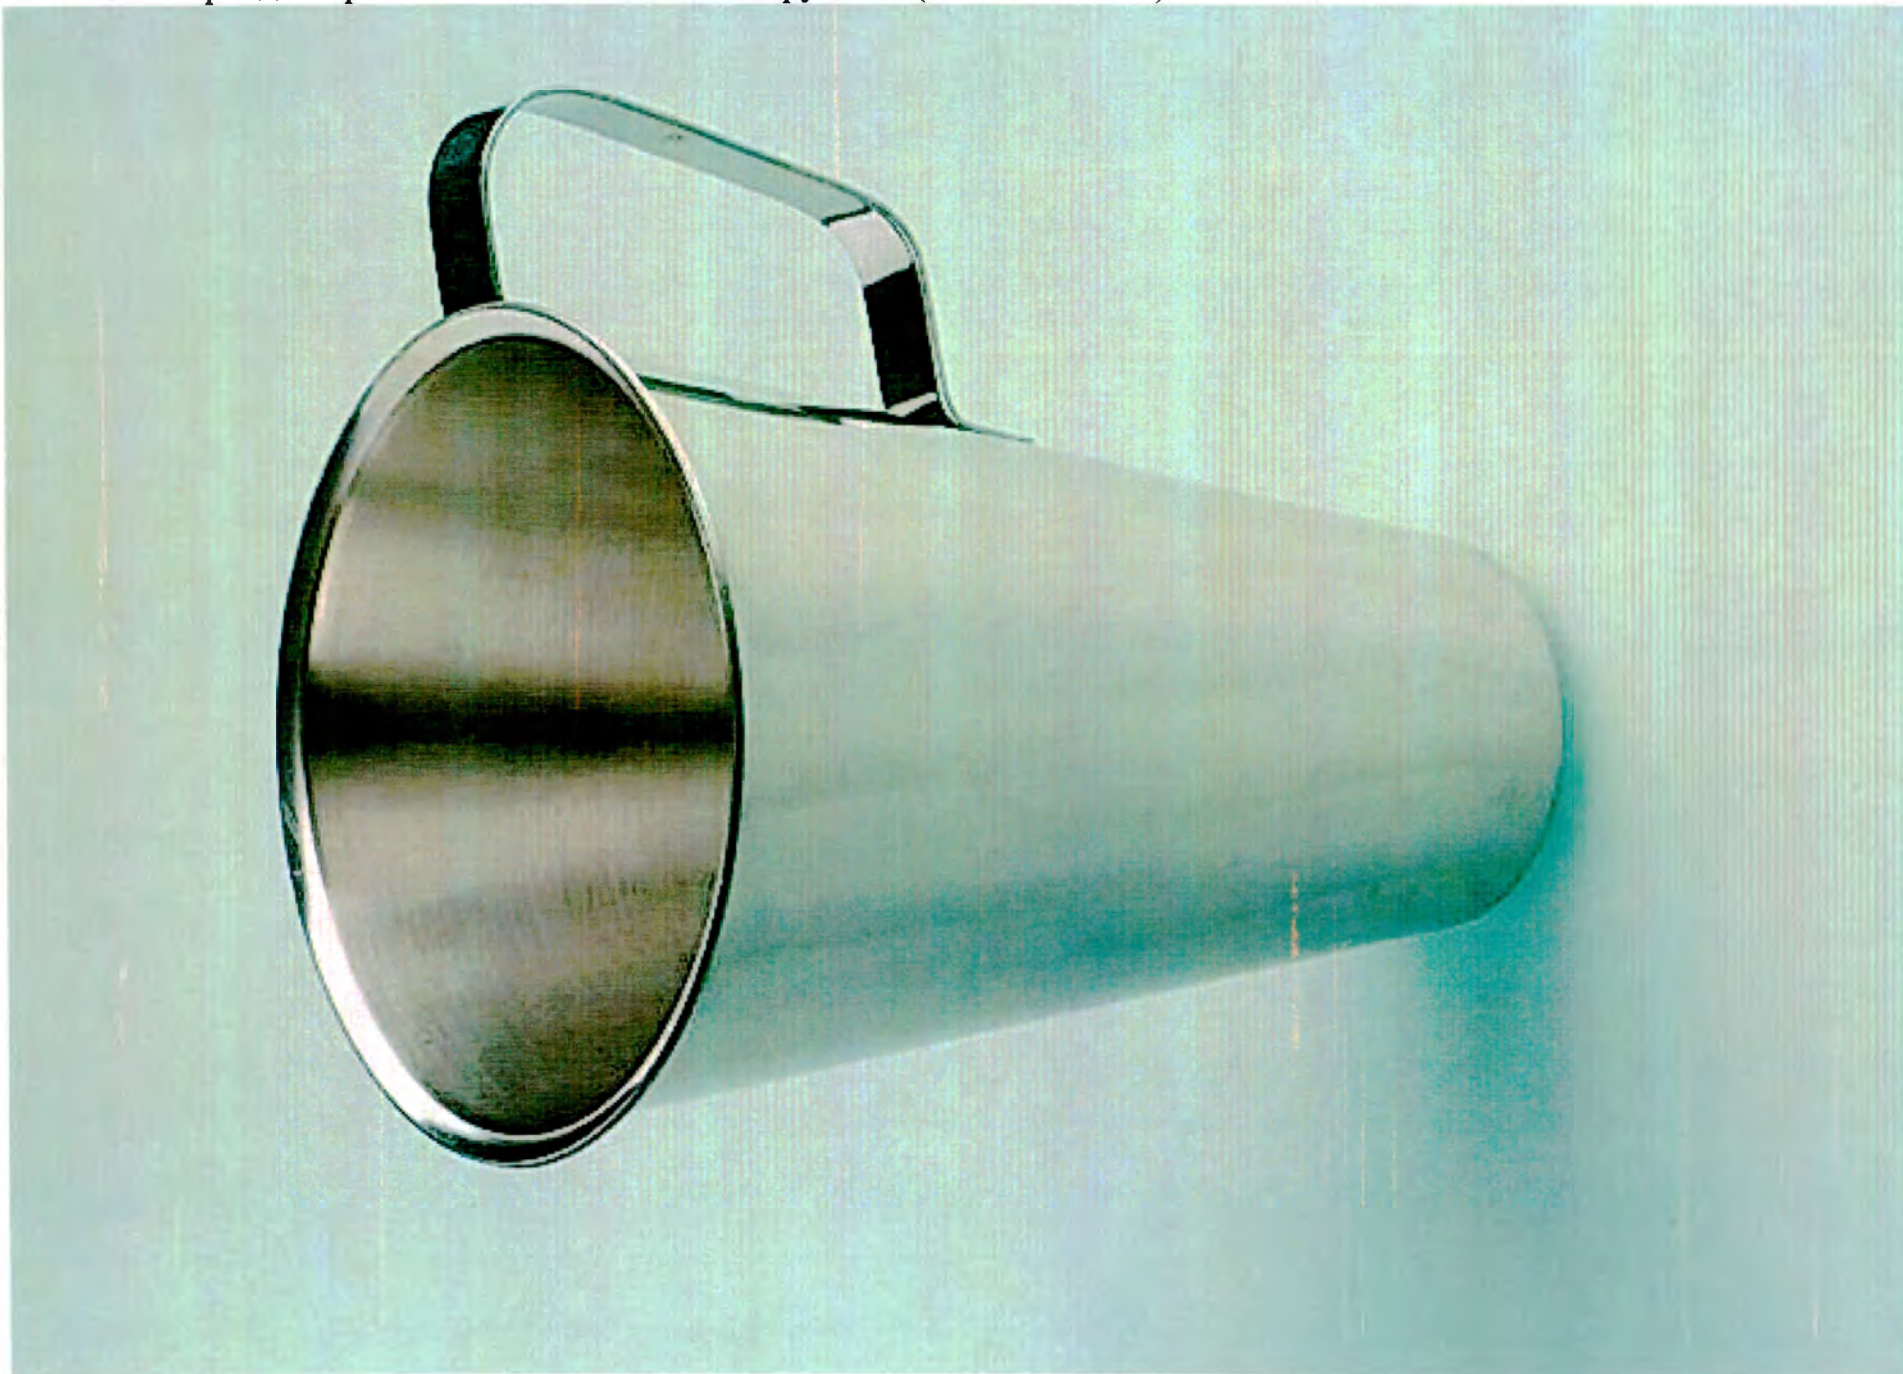


14. Держатели для контейнера (не более 6 шт.).

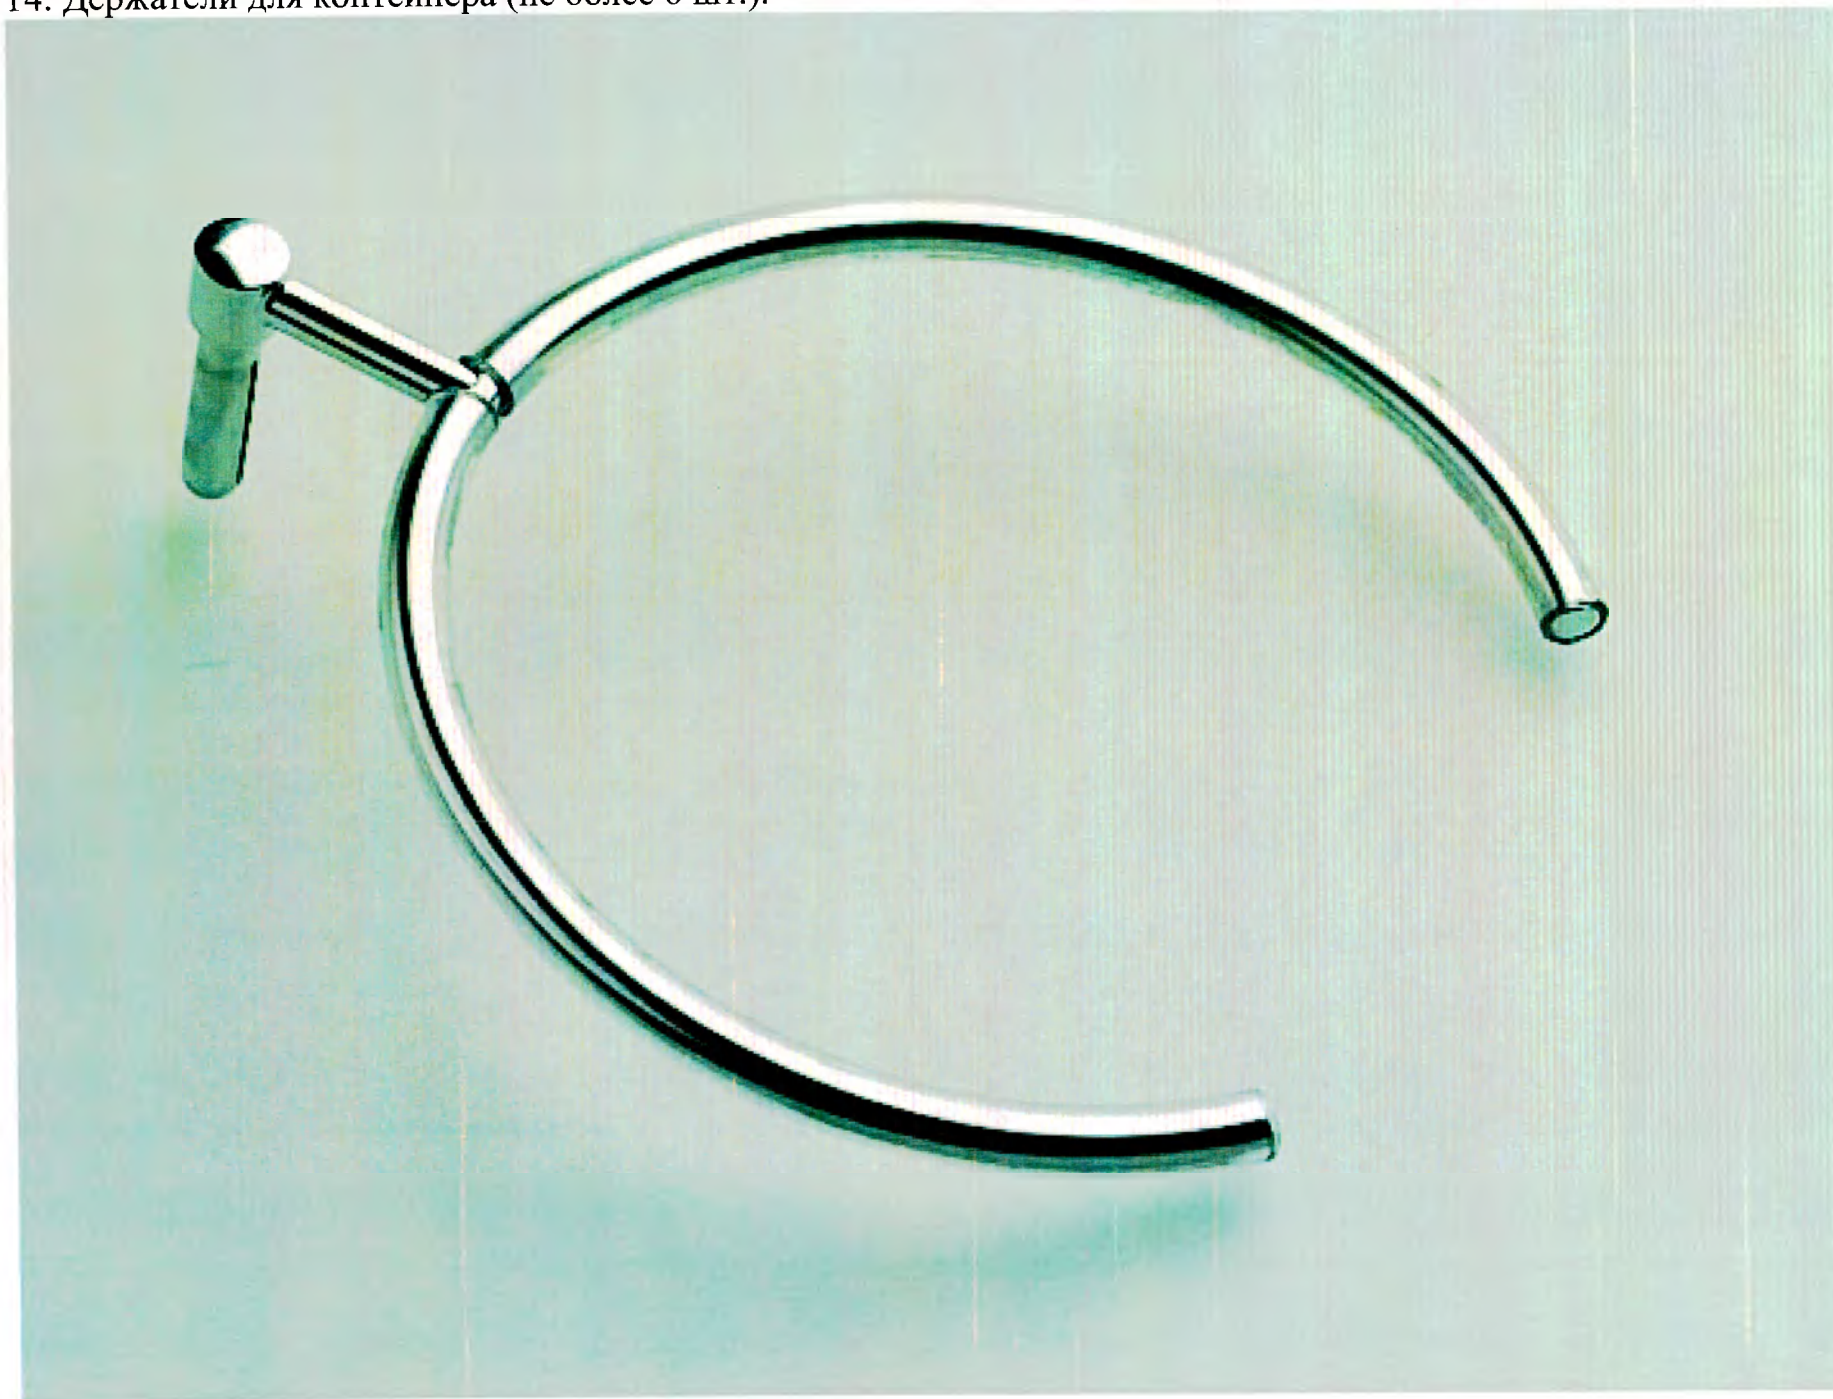

15. Держатели для масок (не более 4 шт.).

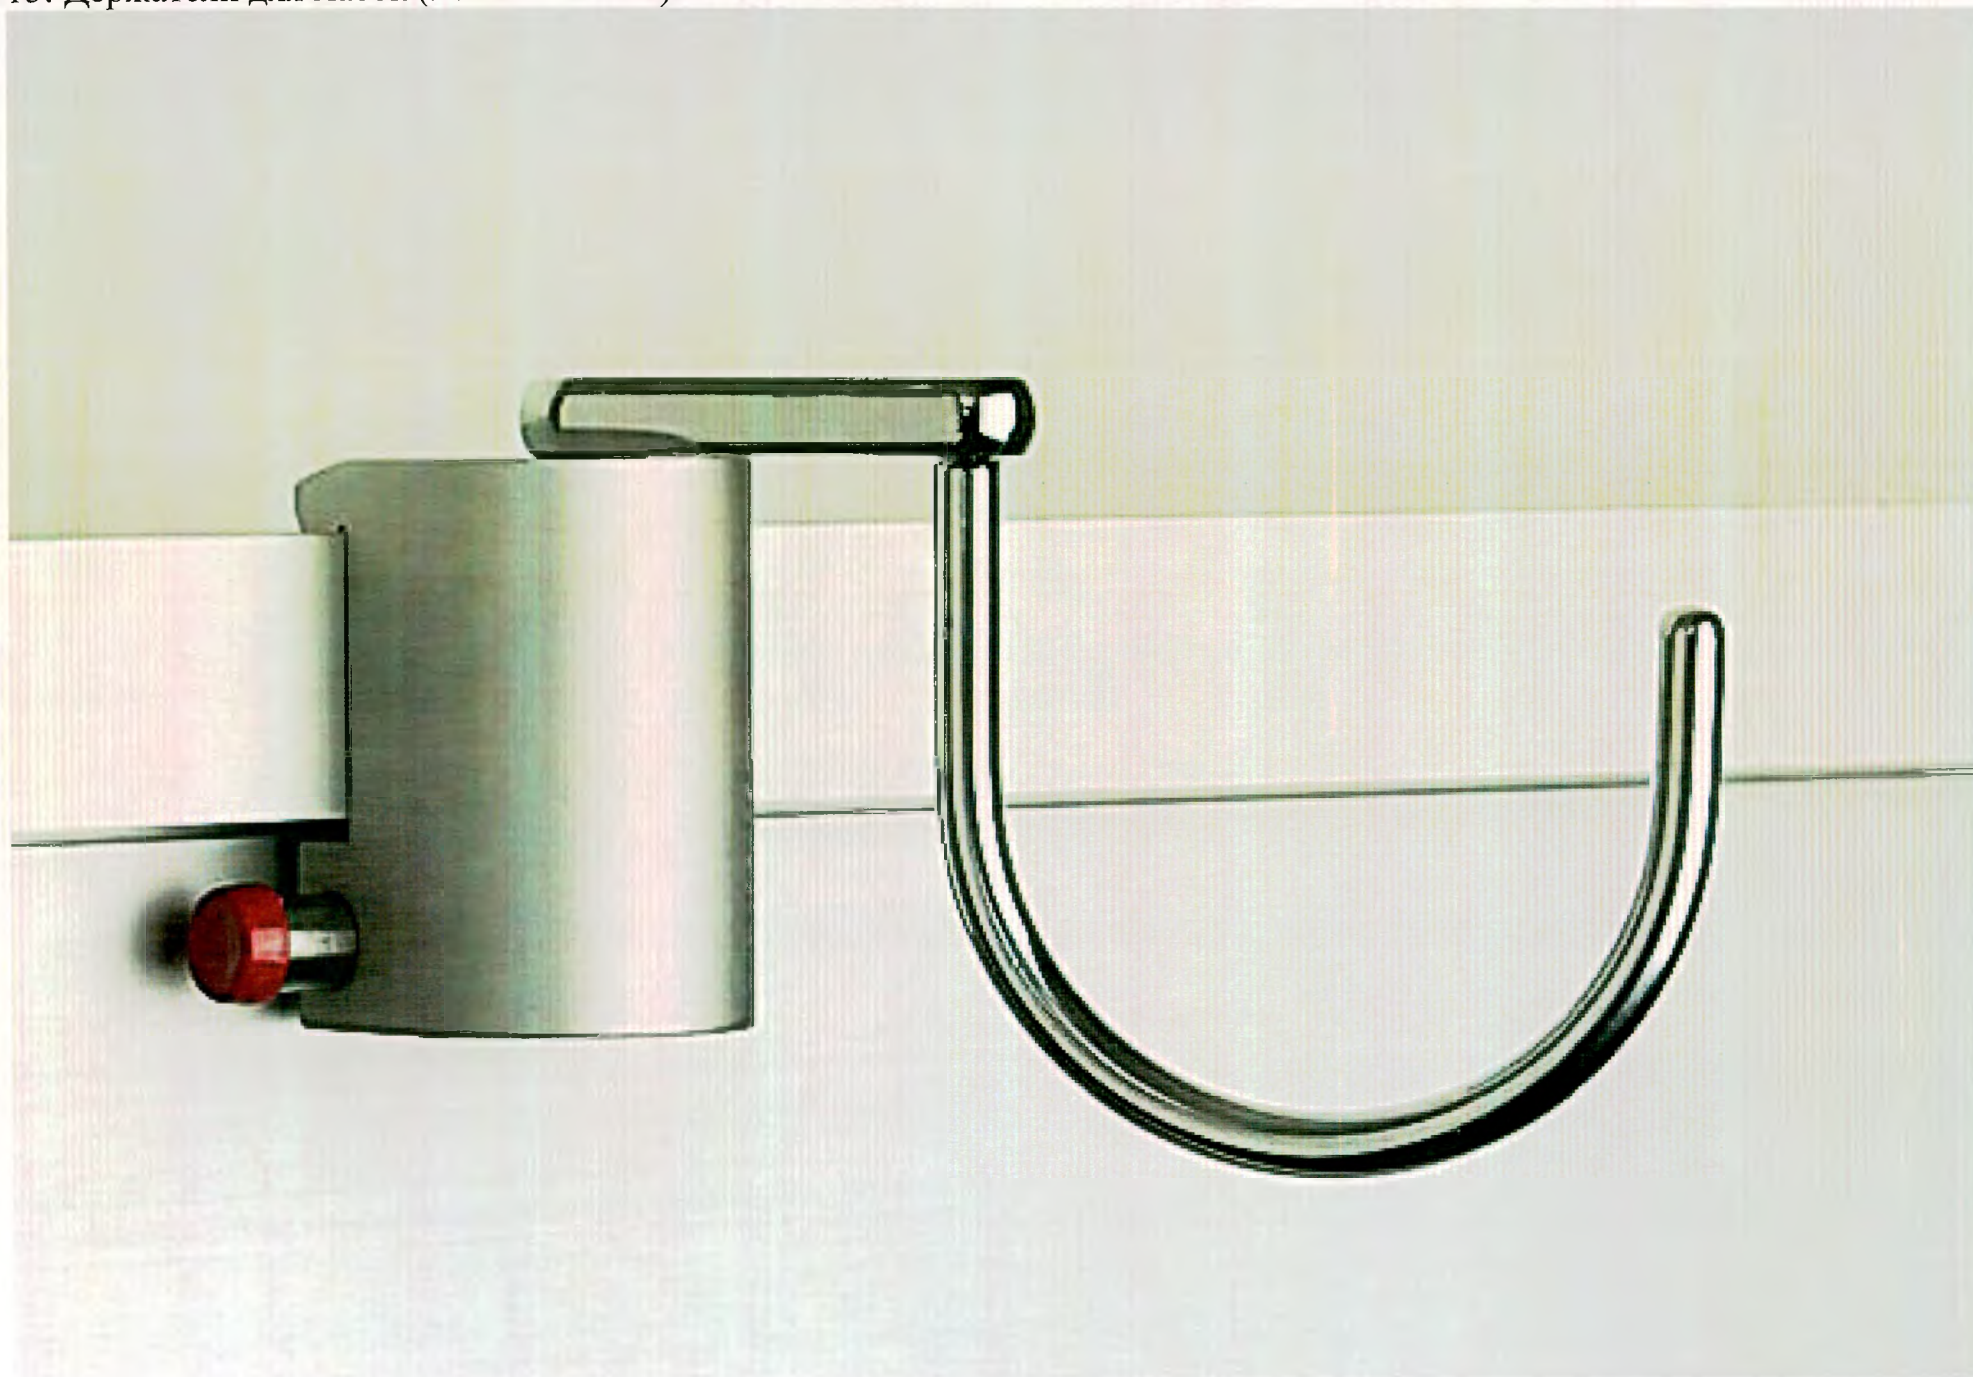


16. Фильтры для абсорберов (не более 2 уп./40 шт. в уп.).

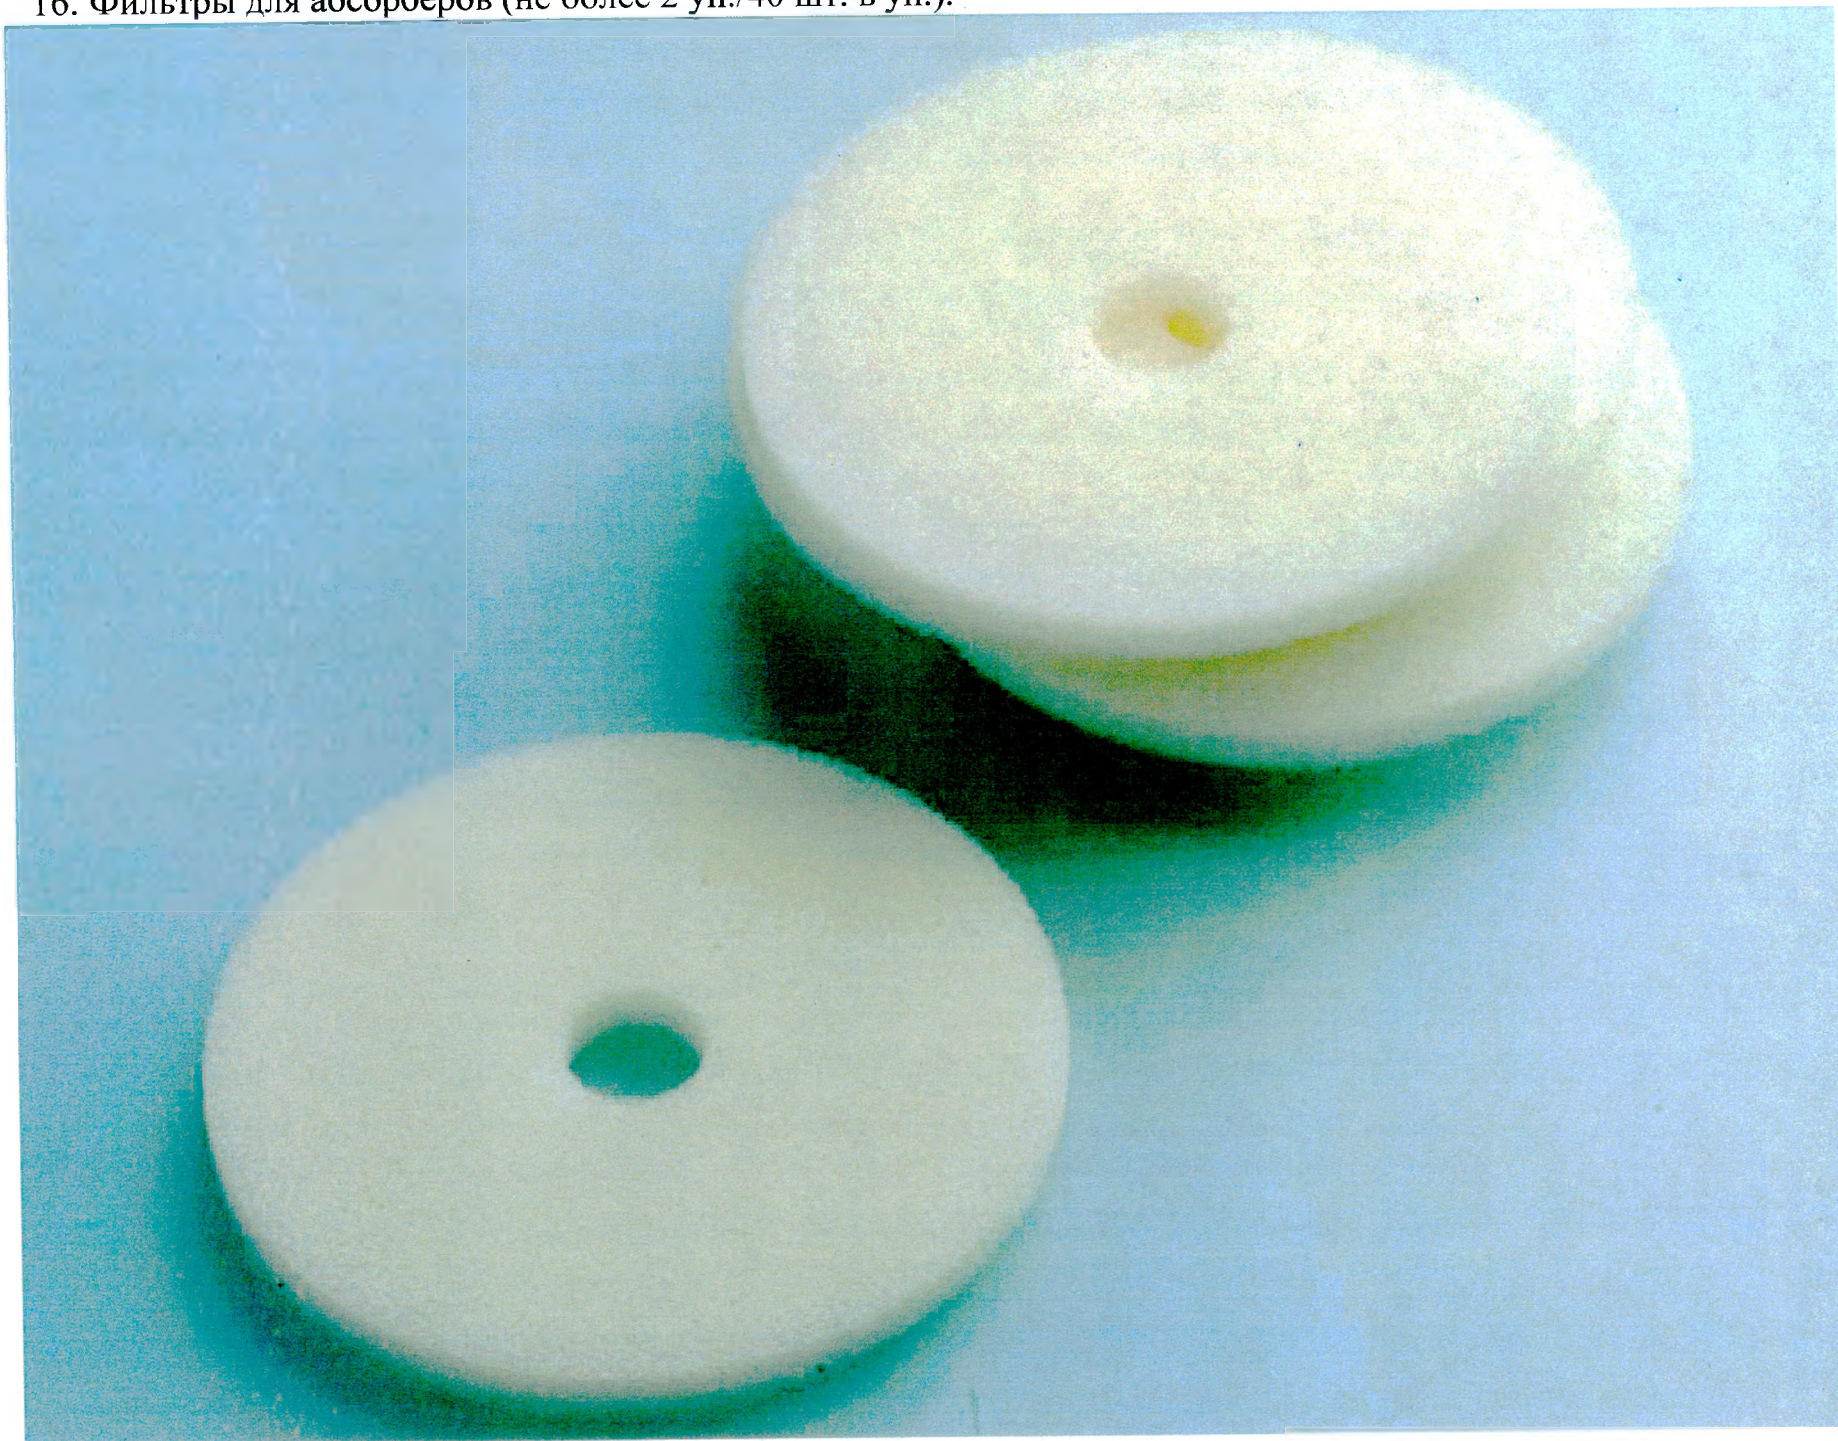


17.Смазка оксидная (не более 5 шт.).




18. Комплекты для спирометрии у взрослых пациентов для наркозных аппаратов Philips, 2м: трубка со встроенным датчиком (не более 4 уп./20 шт. в уп.).

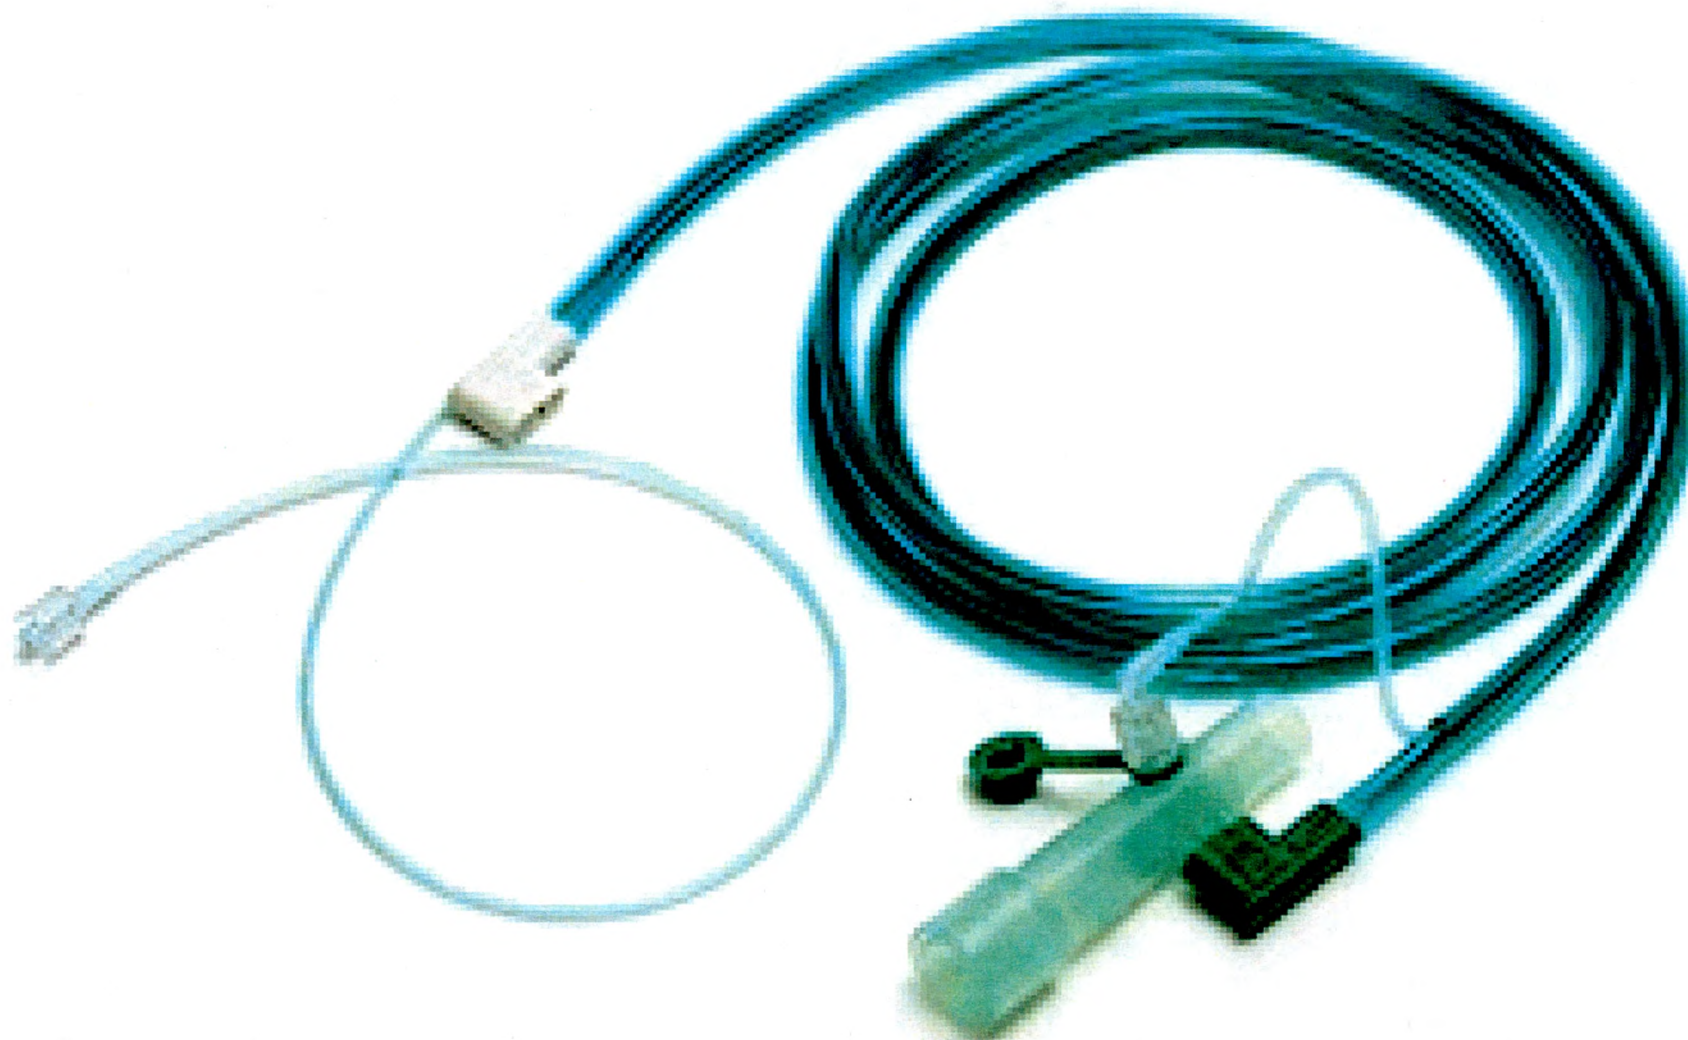

19. Комплекты для спирометрии у взрослых пациентов для наркозных аппаратов Philips, 3м: трубка со встроенным датчиком (не более 4 уп./20 шт. в уп.).

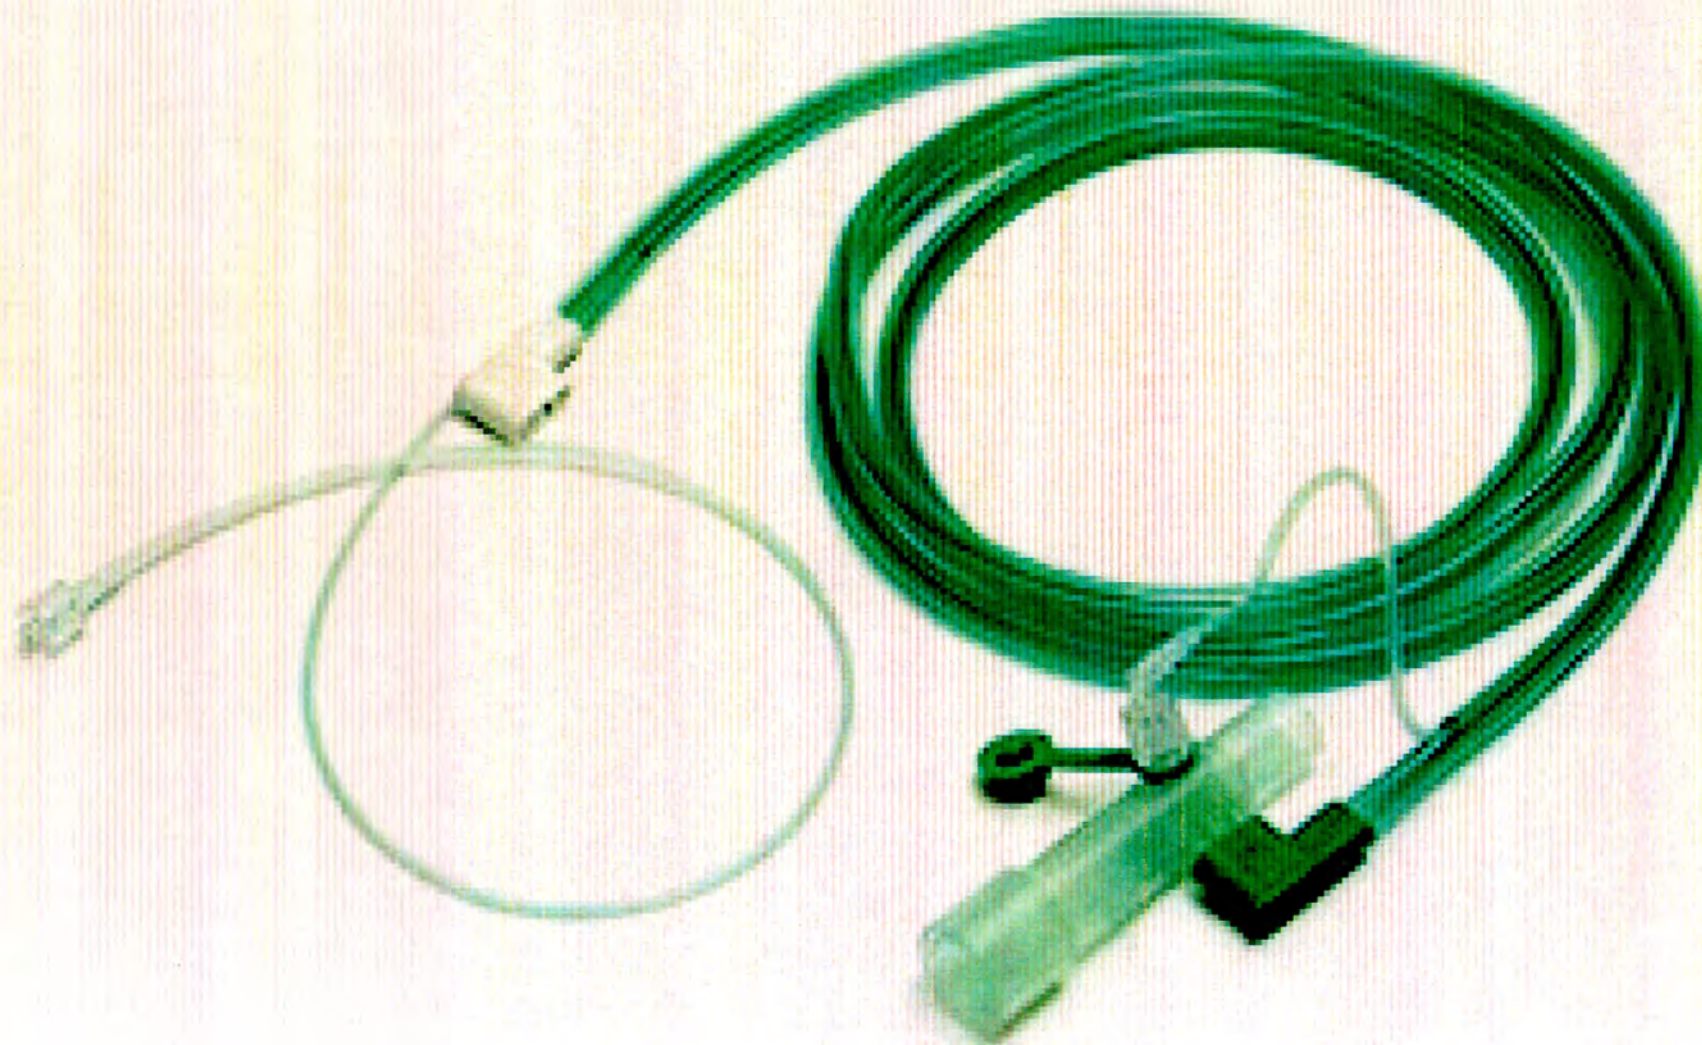

20. Комплекты для спирометрии у взрослых пациентов для наркозных аппаратов Philips, 6м: трубка со встроенным датчиком (не более 4 уп./25 шт. в уп.).

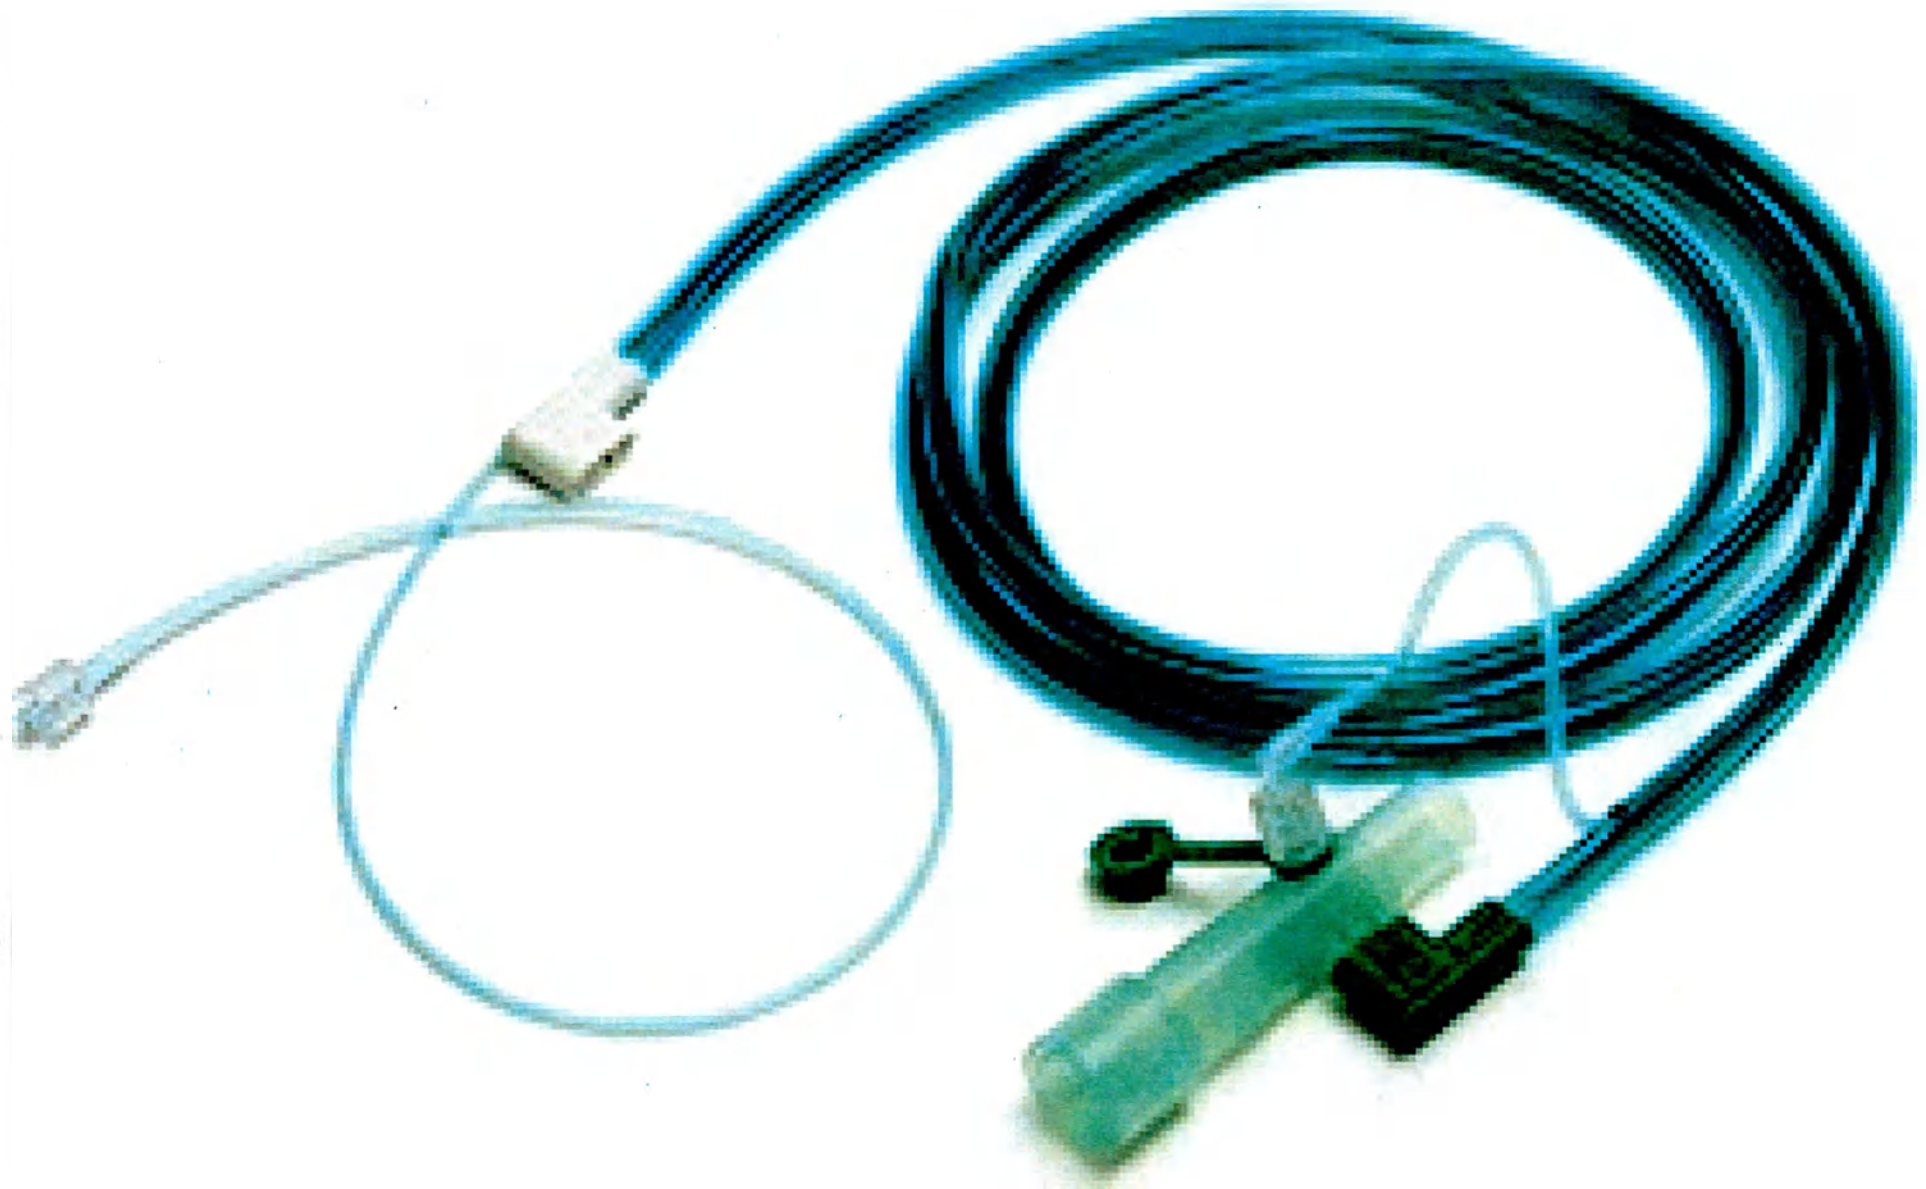

21. Комплекты для спирометрии у детей для наркозных аппаратов Philips, 2м: трубка со встроенным датчиком (не более 4 уп./20 шт. в уп.).



22. Комплекты для спирометрии у детей для наркозных аппаратов Philips, 3м: трубка со встроенным датчиком (не более 4 уп./20 шт. в уп.).



23. Комплекты для спирометрии у детей для наркозных аппаратов Philips, 6м: трубка со встроенным датчиком (не более 4 уп./25 шт. в уп.).




24. Датчики потока для взрослых D-LITE, одноразовые (не более 3 уп./25 шт. в уп.).




25. Датчики потока для детей PEDI-LITE, одноразовые (не более 3 уп./25 шт. в уп.).



26. Датчики потока для взрослых пациентов, для наркозных аппаратов Philips, многоразовые (не более 8 уп./25 шт. в уп.).

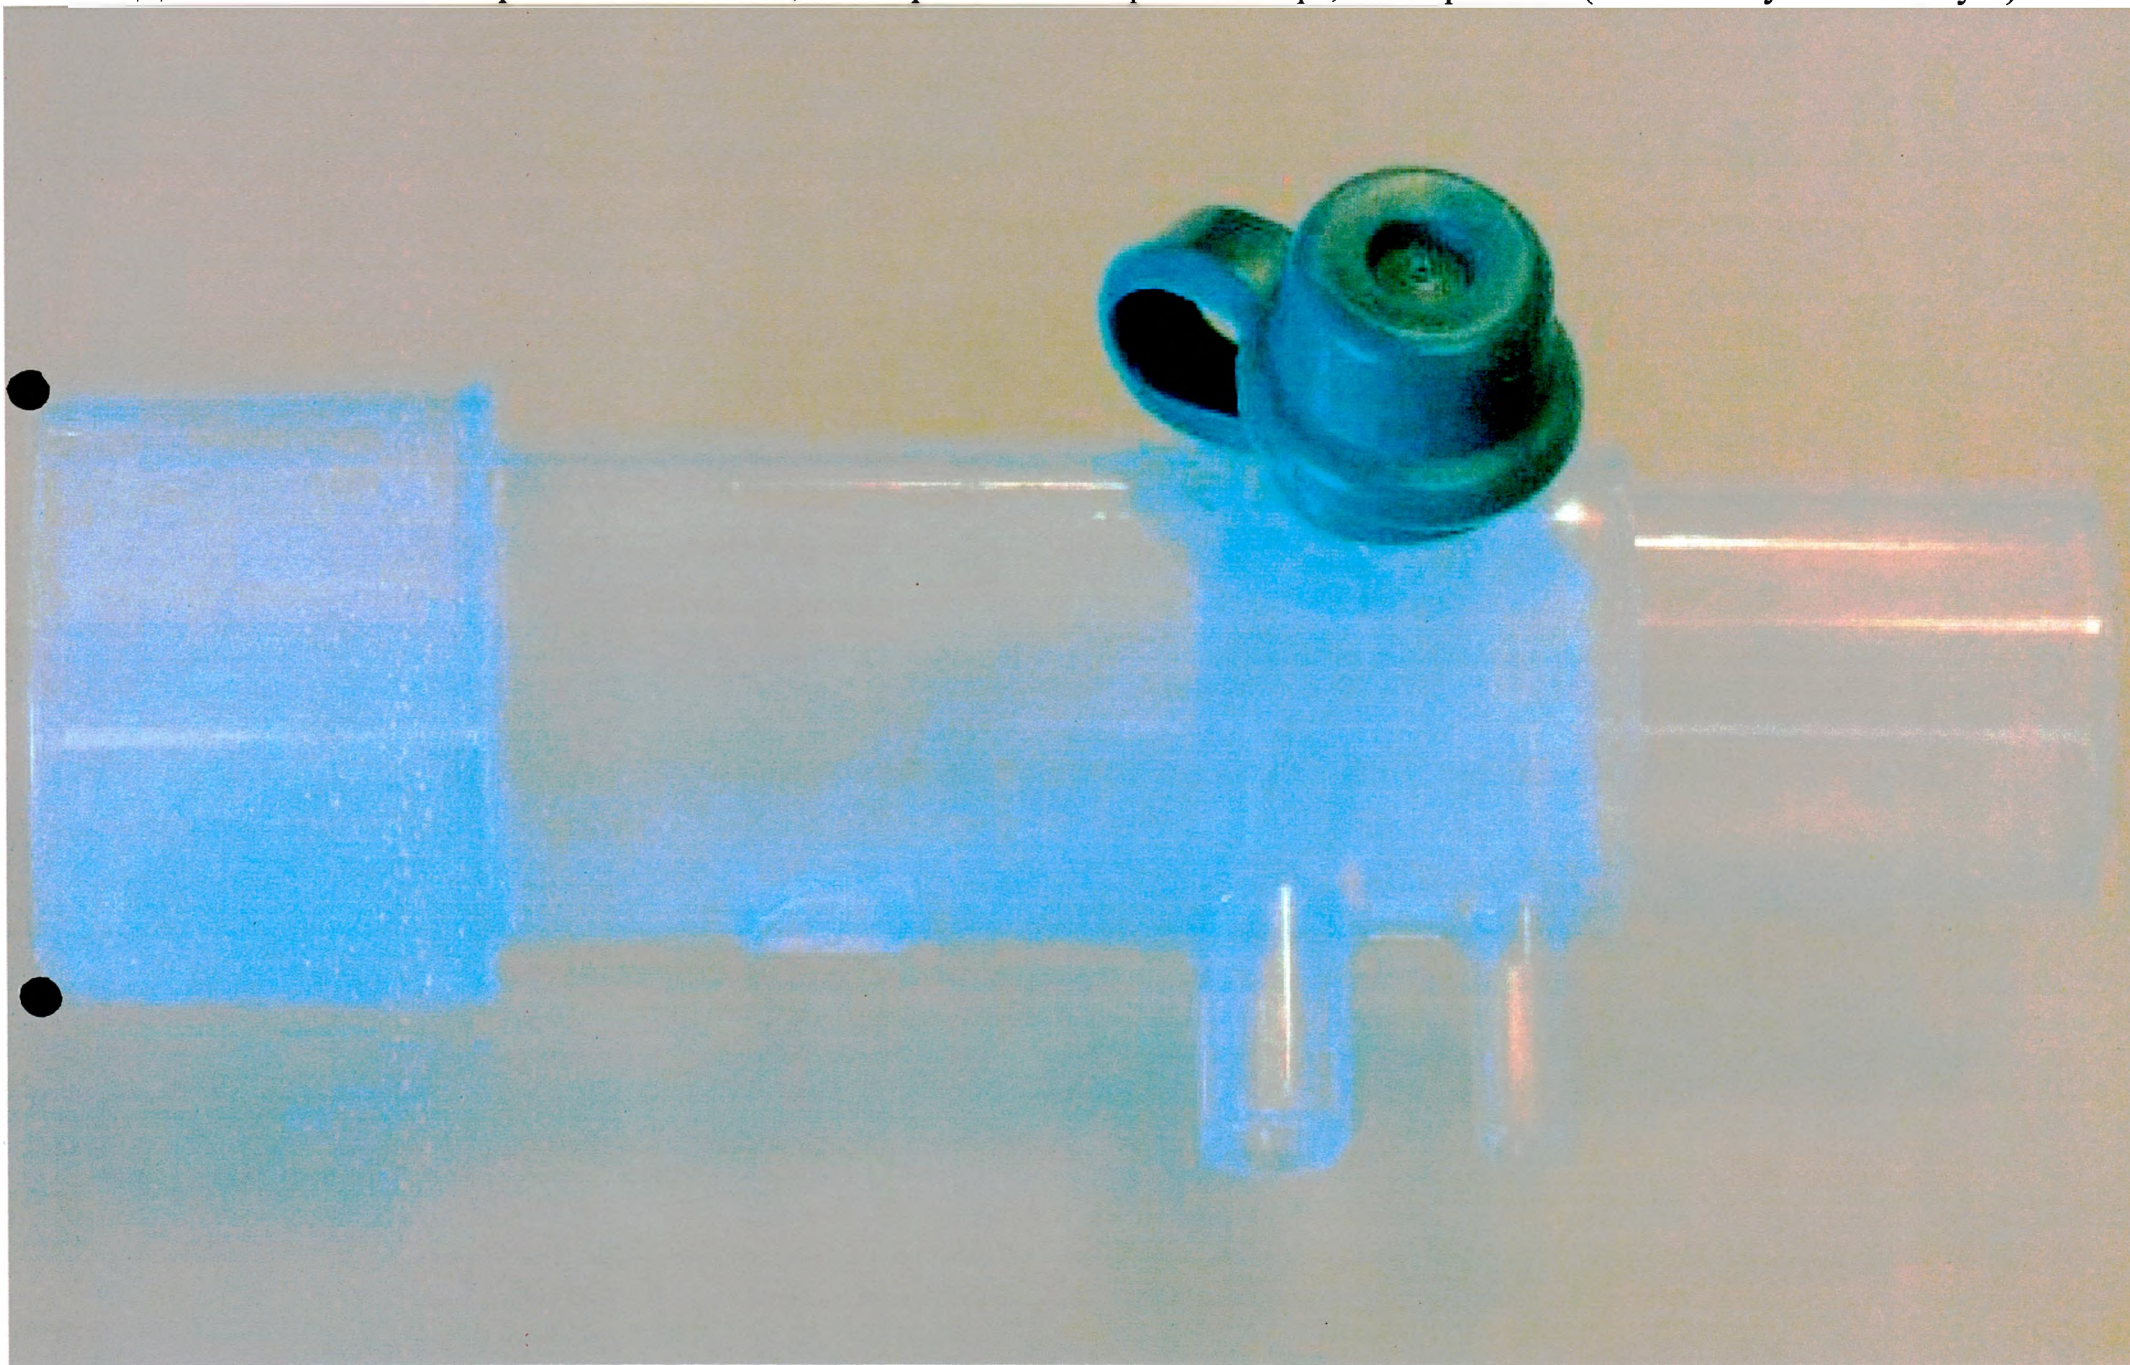

27. Датчики потока для детей, для наркозных аппаратов Philips, многоразовые (не более 8 уп./25 шт. в уп.).

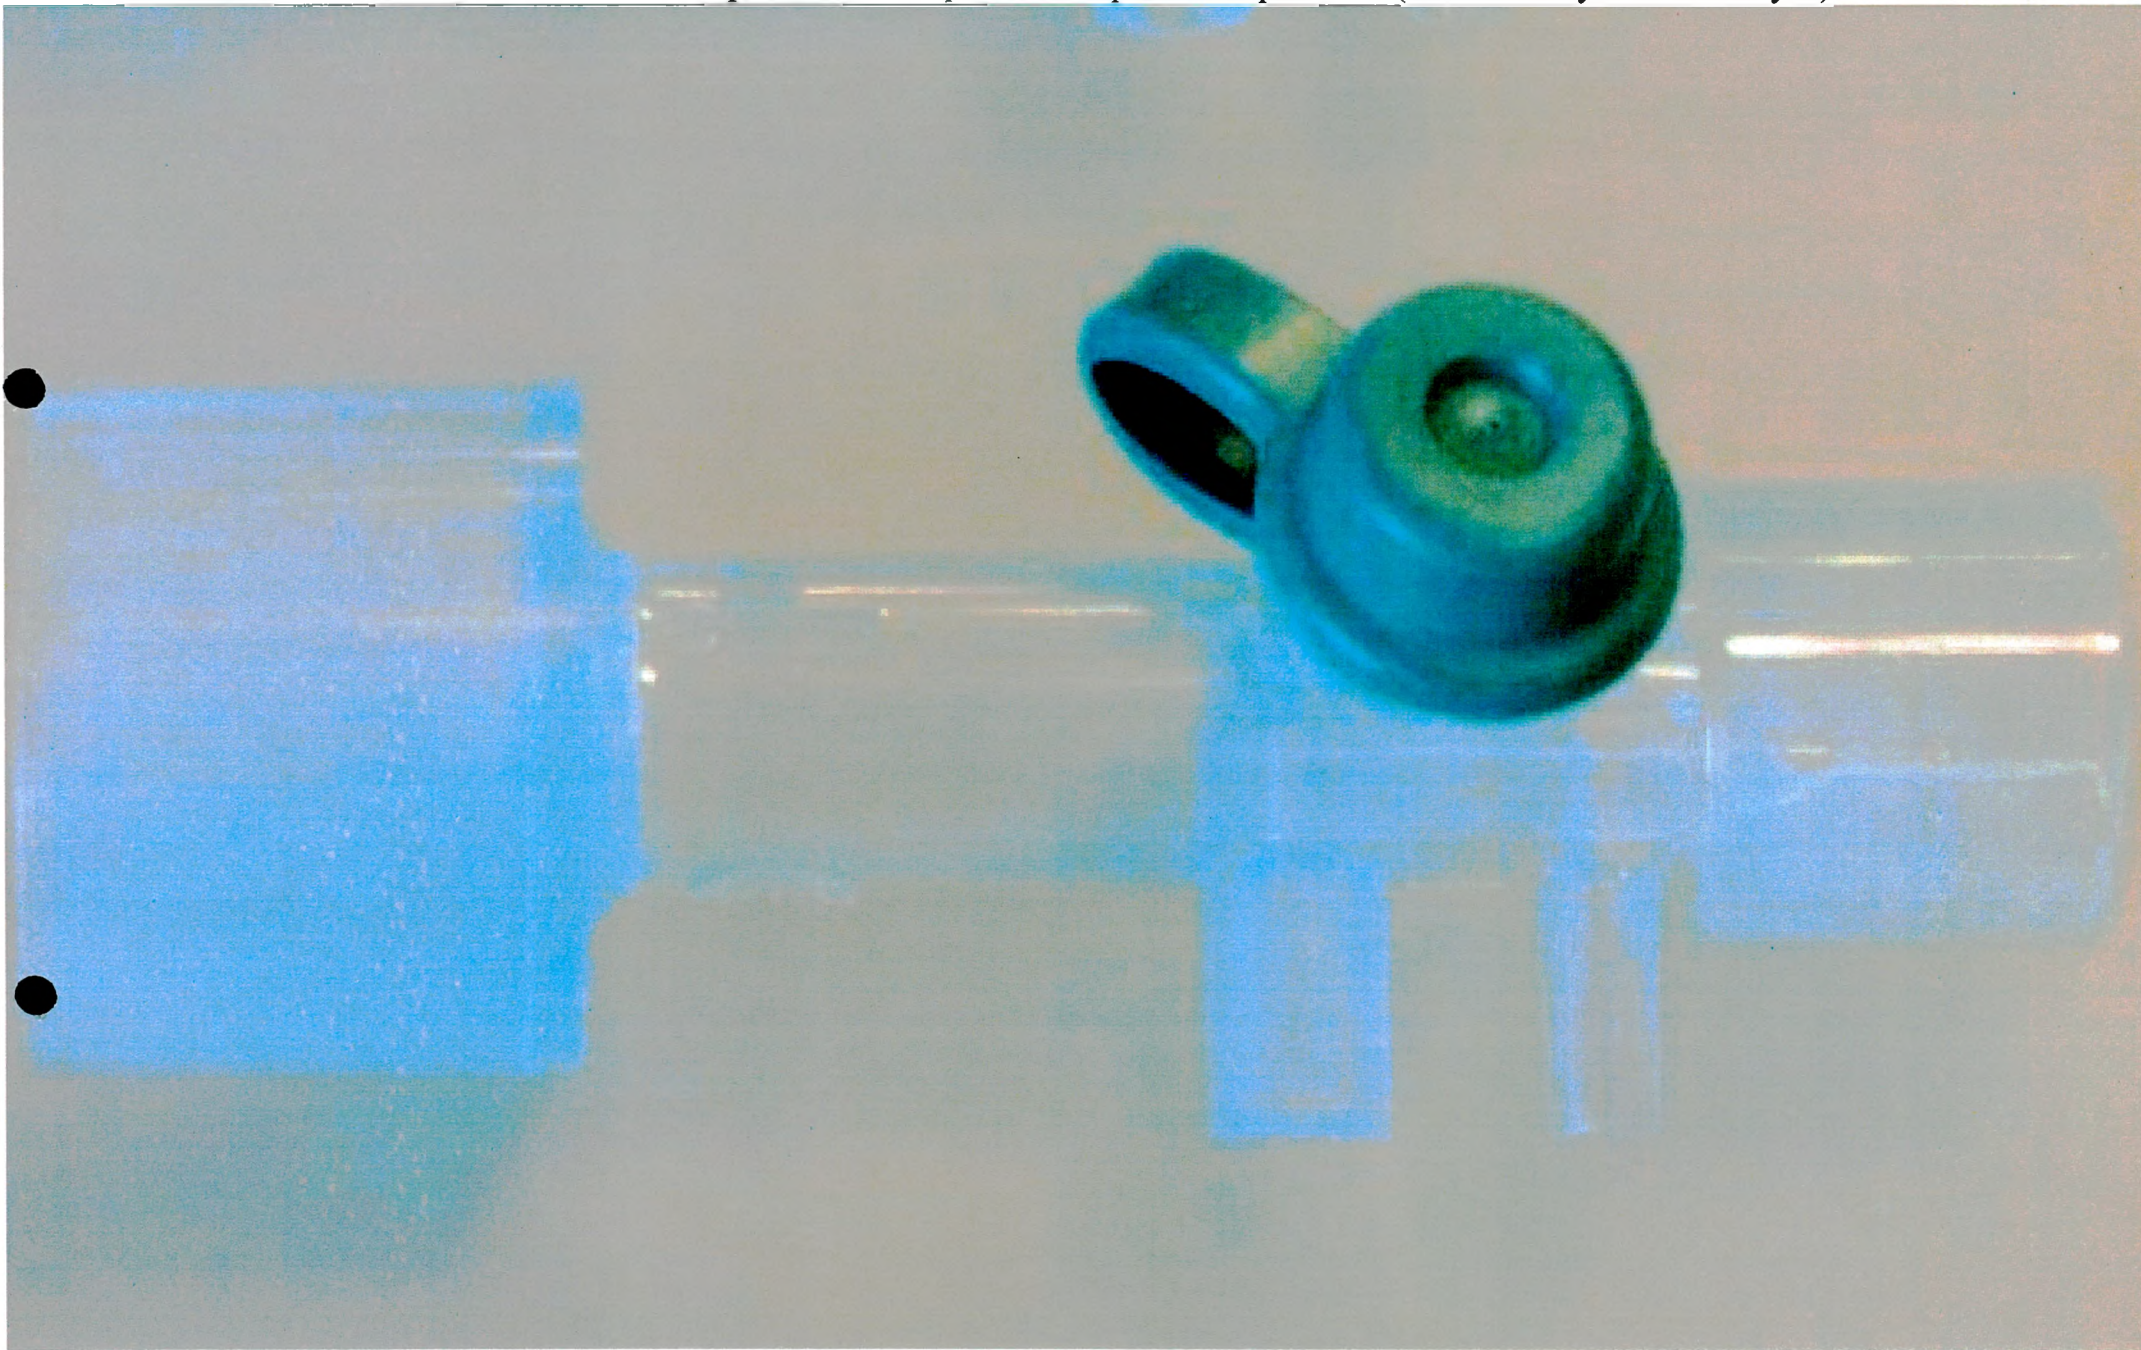


28.Переходники для кислородного датчика (не более 8 шт.).




29. Фильтры бактериальные, одноразовые (не более 2 уп./50 шт. в уп.).




30. Водосборники (влагоуловители) многоразовые (не более 6 уп./10 шт. в уп.).

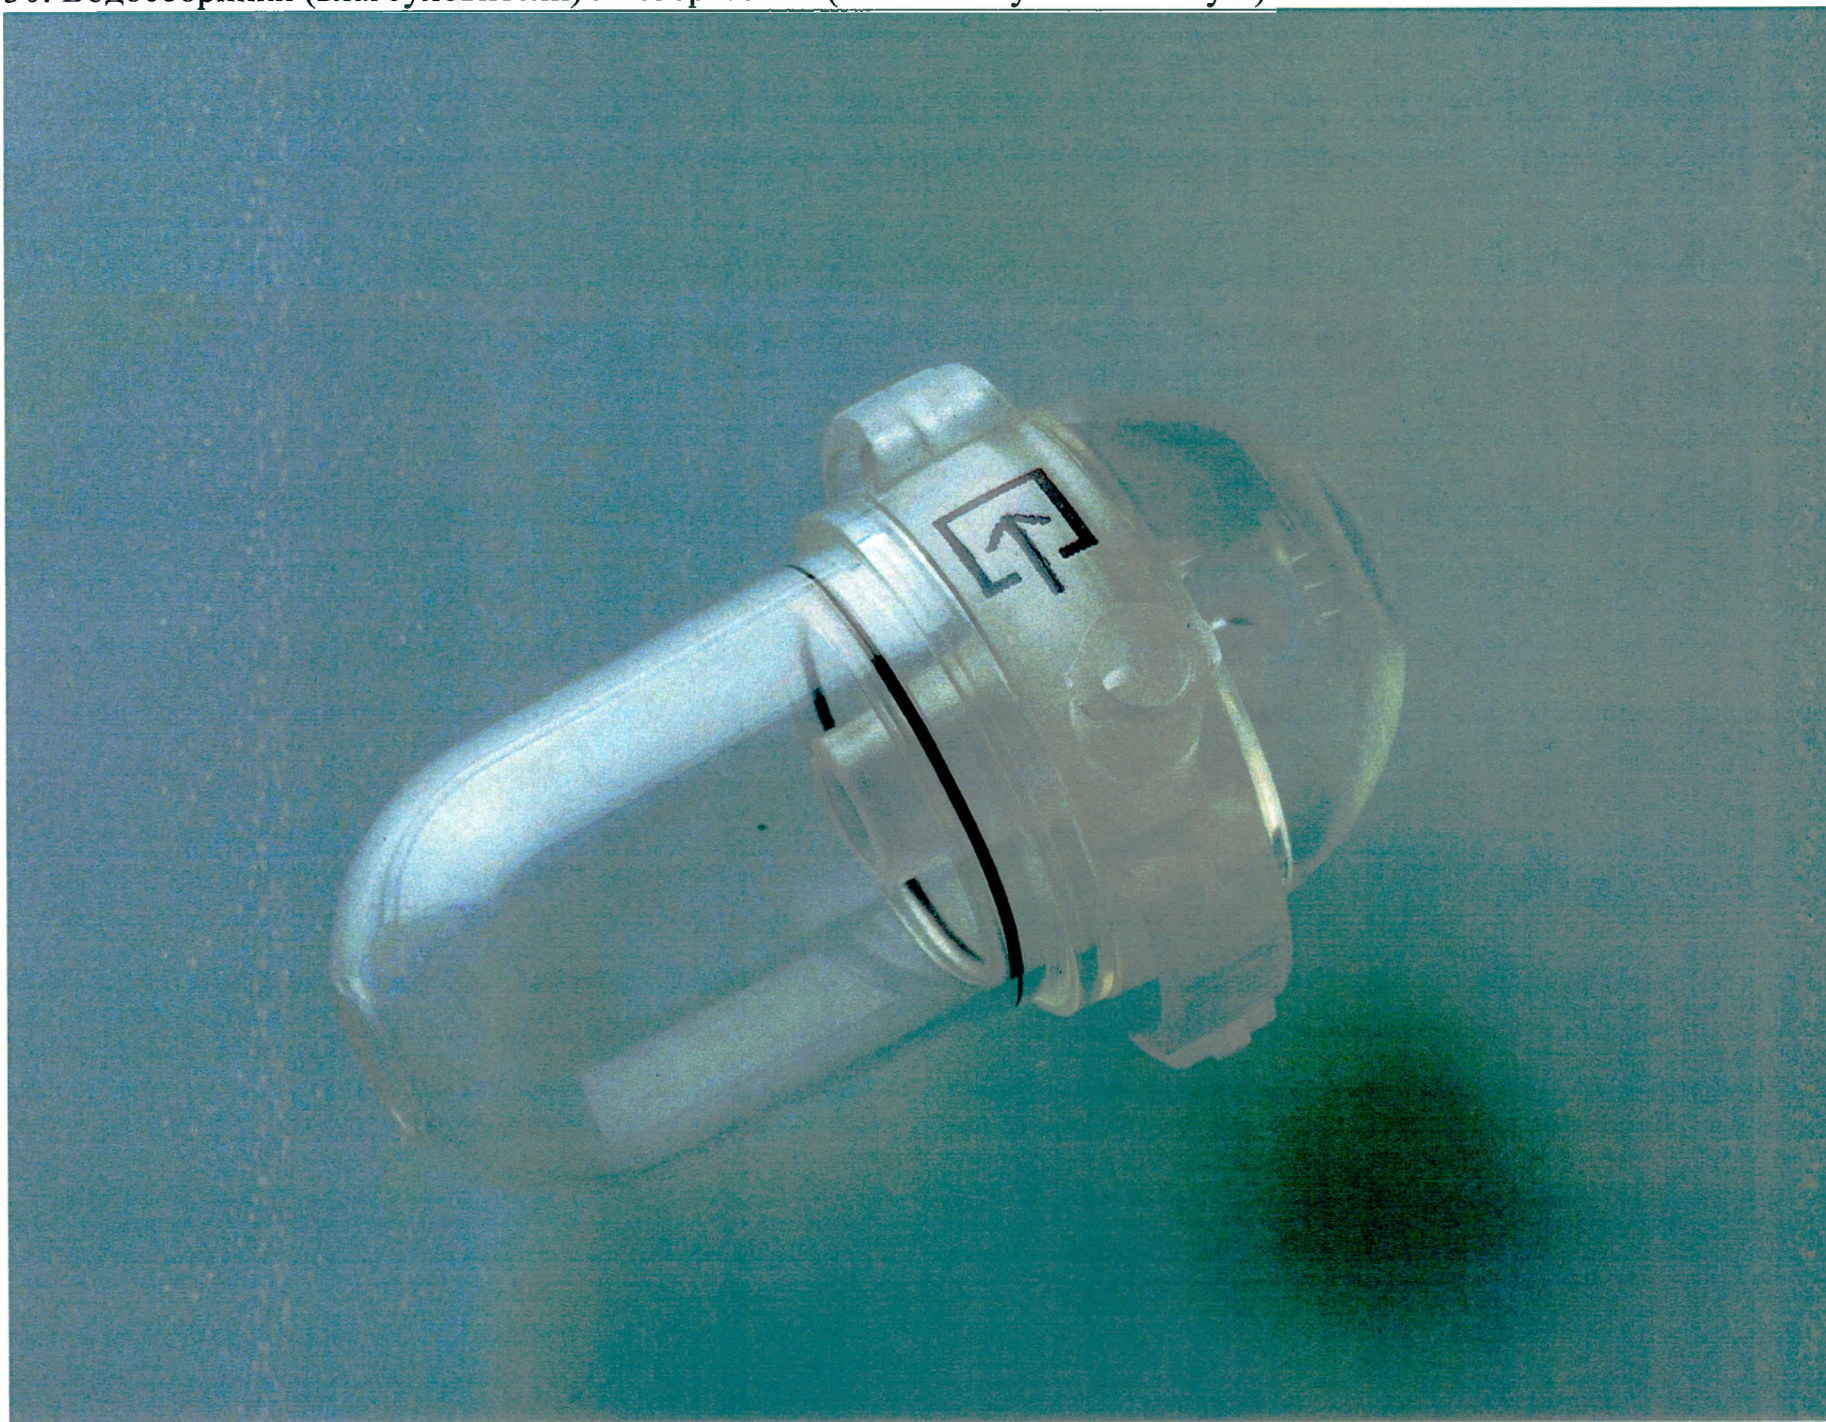

31. Трубки для газоанализа 2м (не более 2 уп./100 шт. в уп.).

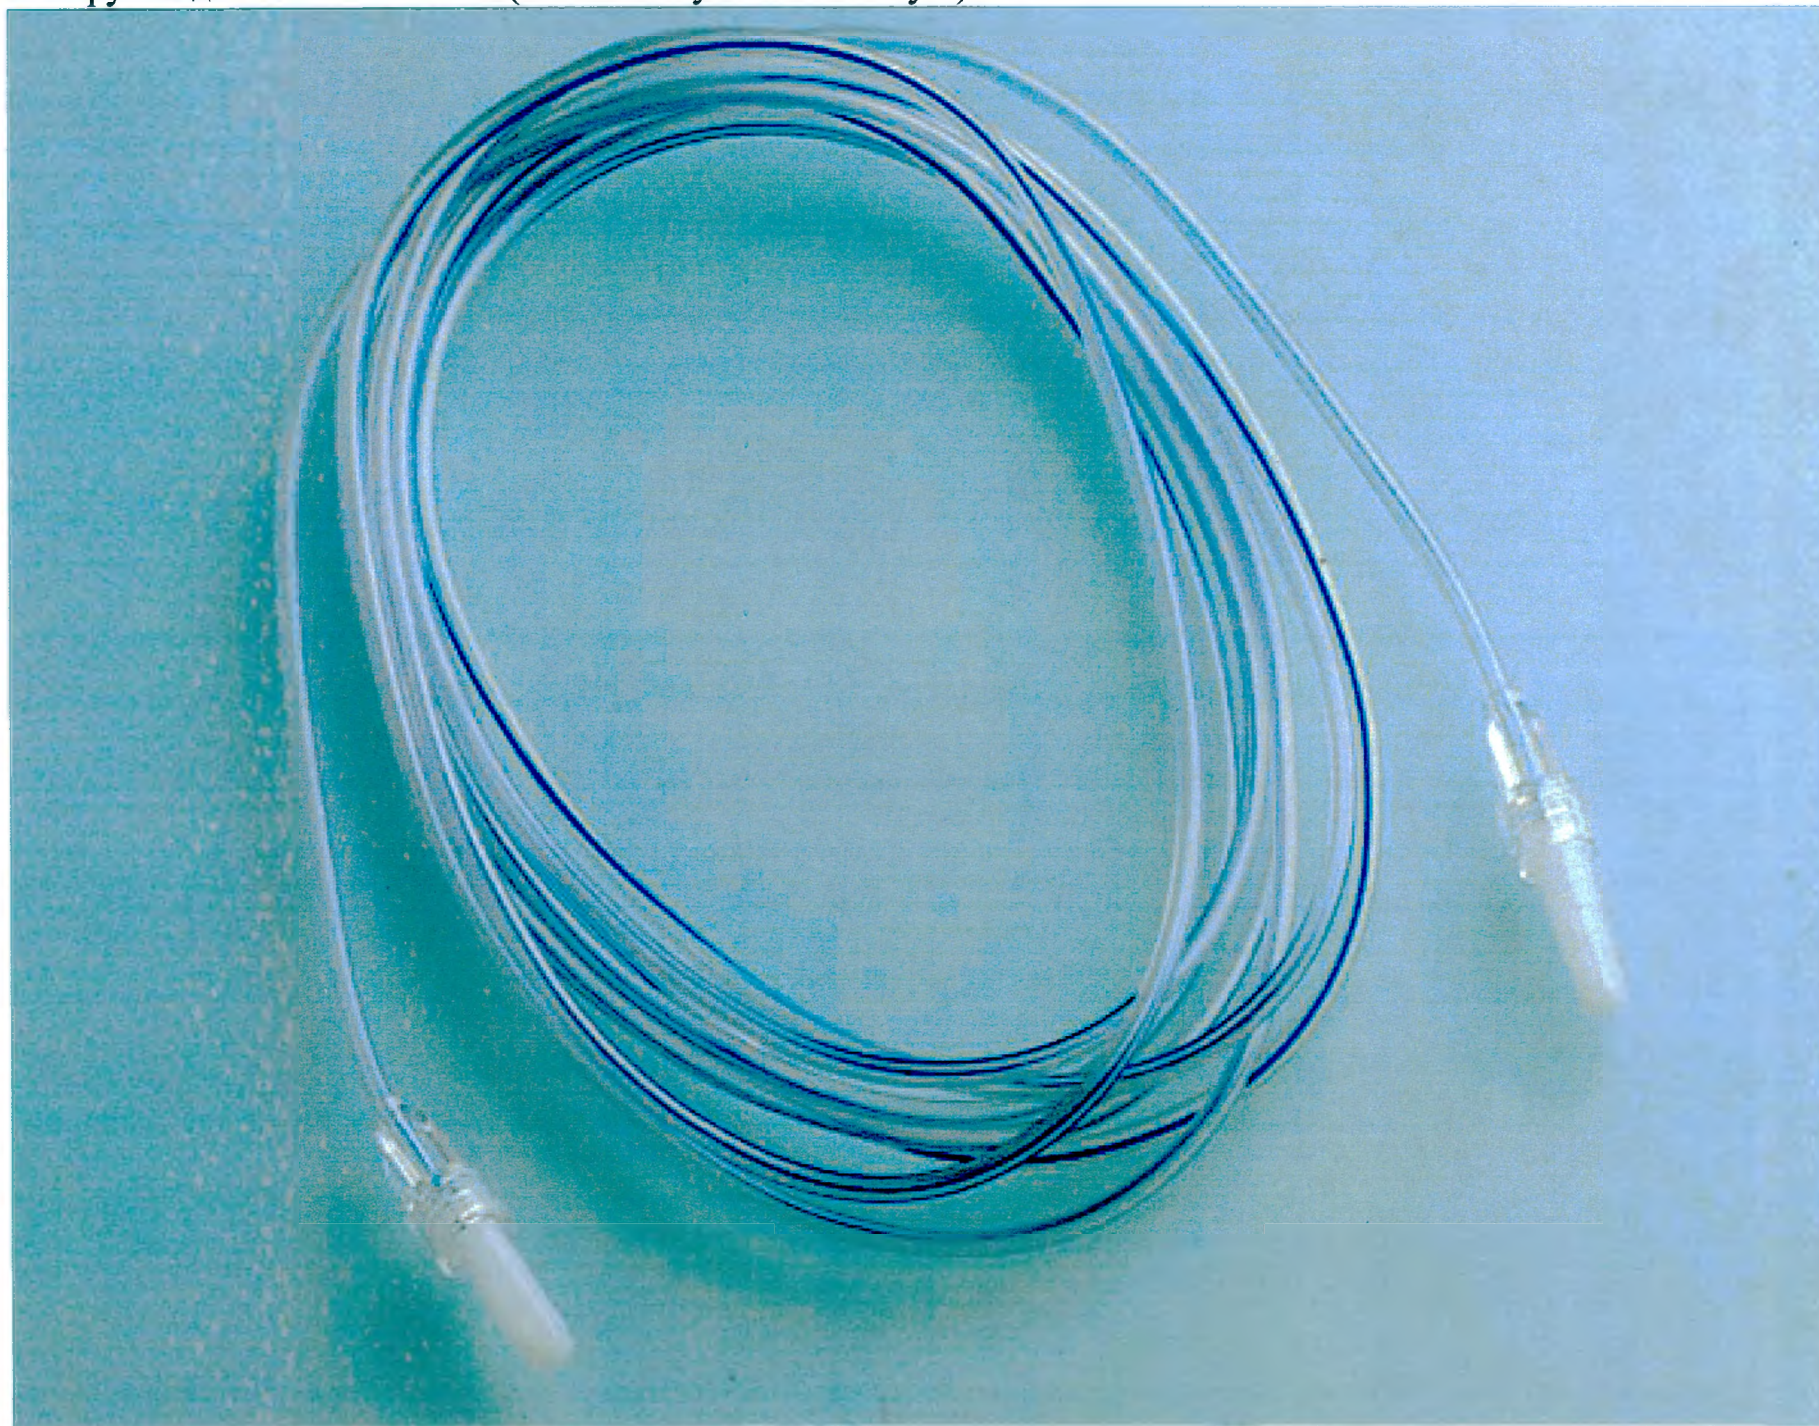


32. Трубки для газоанализа 2,5м (не более 2 уп./25 шт. в уп.).

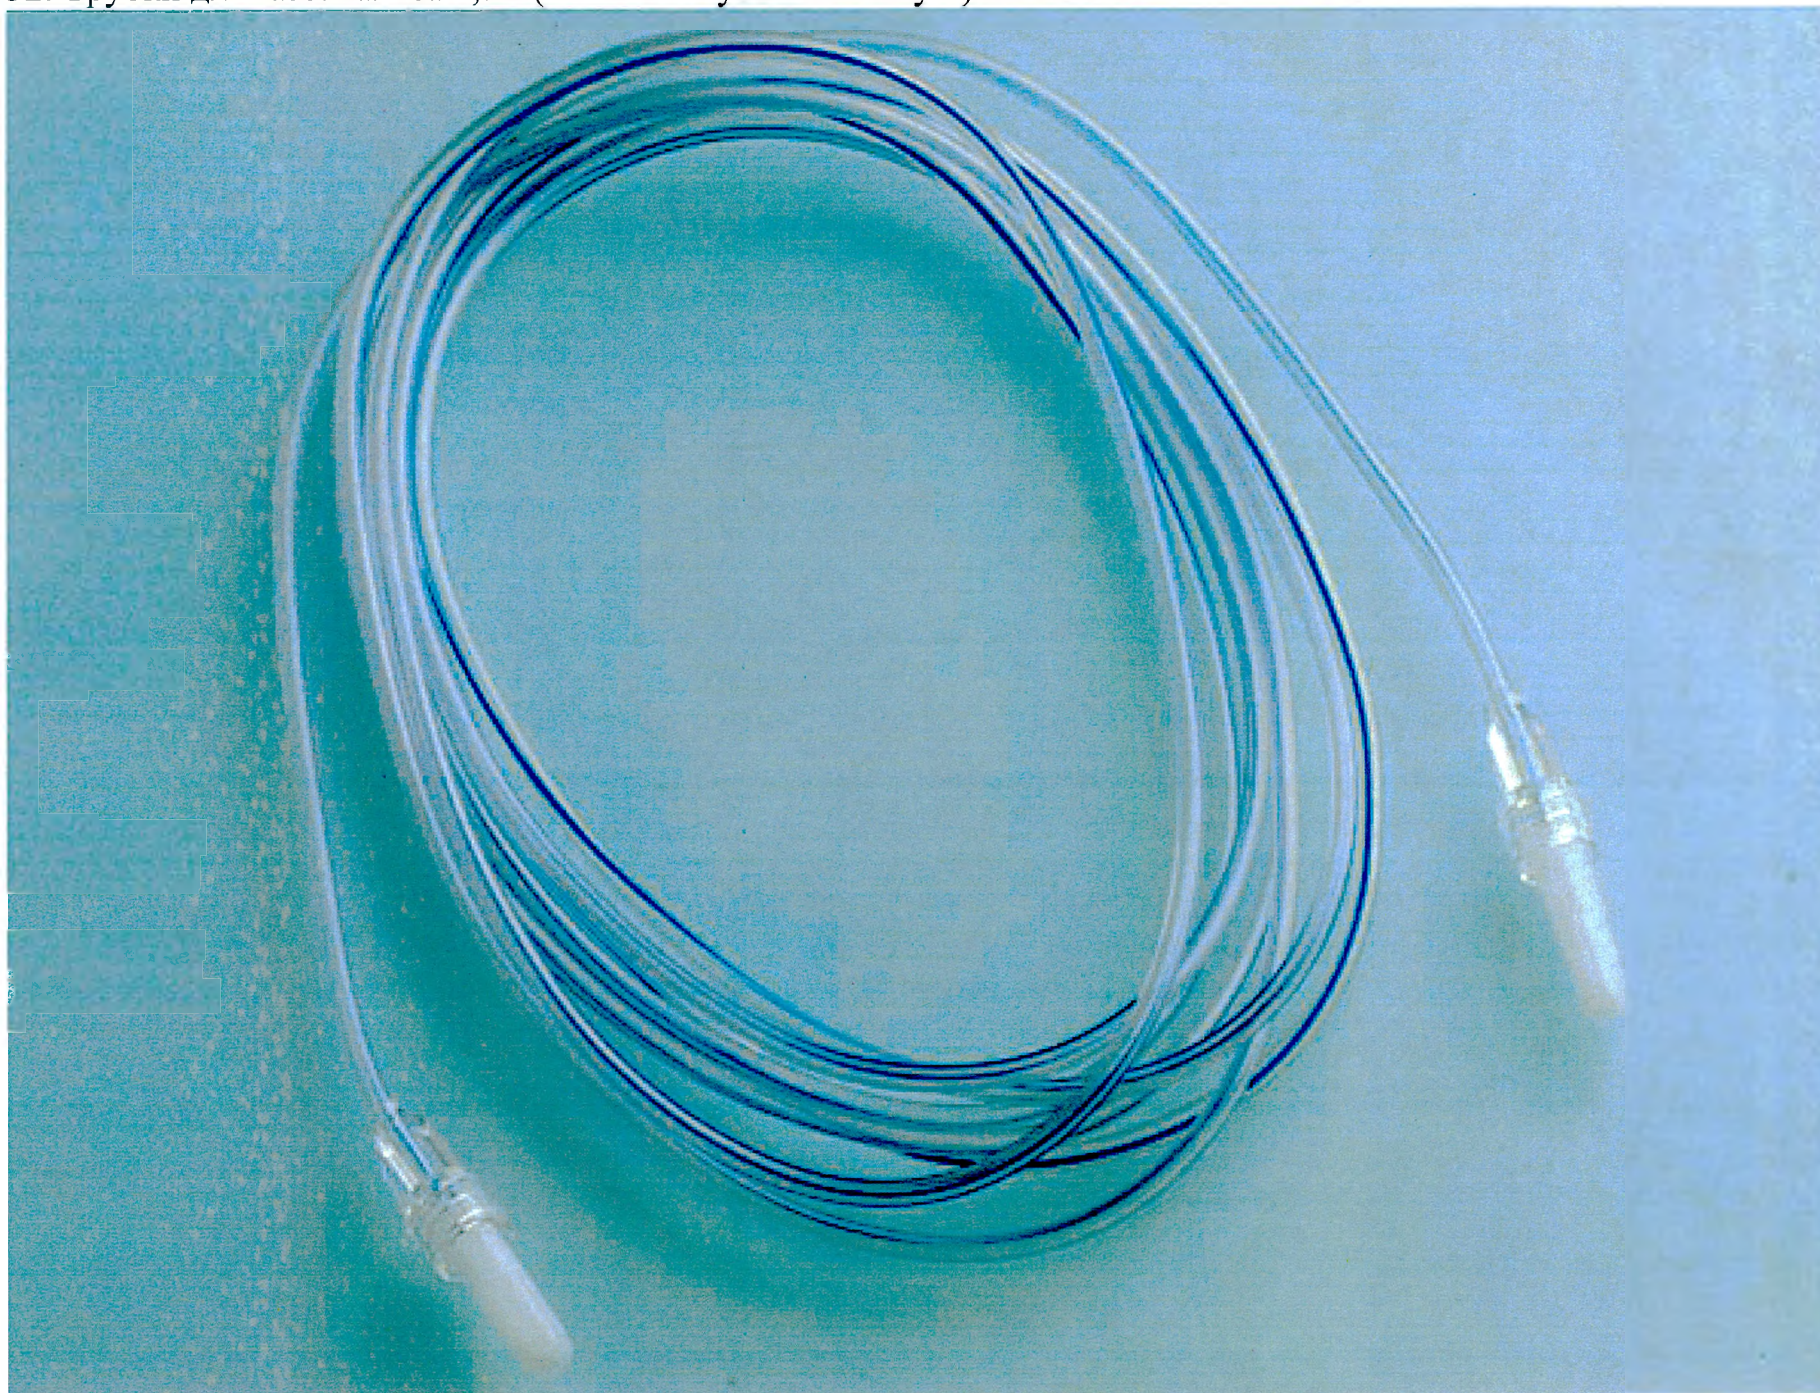


33. Трубки для спирометрии 2м (не более 8 уп./5 шт. в уп.).




34.Трубки для спирометрии 3м (не более 8 уп./5 шт. в уп.).

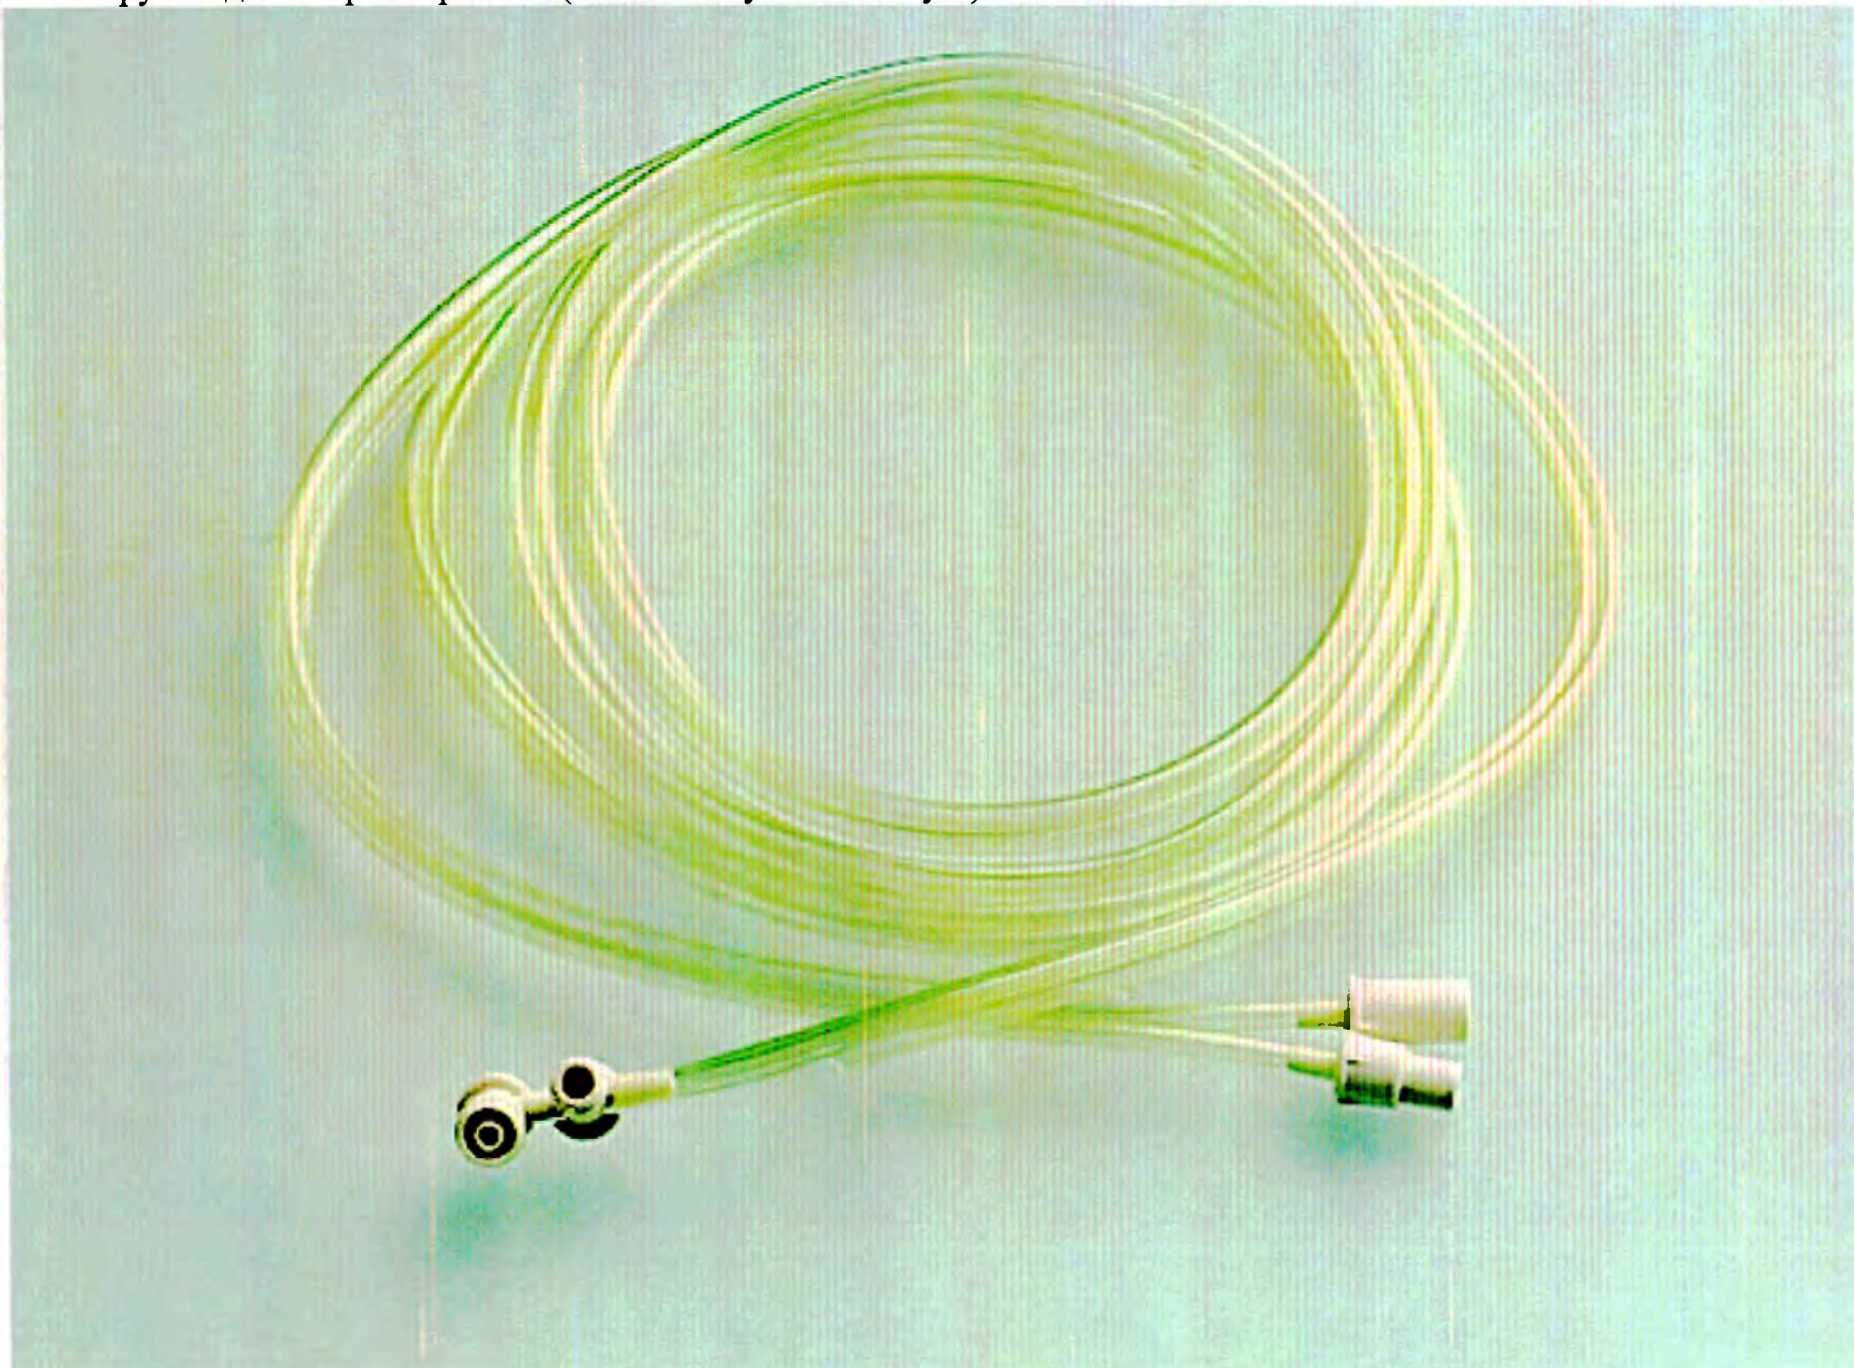

35. Трубки для встроенного аспиратора пациента (не более 5 шт.).

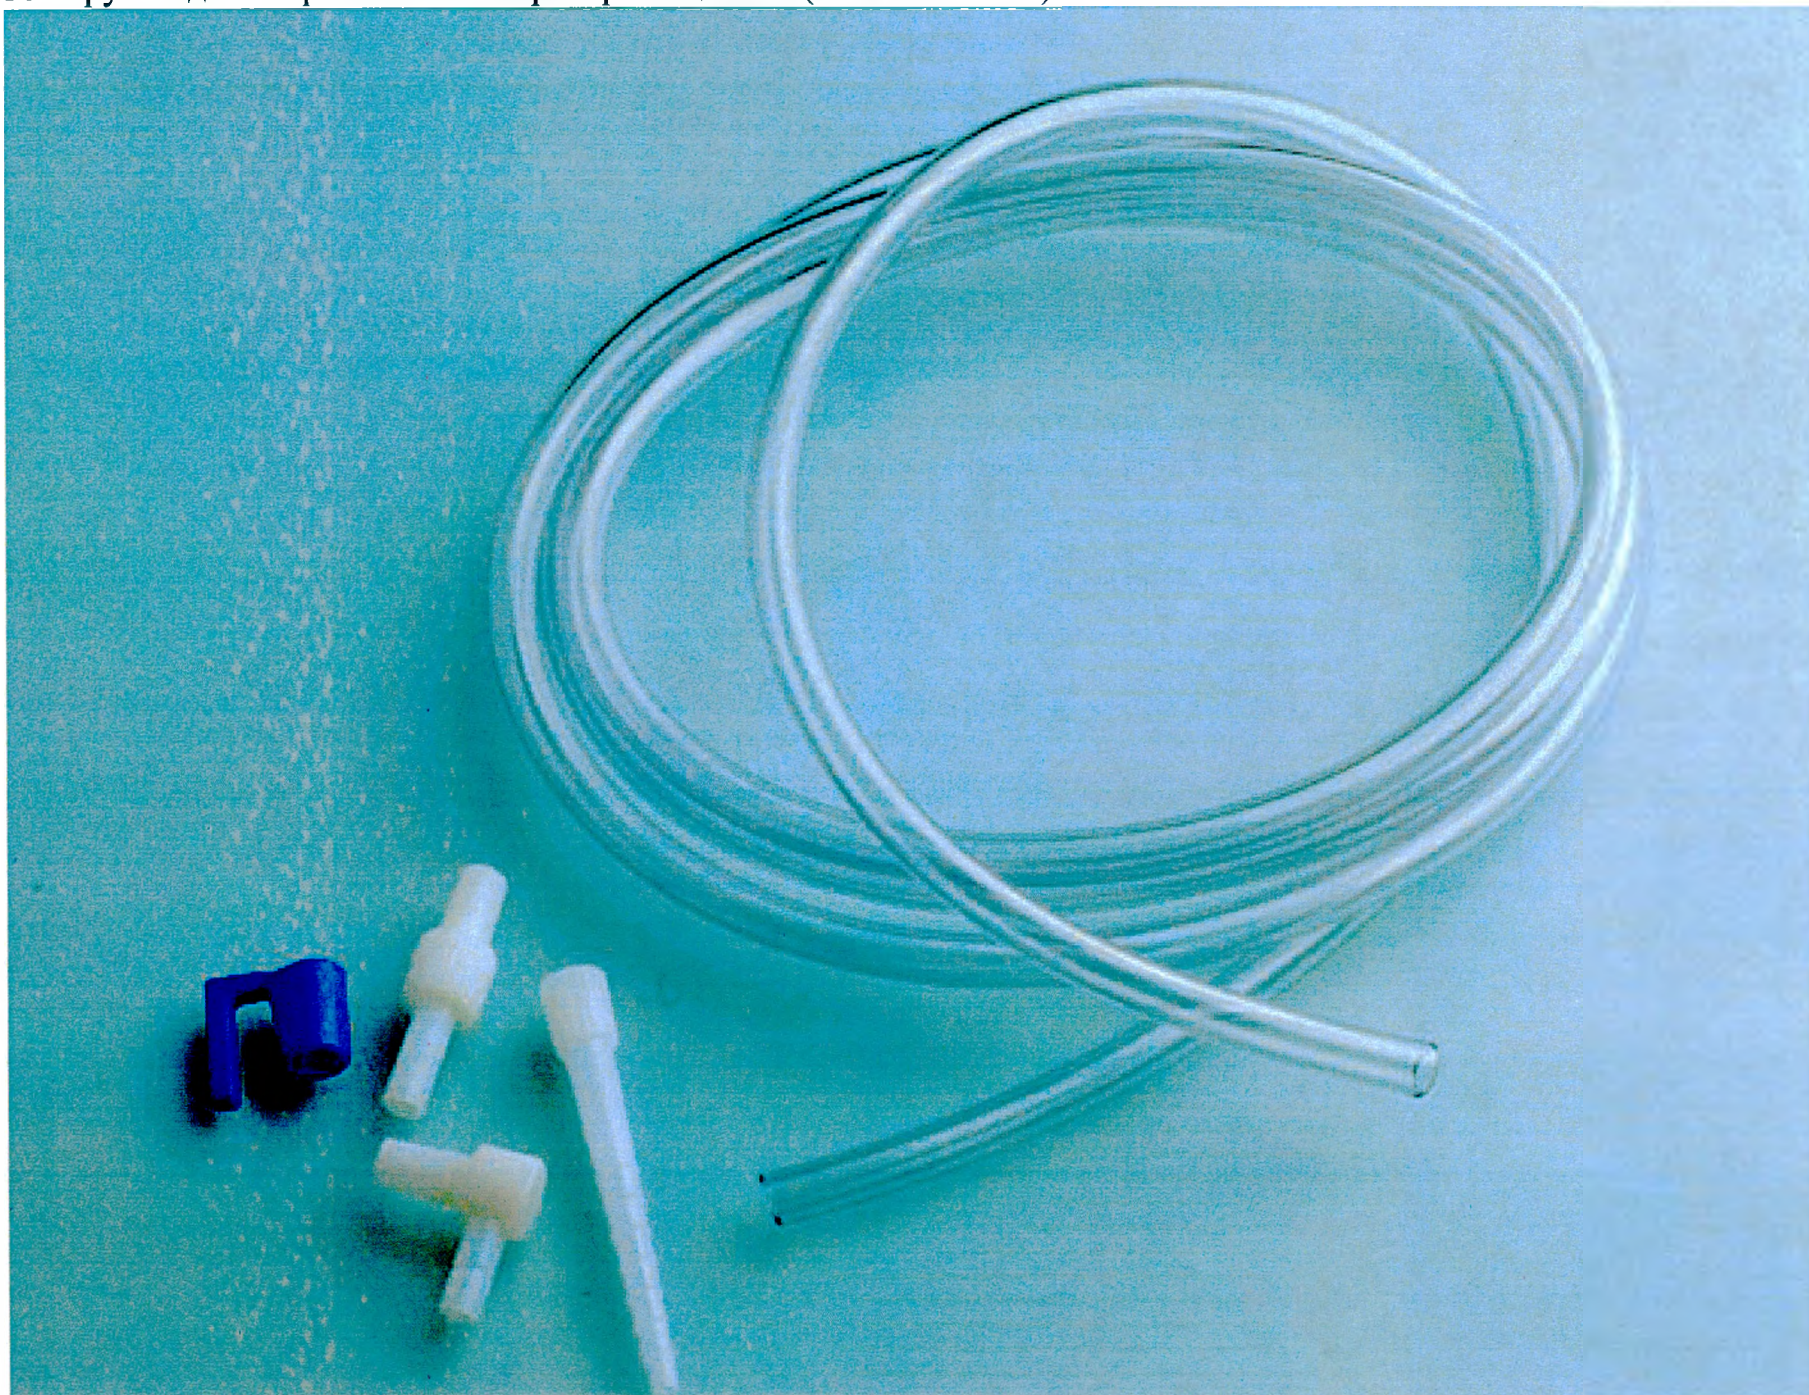

36. Коннекторы для трубки для встроенного аспиратора пациента (не более 5 шт.).

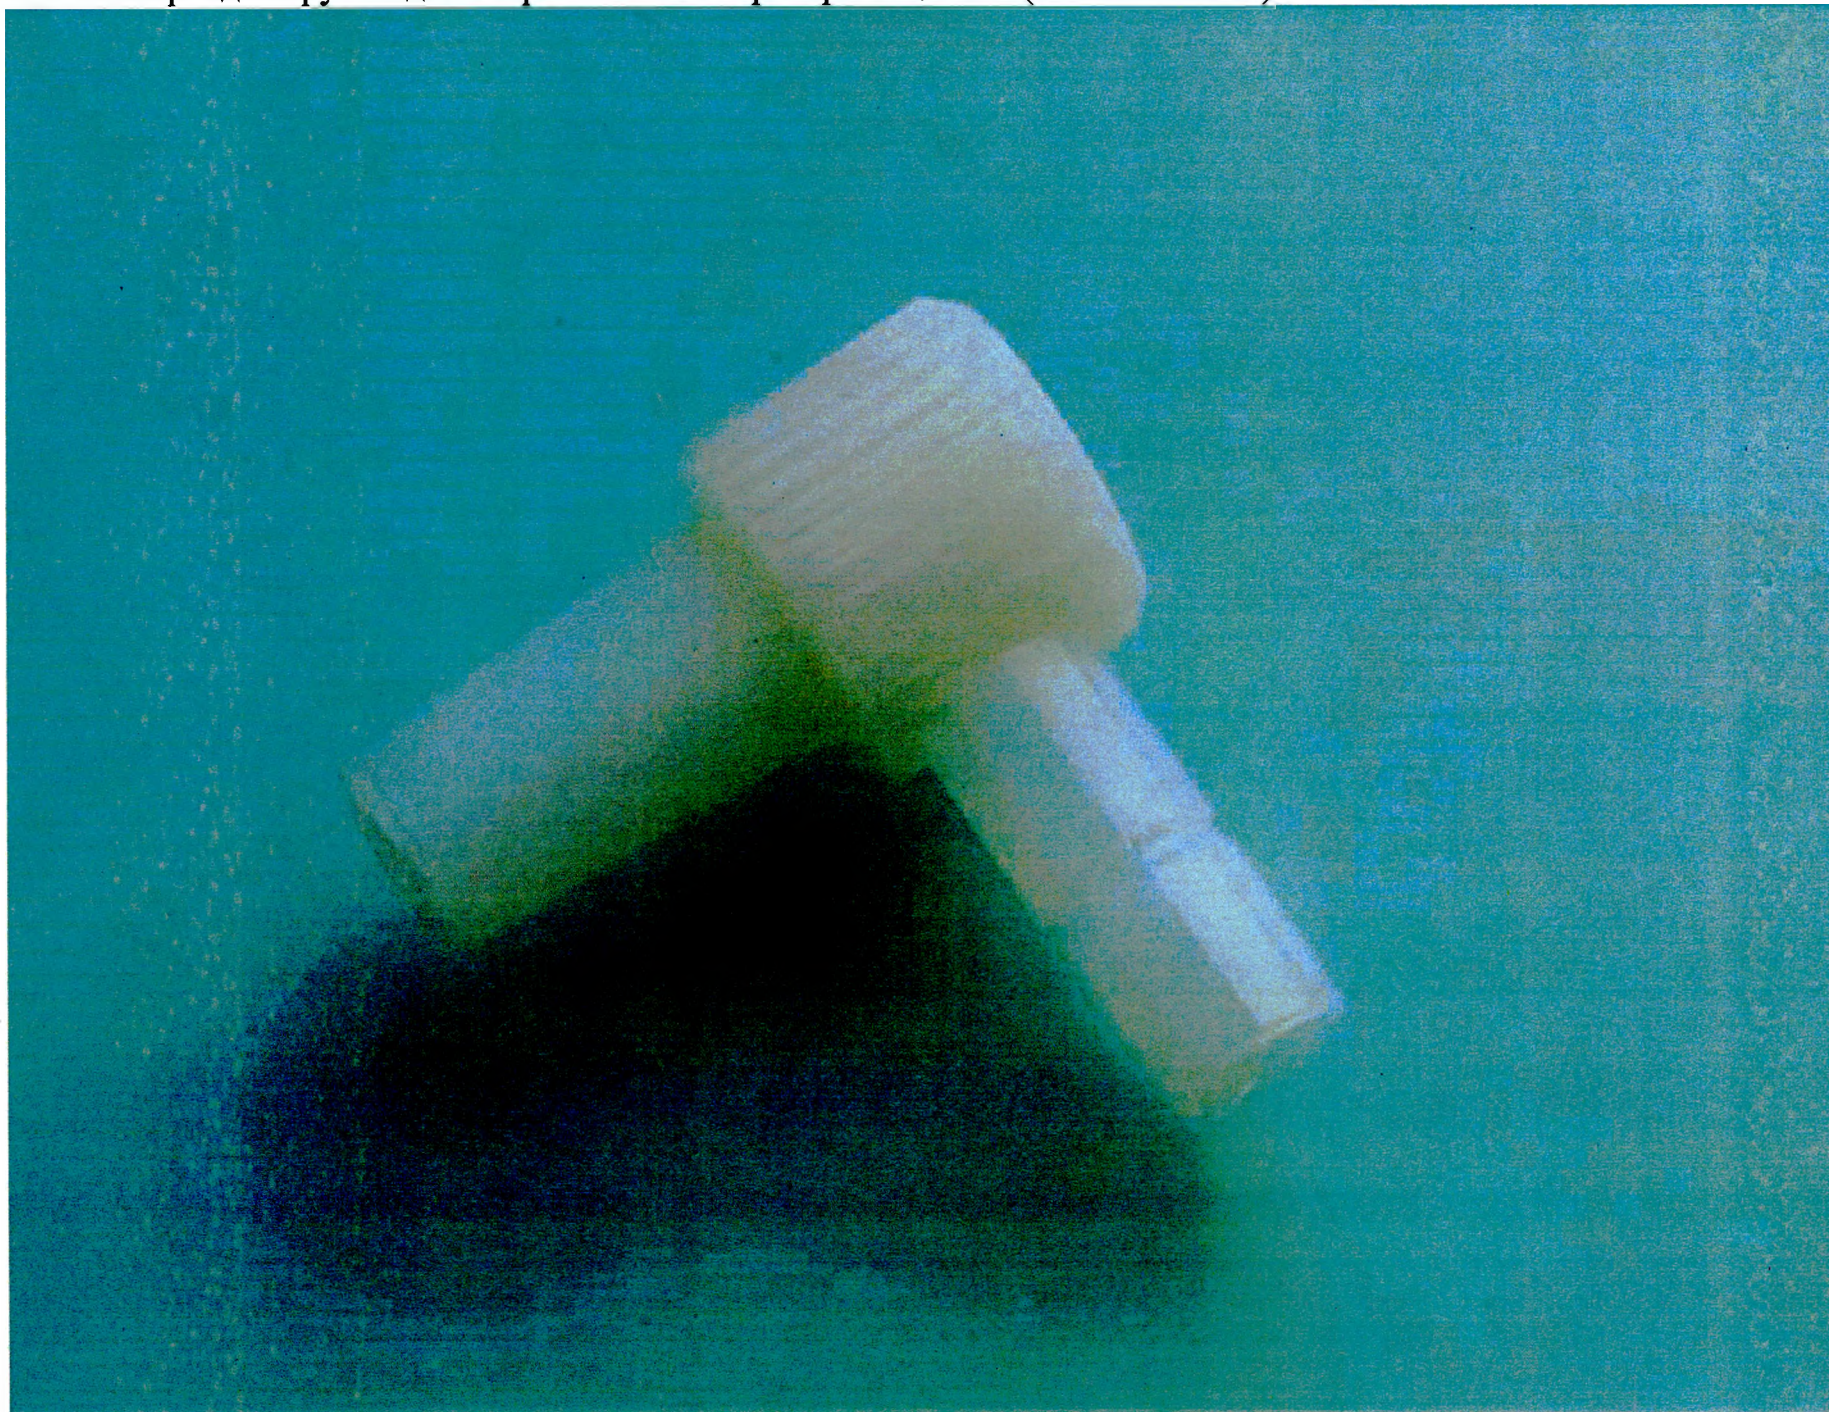

37. Маски лицевые для детей, размеры: 0; 1; 2 (не более 9 шт.).
Маски лицевые для детей, размер 0




37. Маски лицевые для детей, размеры: 0; 1; 2 (не более 9 шт.).
Маски лицевые для детей, размер 1



37. Маски лицевые для детей, размеры: 0; 1; 2 (не более 9 шт.).

Маски лицевые для детей, размер 2

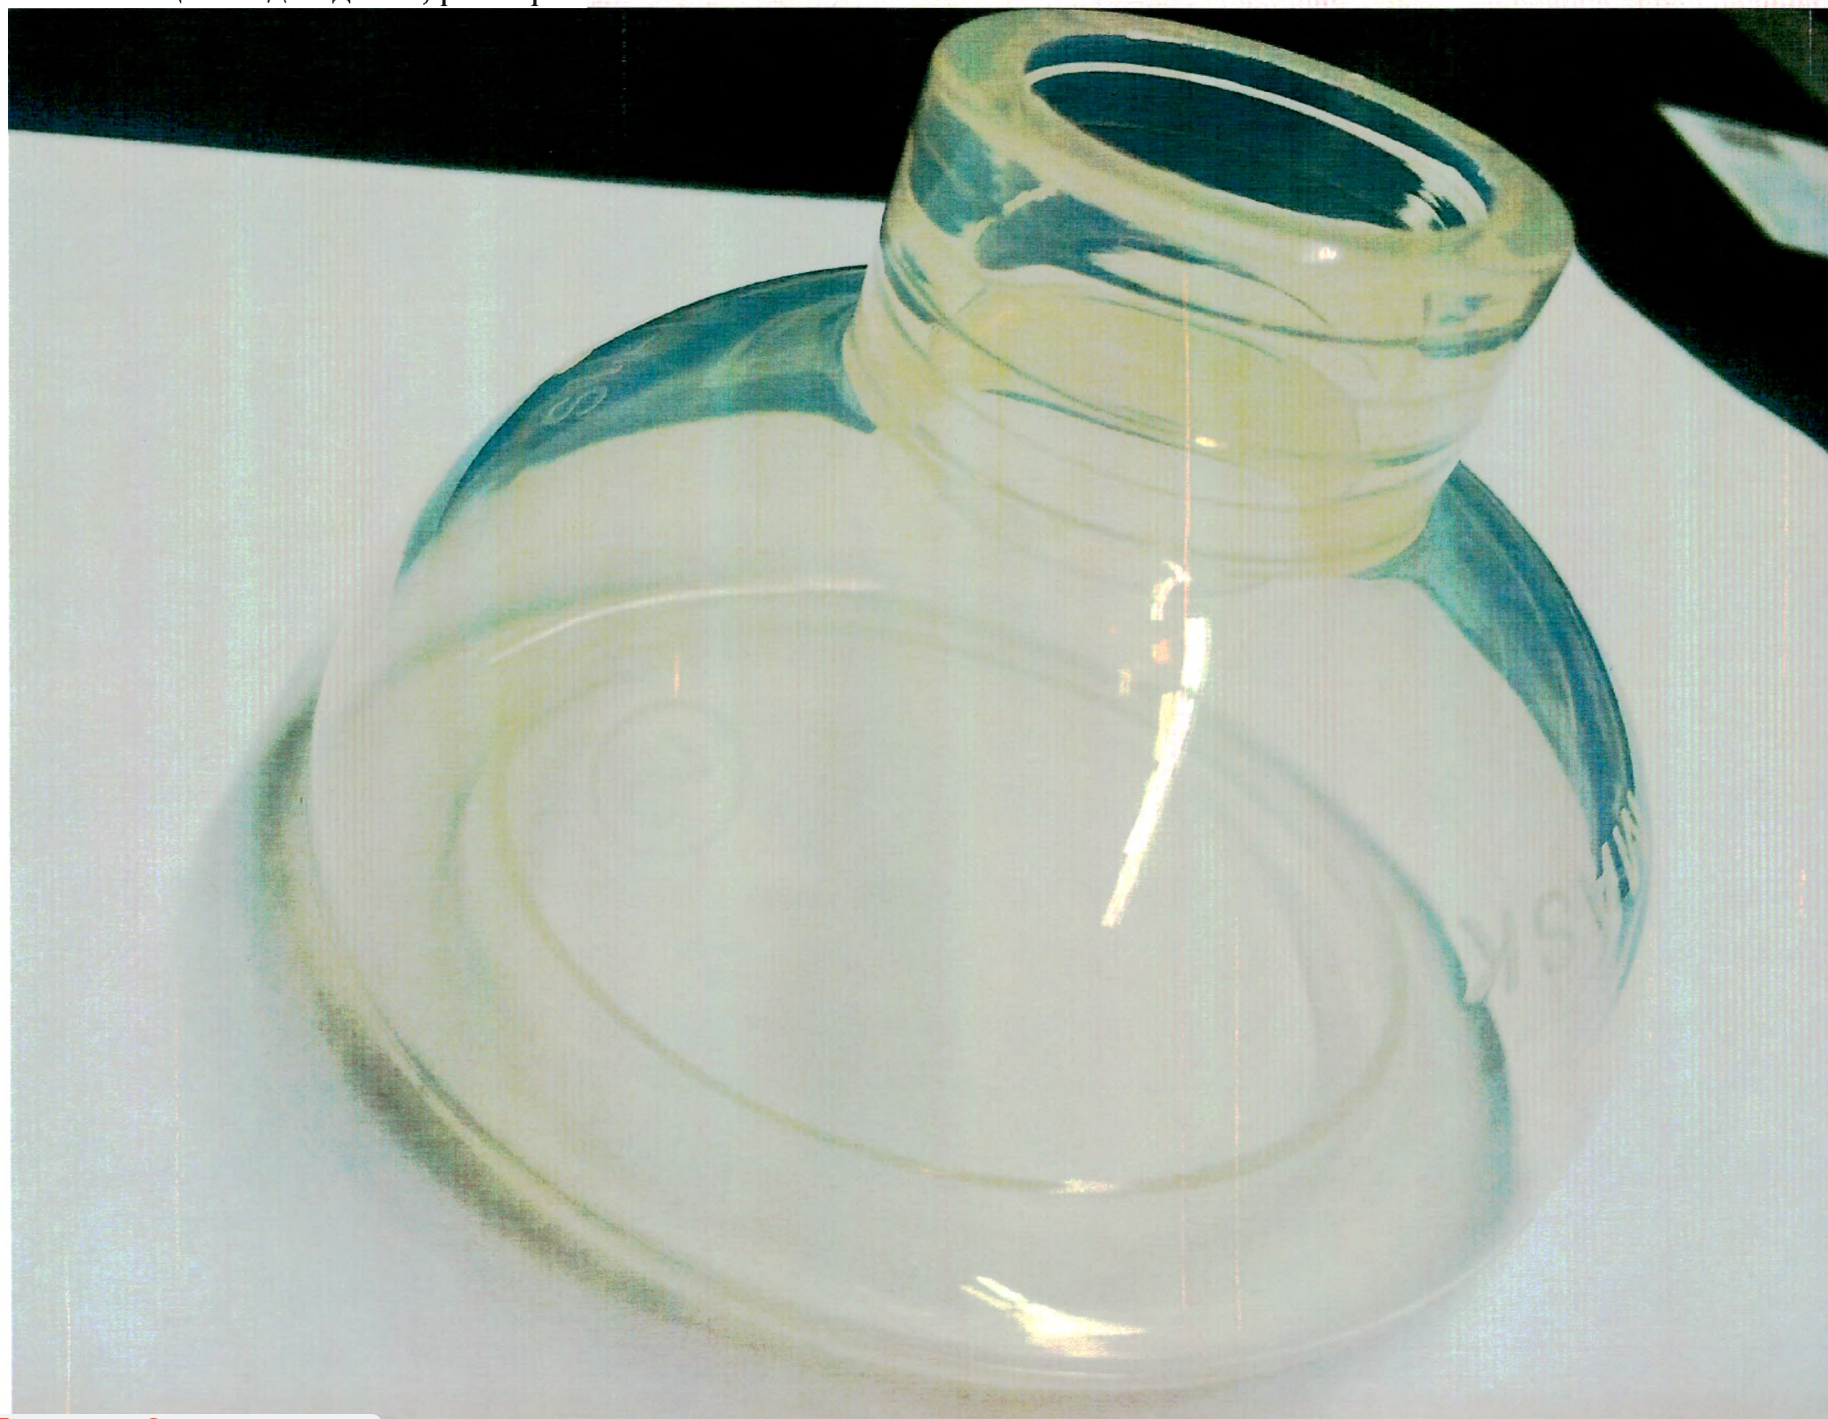

38. Маски лицевые для взрослых, размеры: 3; 4; 5 (не более 9 шт.).

Маски лицевые для взрослых, размер 3



38. Маски лицевые для взрослых, размеры: 3; 4; 5 (не более 9 шт.).

Маски лицевые для взрослых, размер 4



38. Маски лицевые для взрослых, размеры: 3; 4; 5 (не более 9 шт.).


Маски лицевые для взрослых, размер 5



39.Мешки дыхательные, объем 0,5 л; 1 л; 2 л; 2,3л; 3 л; 4 л (не более 10 шт.).




40. Держатель трубок.

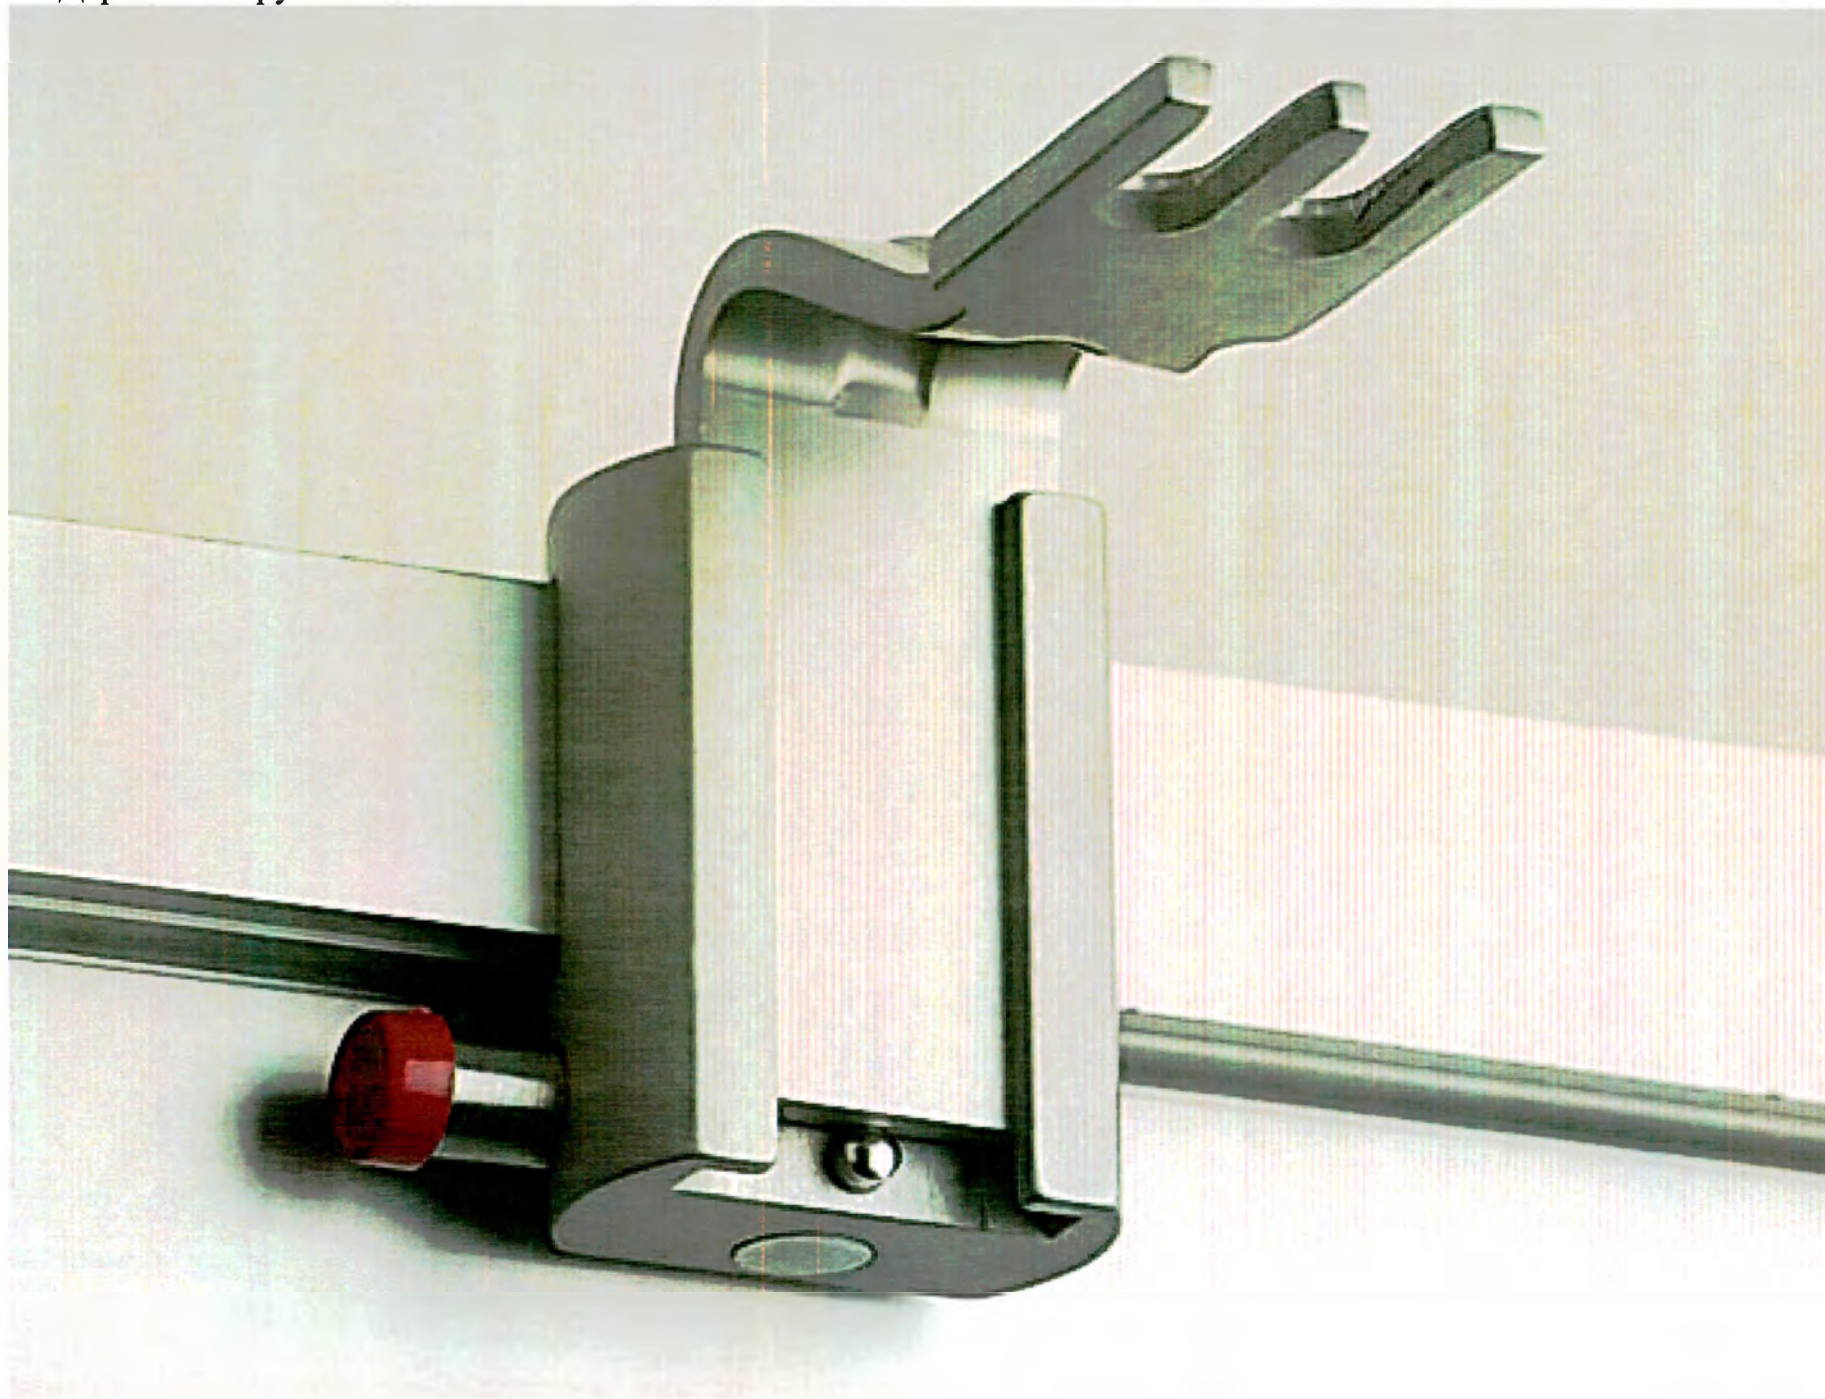


41.Переходники (Y-тройники) (не более 6 шт.).



42.Переходники прямые (не более 6 шт.).

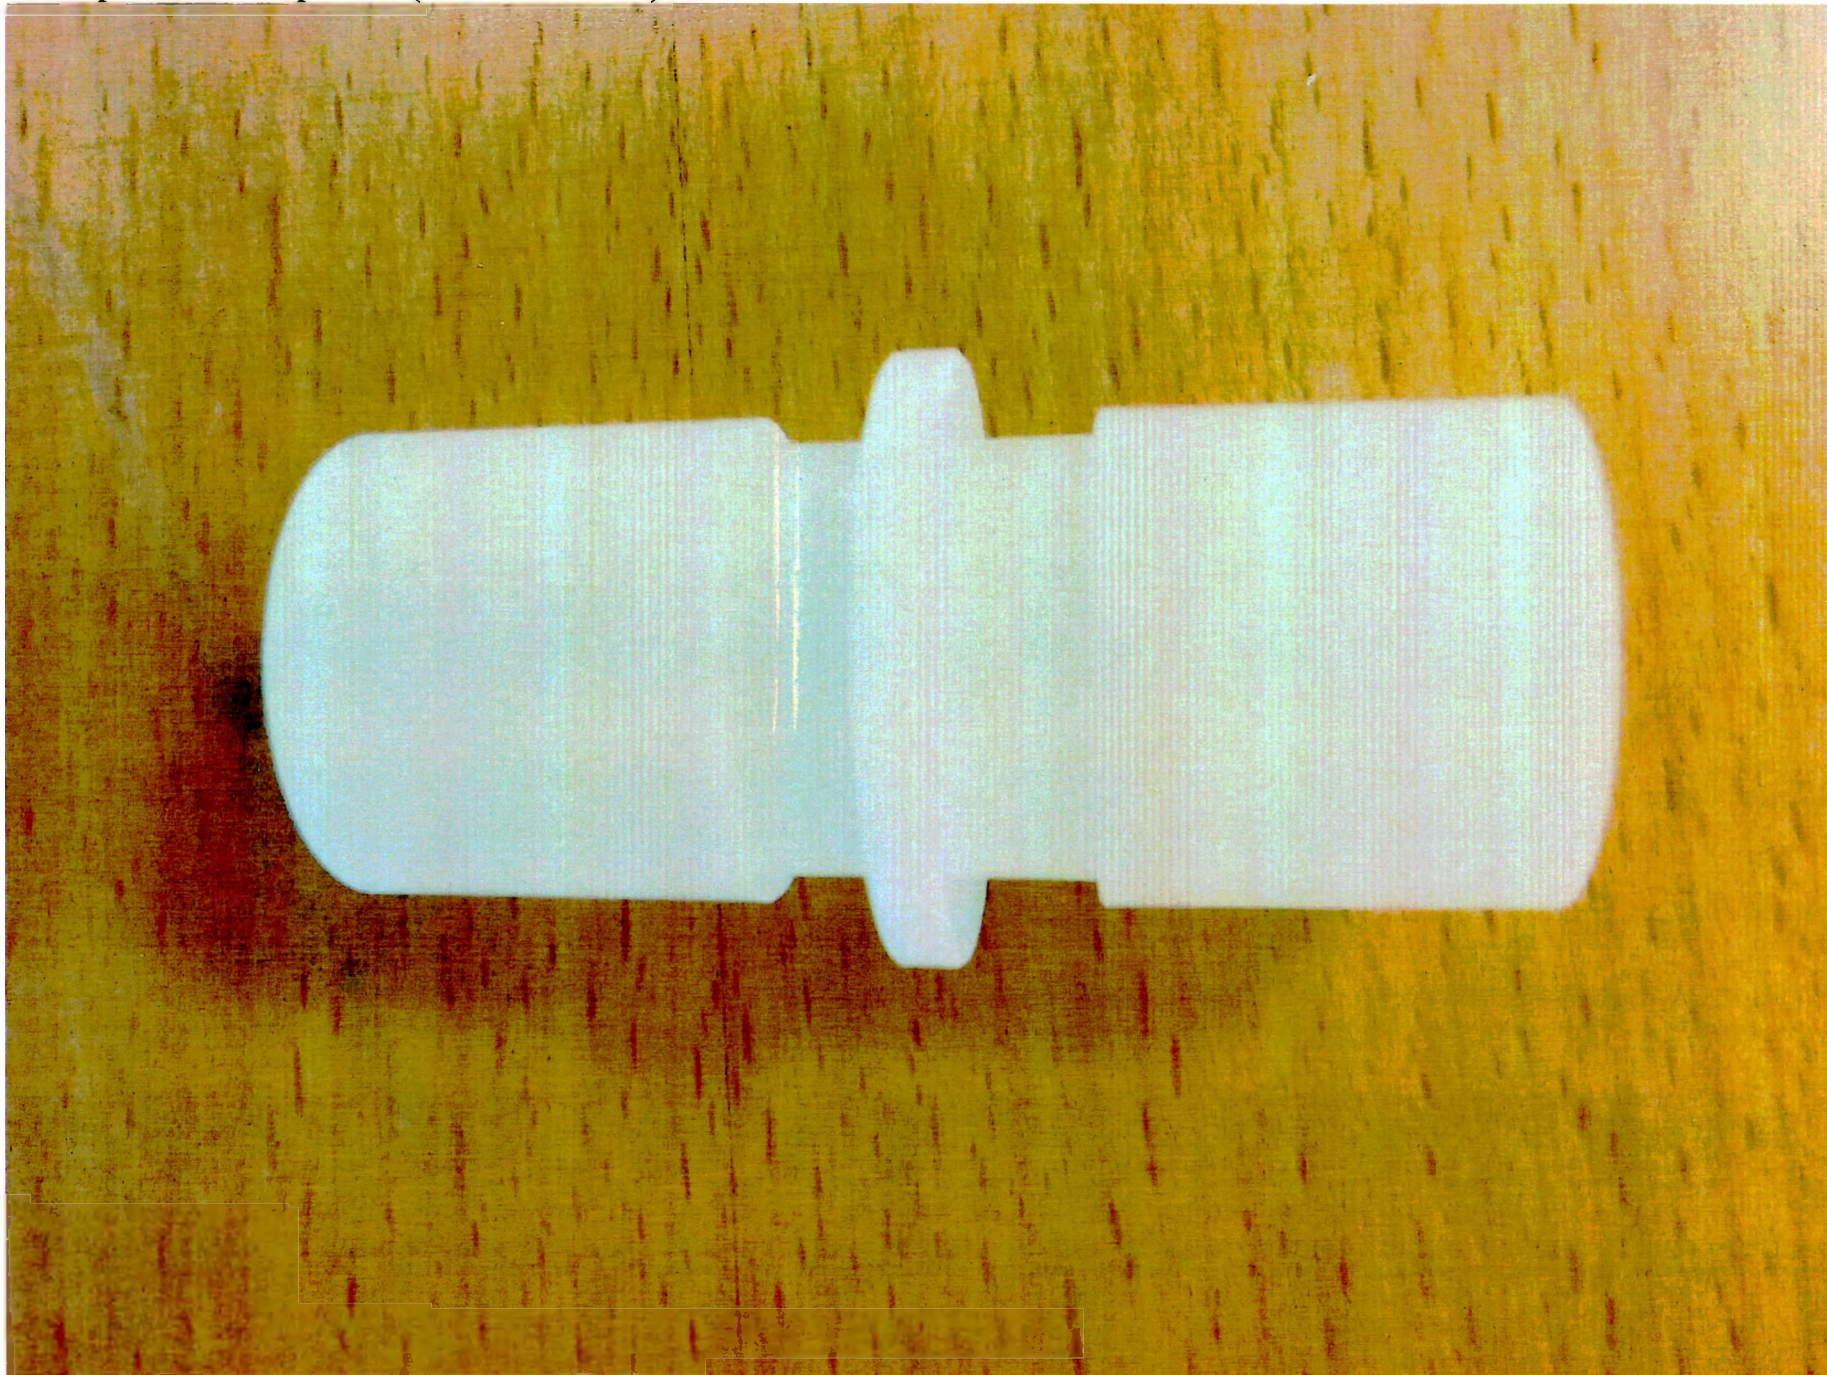

43.Контуры пациента дыхательные неонатальные (не более 25 шт.).

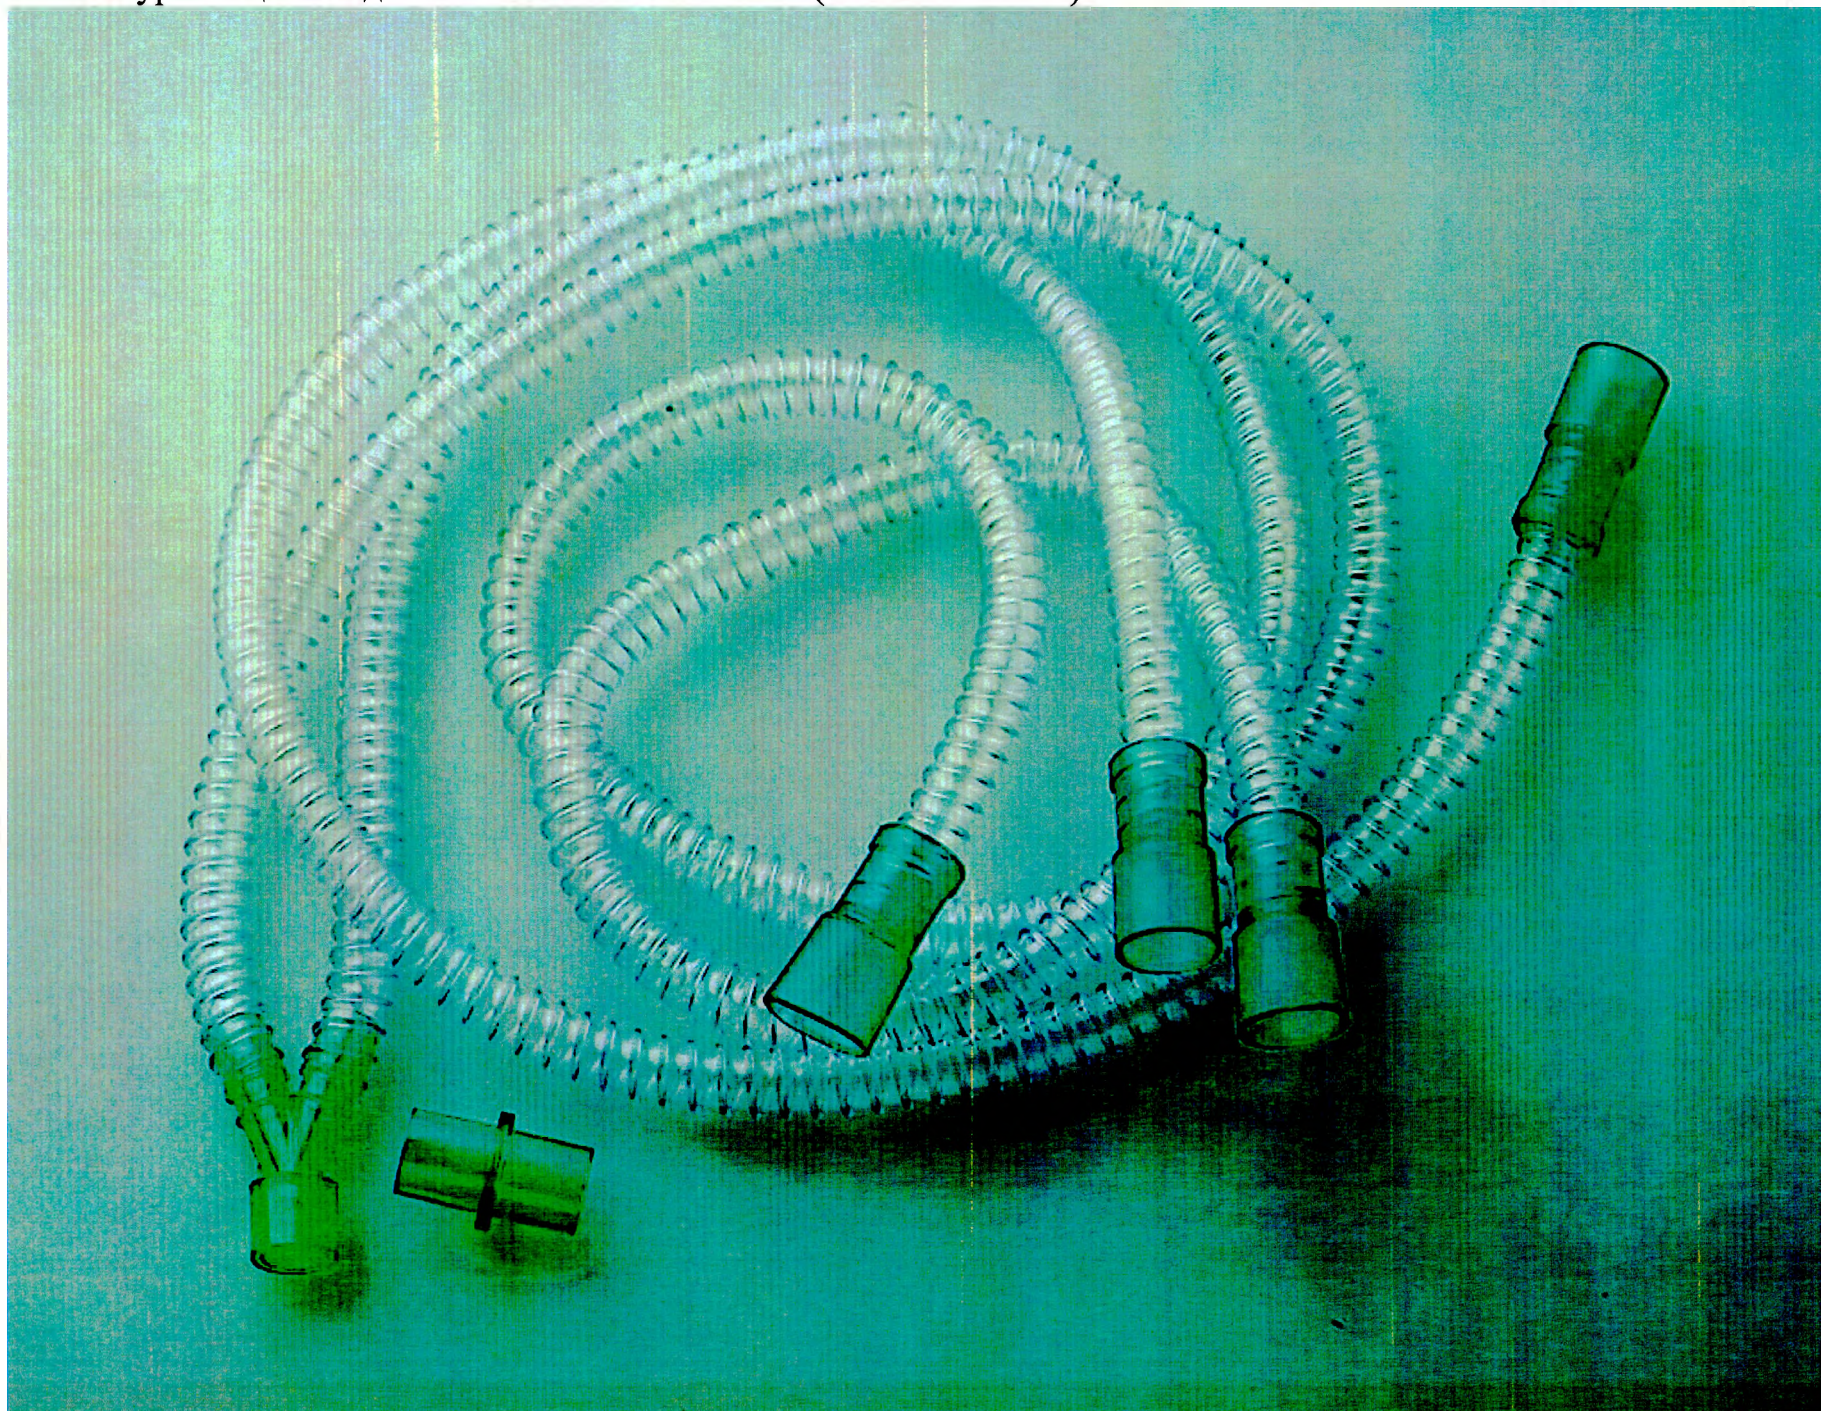

44. Контуры пациента дыхательные детские (не более 25 шт.).




45. Контуры дыхательные Jackson Rees для взрослых (не более 10 шт.).



46. Контуры дыхательные Magill System для взрослых (не более 10 шт.).




47. Трубки силиконовые для контура пациента 0,6м; 1,8м (не более 12 шт.).

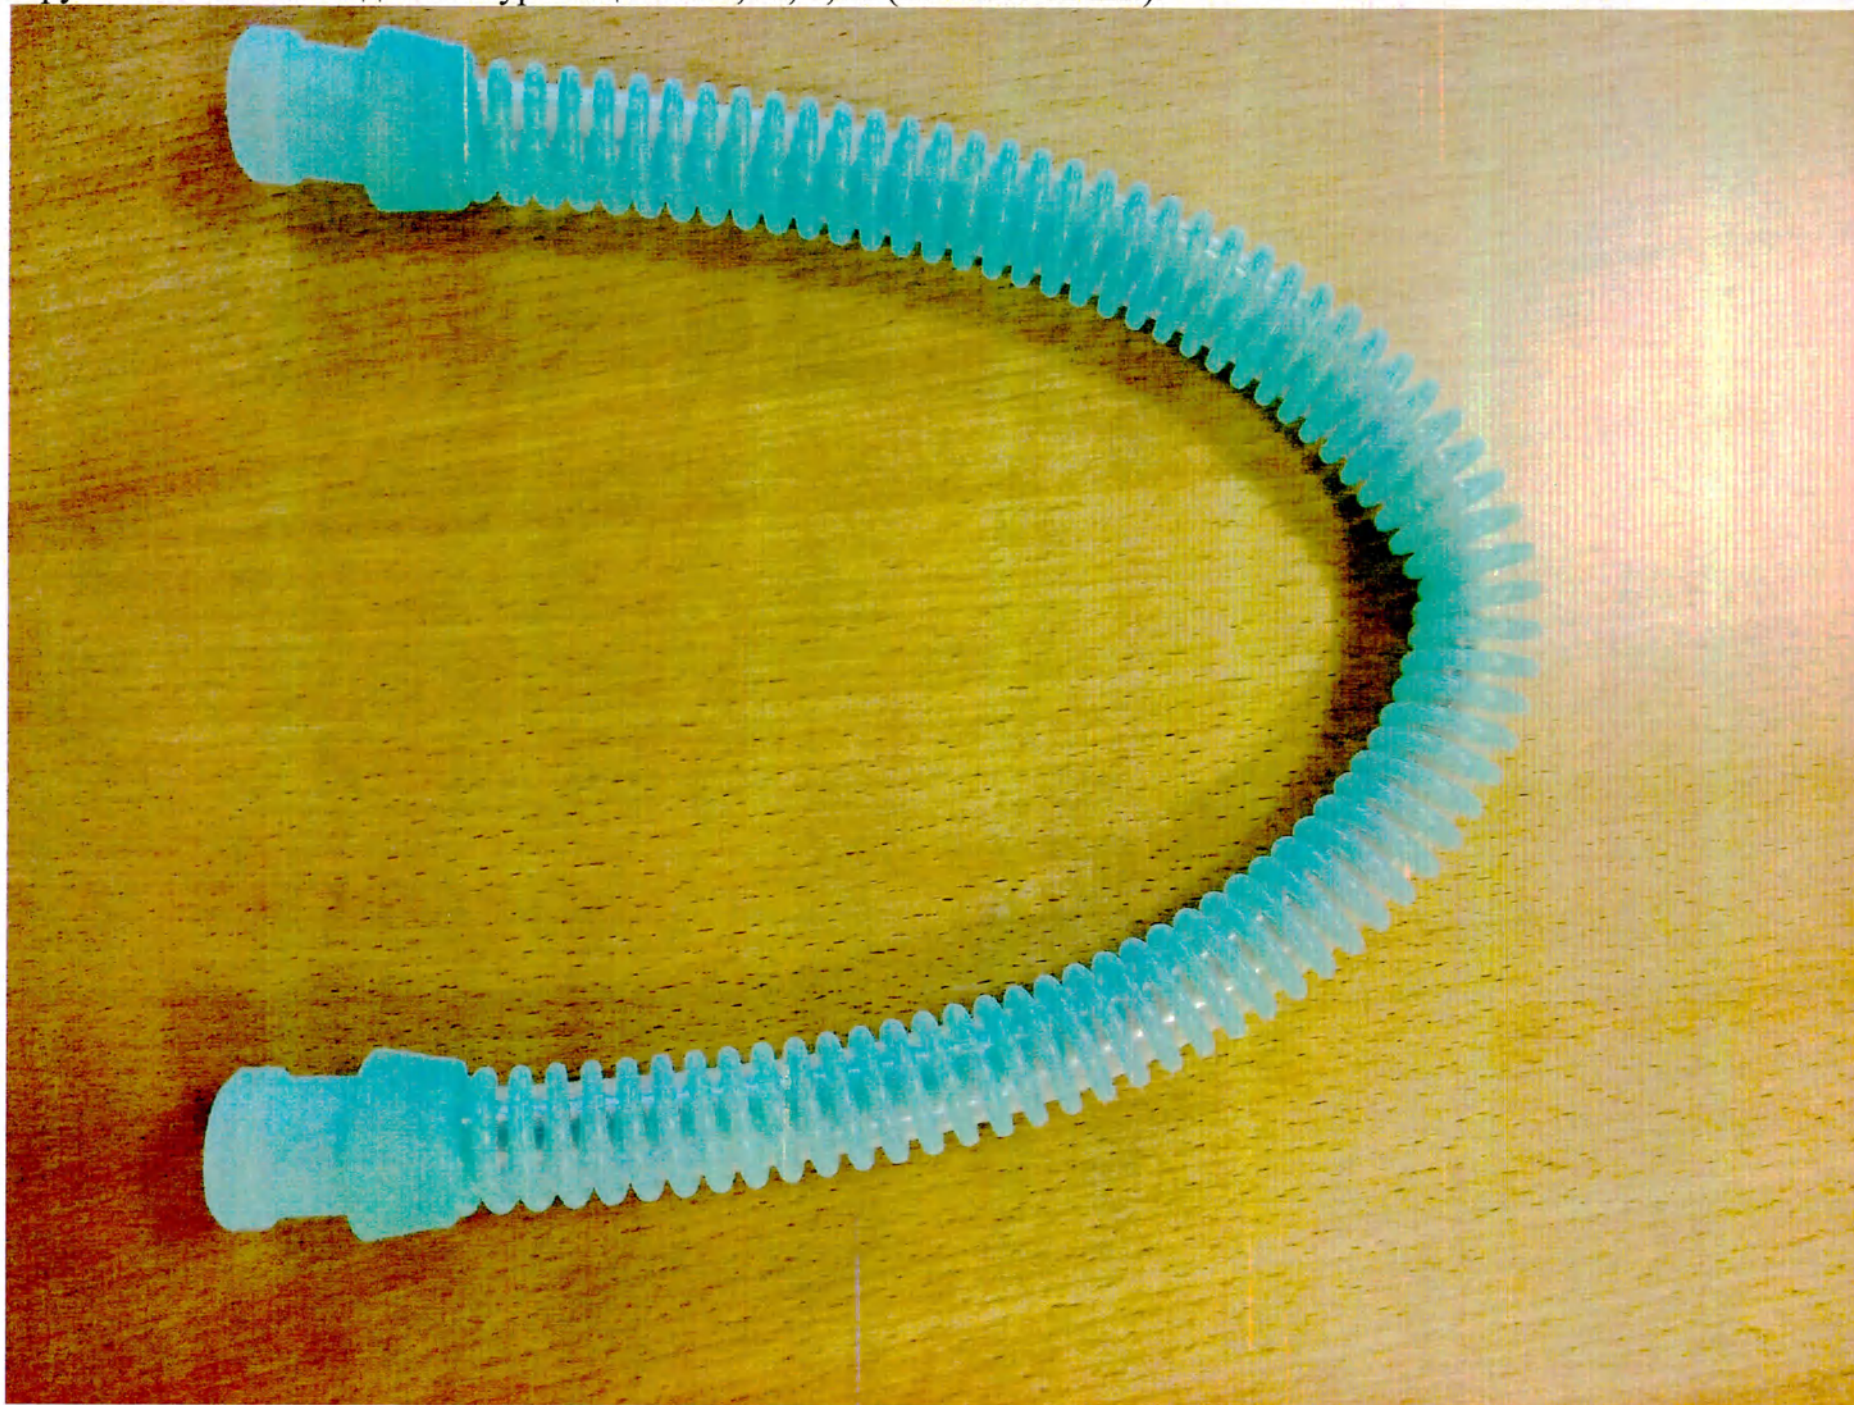


47.Трубки силиконовые для контура пациента 0,6м; 1,8м (не более 12 шт.).




48. Рельсы для навесных принадлежностей (не более 4 шт.).

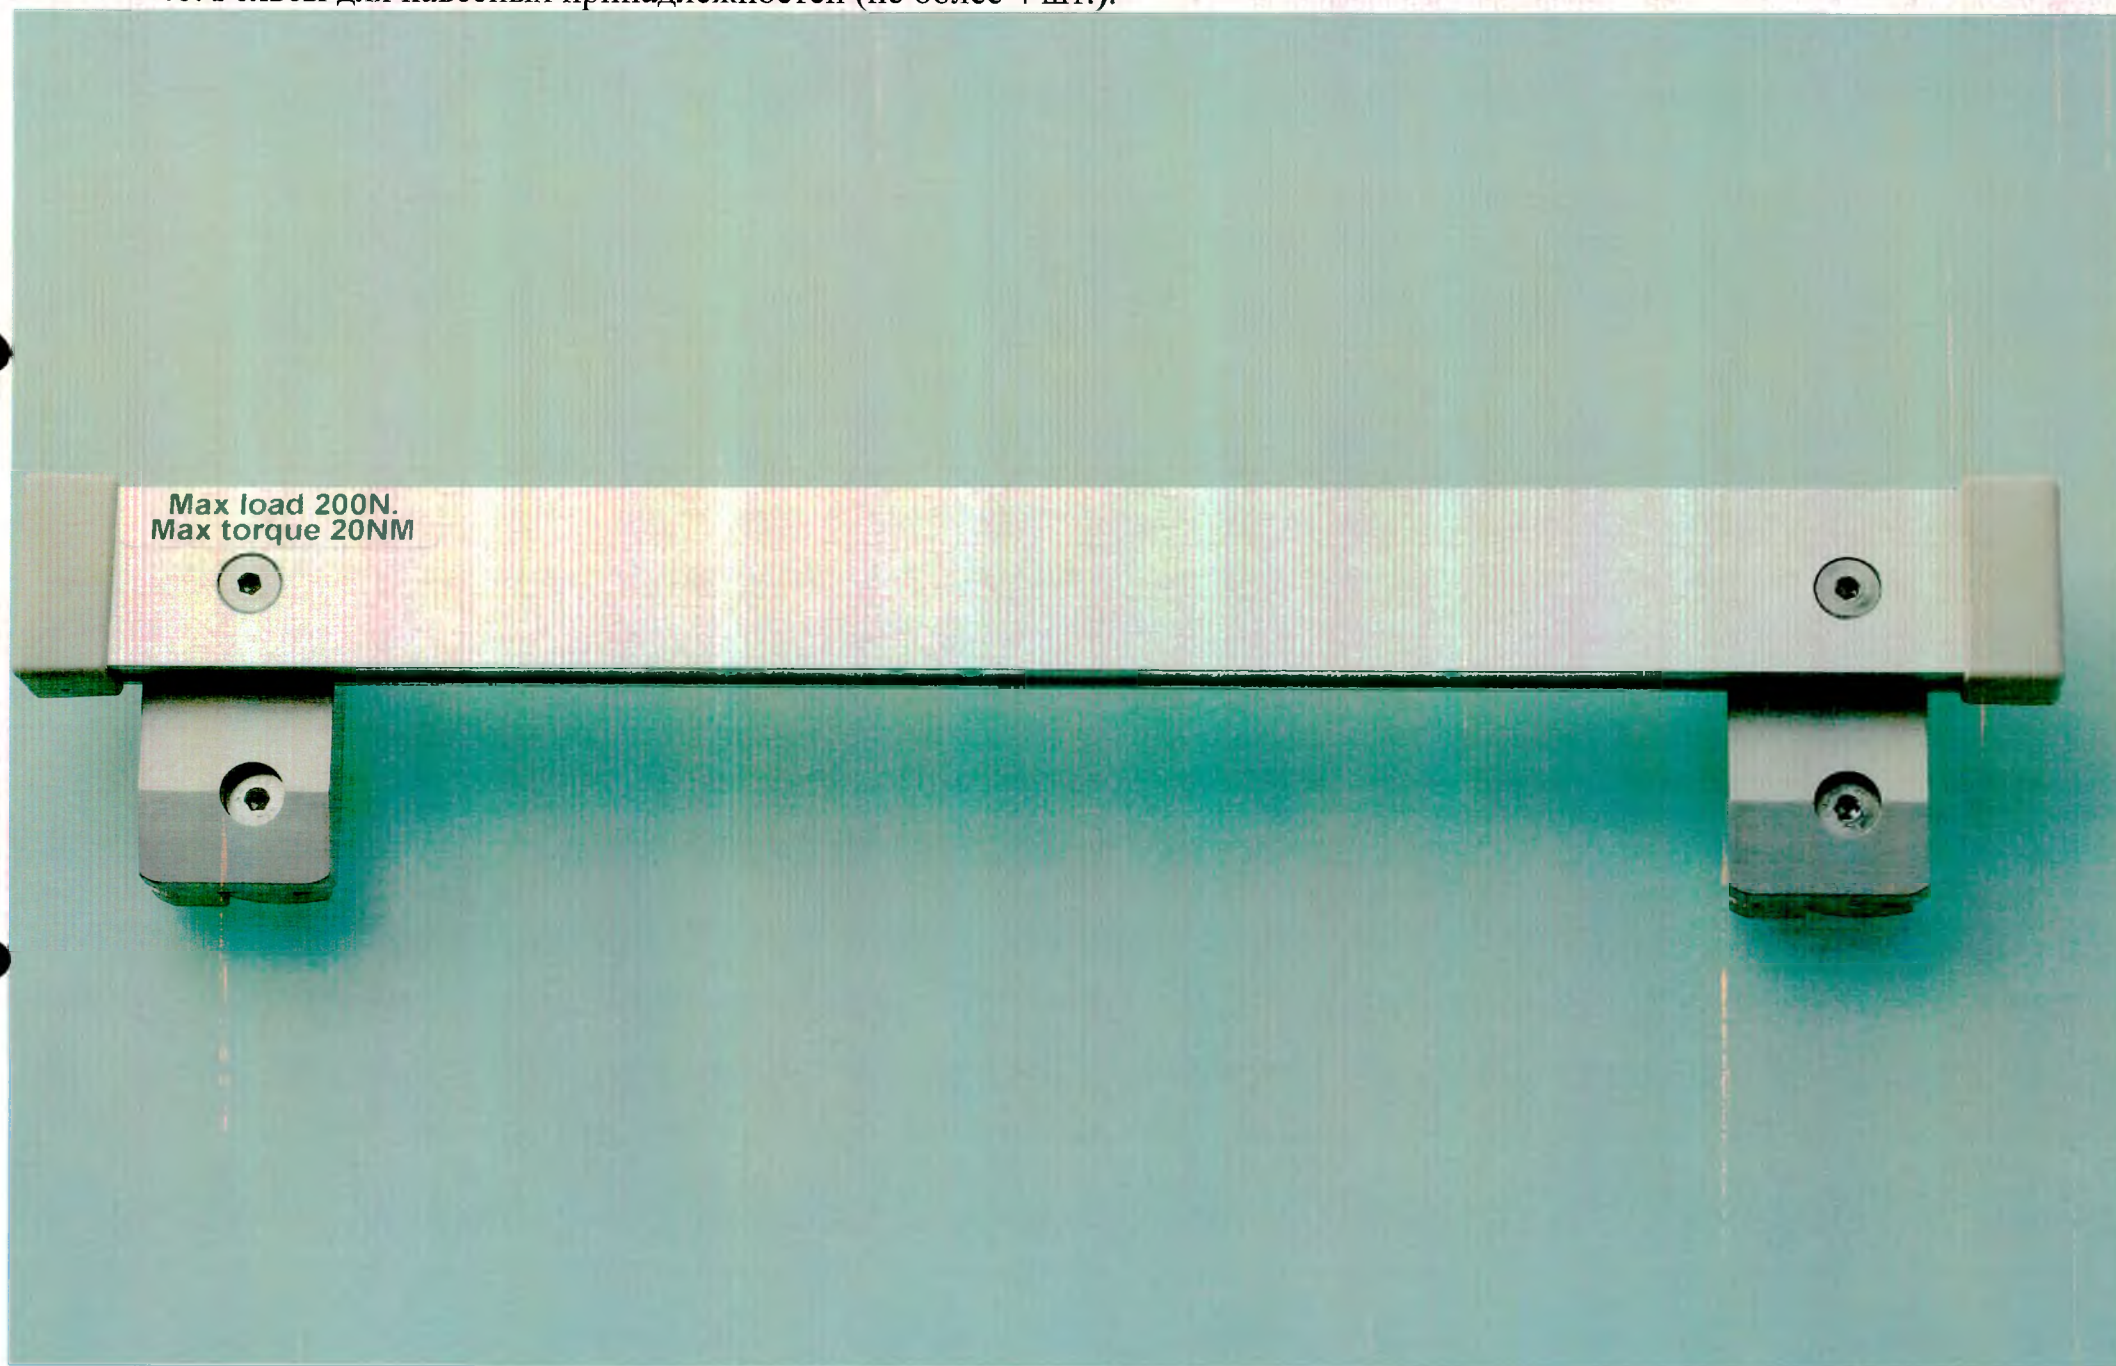


49. Зажимы для рельсов (не более 12 шт.).

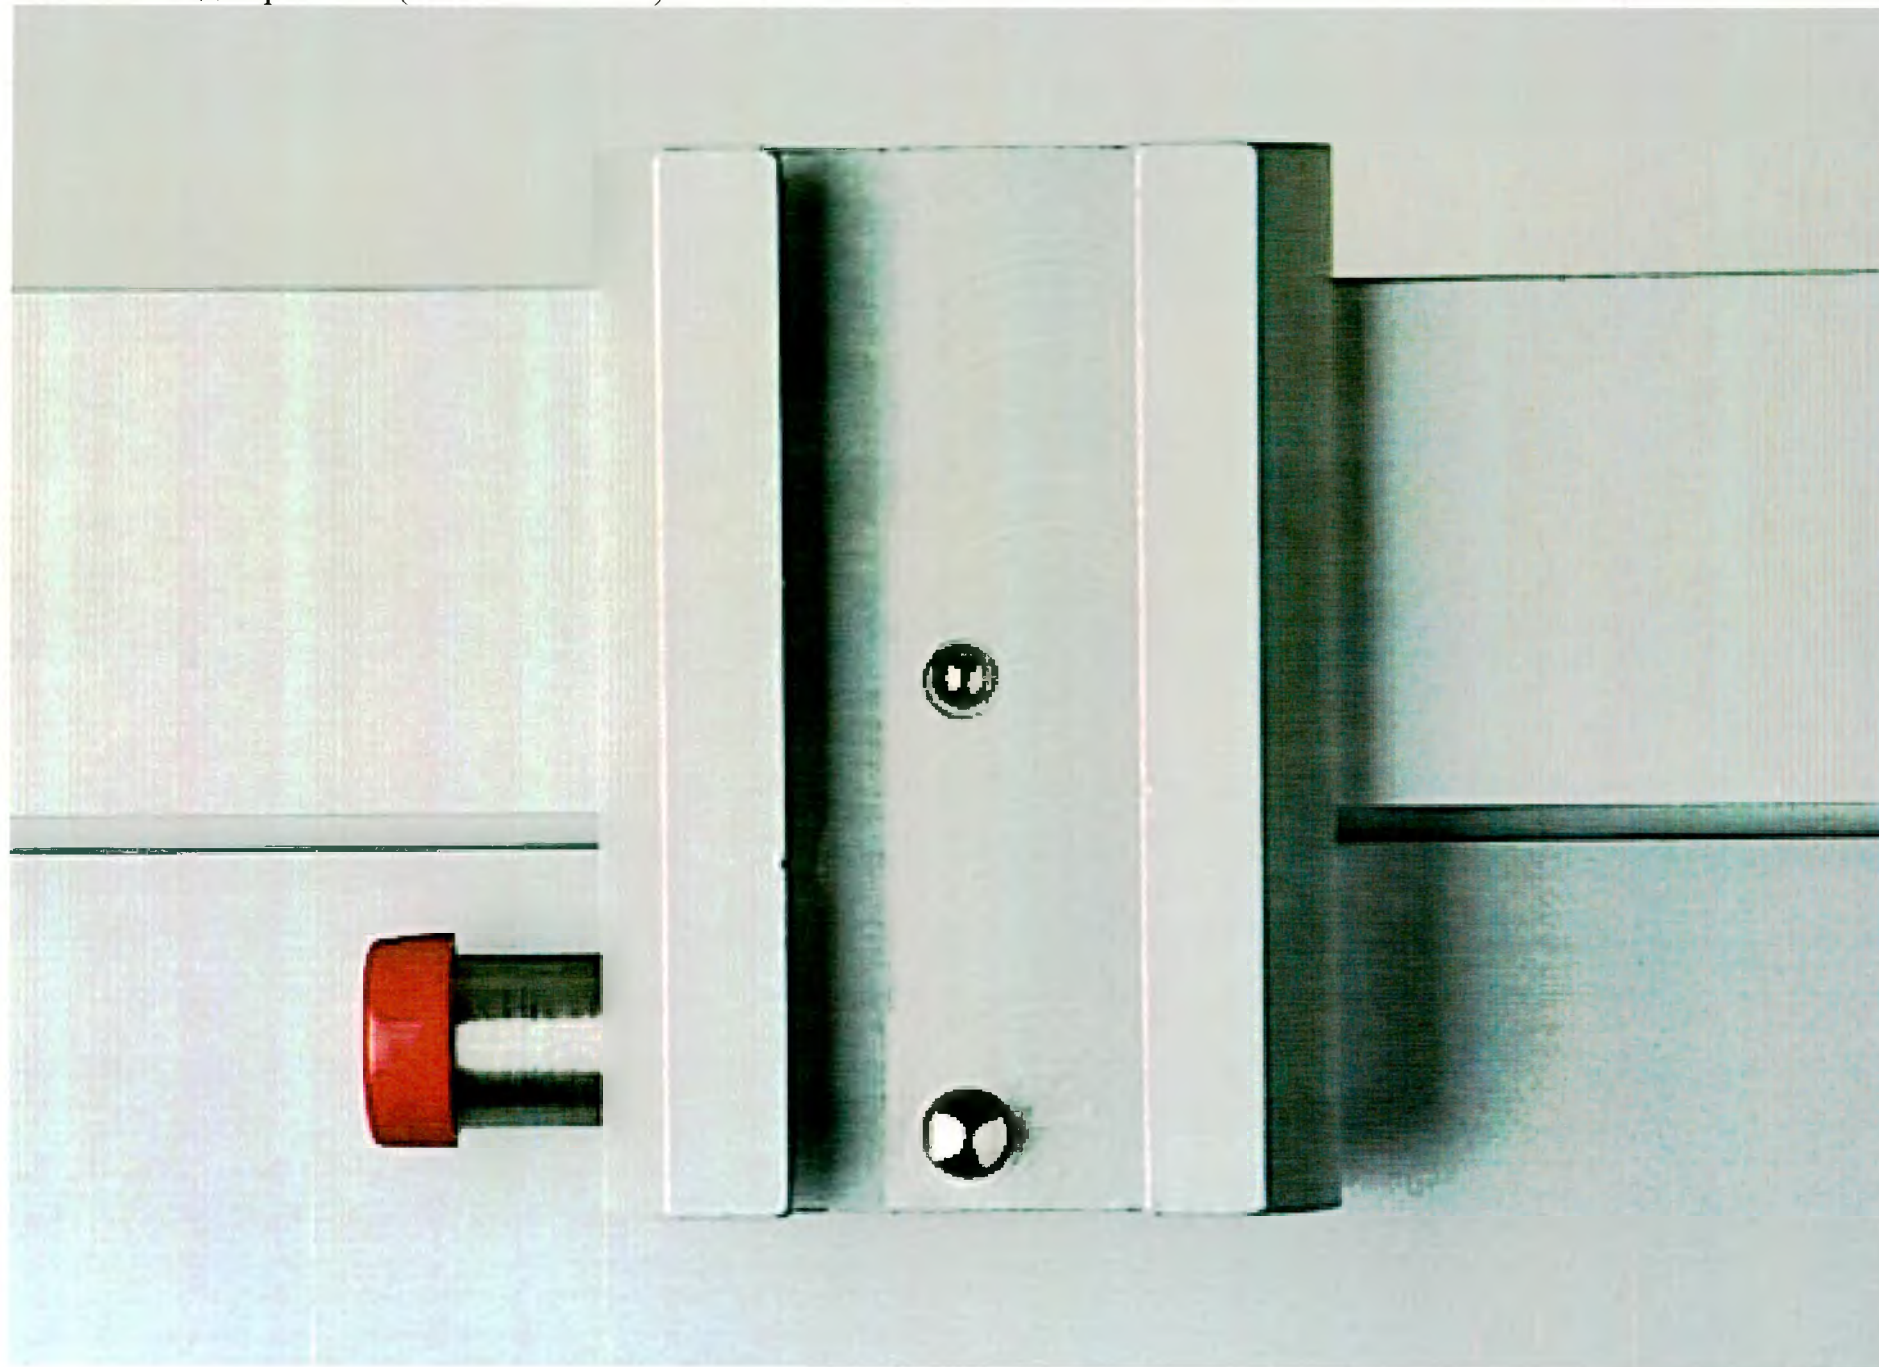

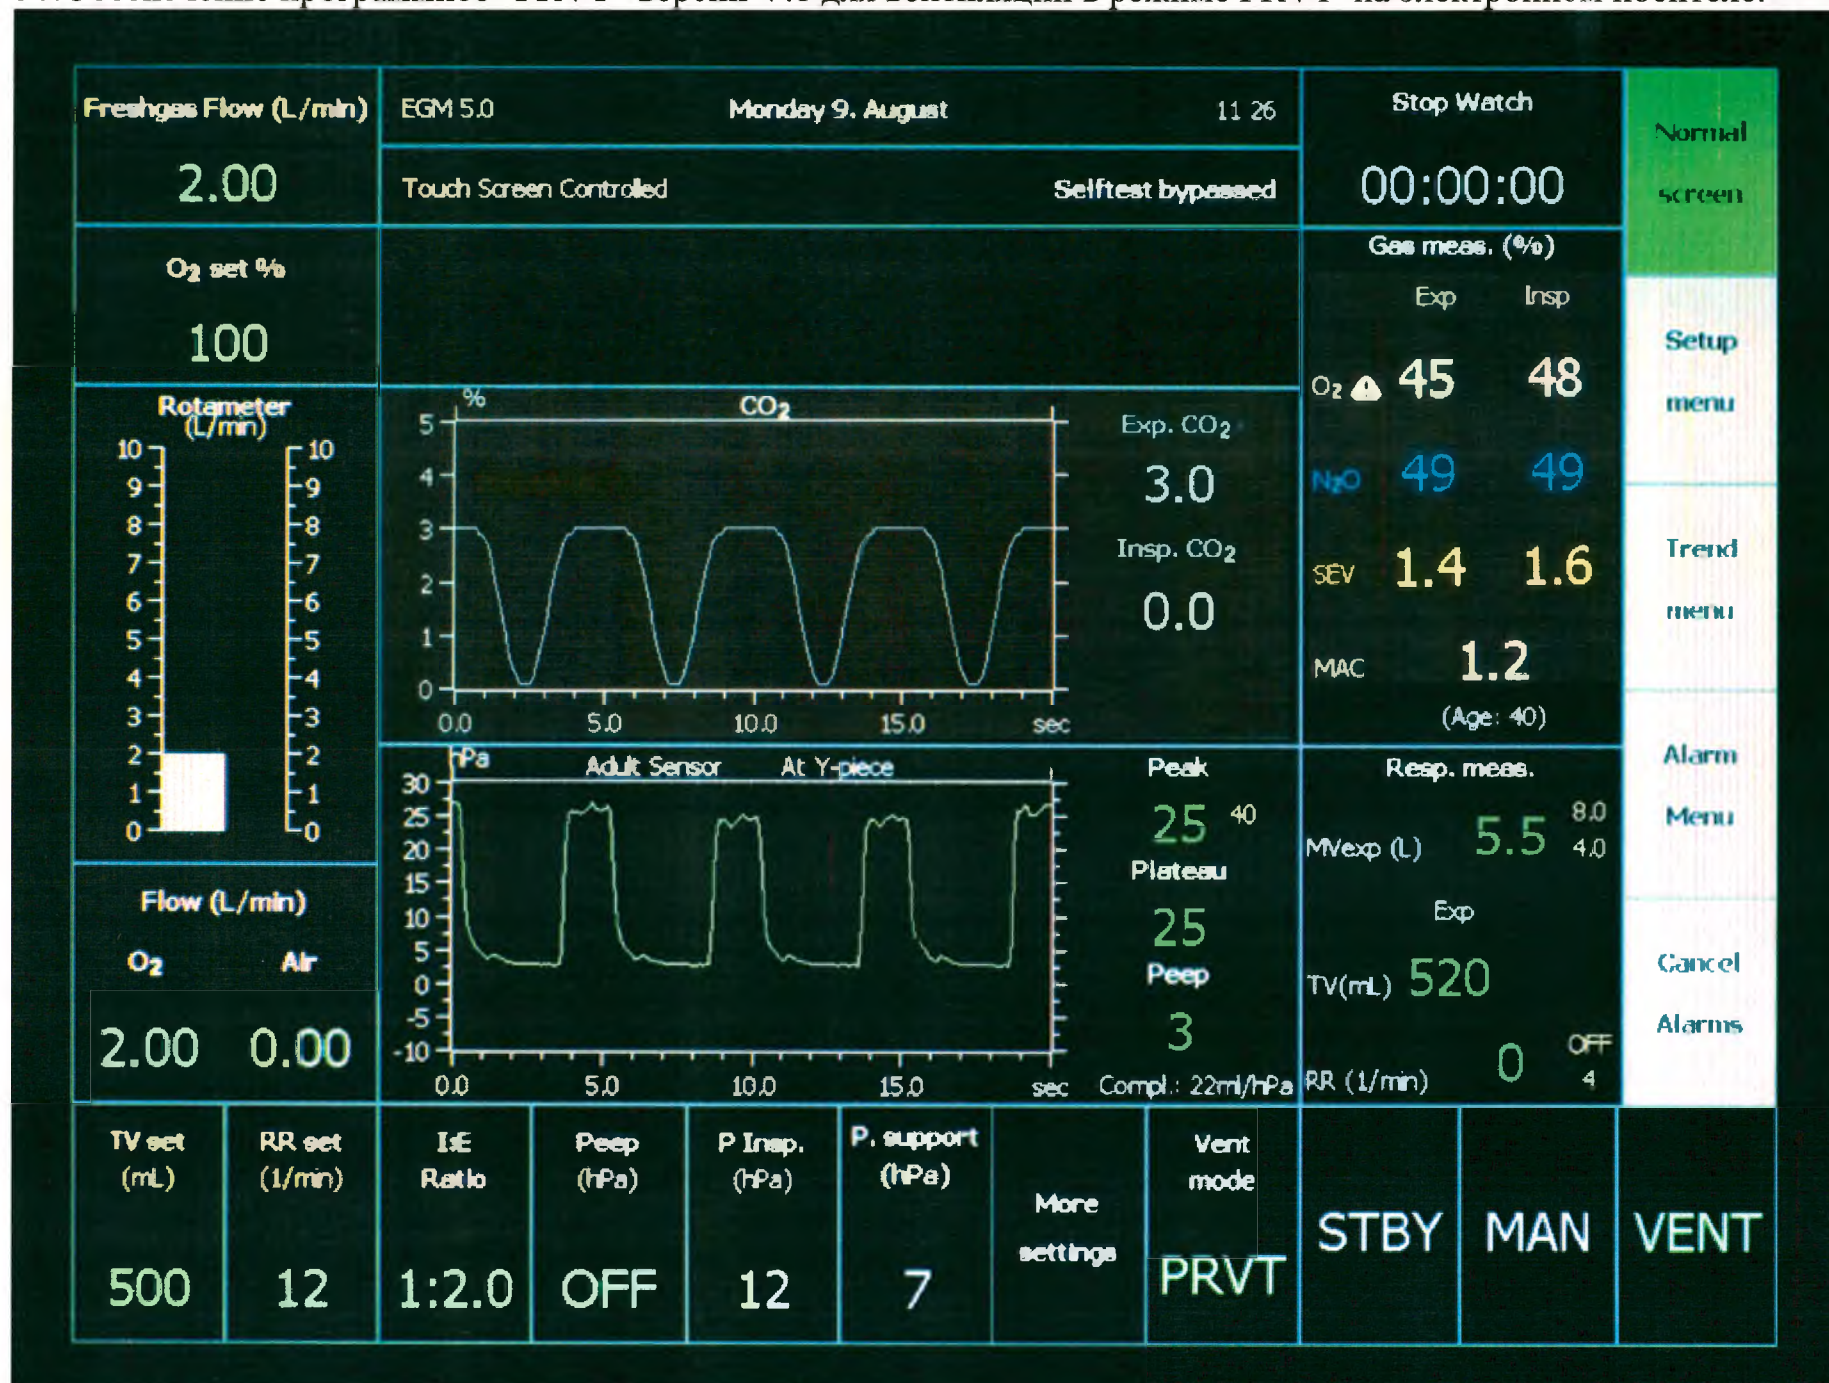

51. Обеспечение программное “Neonatal ventilation mode” версии V.1 для вентиляции новорожденных, на электронном носителе.

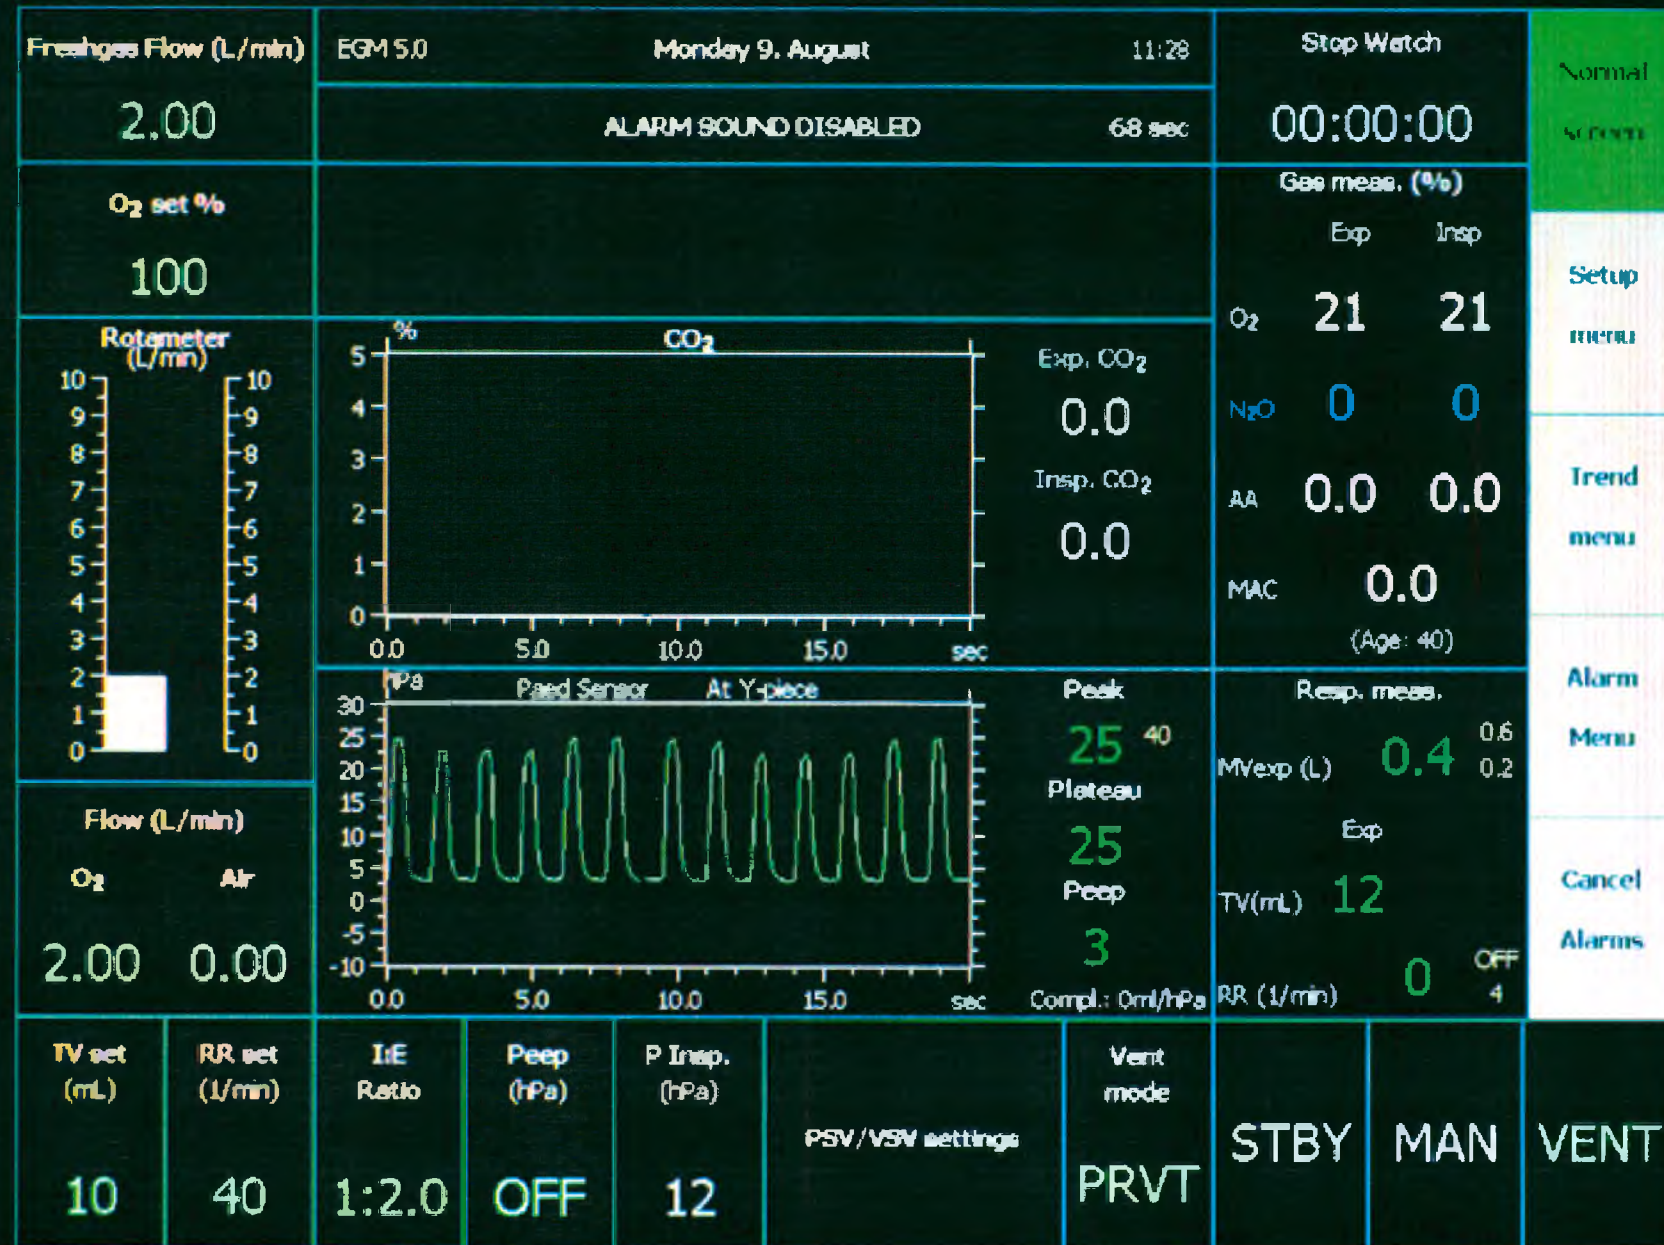

2. Обеспечение программное "Heart-Lung Machine mode" версии V.1 для работы при проведении операций на открытом сердце, на электронном носителе.



его пронумеровано.
прошнуровано и
скреплено печатью
94 (факт) листа (ов)
тетра

