



**Фотографические изображения
на медицинское изделие:**

«Машины моеуще-дезинфицирующие INNOVA ,
варианты исполнений:

M3, M4-1, M4-2 , M5-1, M5-2, M5 ISO-1, M5 ISO-2,
T5-3 , T5-4, E2-DH , E2-DC, E3-DH , E3-DC,
E3 CMS DH, E3 CMS DC, E4 CMS DH, E4 CMS DC,
E5 CMS DH , E5 CMS DC , с принадлежностями»,

производства фирмы BHT Hygienetechnik GmbH,
Германия.

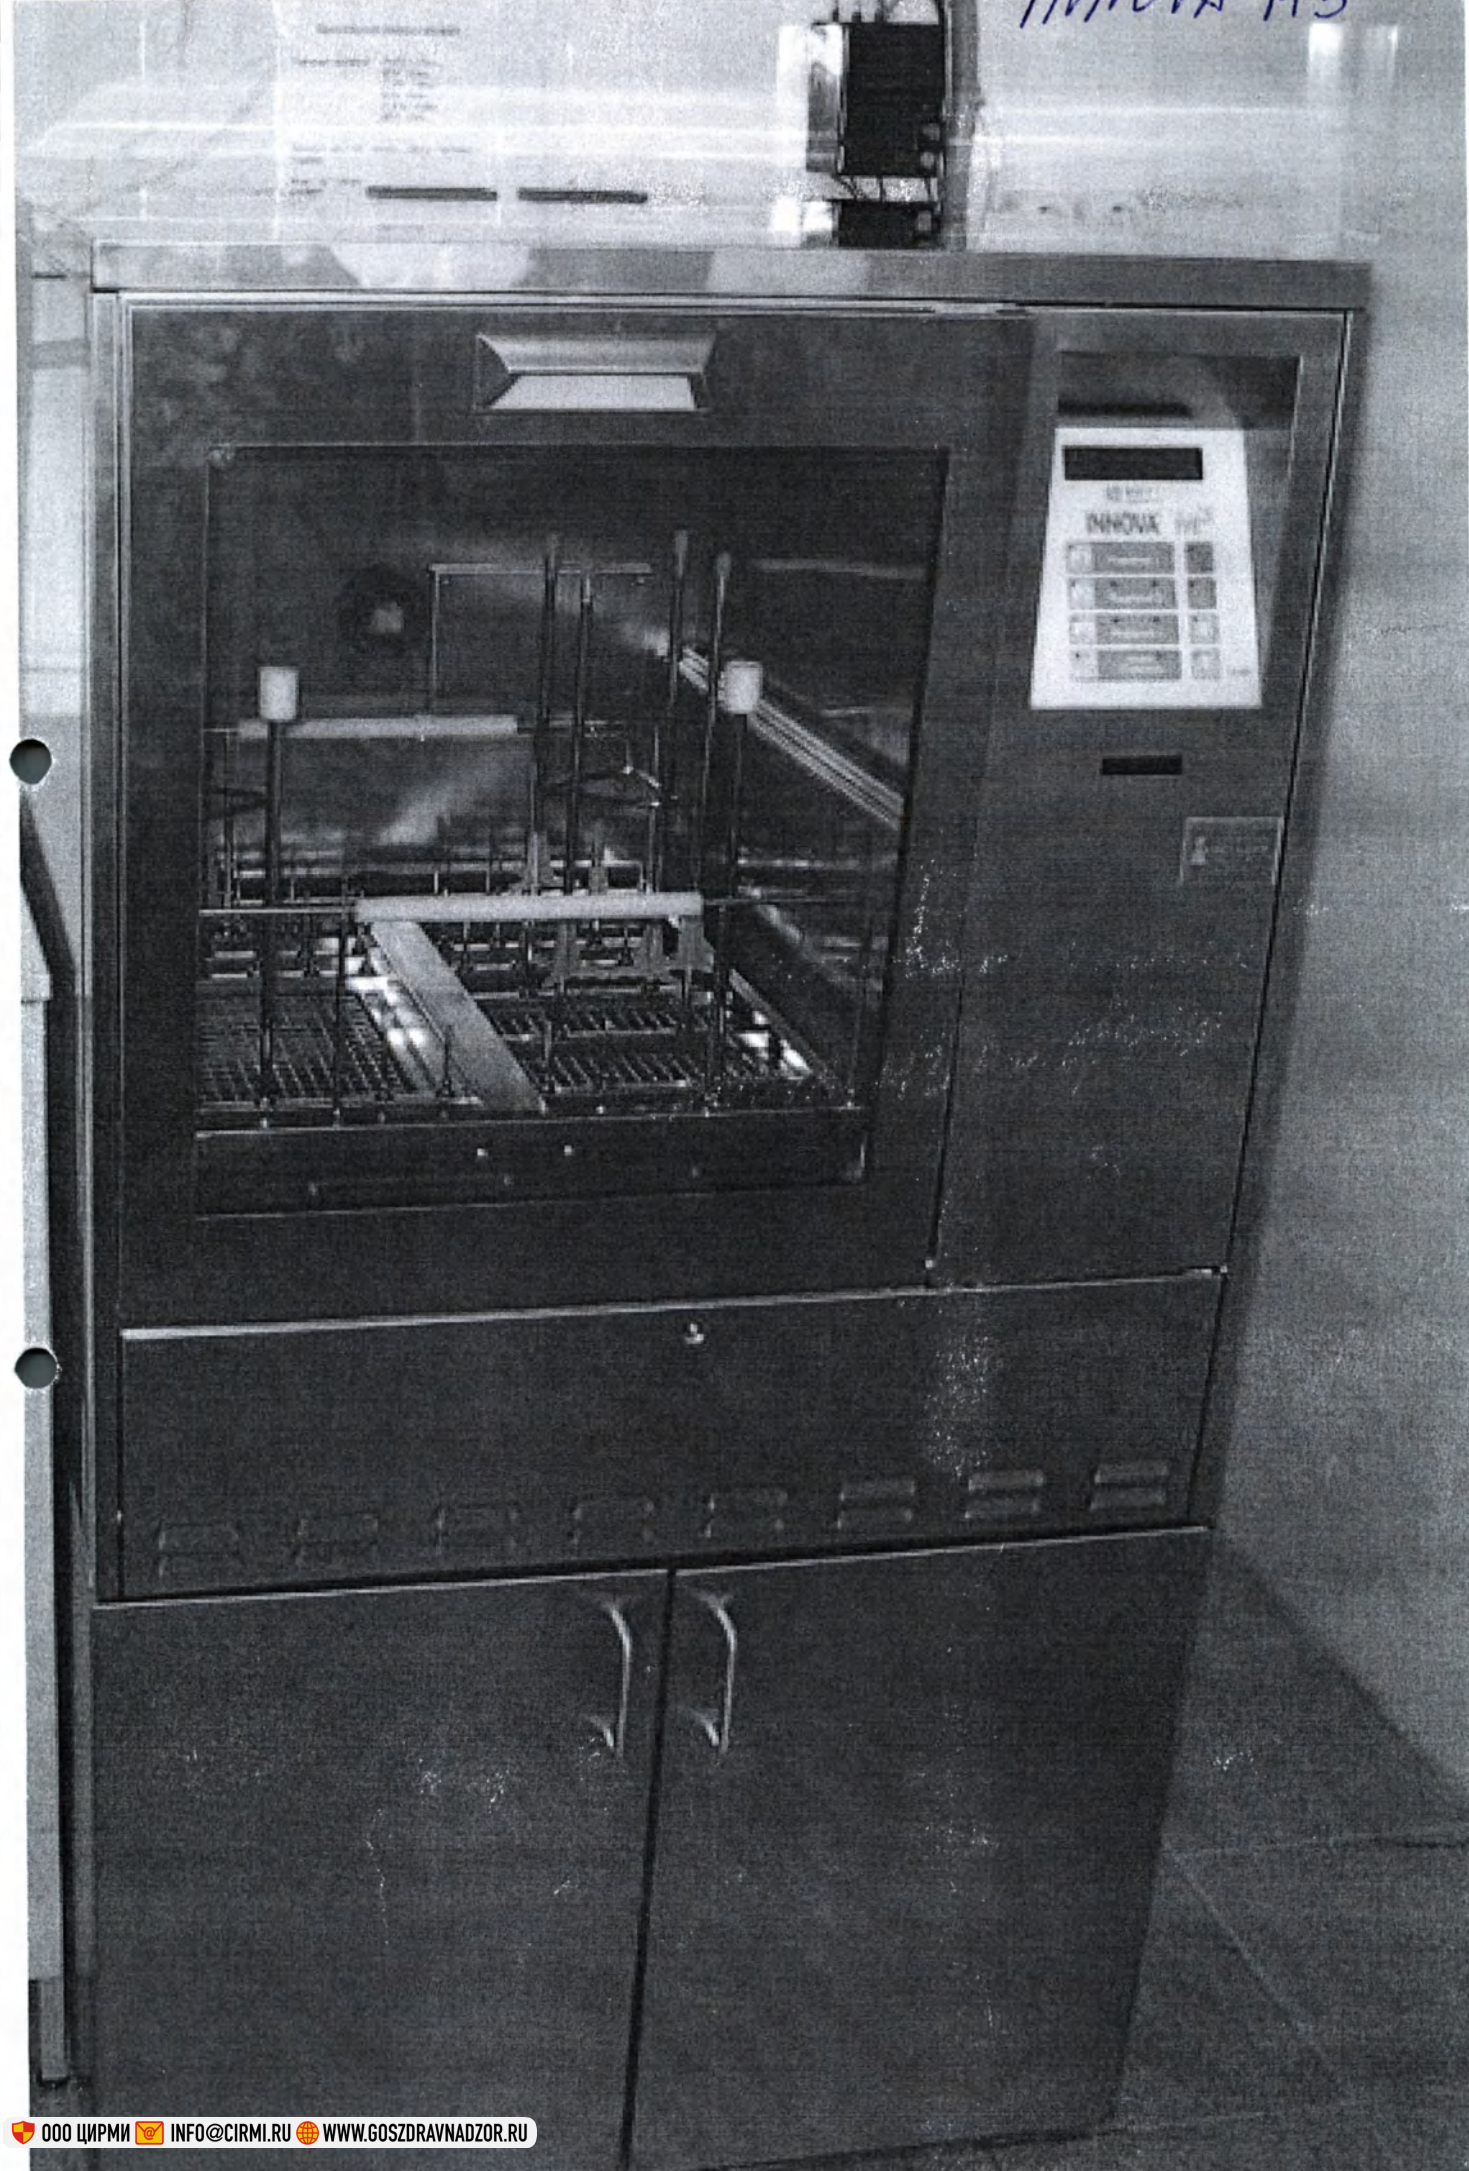


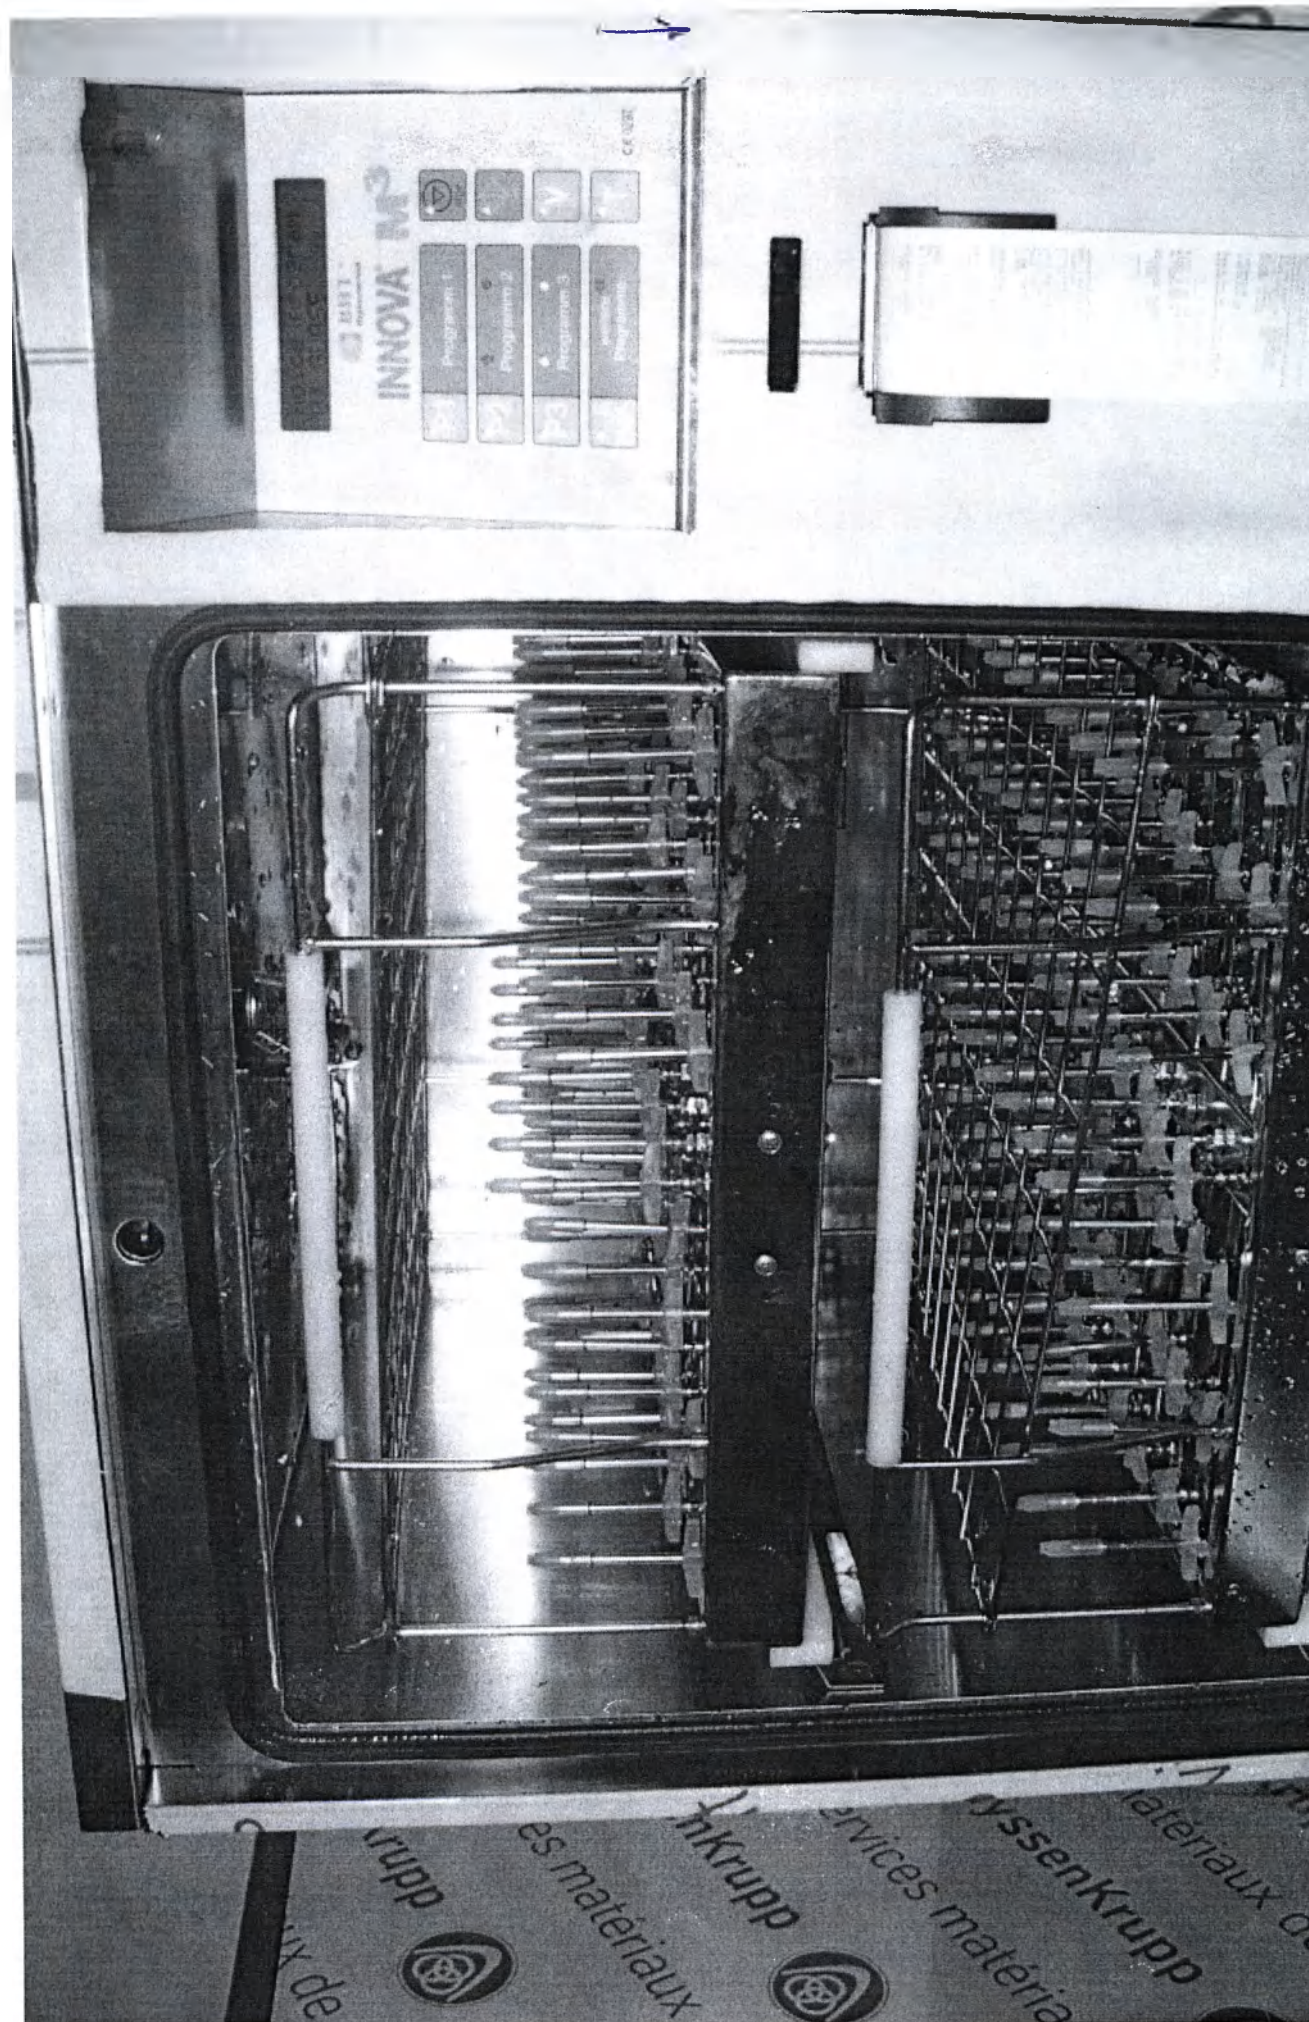


ИИДОВА М4-1




ИННОВА М4-2

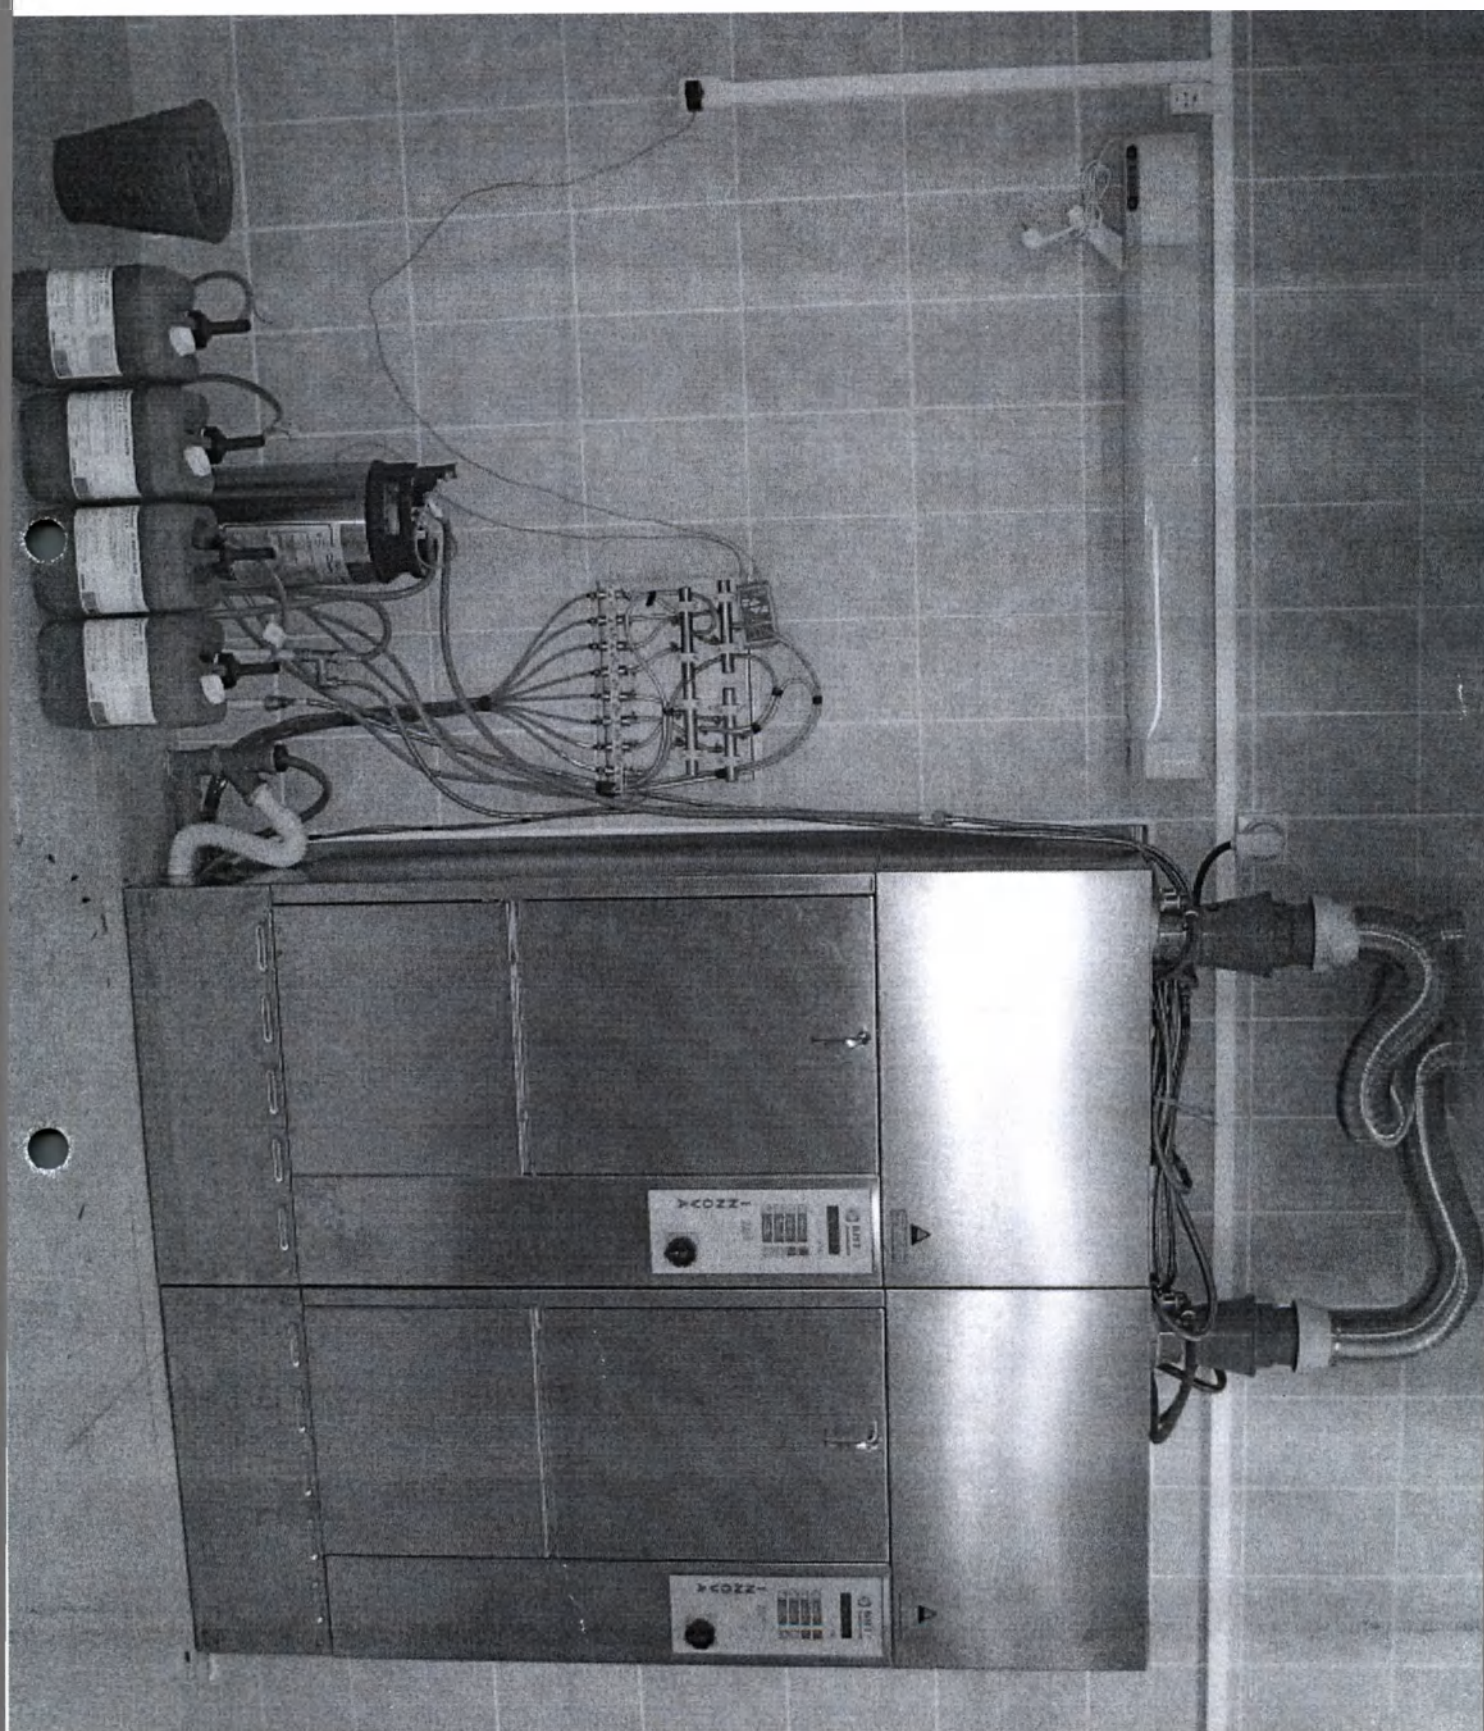

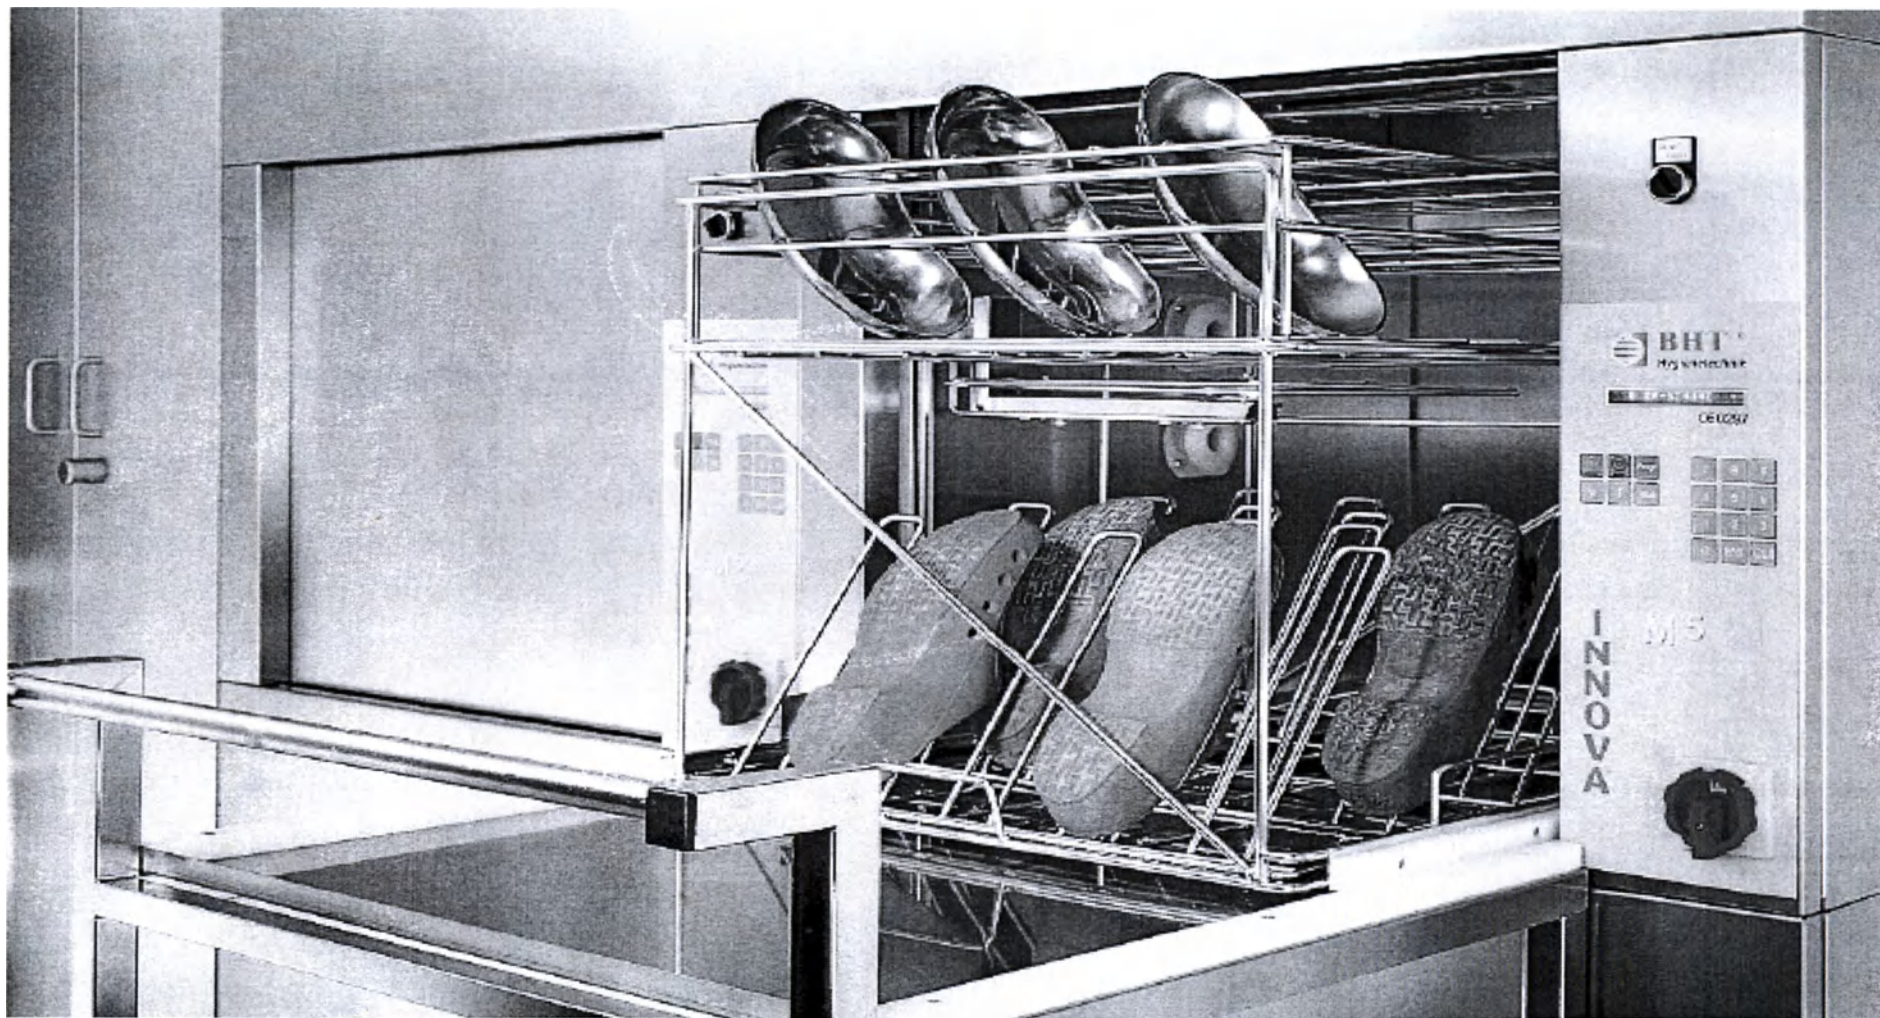

МАШИНА МОЮЩЕ-ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ INNOVA M5 - 1

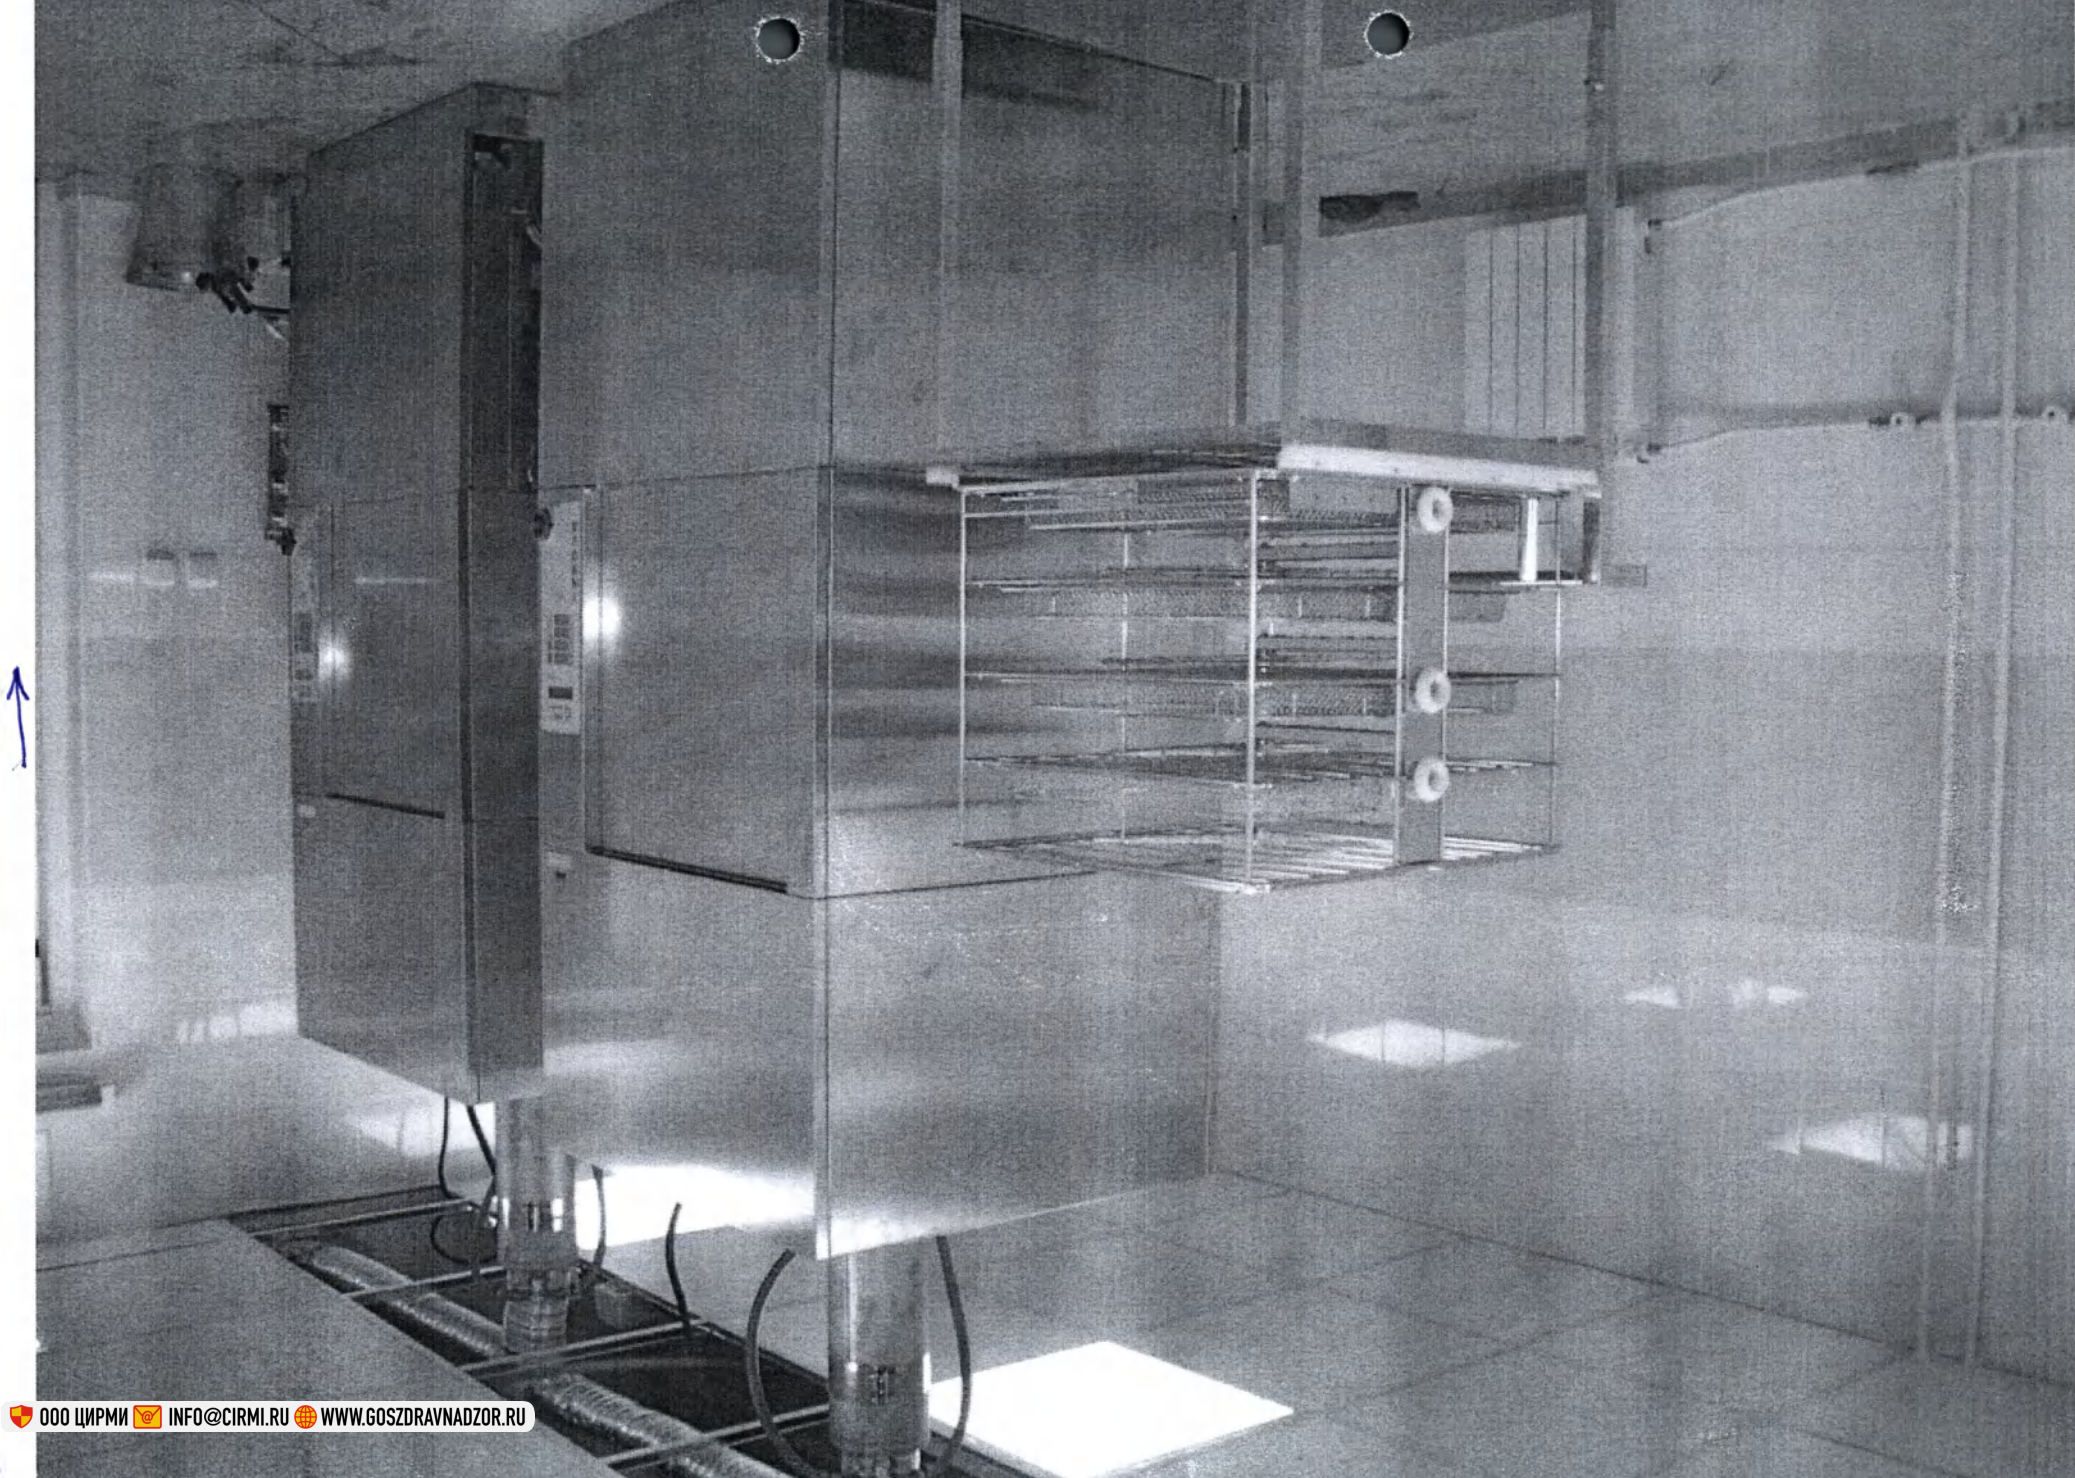


ММОВ А 15-2




Машина моеще-дезинфицирующая М5 ISO-1



МАШИНА МОЮЩЕ-ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ INNOVA M5 ISO-2

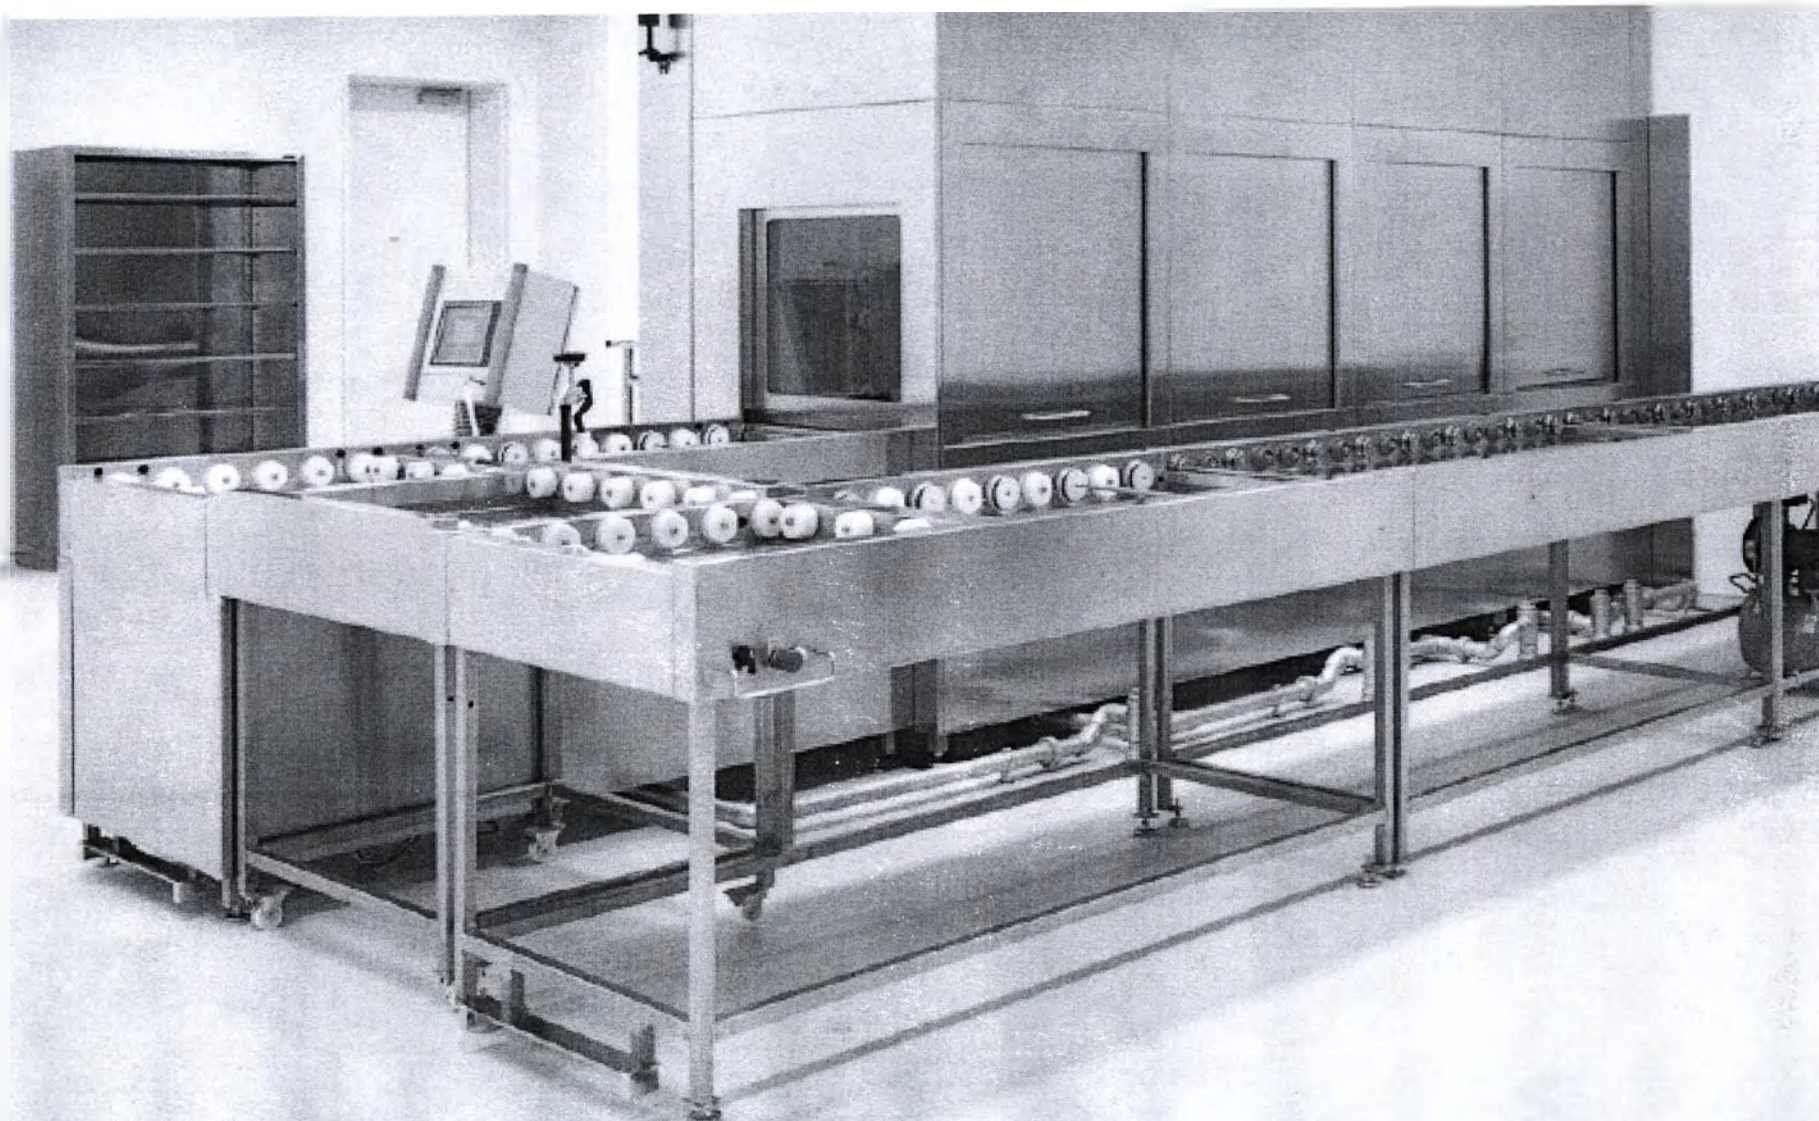

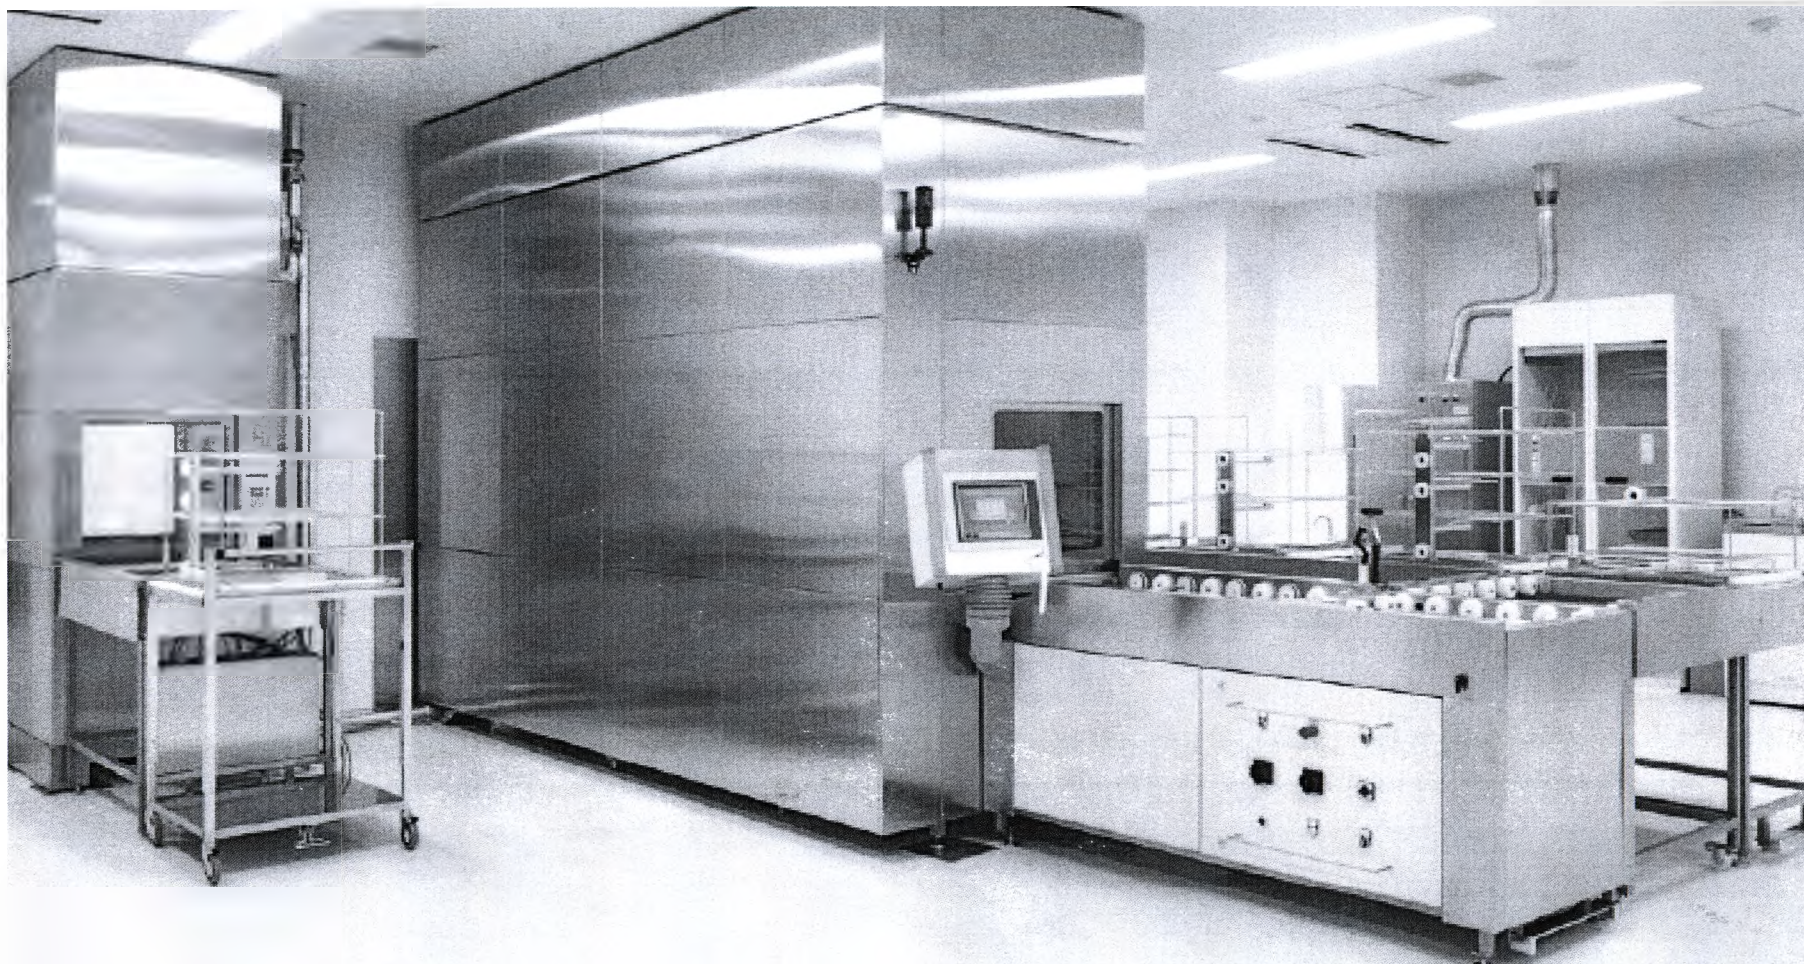

Машины моюще-дезинфицирующие INNOVA T5-4 (тоннельно-конвейерного типа).



ИНОВА E2-DC



INNOVA E2

P1 Etko Pomer
P2 Etko razmera
P3 Etko Duzine
P4 Etko Tezine
V
T

BHT
Cenovnik 2014/2015

ЭЗ МАШИНЫ
ПАРТОНА ВЪВЕДЕНИЕ
МАШИНЫ МАШИНЫ

КУ6

CE 0297

P01 STEP:04
05.0 0069

INNOVA® E₂

P1

Endo Normal

P2

Endo Intensiv

P3

Endo Zubehör

P4

weitere
Programme

V

T

BHT

Disinfection Technology

МАШИНА МОЕЮЩАЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ
INNOVA E3-DK



ИННОВА E3 124
кнопочный дисплей + встроенный принтер

ASKLEPIOS
Klinische Schmelztechnik
ID No. 26586
1111 1111 1111 1111

BHT
Hygienetechnik


INNOVA[®] E3

P1	Endo Normal	
P2	Endo Intensiv	
P3	Endo Zubehör	V
P4	weitere Programme	T


CE 0297

BHT-INNOVA-E3
V E360102.45
12.05.2015 / 15:55
Masch.-Nr.: 55555001
DOSIEREN PARAMETER
A C sek Imp ml
DOSI 1 37 000 1007
DOSI 2 10 010 0000
DOSI 3 1 40 045 1100
DOSI 4 0 30 010 0000
DOSI 5 0 30 010 0000

ИННОВА Е3-РС (общий вид)

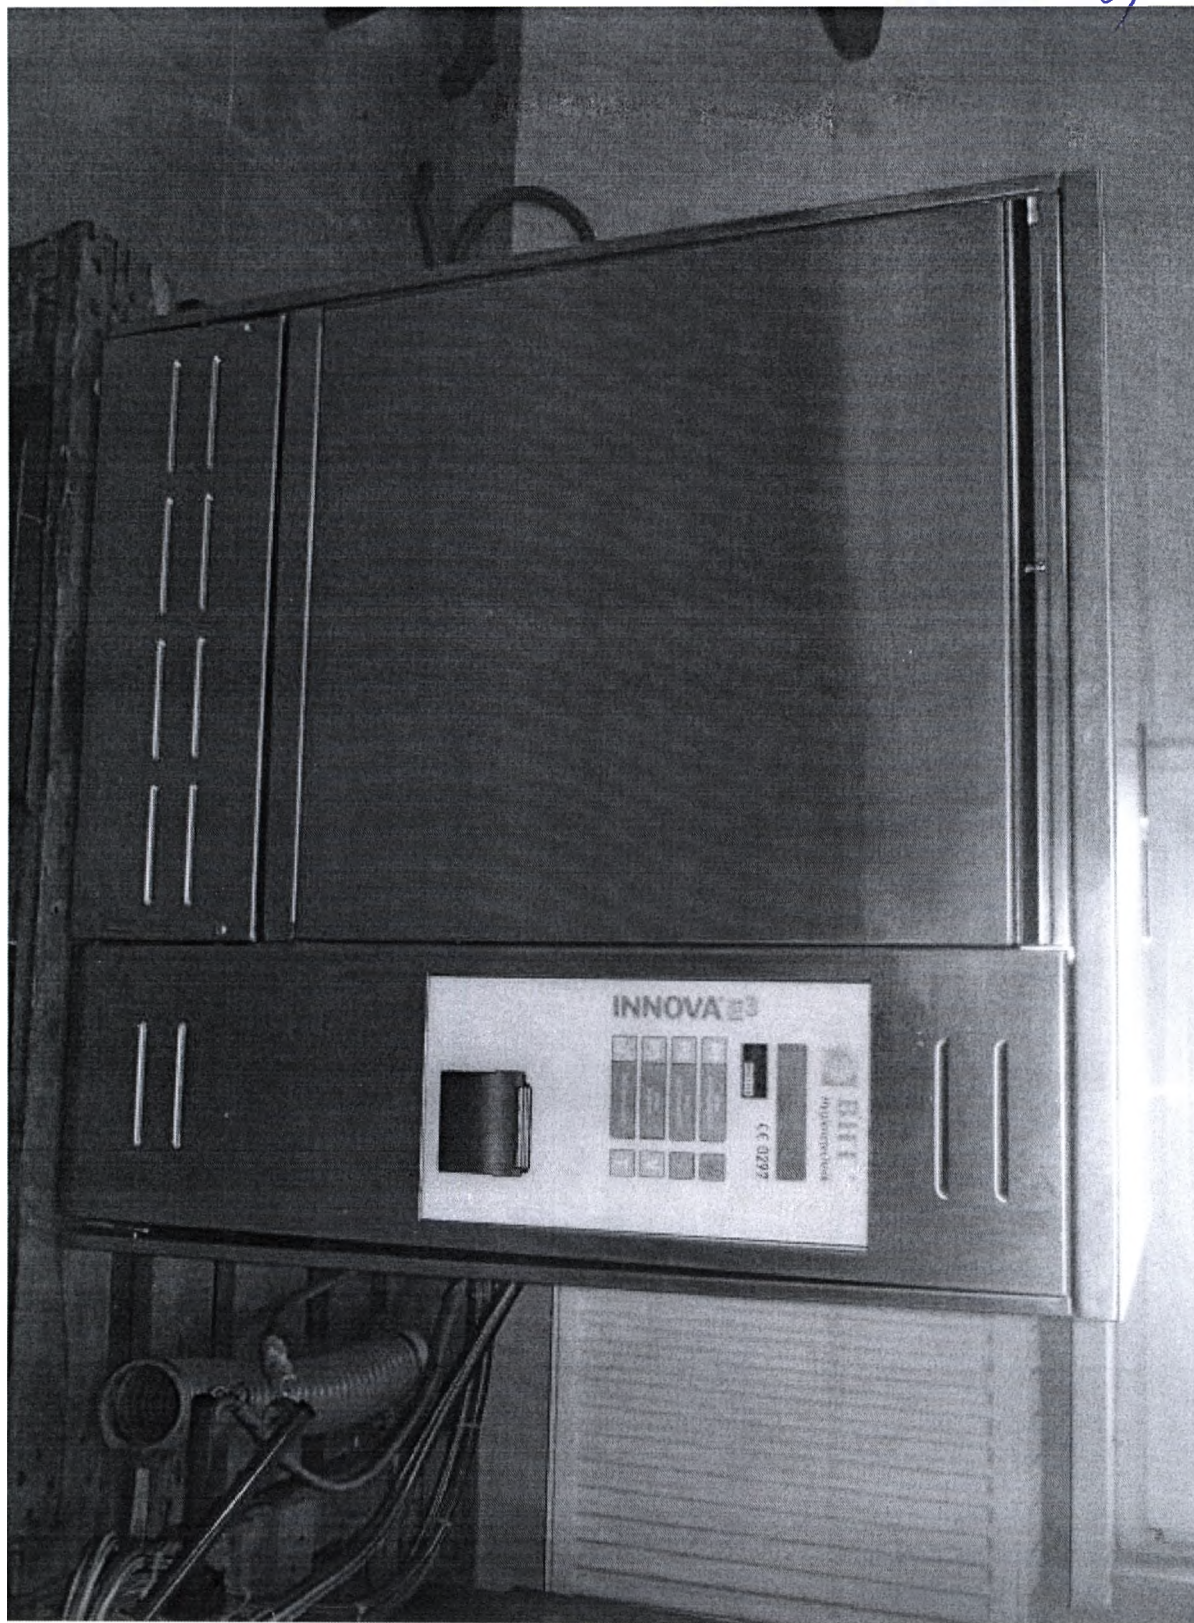


ИНОВА ЕЗ-ДС с откидной дверью

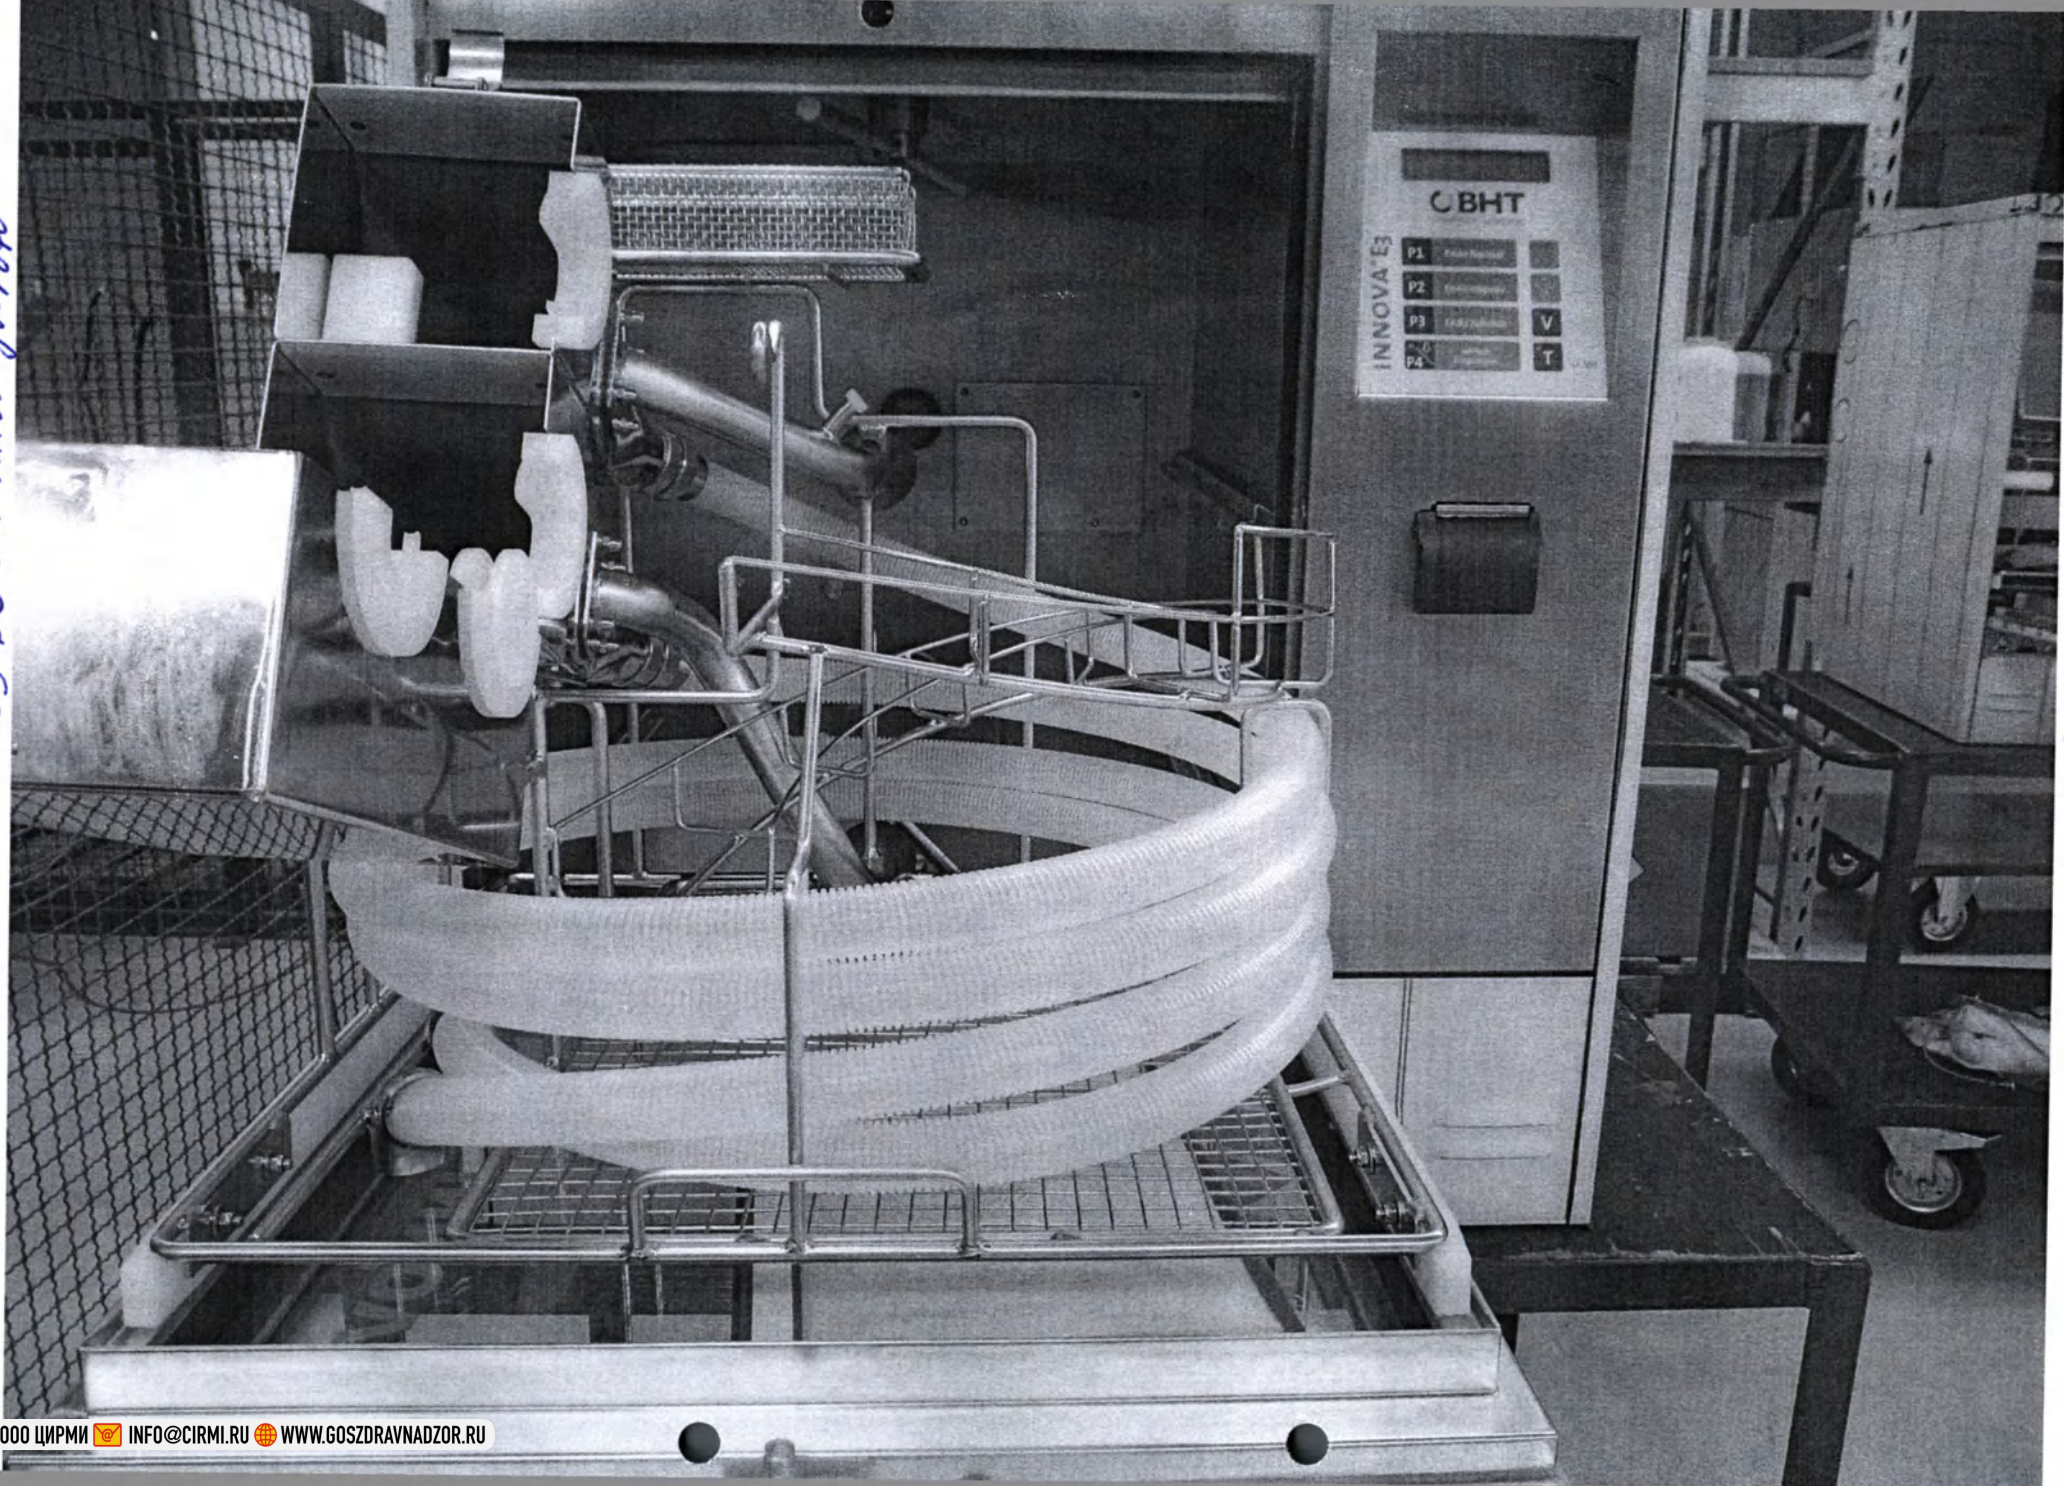


↓

18

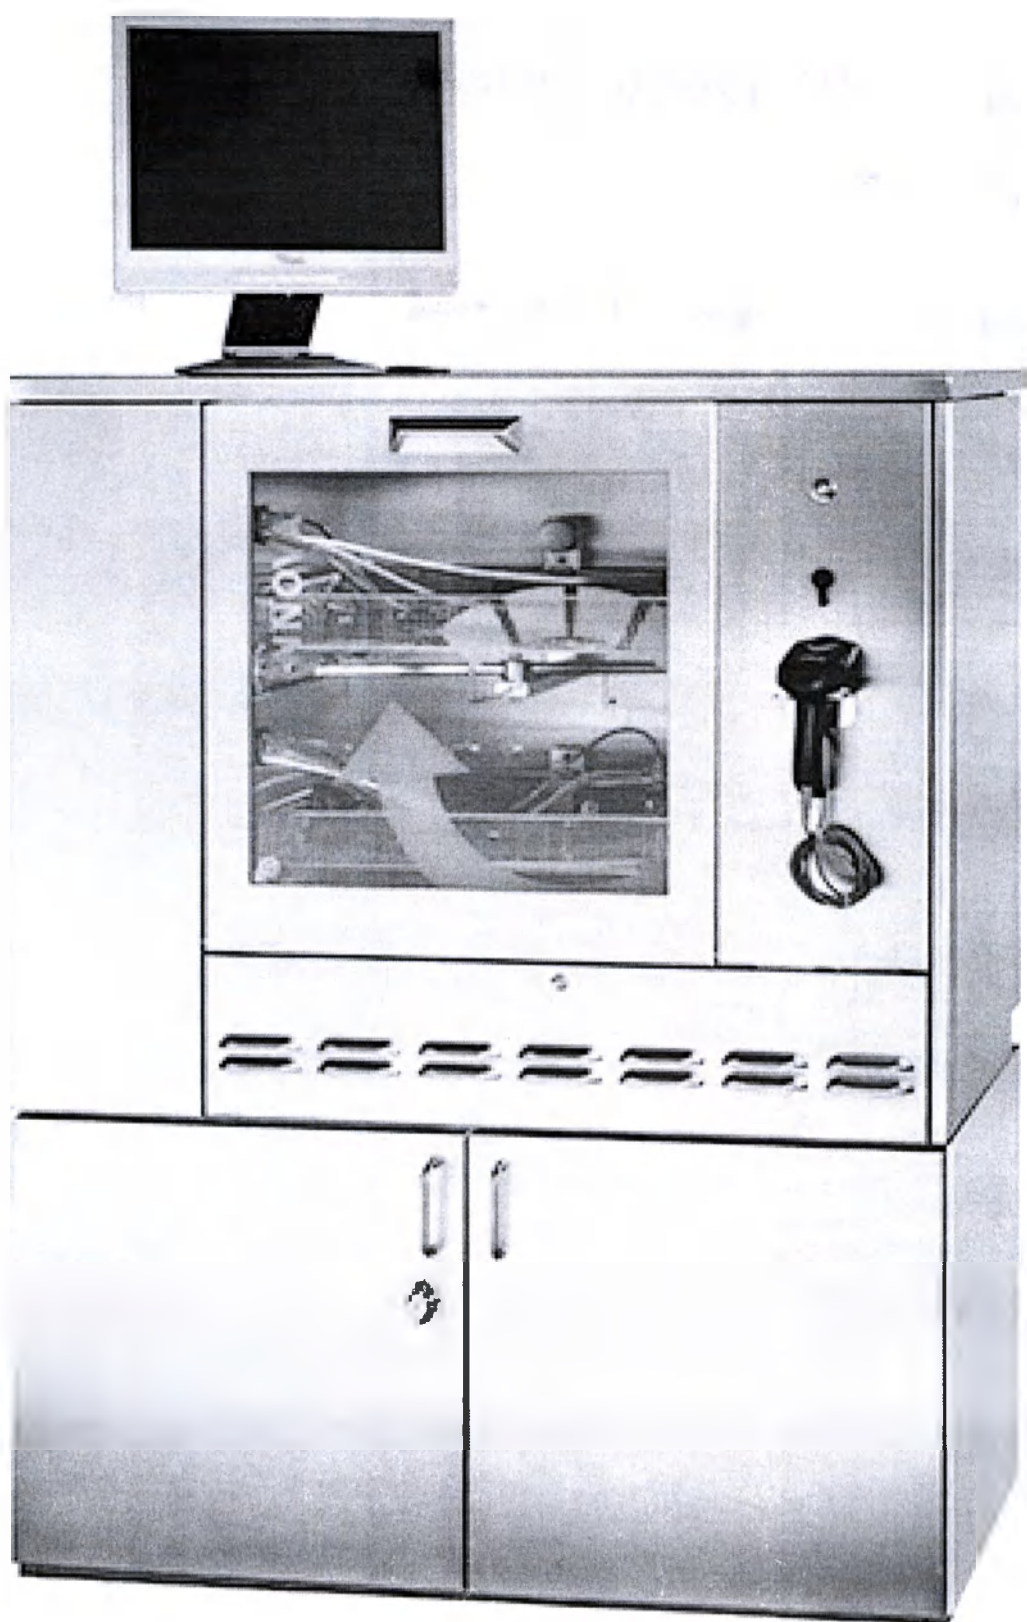


Машина моюще-дезинфицирующая INNOVA E3 CMS-DH (общий вид)

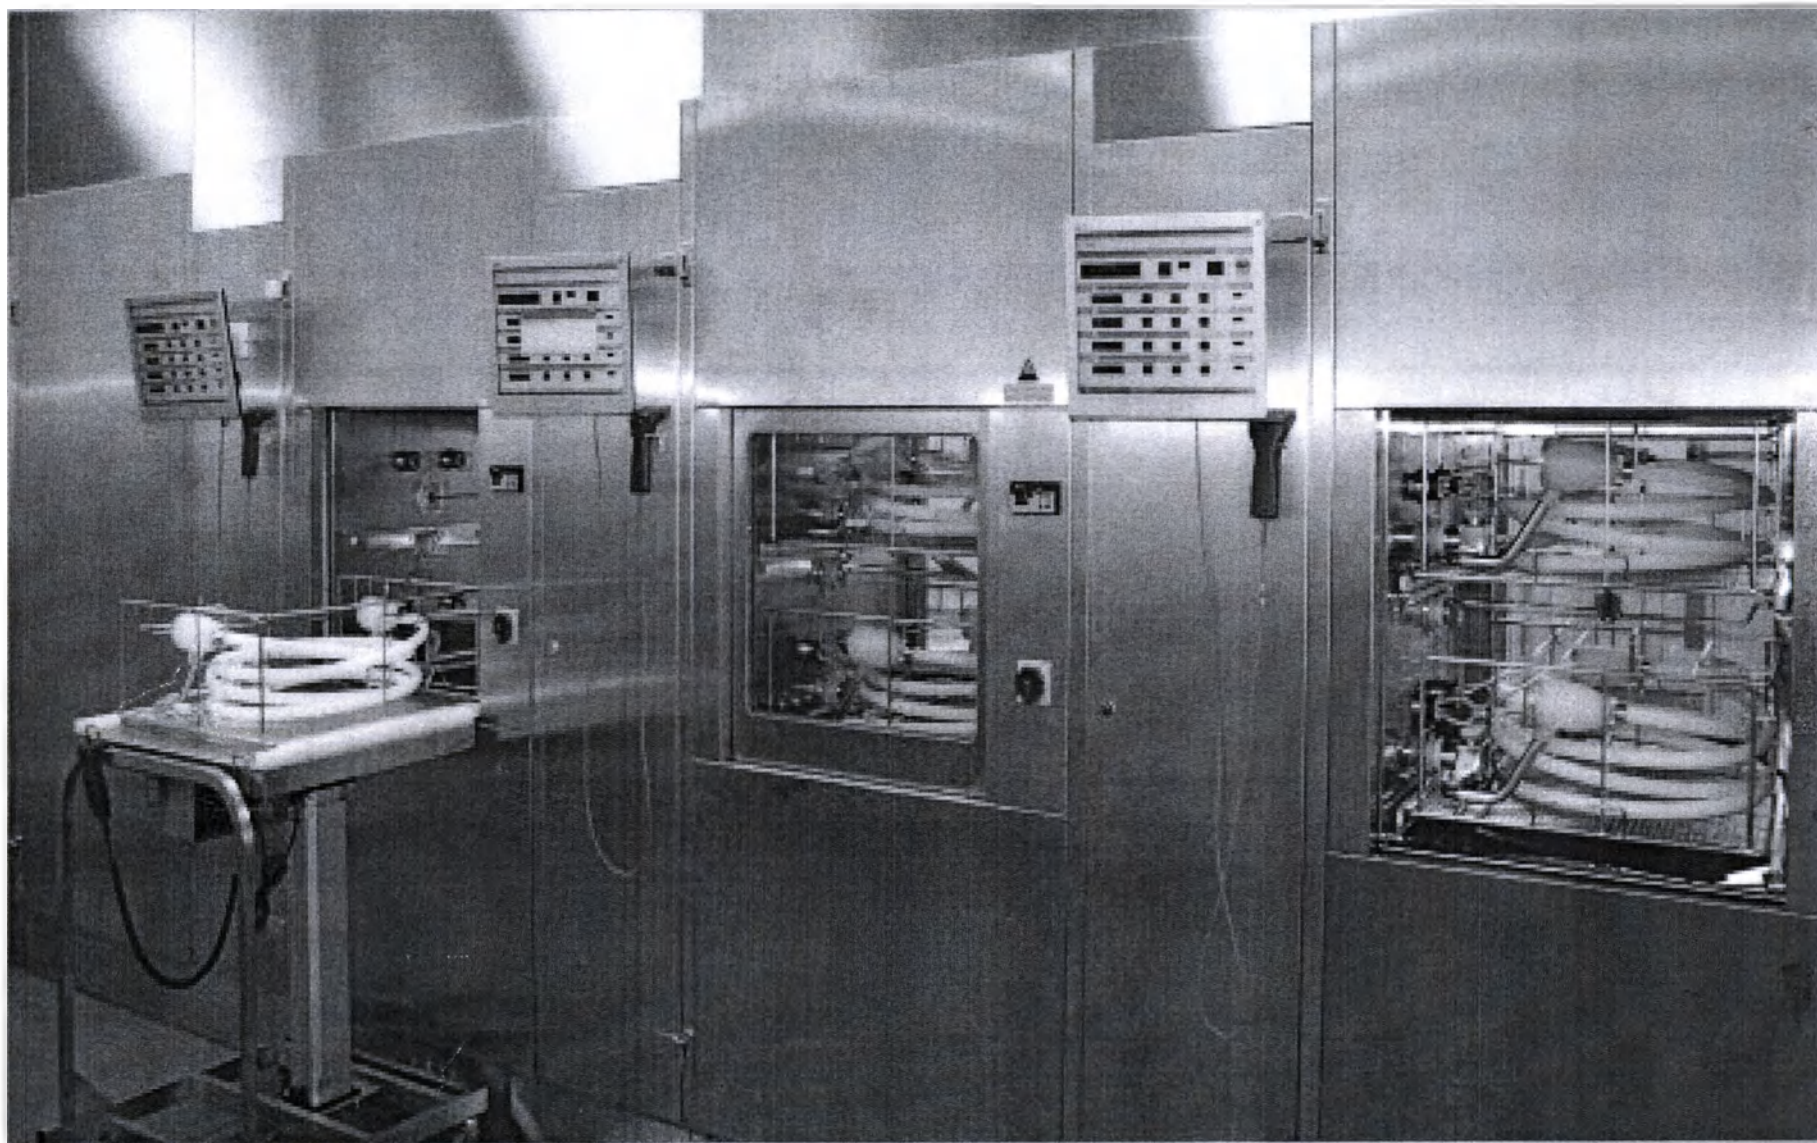


Машина моюще-дезинфицирующая INNOVA E3 CMS-DC.

Машина моеще-дезинфицирующая INNOVA E4 CMS DH



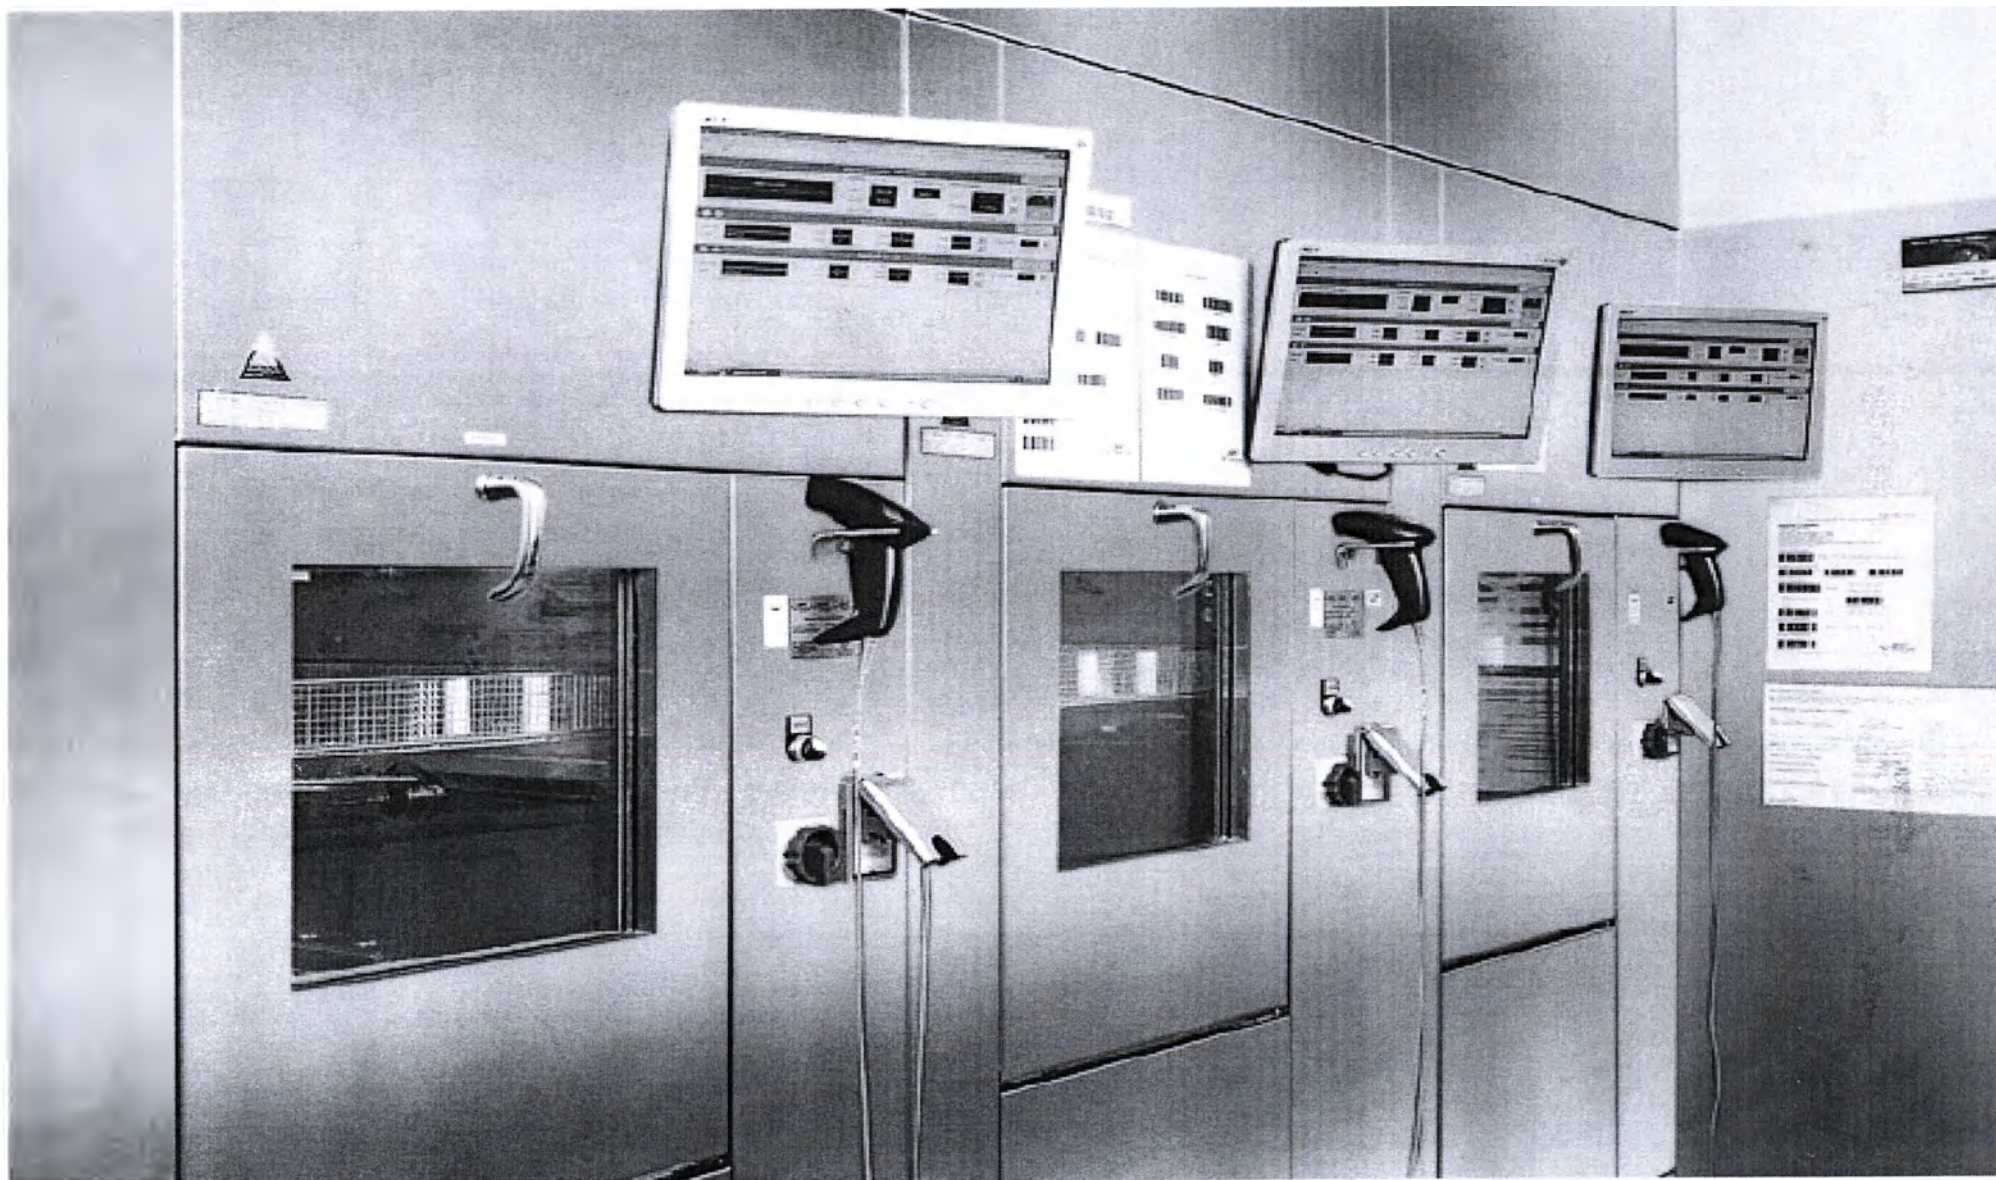

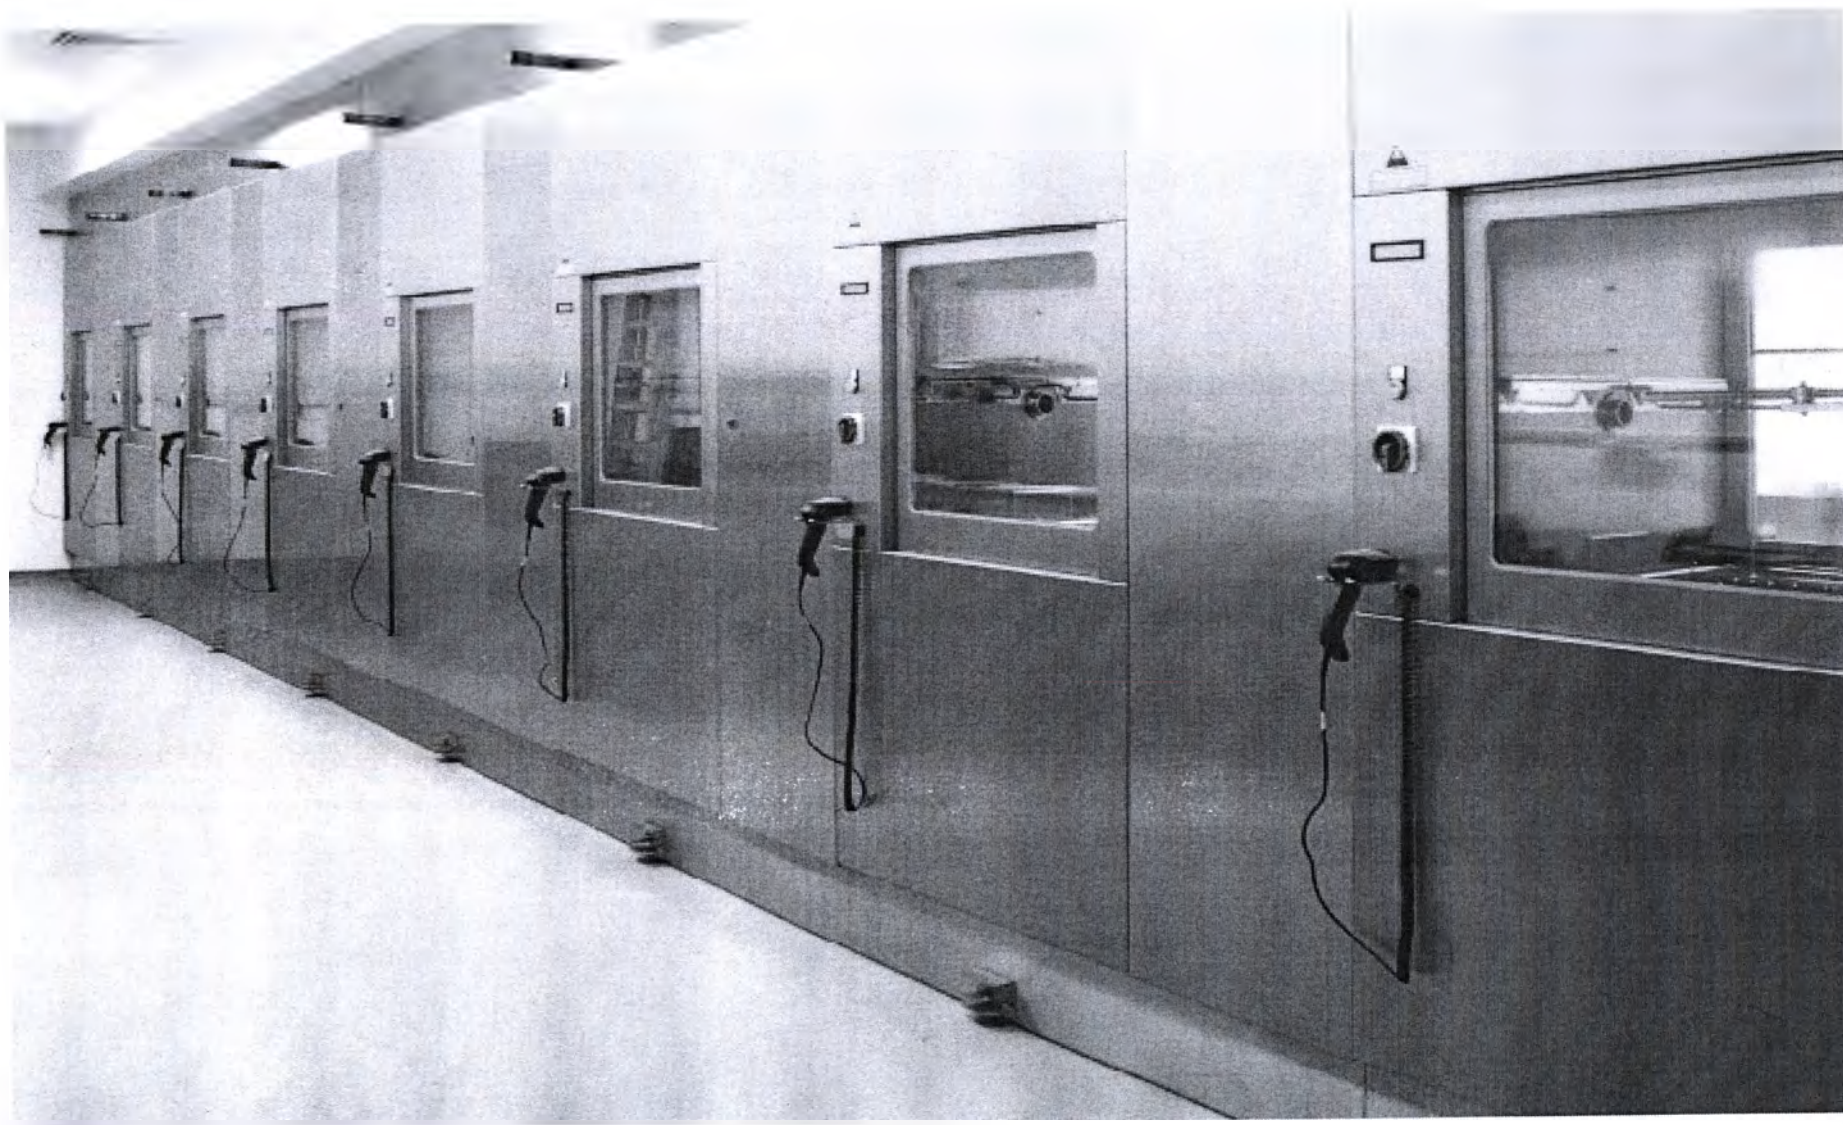

Машины моюще-дезинфицирующие INNOVA E5 CMS DC



Работа со сканирующим устройством в машинах INNOVA серии CMS для гибких эндоскопов с системой мониторинга каналов.

(E3, E4 и E5)

МАШИНА ІННОВА серій СМС (Е3, Е4 і Е5)



Barcodes

LOGIN



LOGOUT




START



STOP



PREPARE/ENDOSKOPMASKE

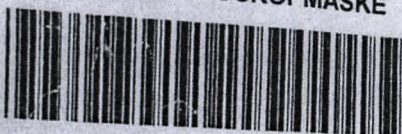

ERRORQUIT



SERVICE/77833864



SERVICE BHT



PRÜFFELD BHT



ENDO-NORMAL-DH




ENDO-INTENSIV-DH



CMS-DIAGNOSE




ENDO-NORMAL-DC



HYGIENETEST-DH



MASCH-DESINFEKTION



CC-TROCKNEN



09/2012/1P

Datum: 19.07.2012
Gehört zu: 000011_01_HA

TESTBENCH - Barcodevorlage

Verwendbar mit den Programmen

- ENDO-NORMAL-DH
- SETUP-DH
- ENDO-INTENSIV-DH

serial no.: FT1-V6-DH



serial no.: FT2-V6-DH



serial no.: FT3-V6-DH




serial no.: FT4-V6-DH





Barcodes







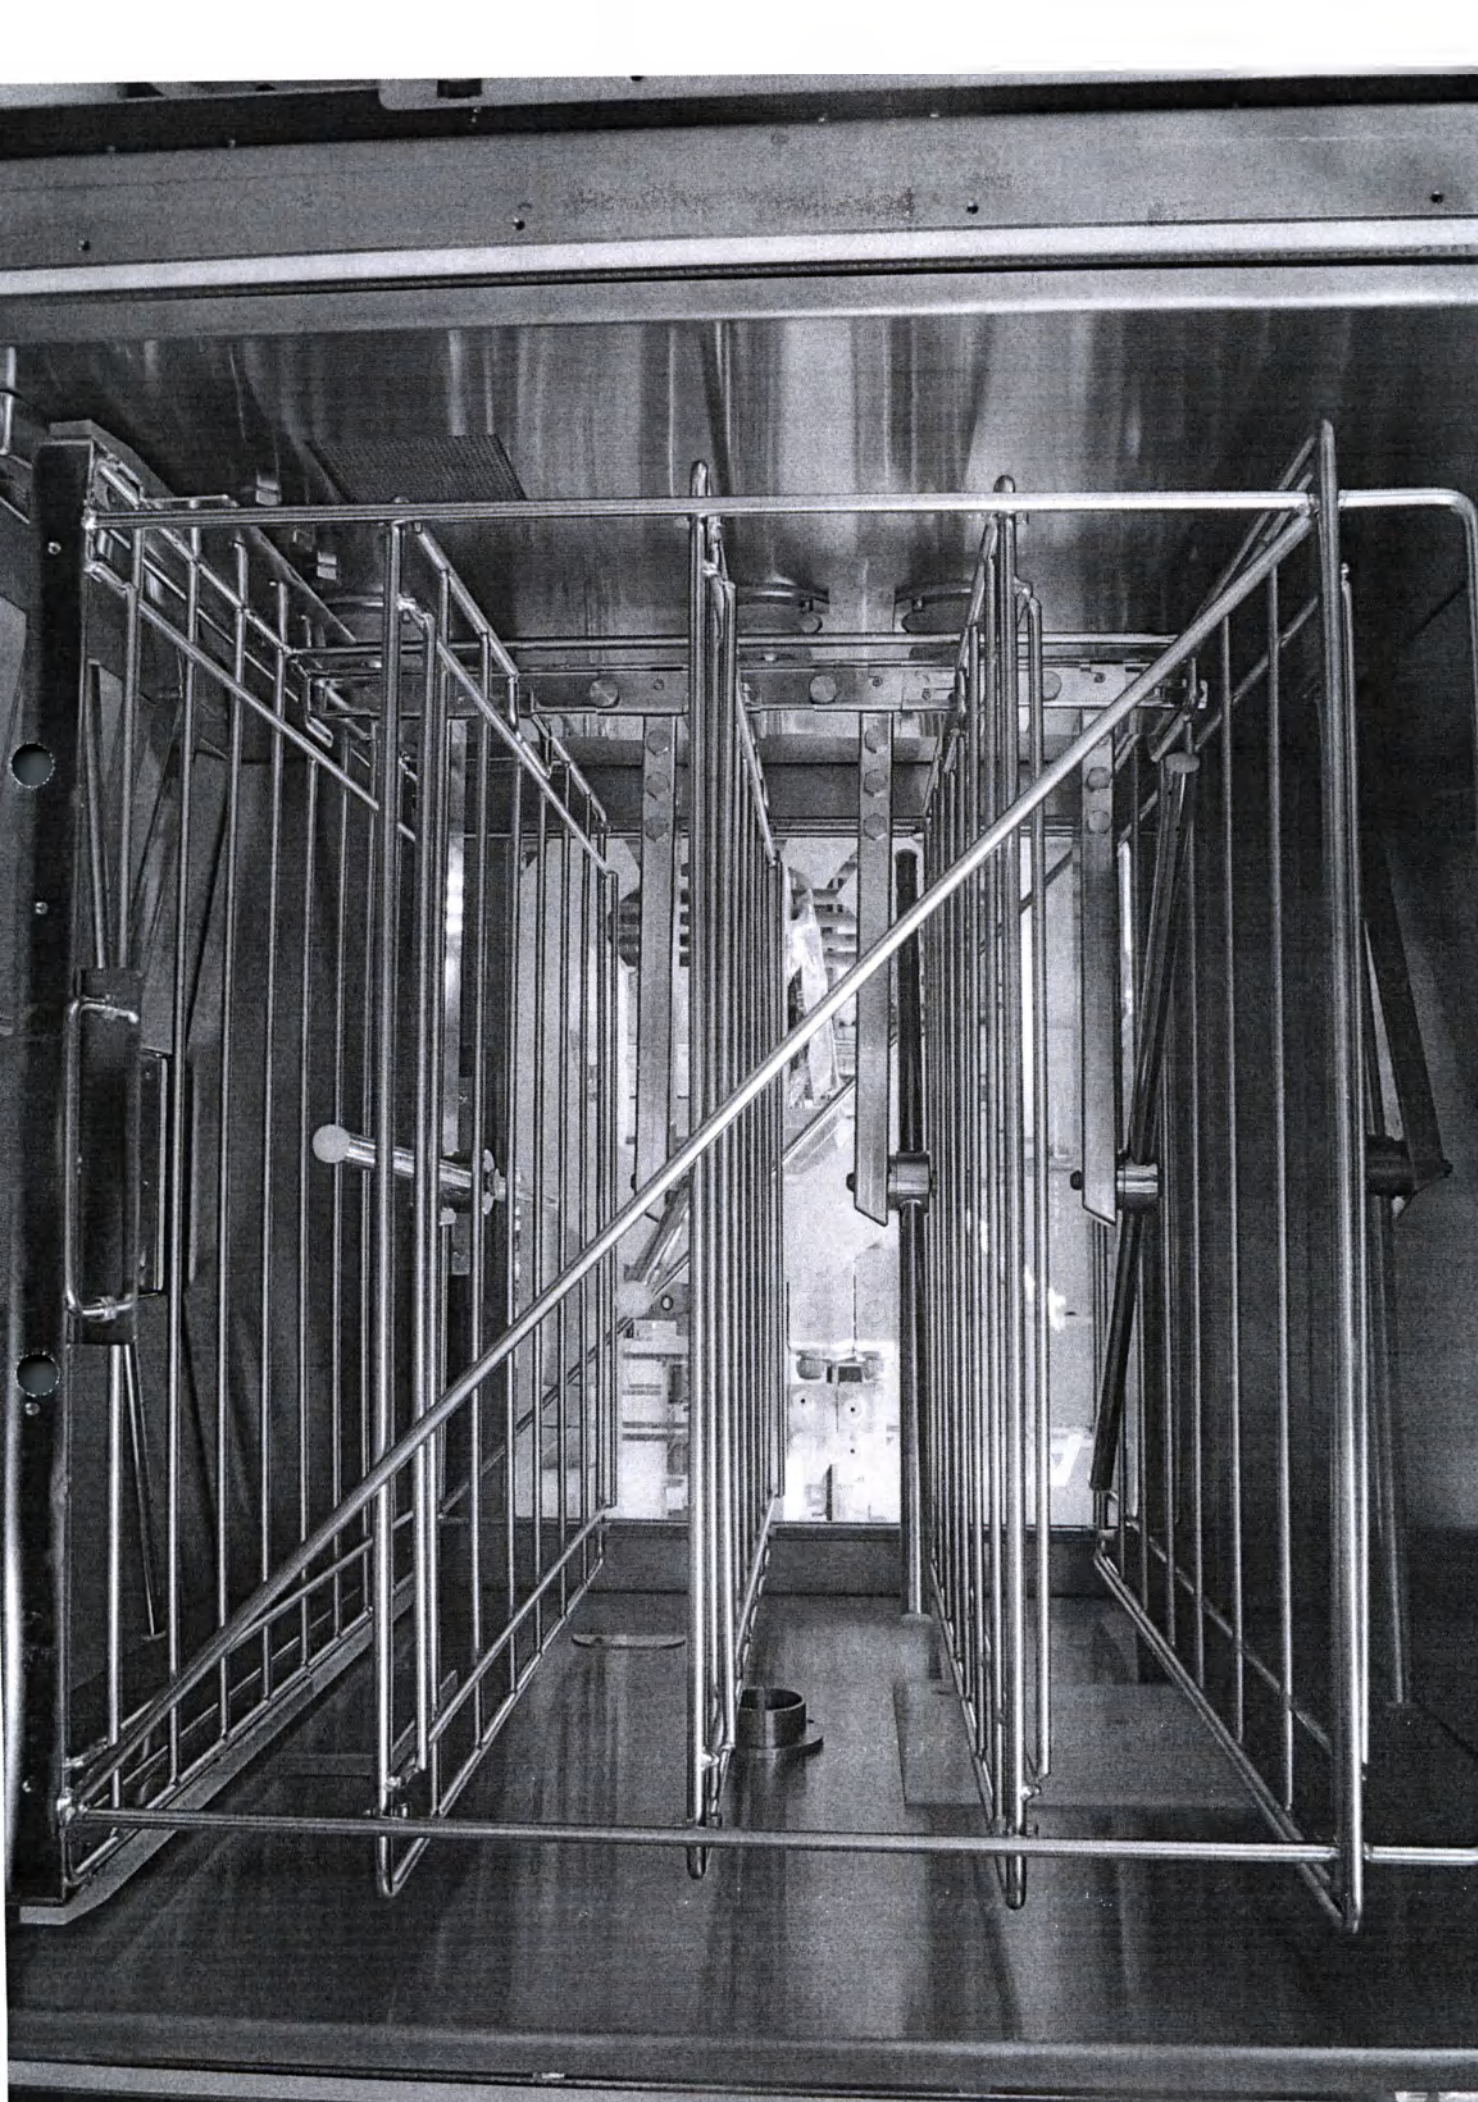


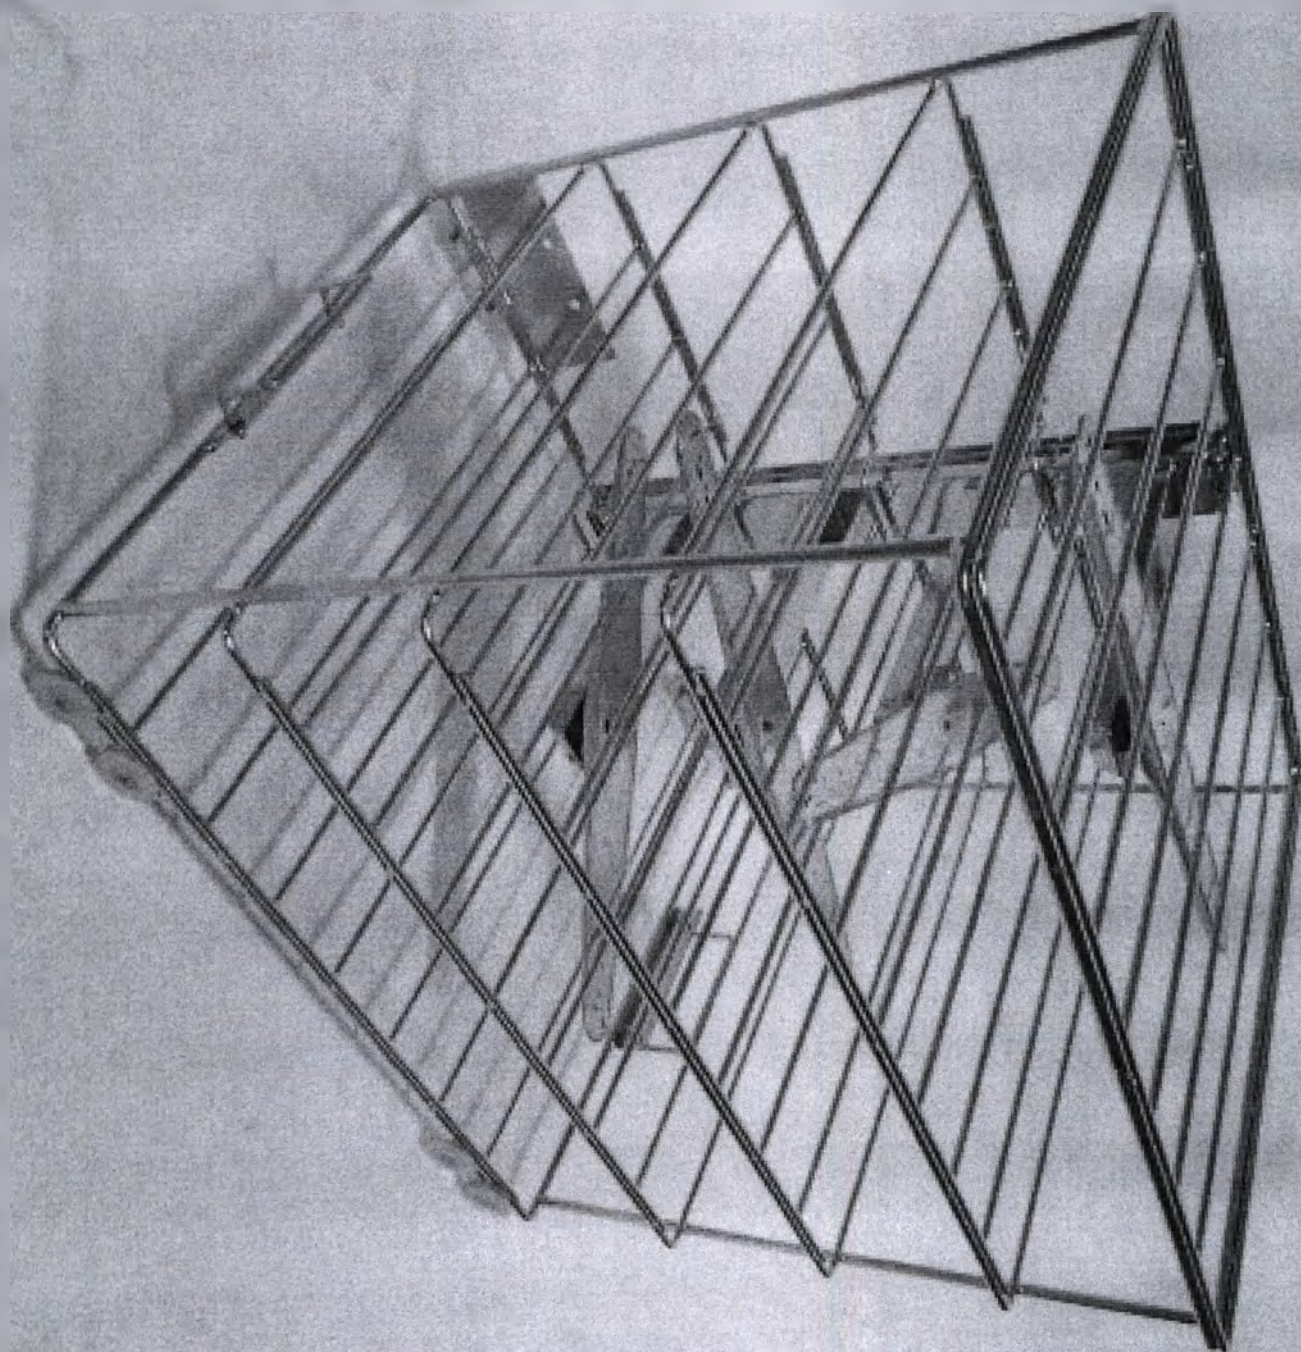


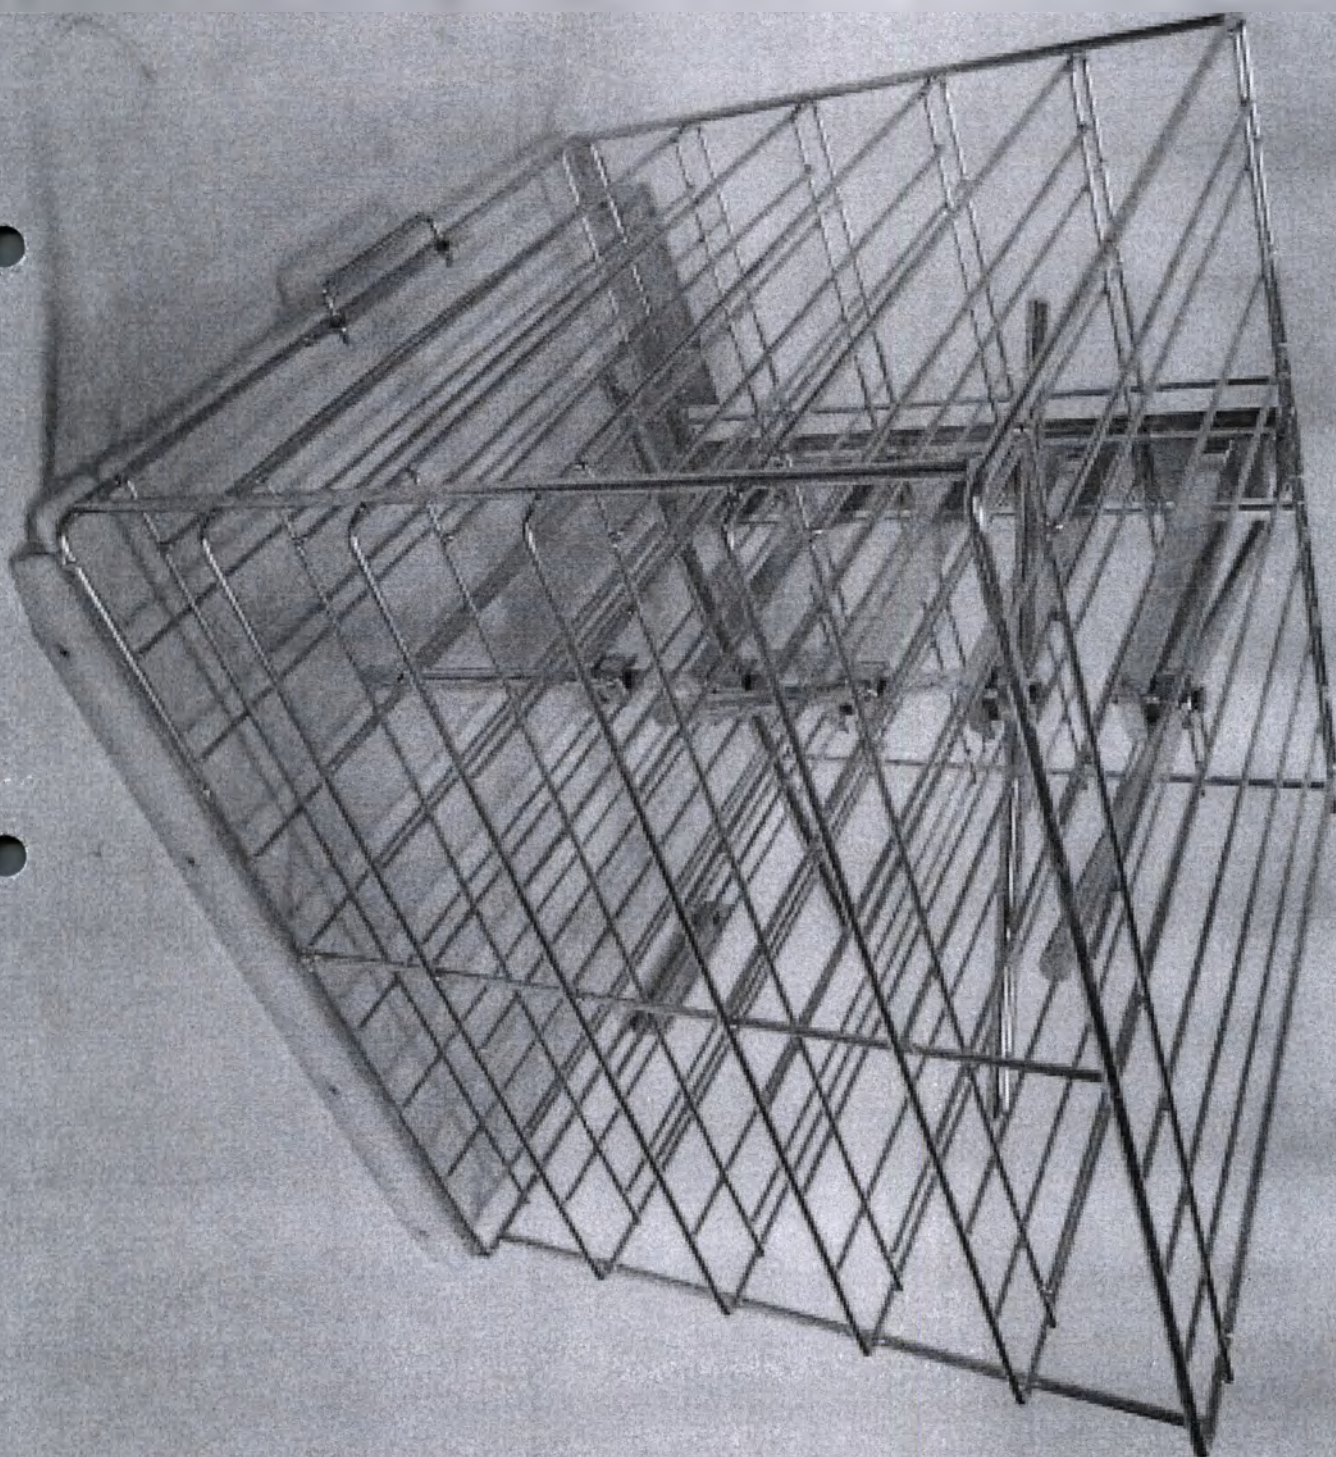


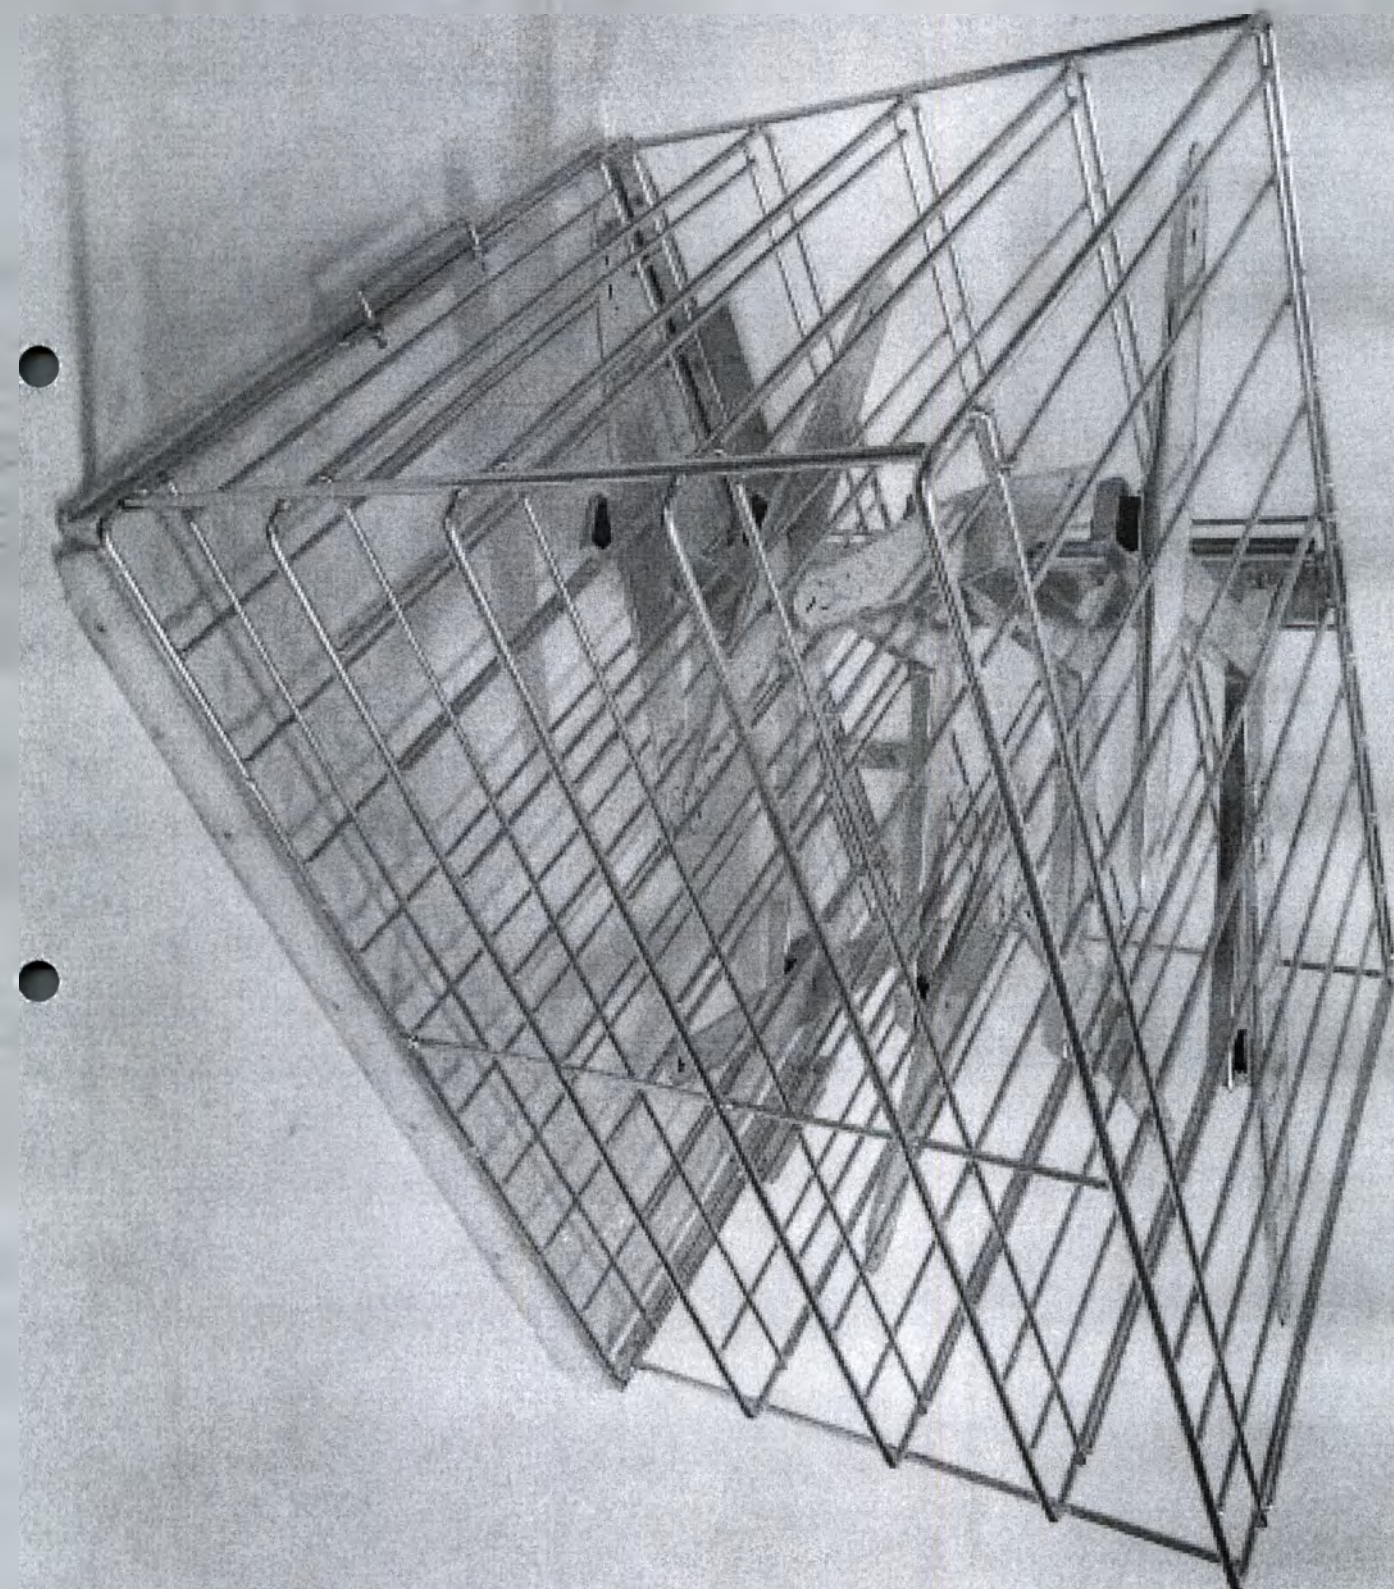

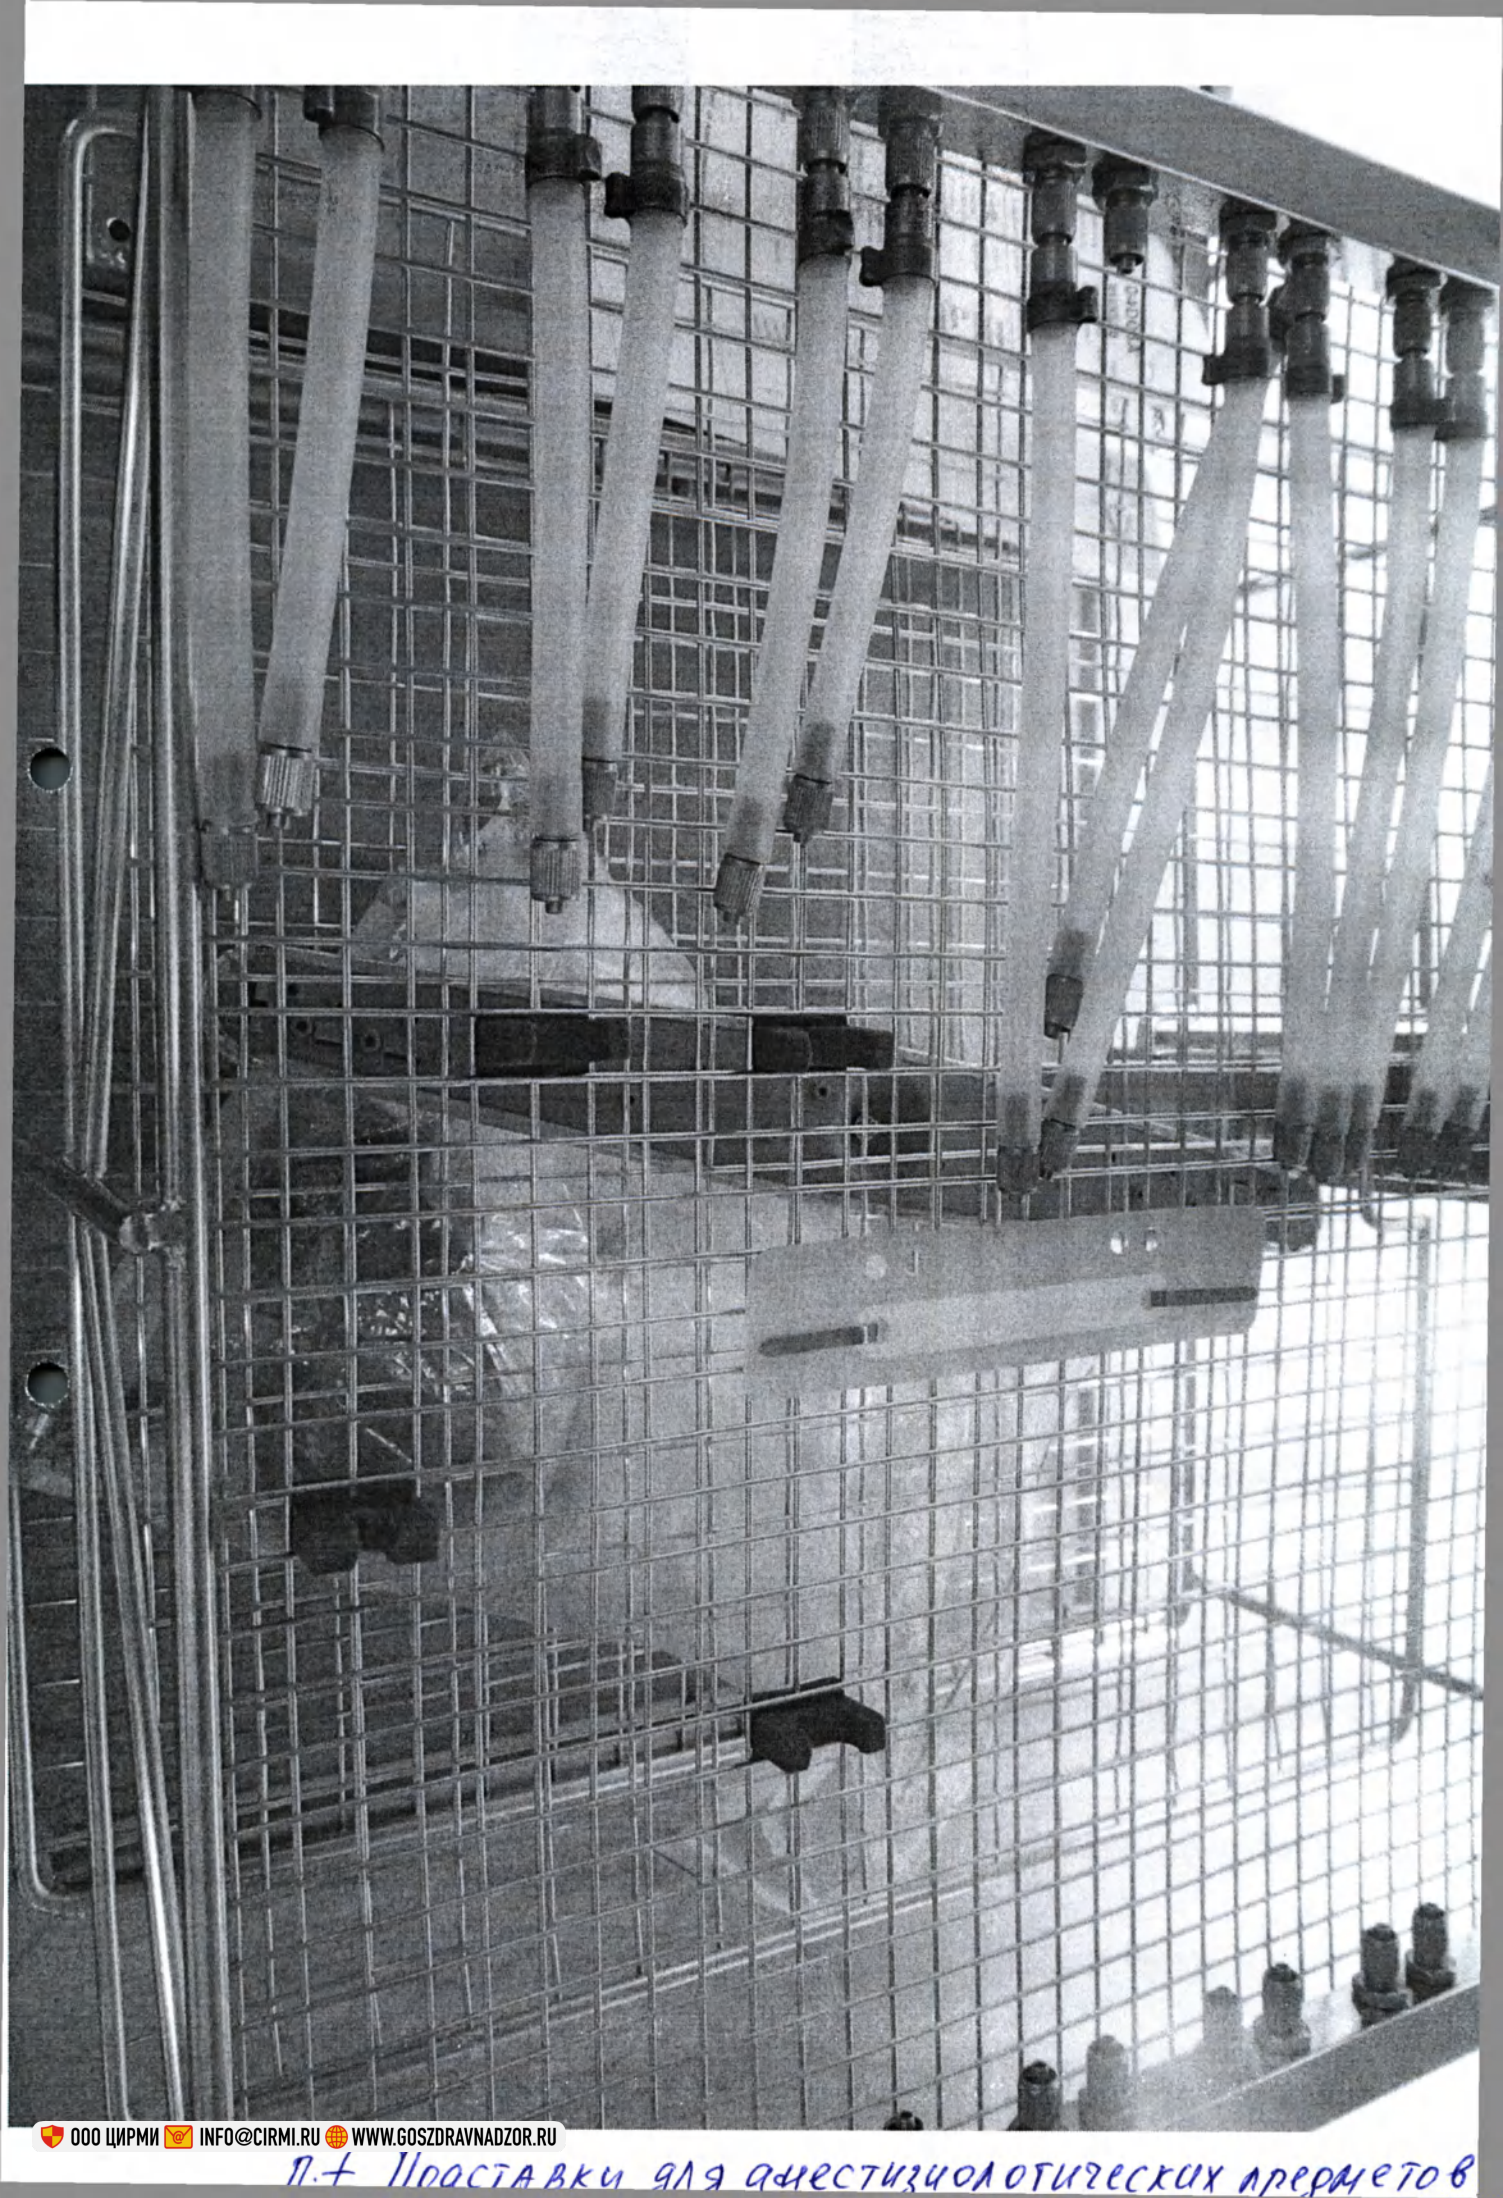

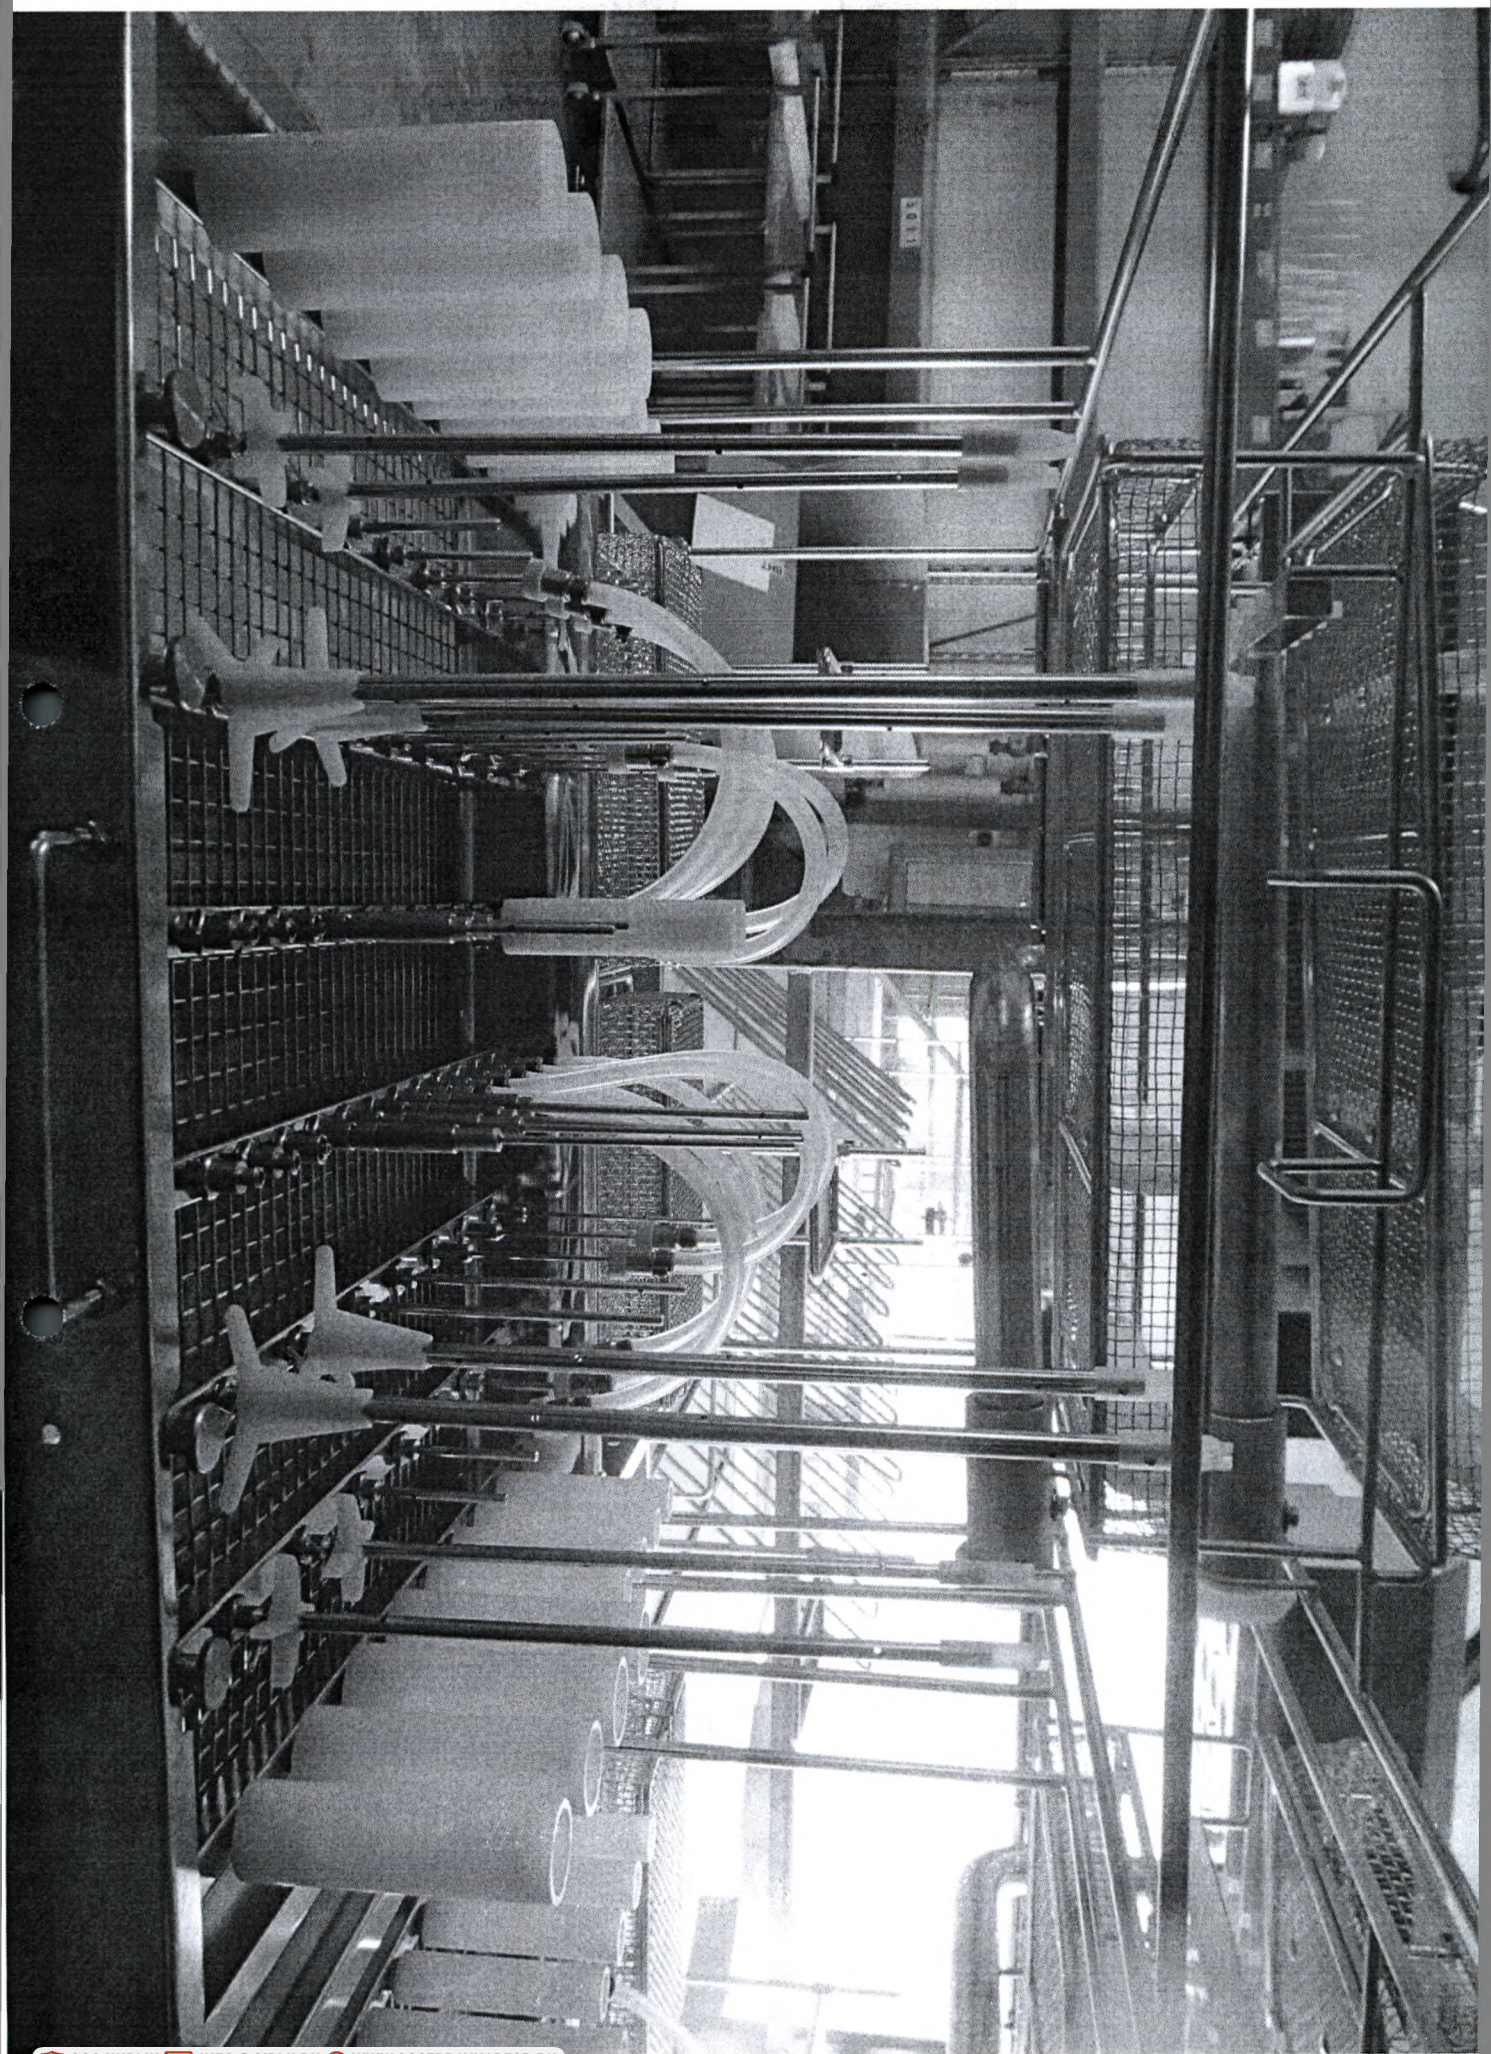


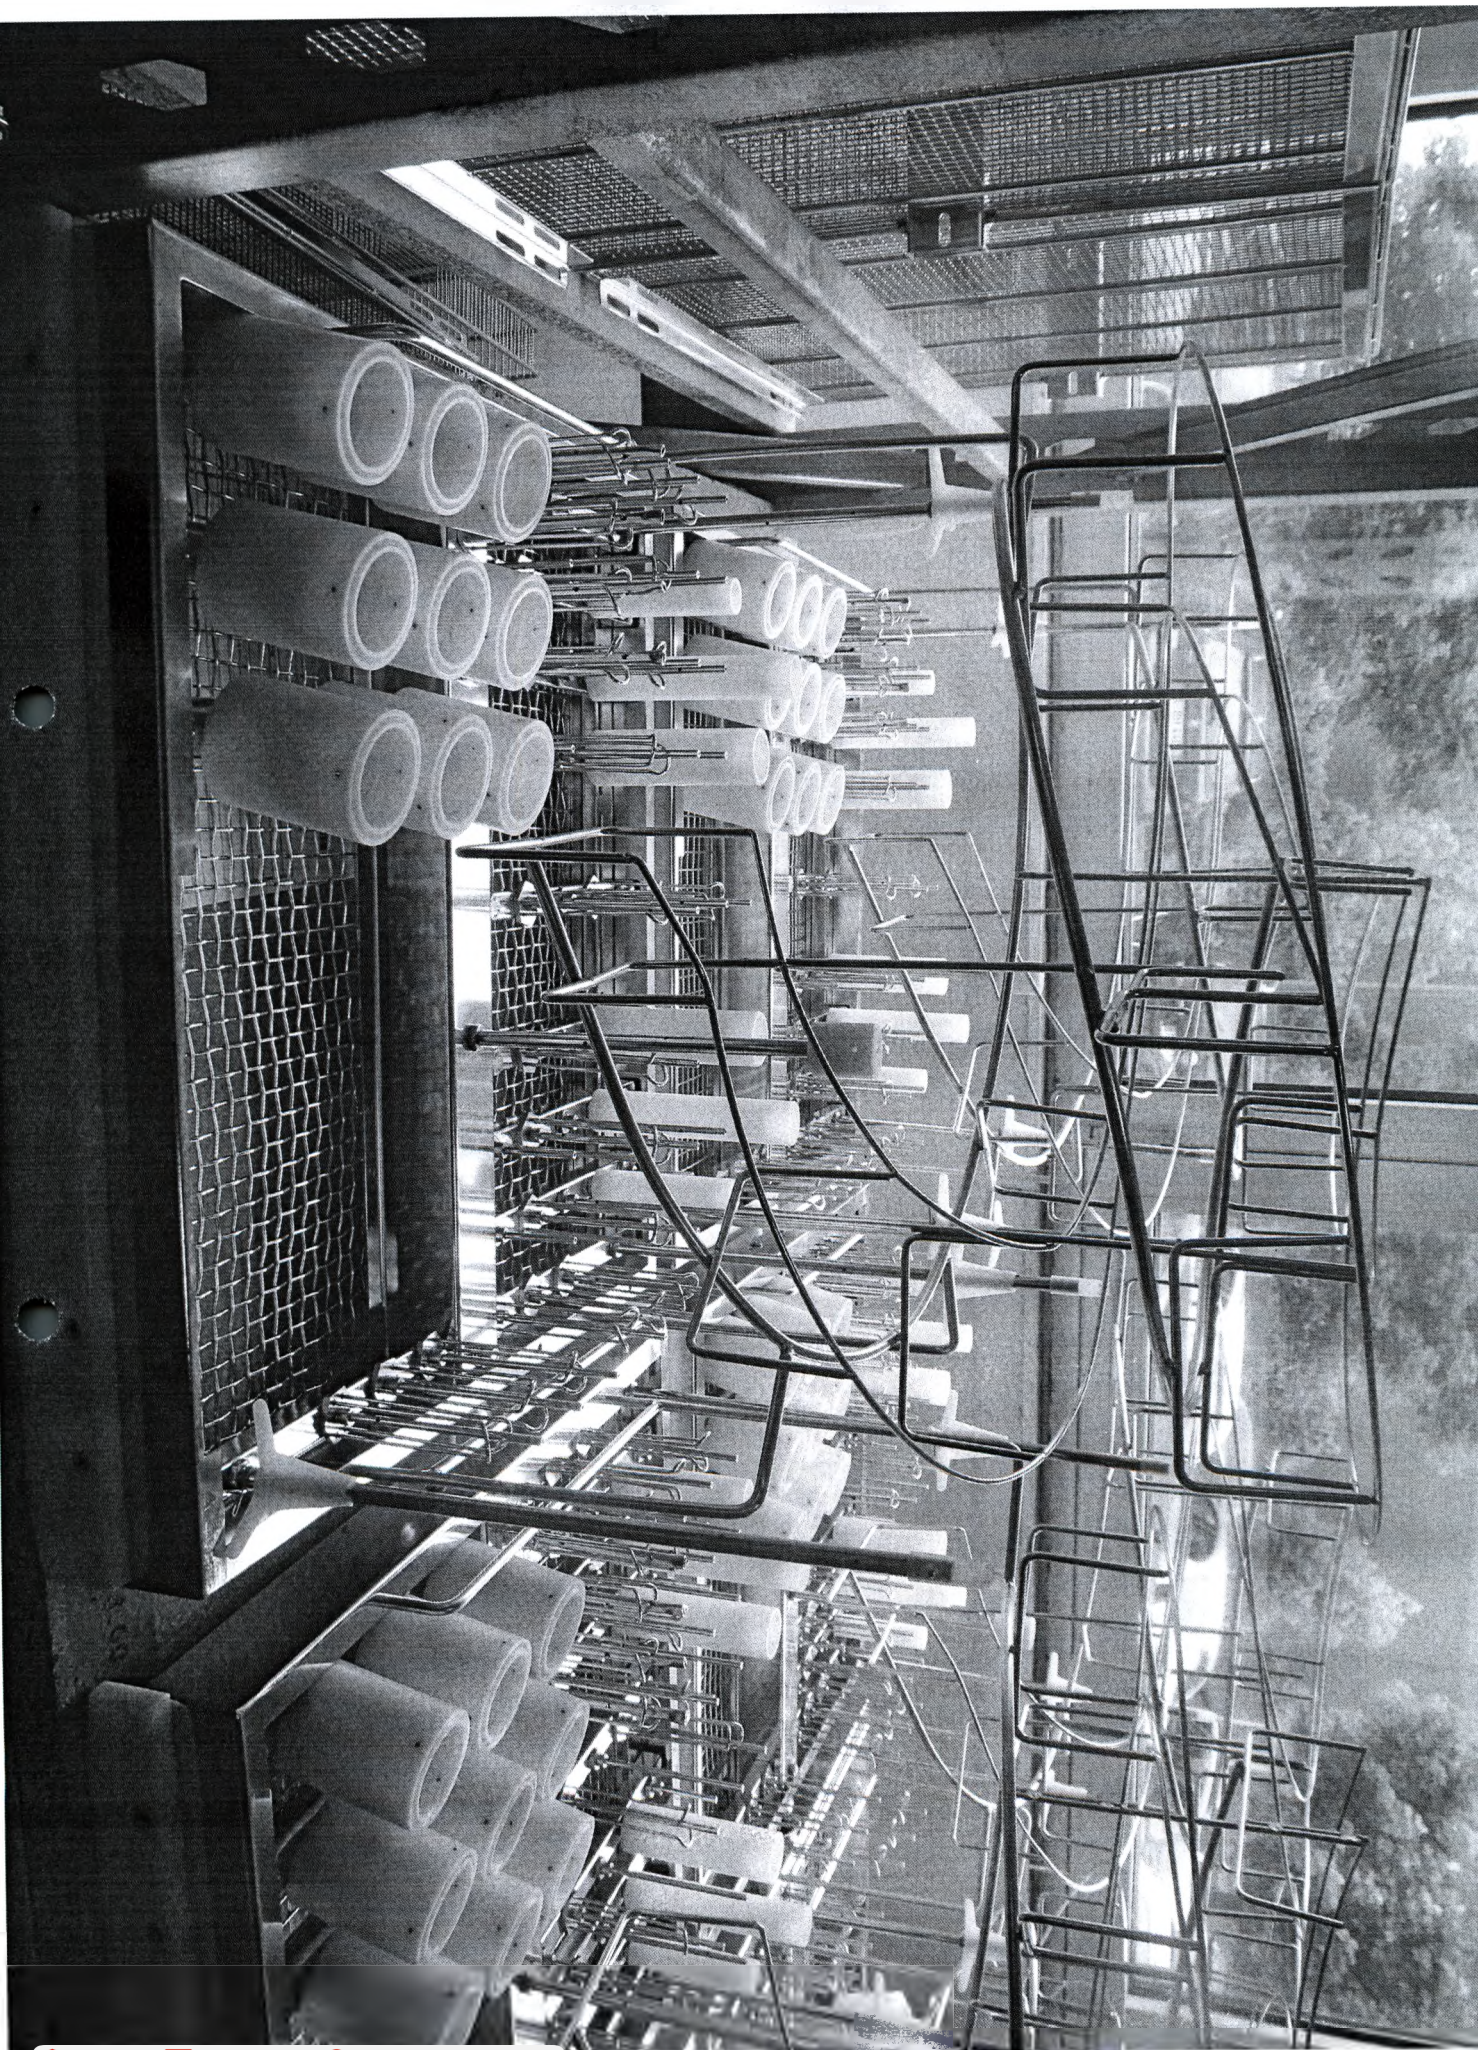


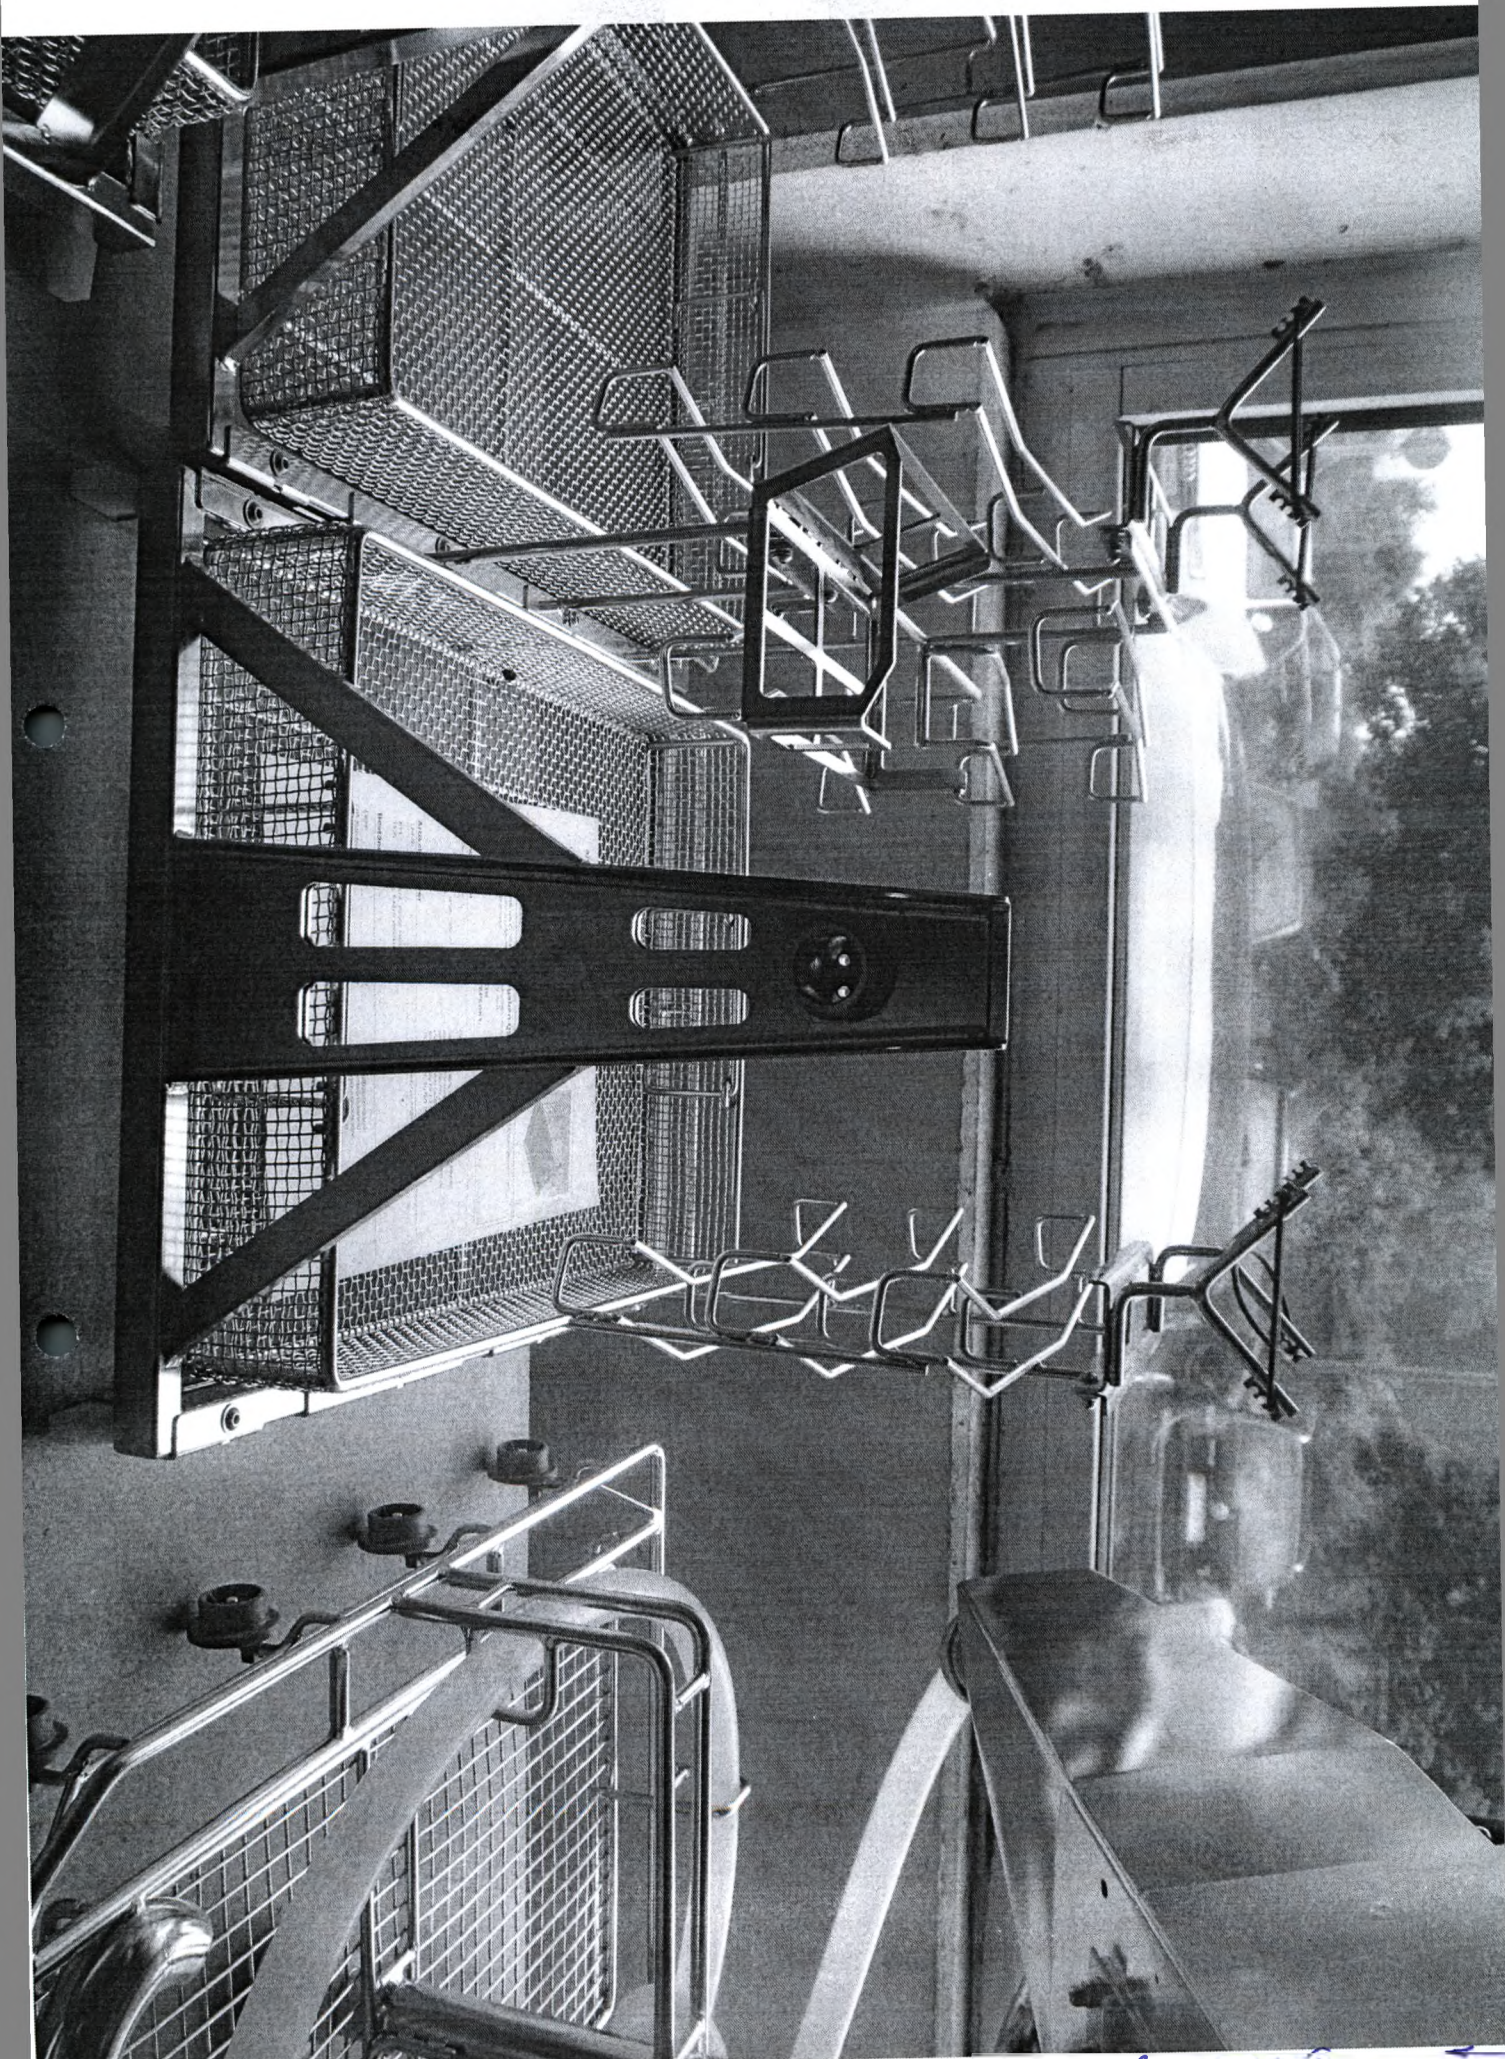






п. 12. Предоставки универсальные оборудование

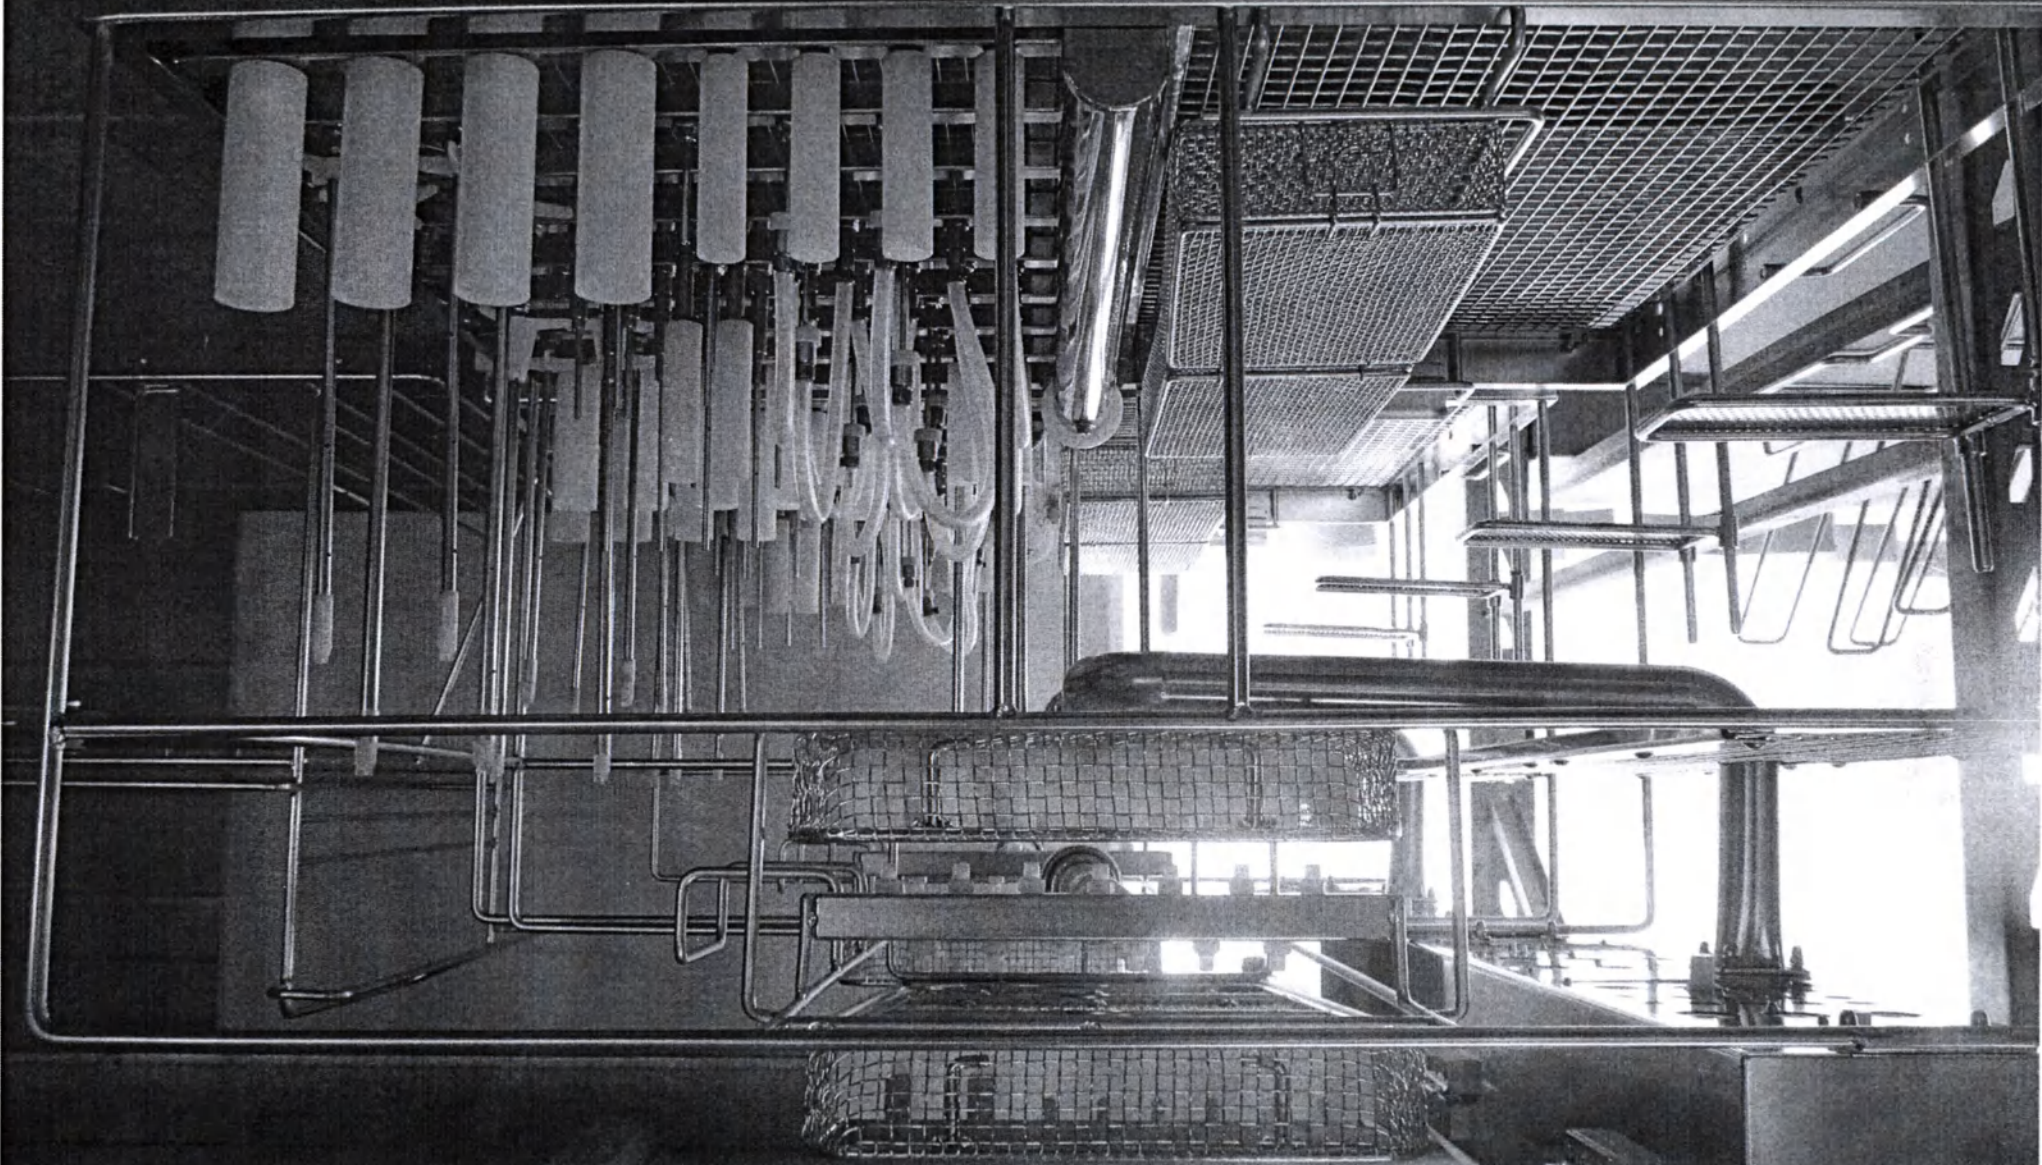


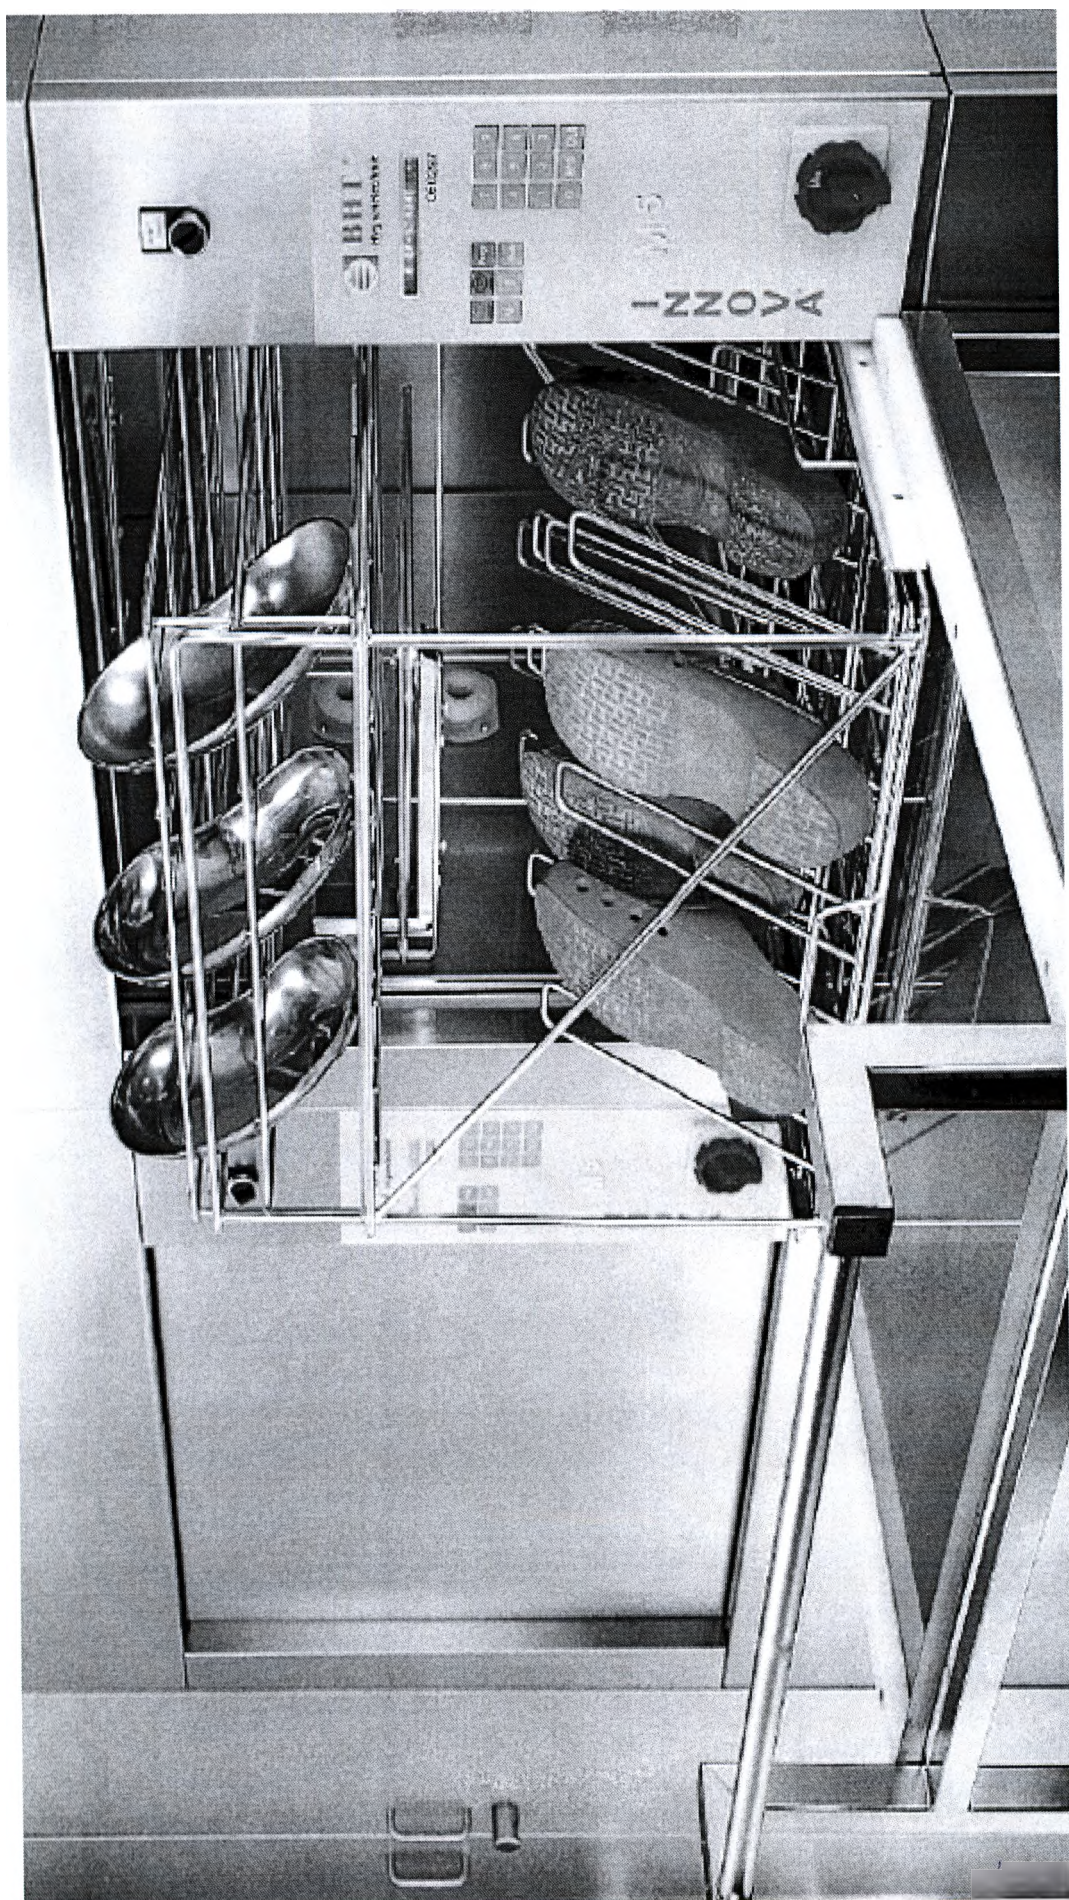


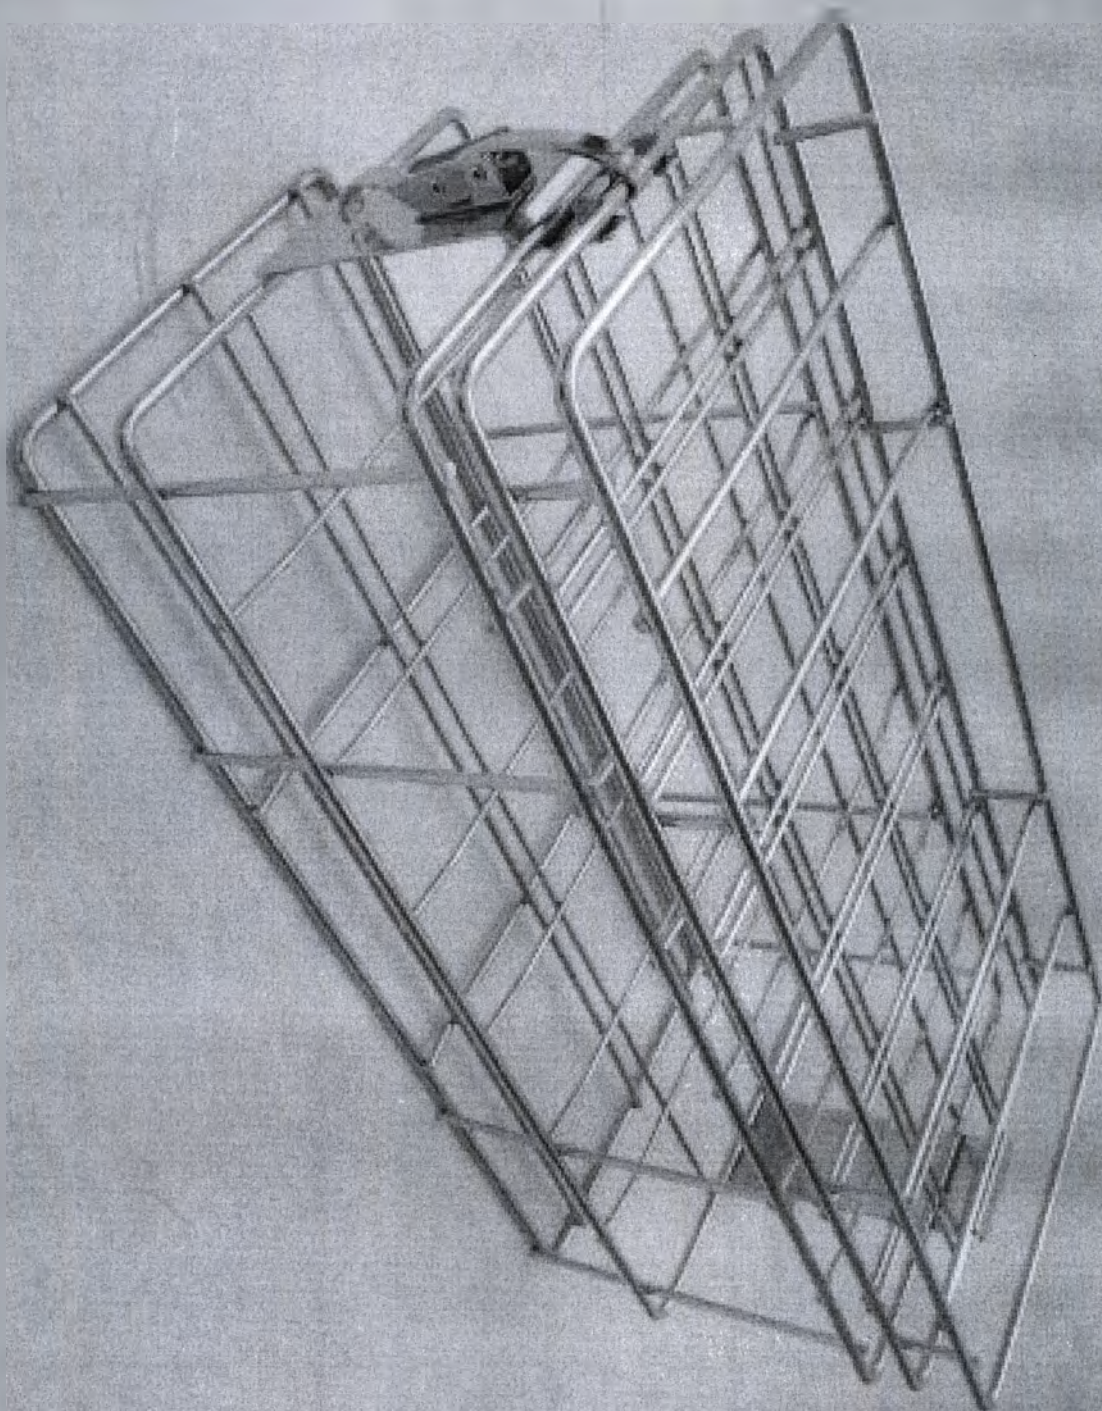


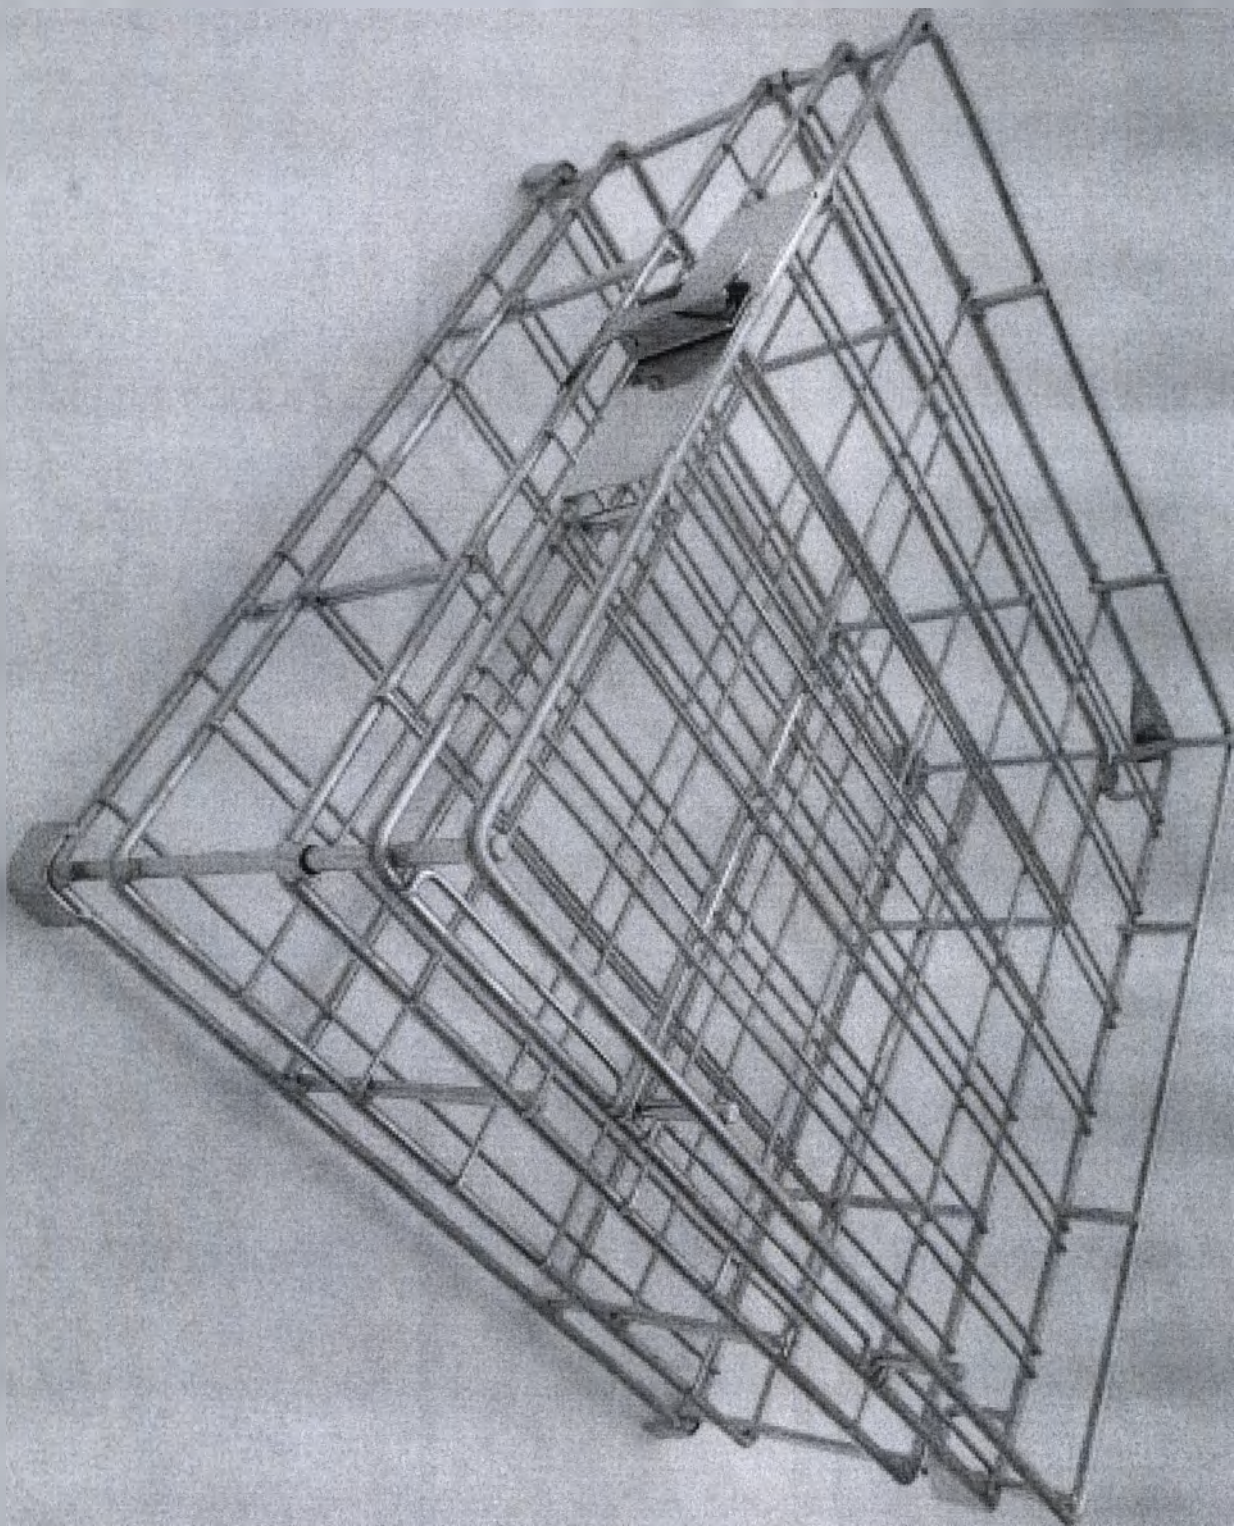

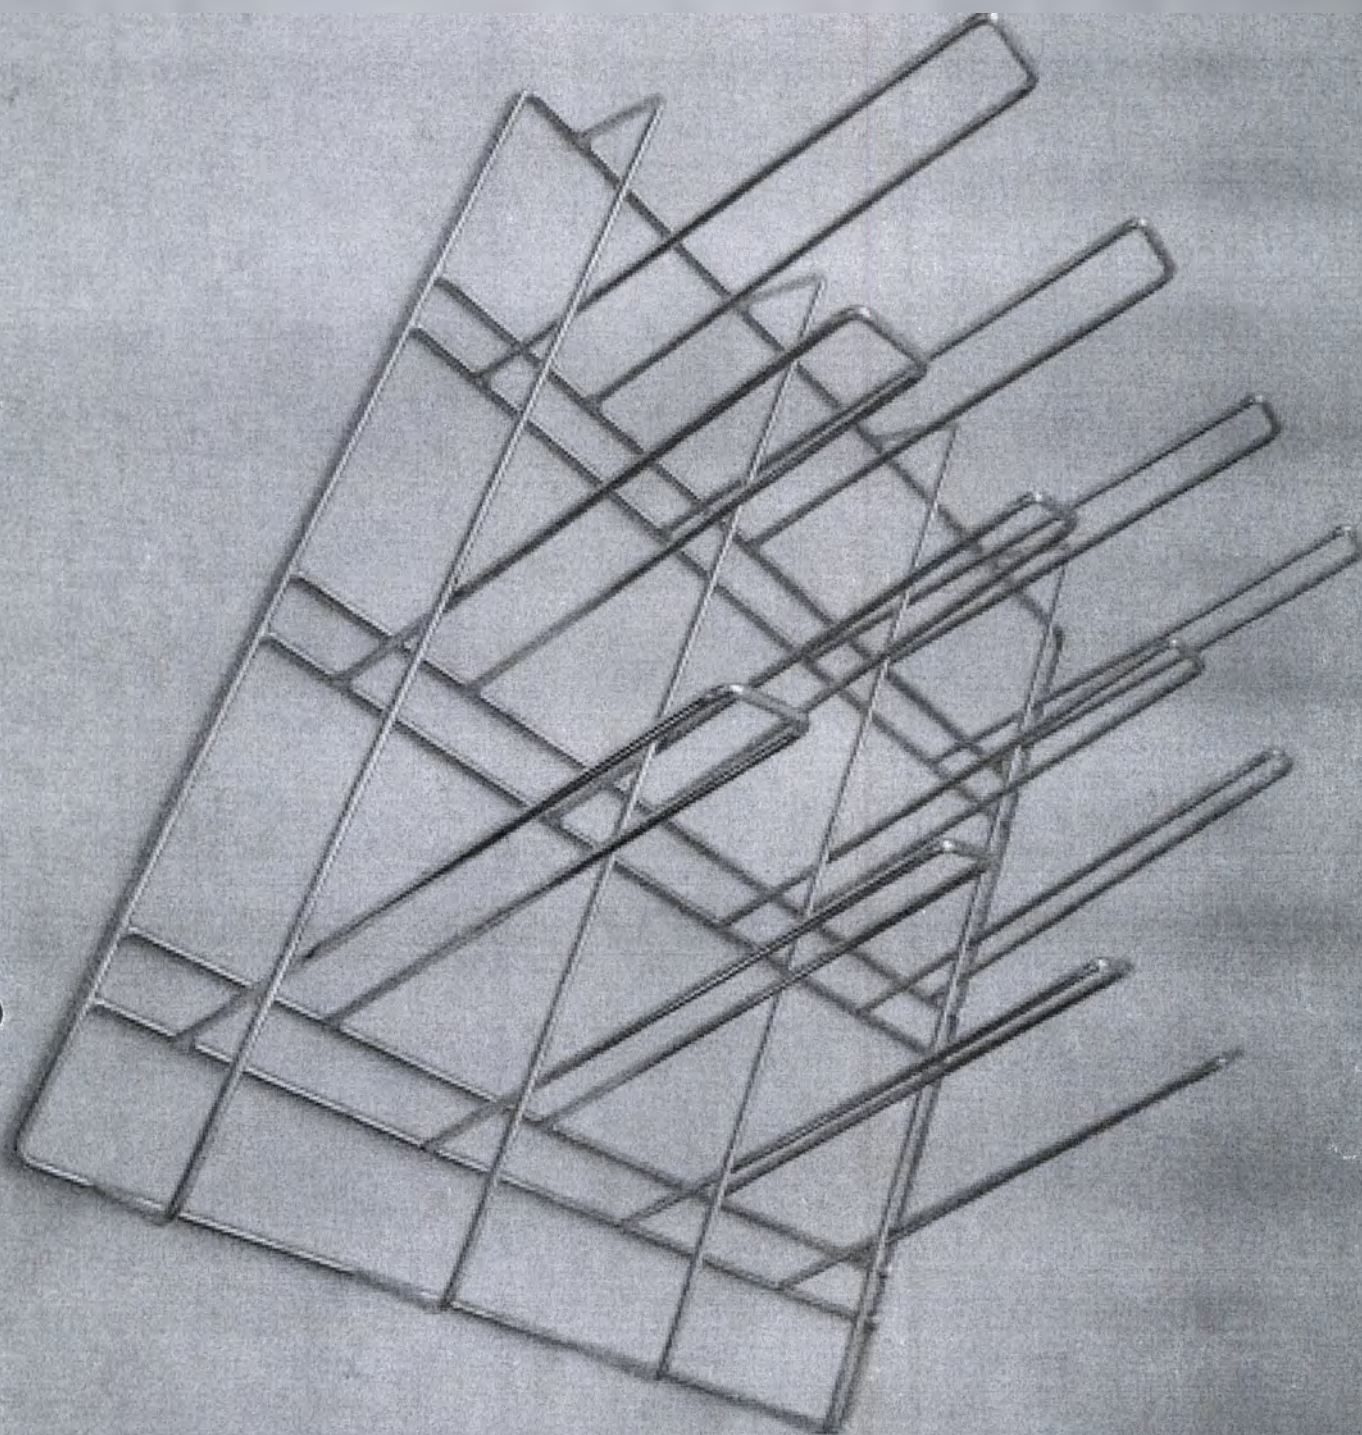


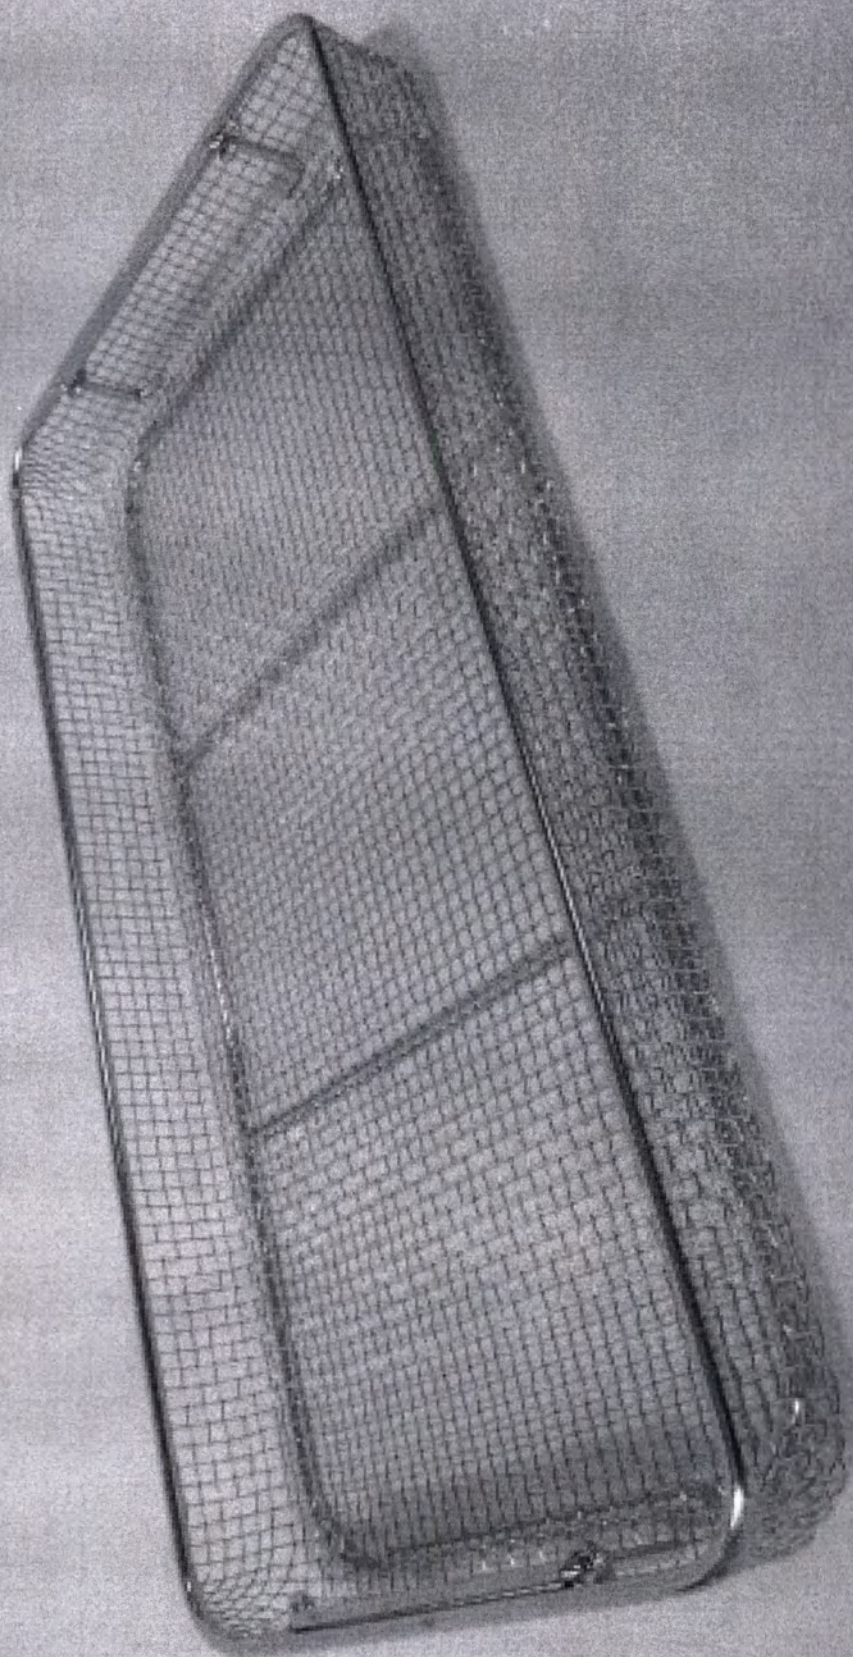

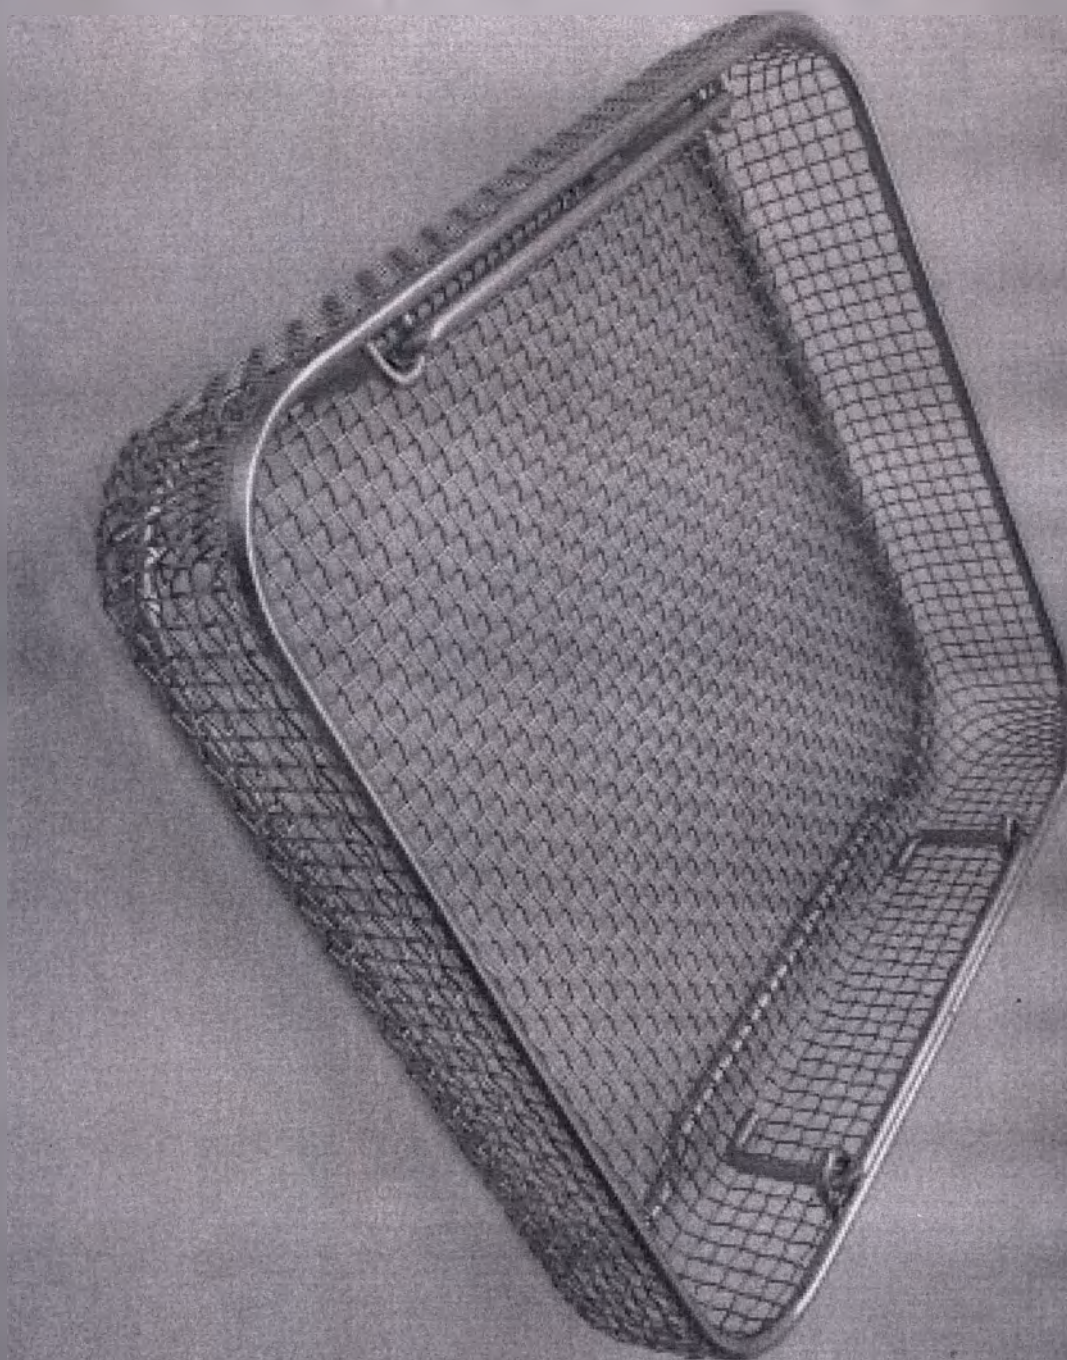


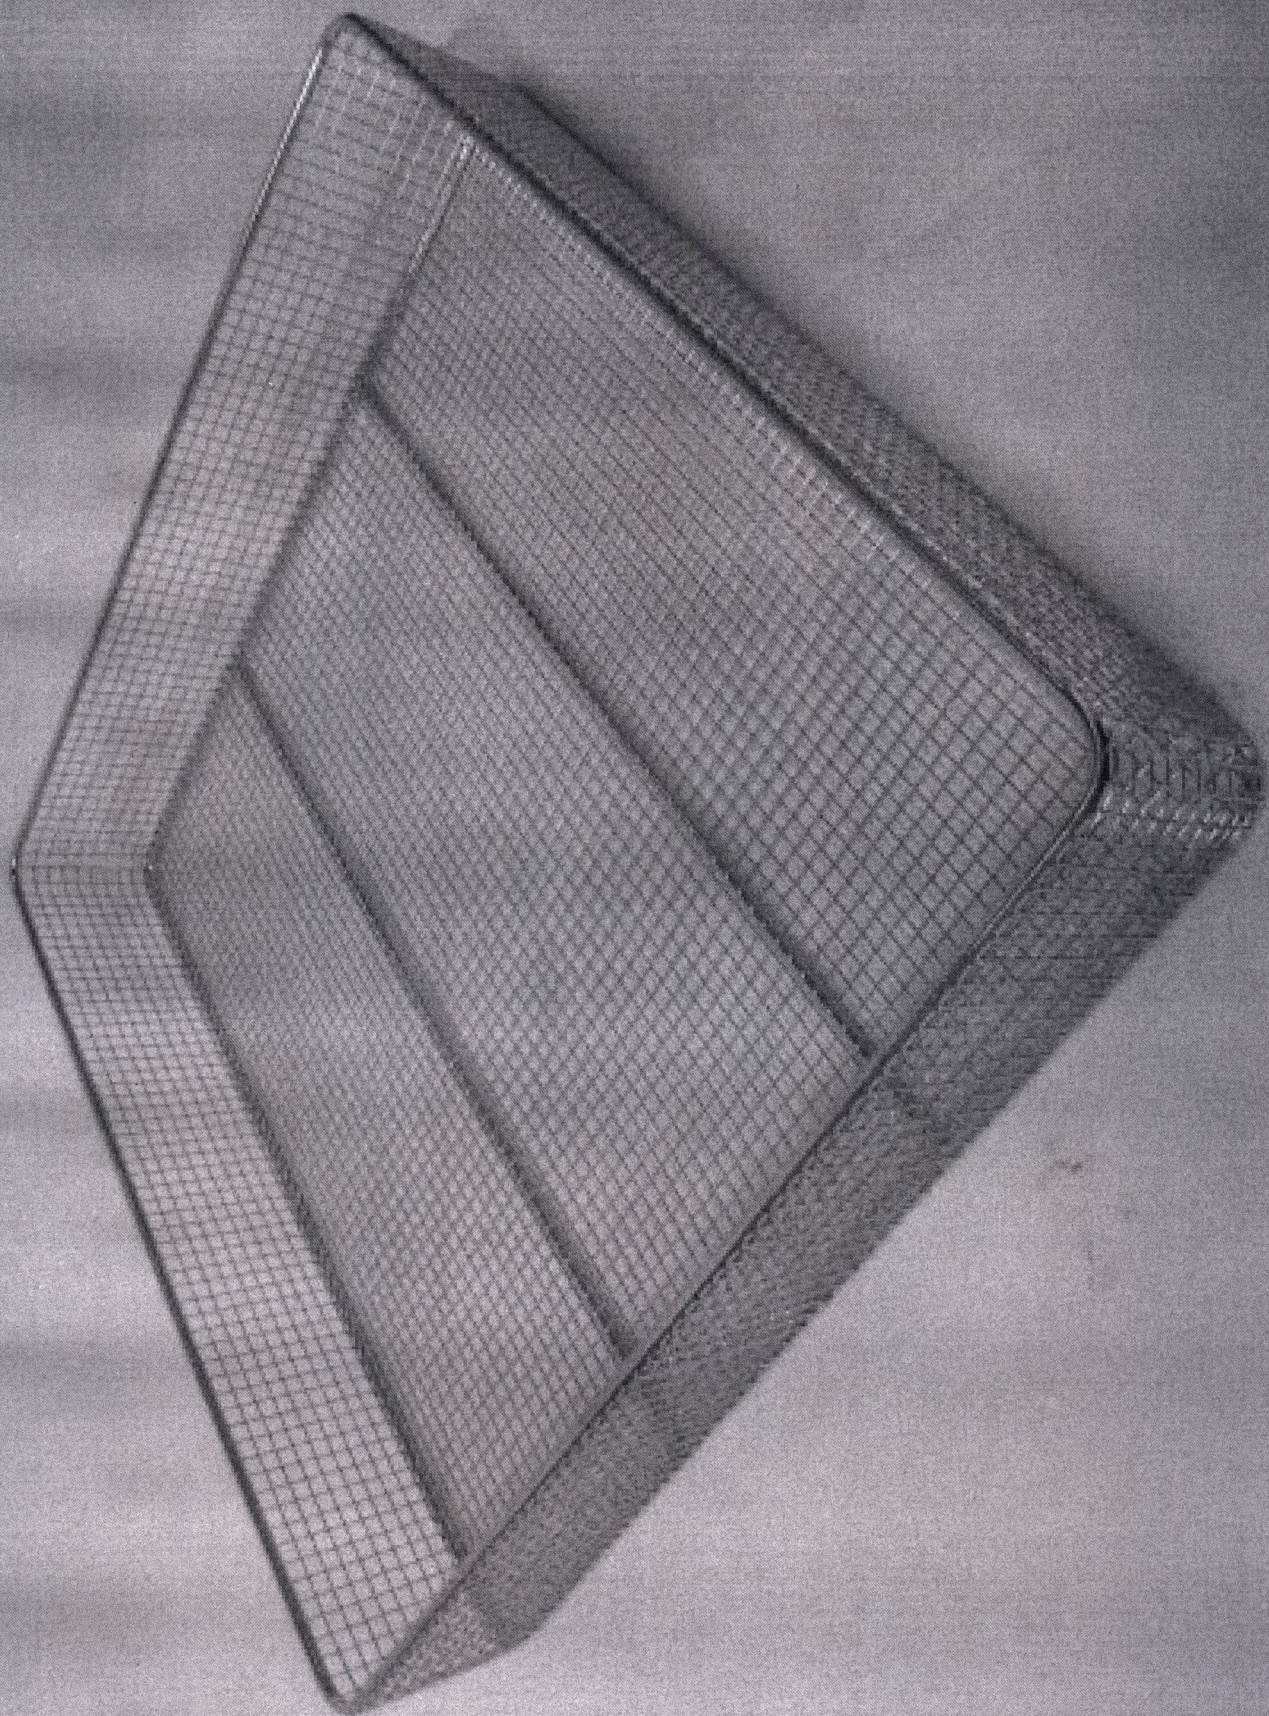


11.20 Копия для метрологии вв ил 96

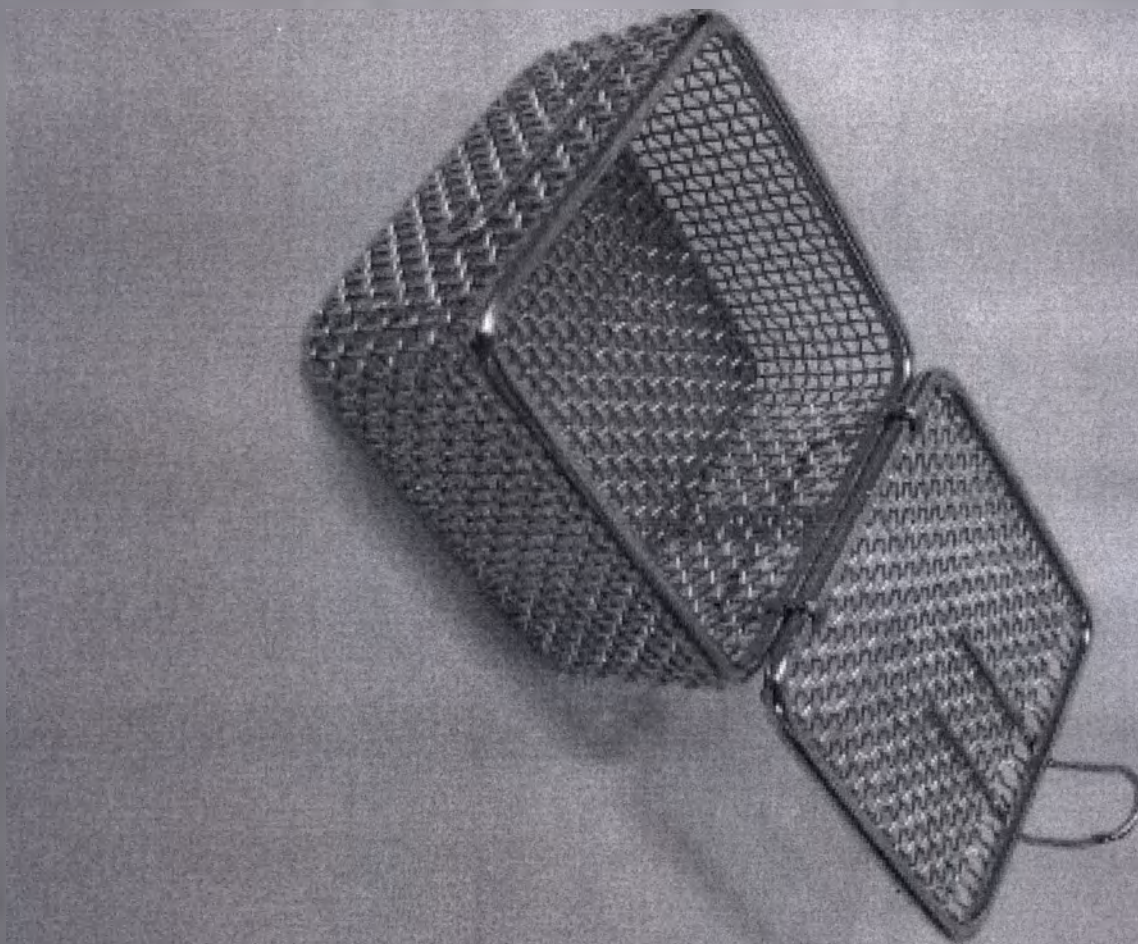


17.01 Корпусная крышка с вентиляторами 44

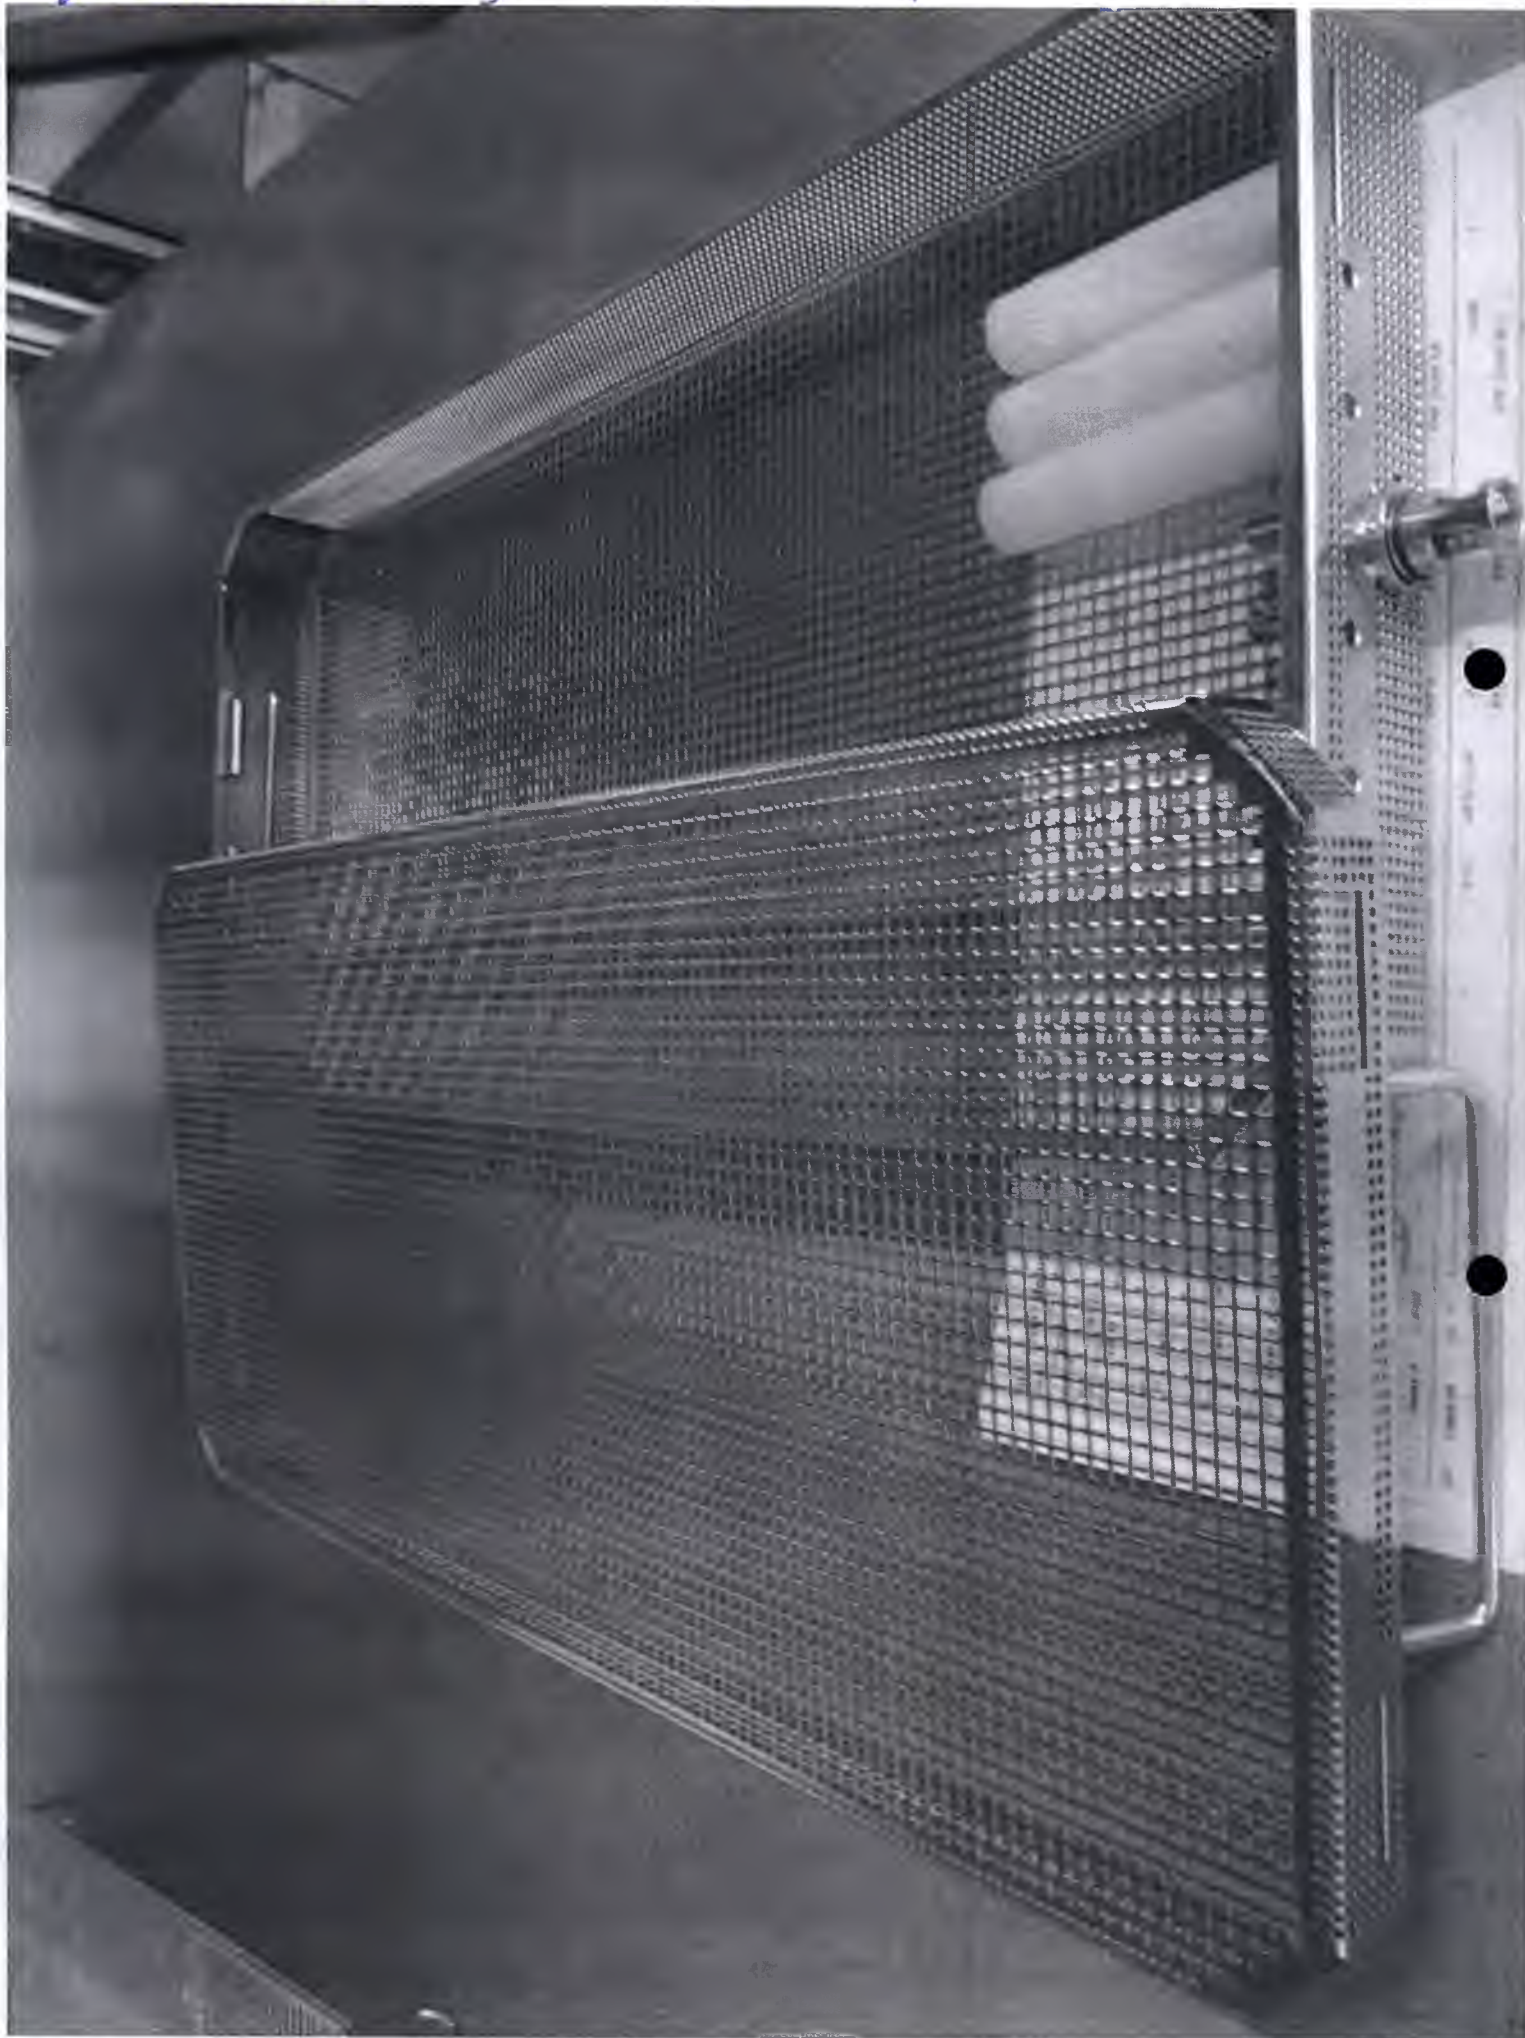


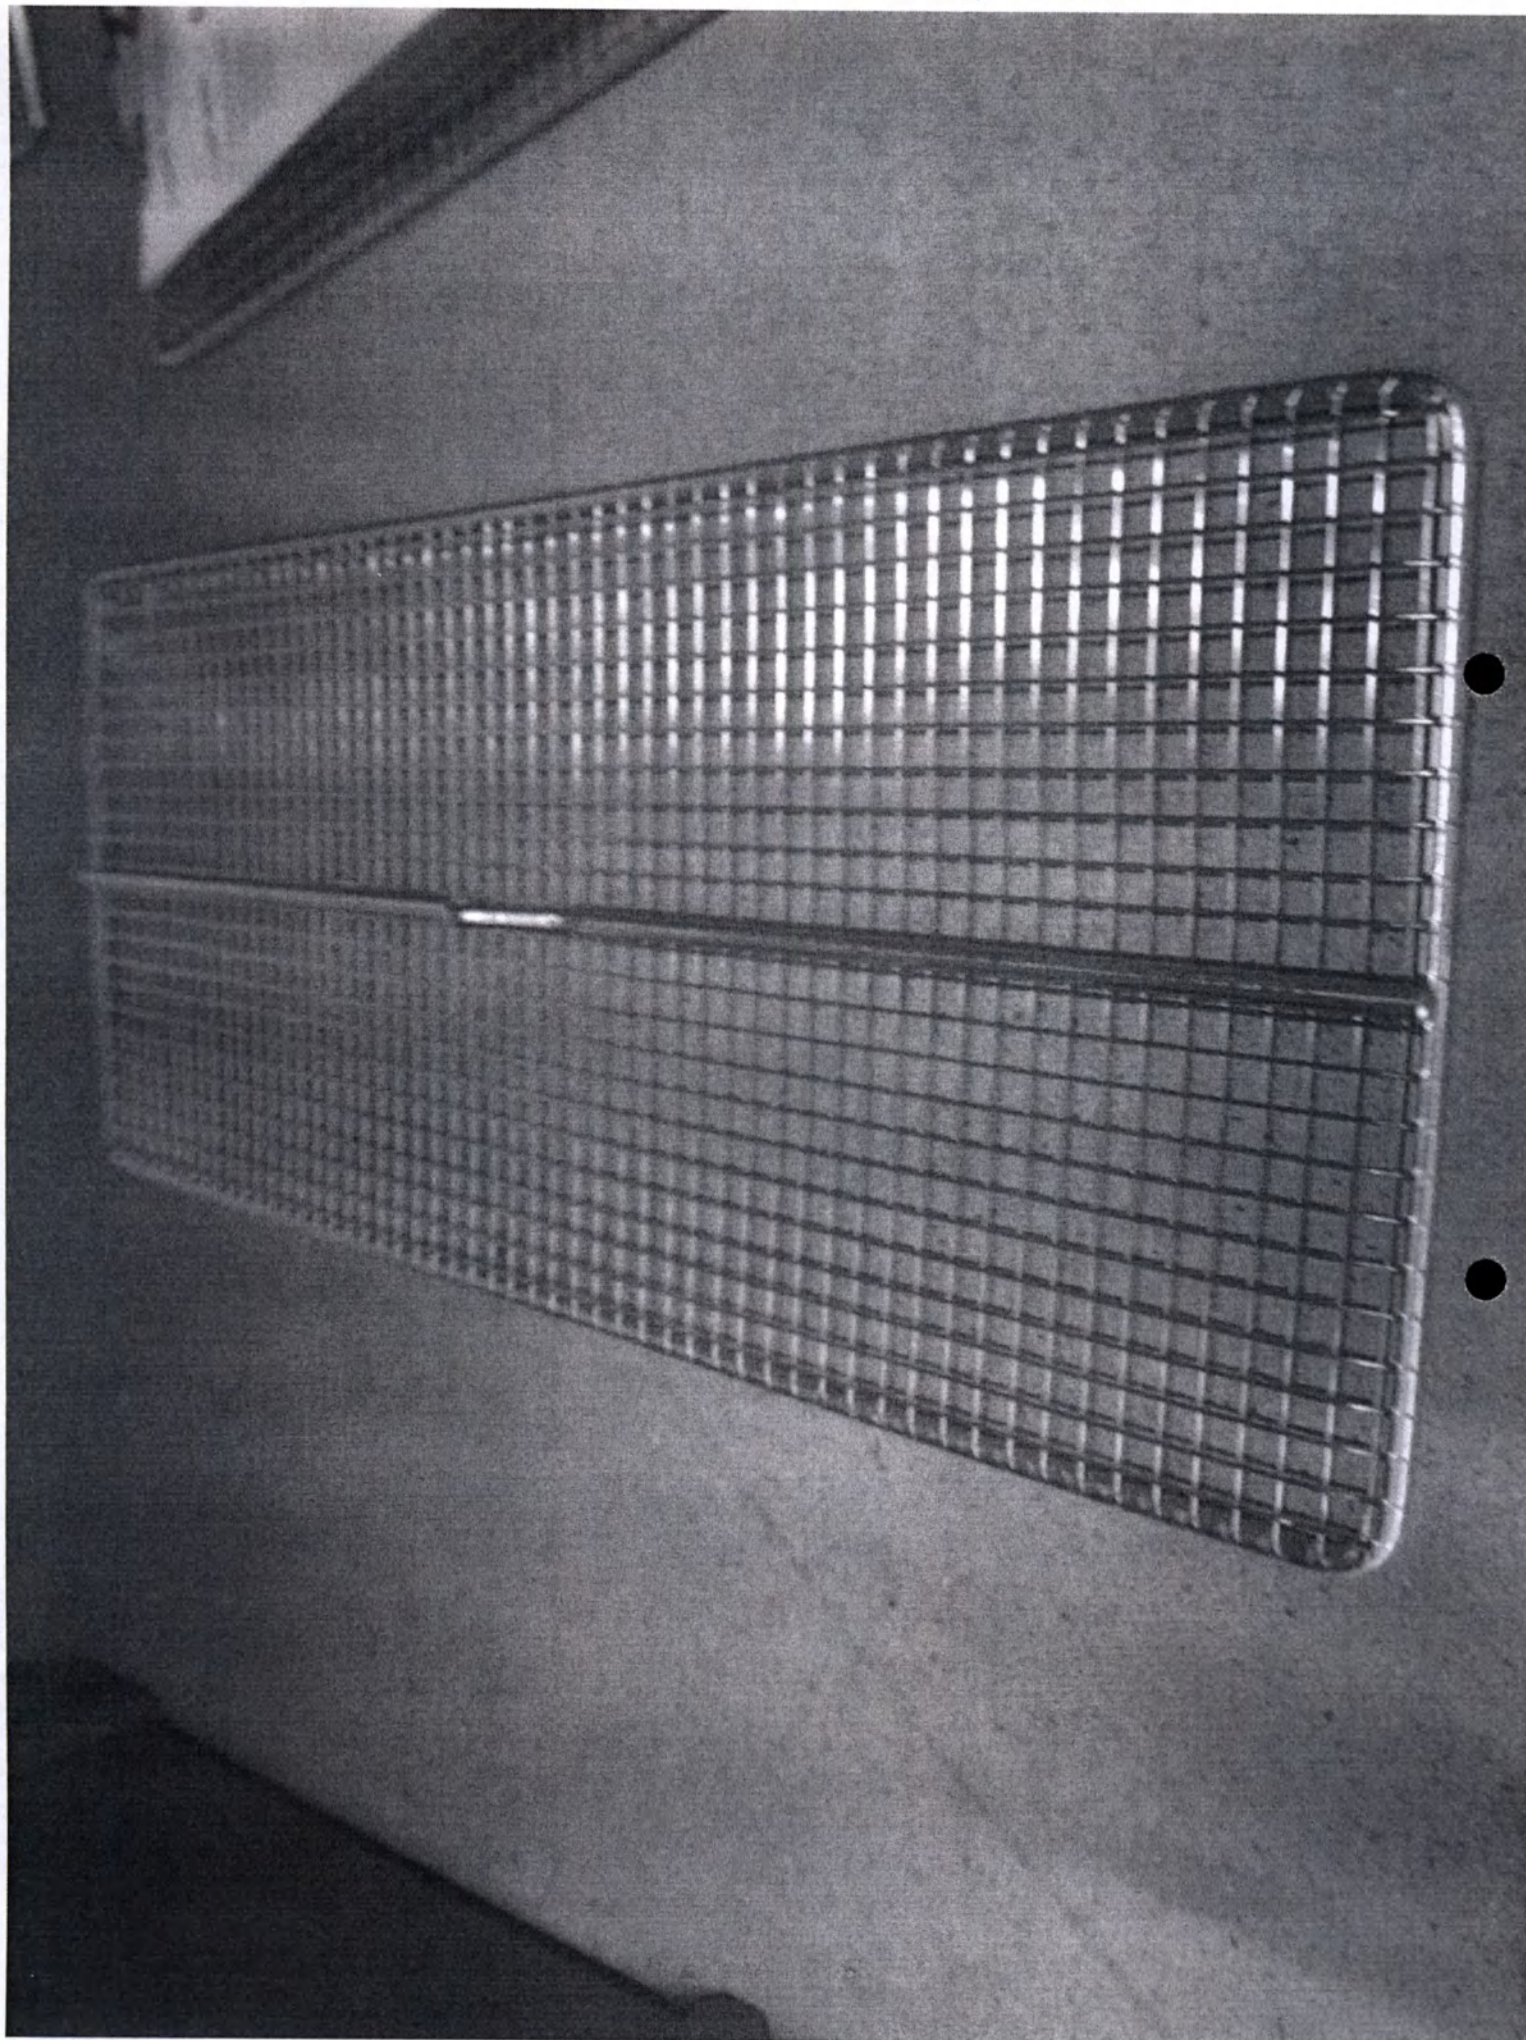


17.23 Разъемник для инструментов

48

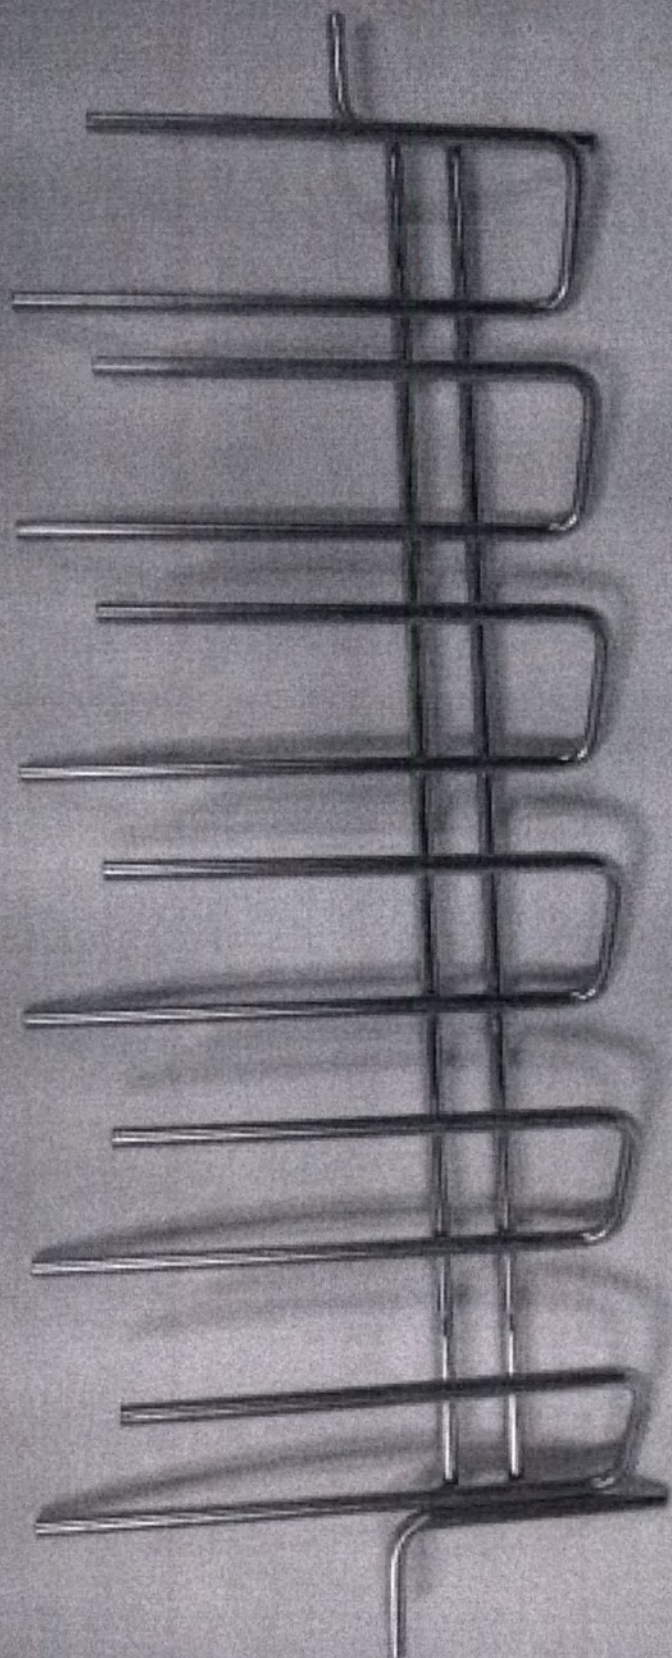

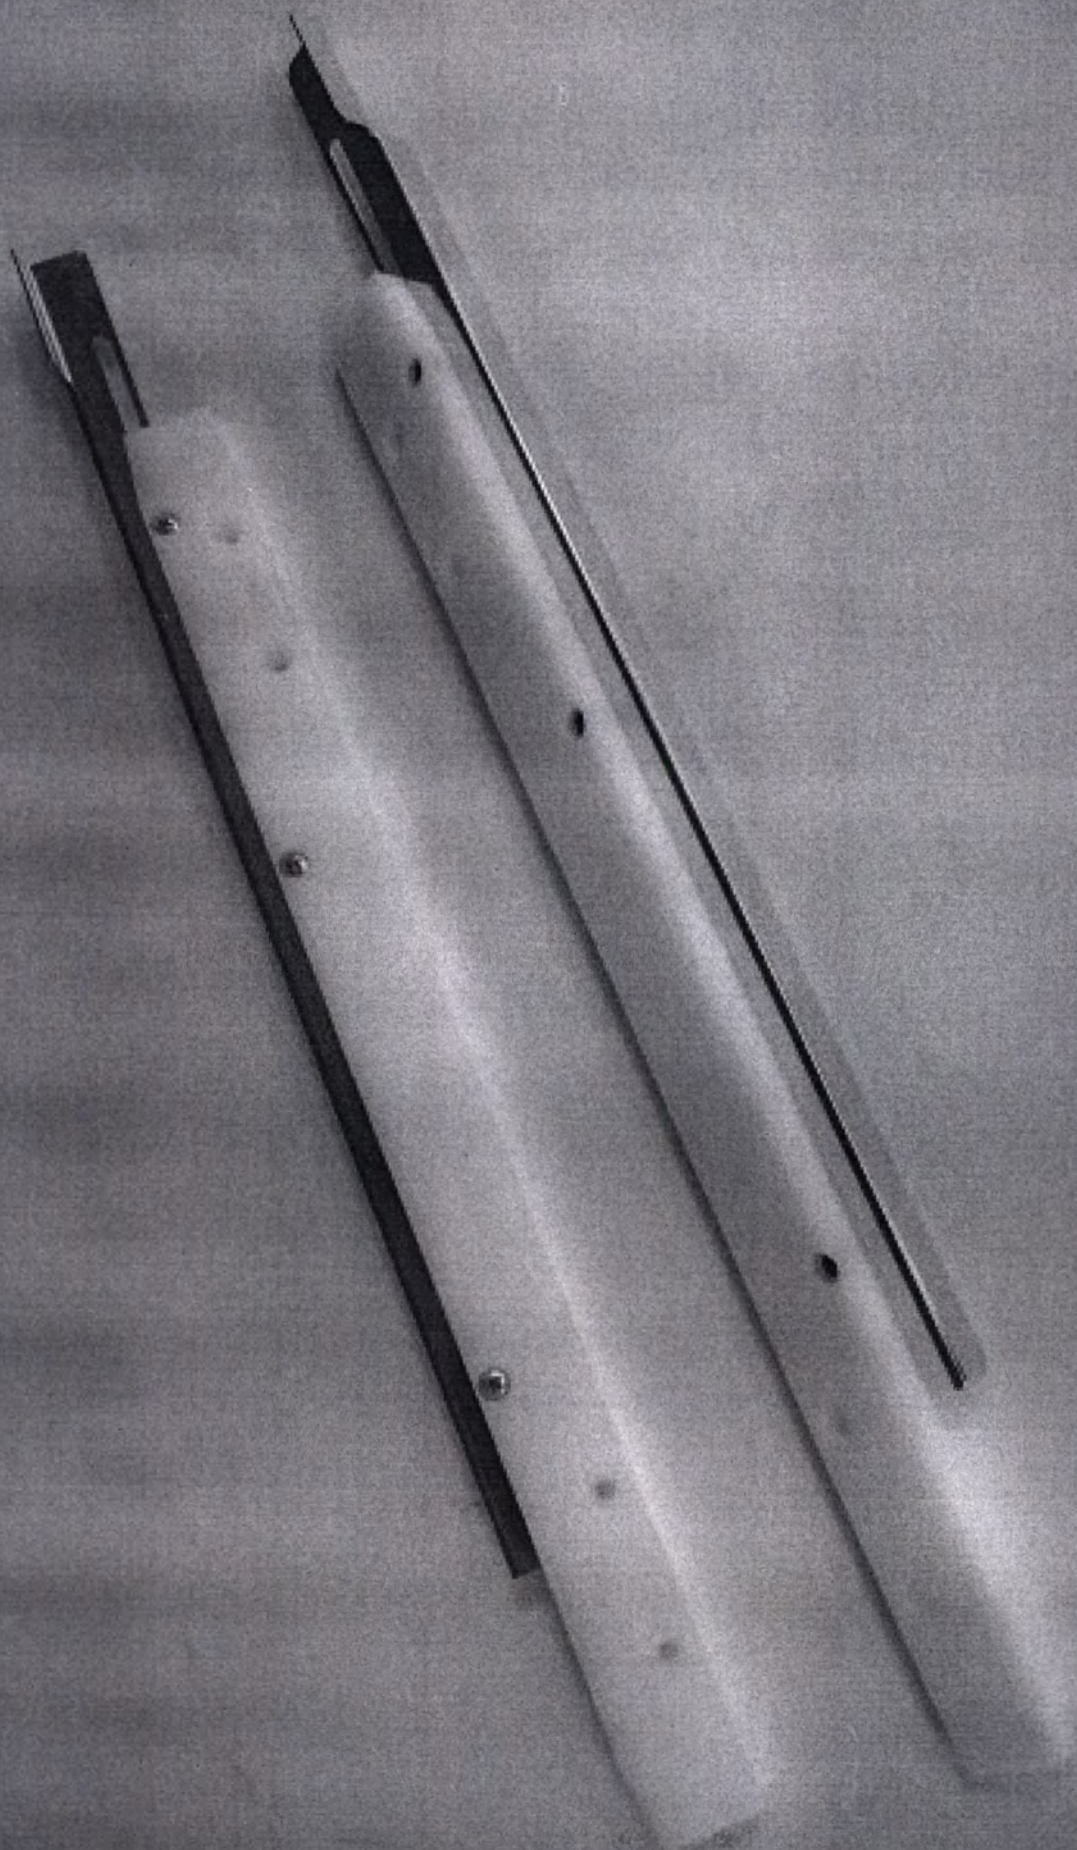





BHT[®]
Hygienetechnik


INNOVA[®] E3


P1	Endo Normal	
P2	Endo Intensiv	
P3	Endo Zubehör	V
P4	weitere Programme	T


CE 0297

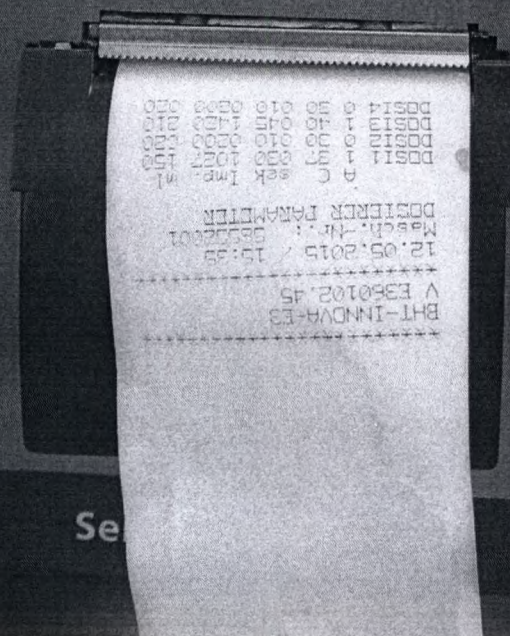


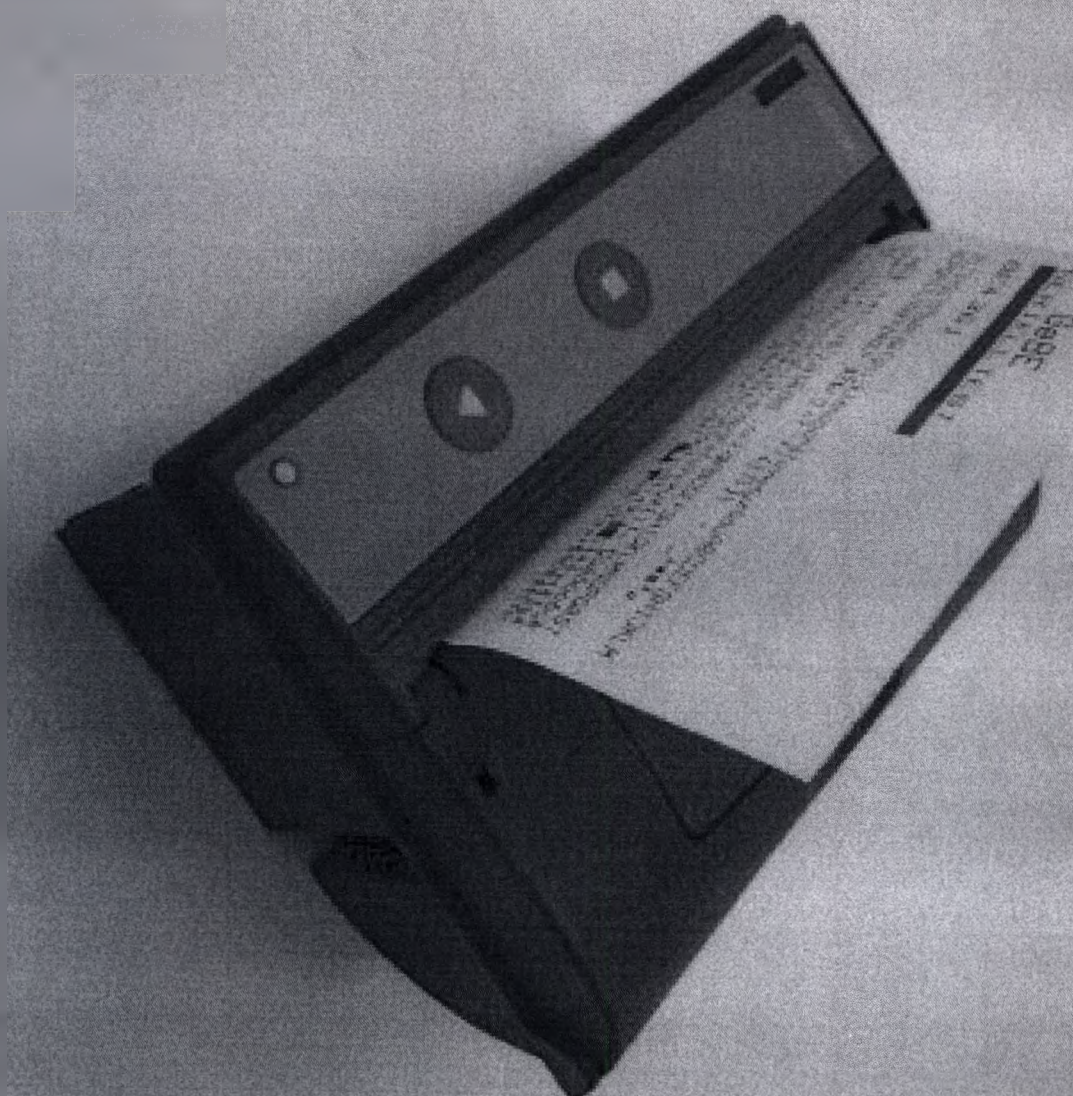


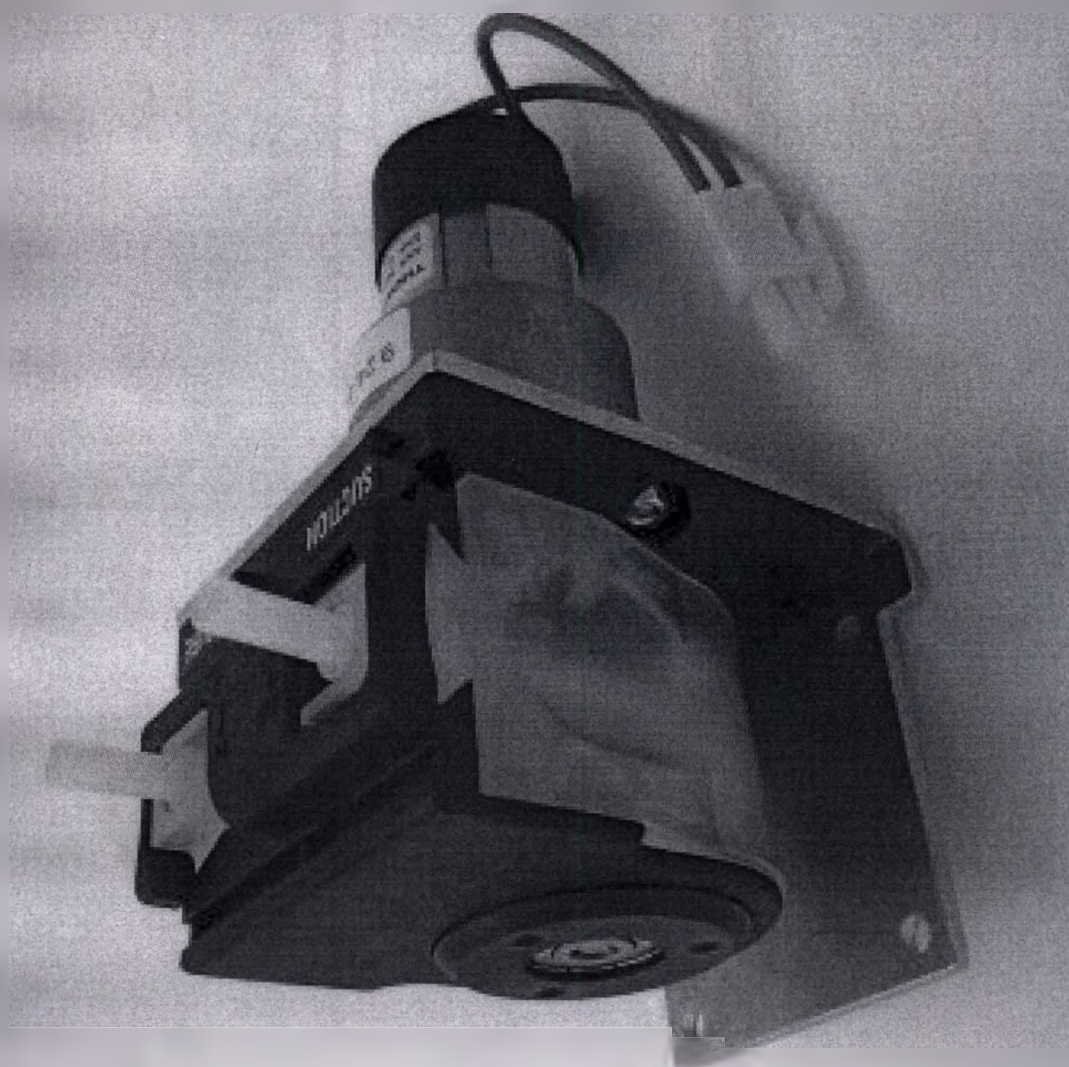


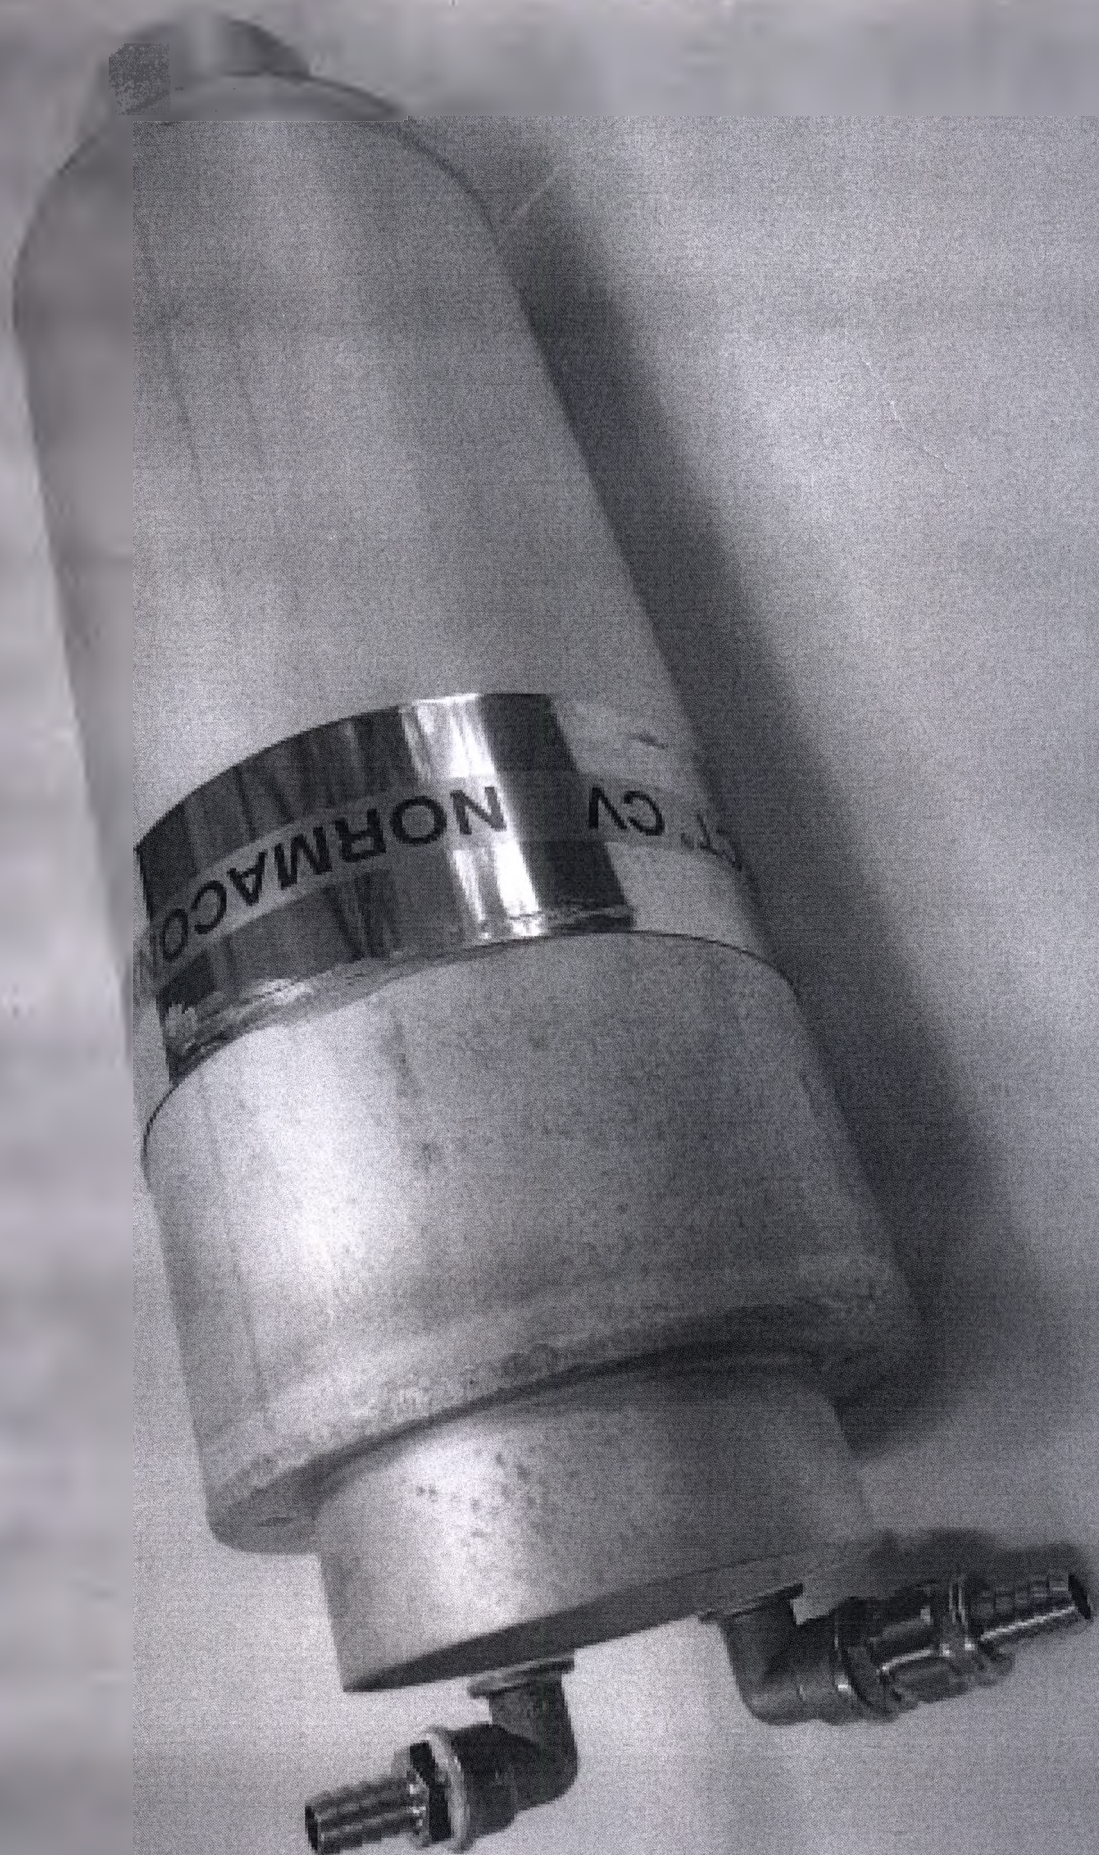

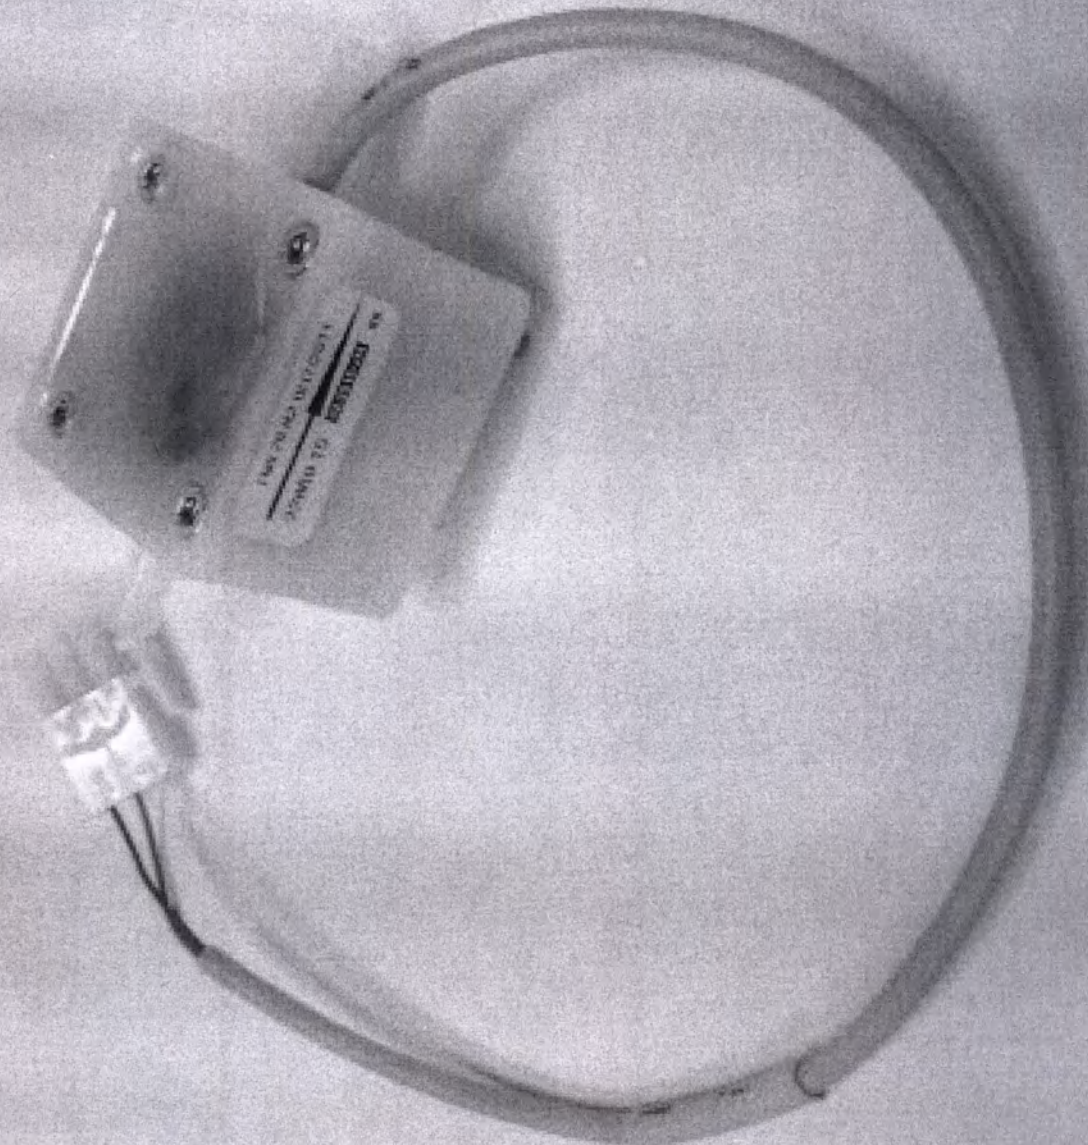

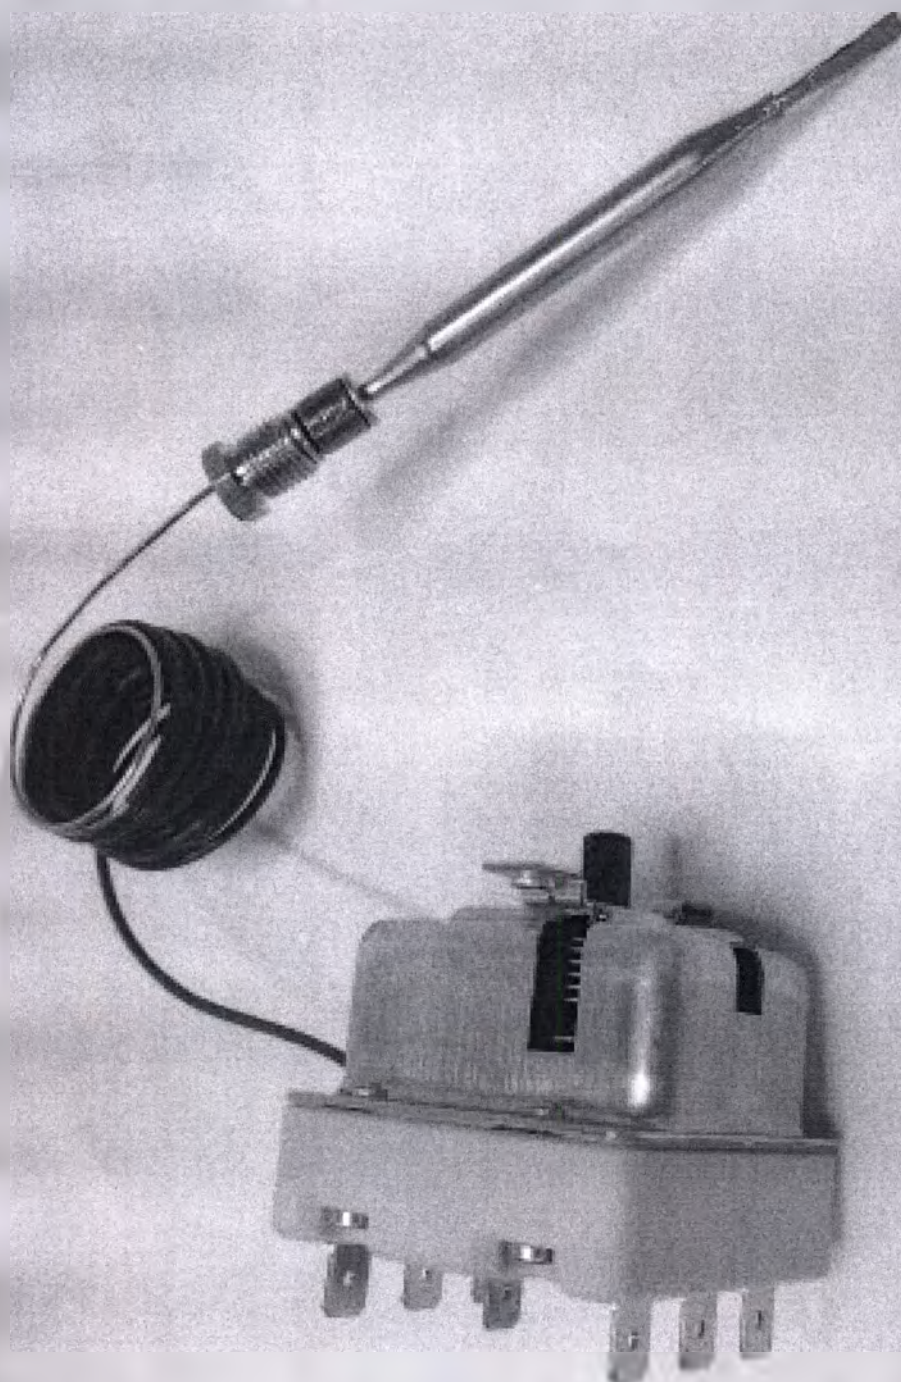


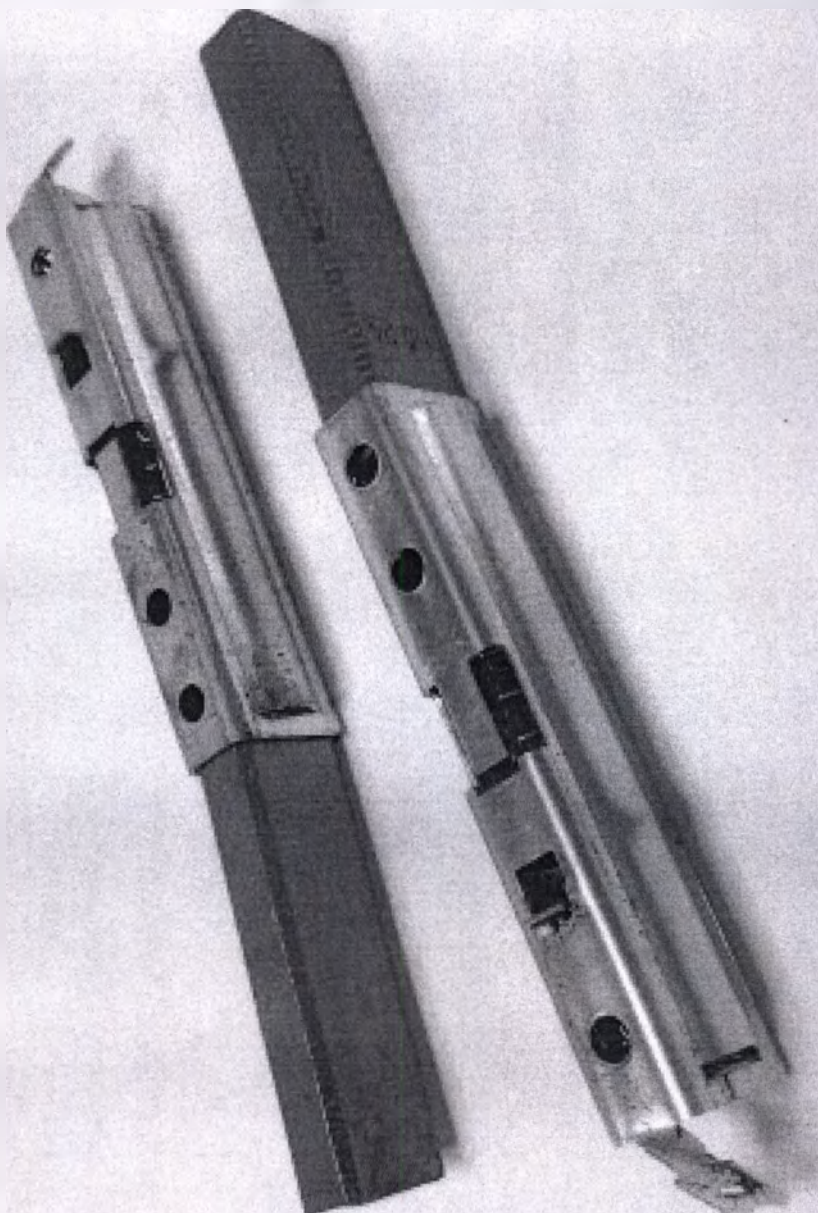


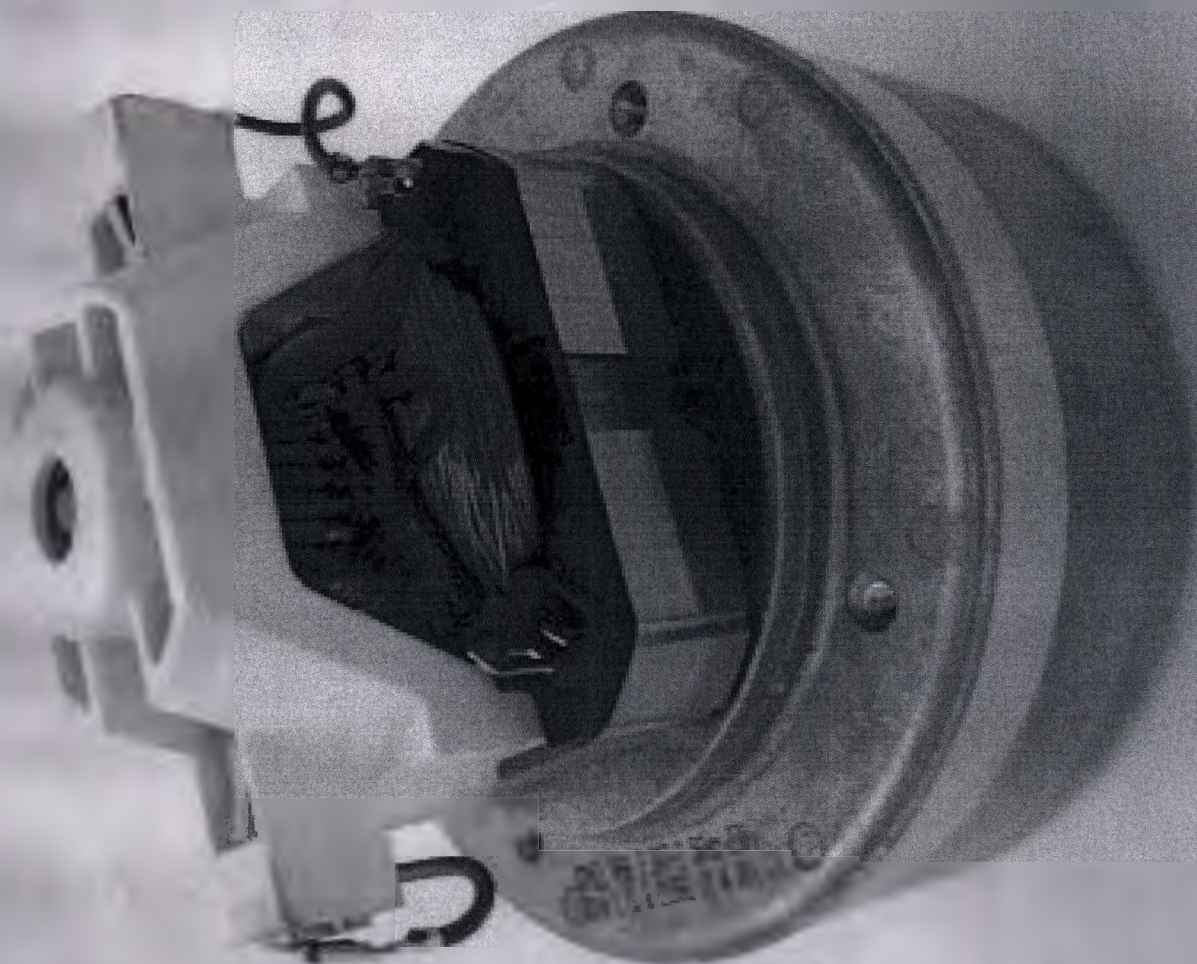

34. бумага для принтера

59

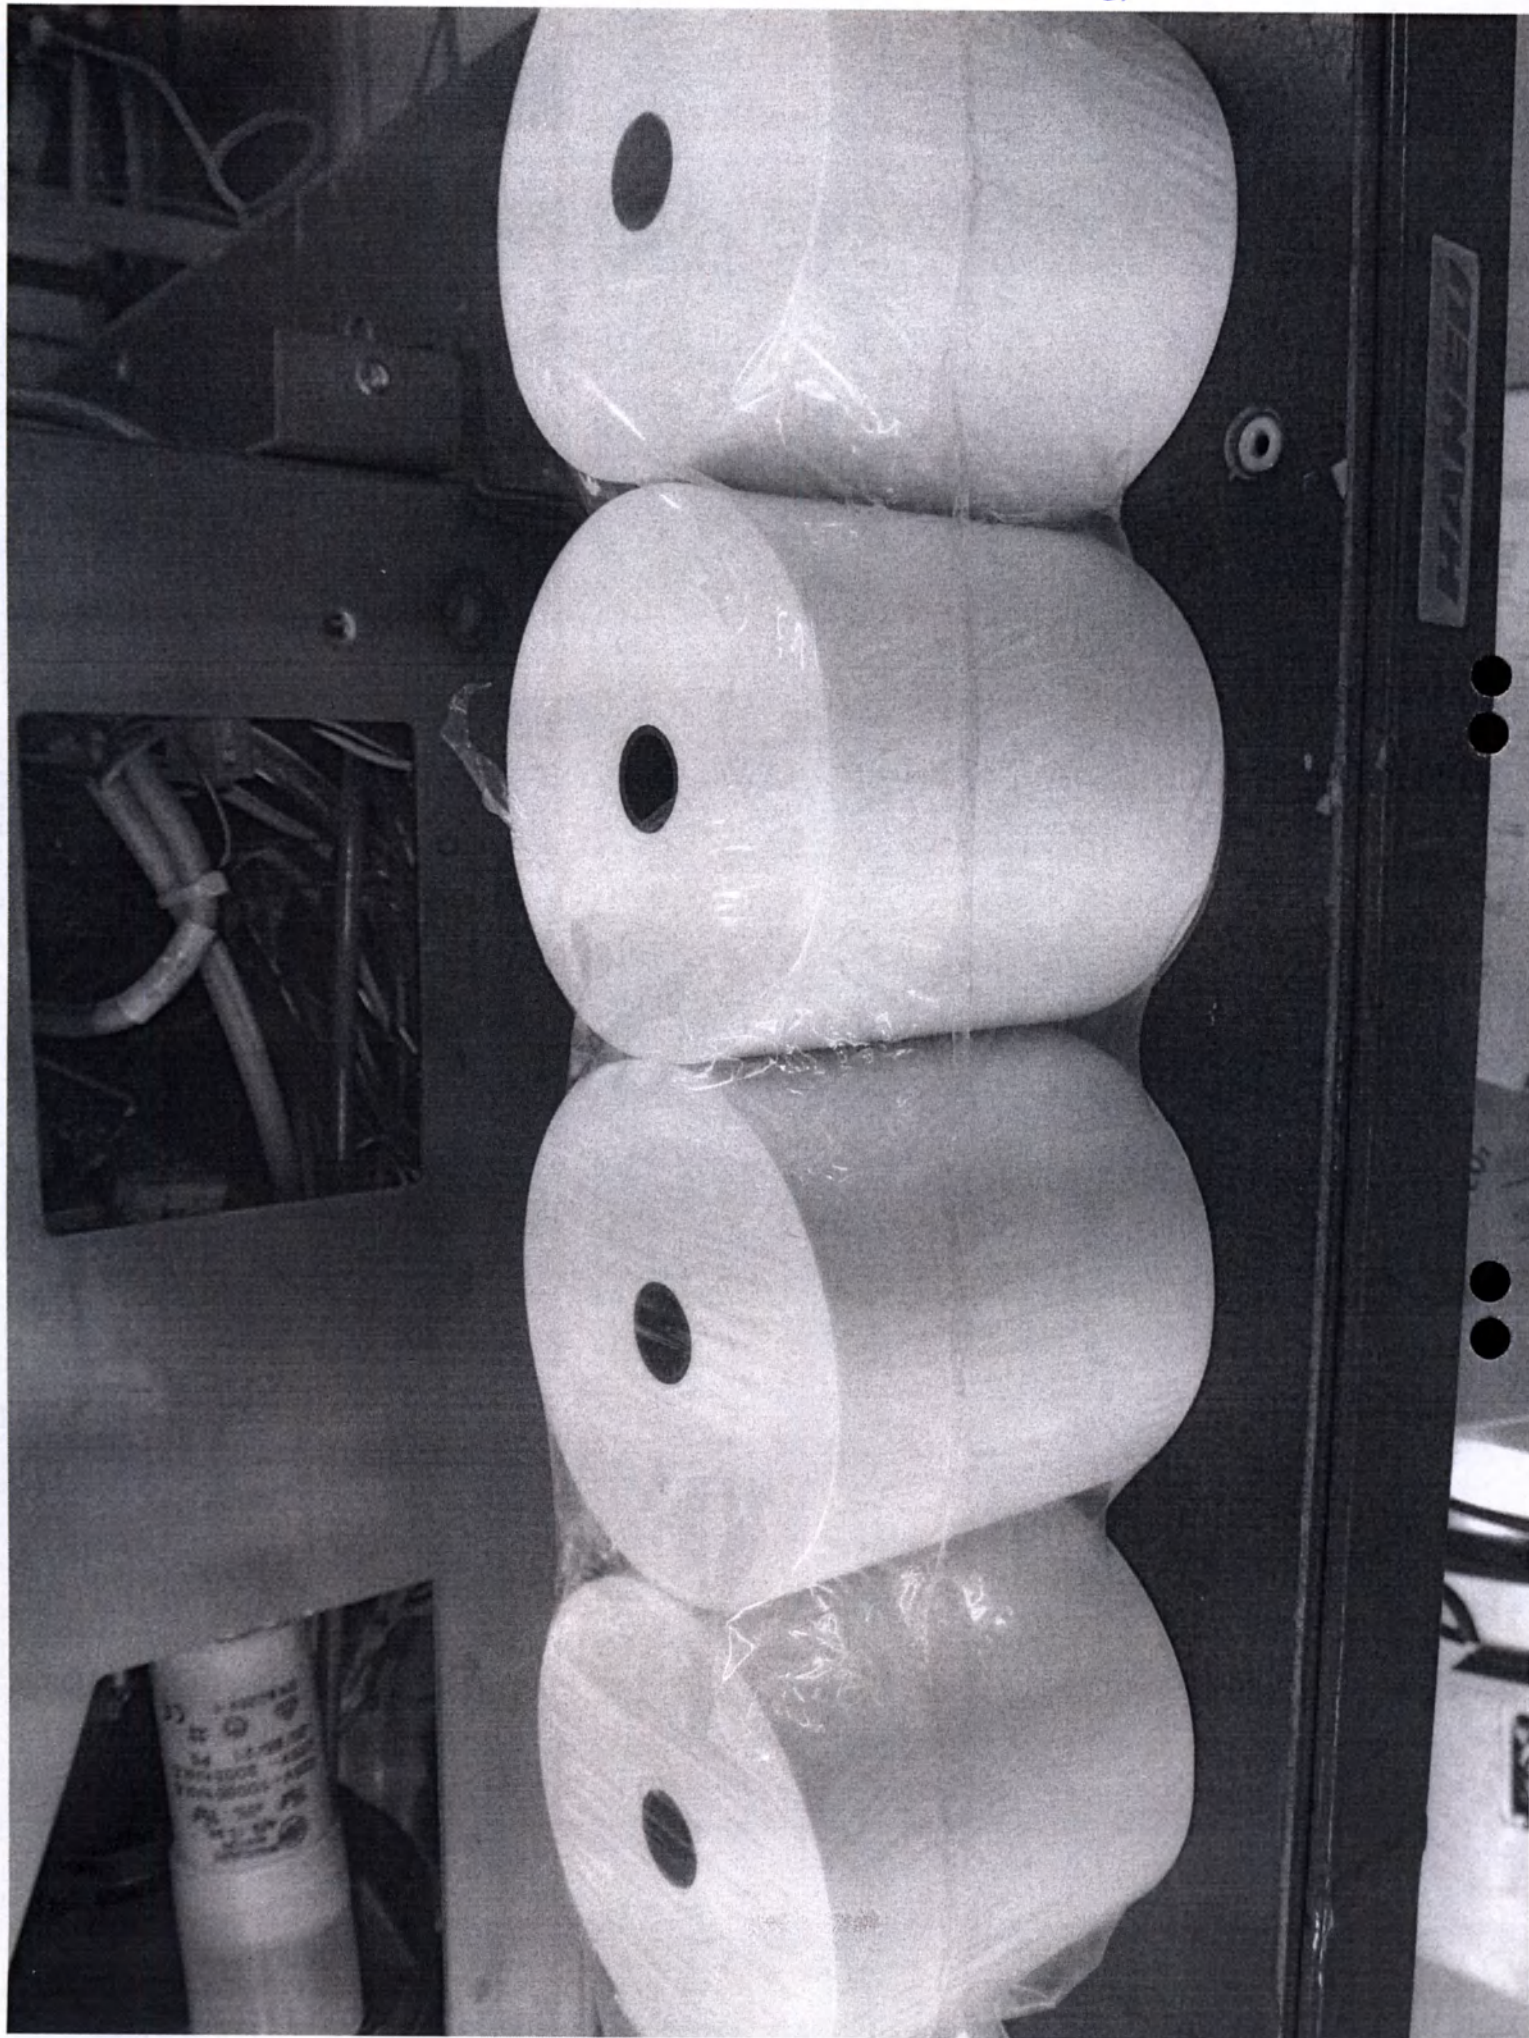

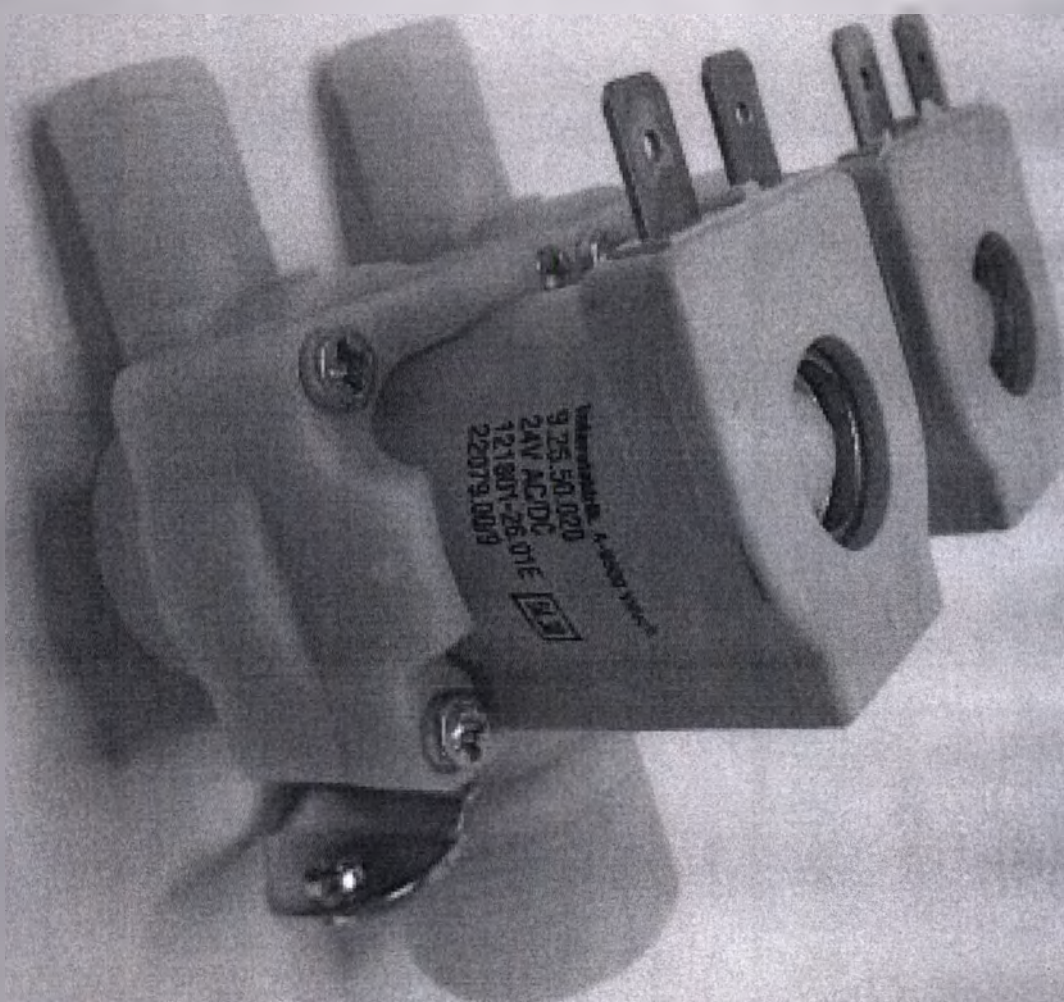




Л.34. Умелые


62



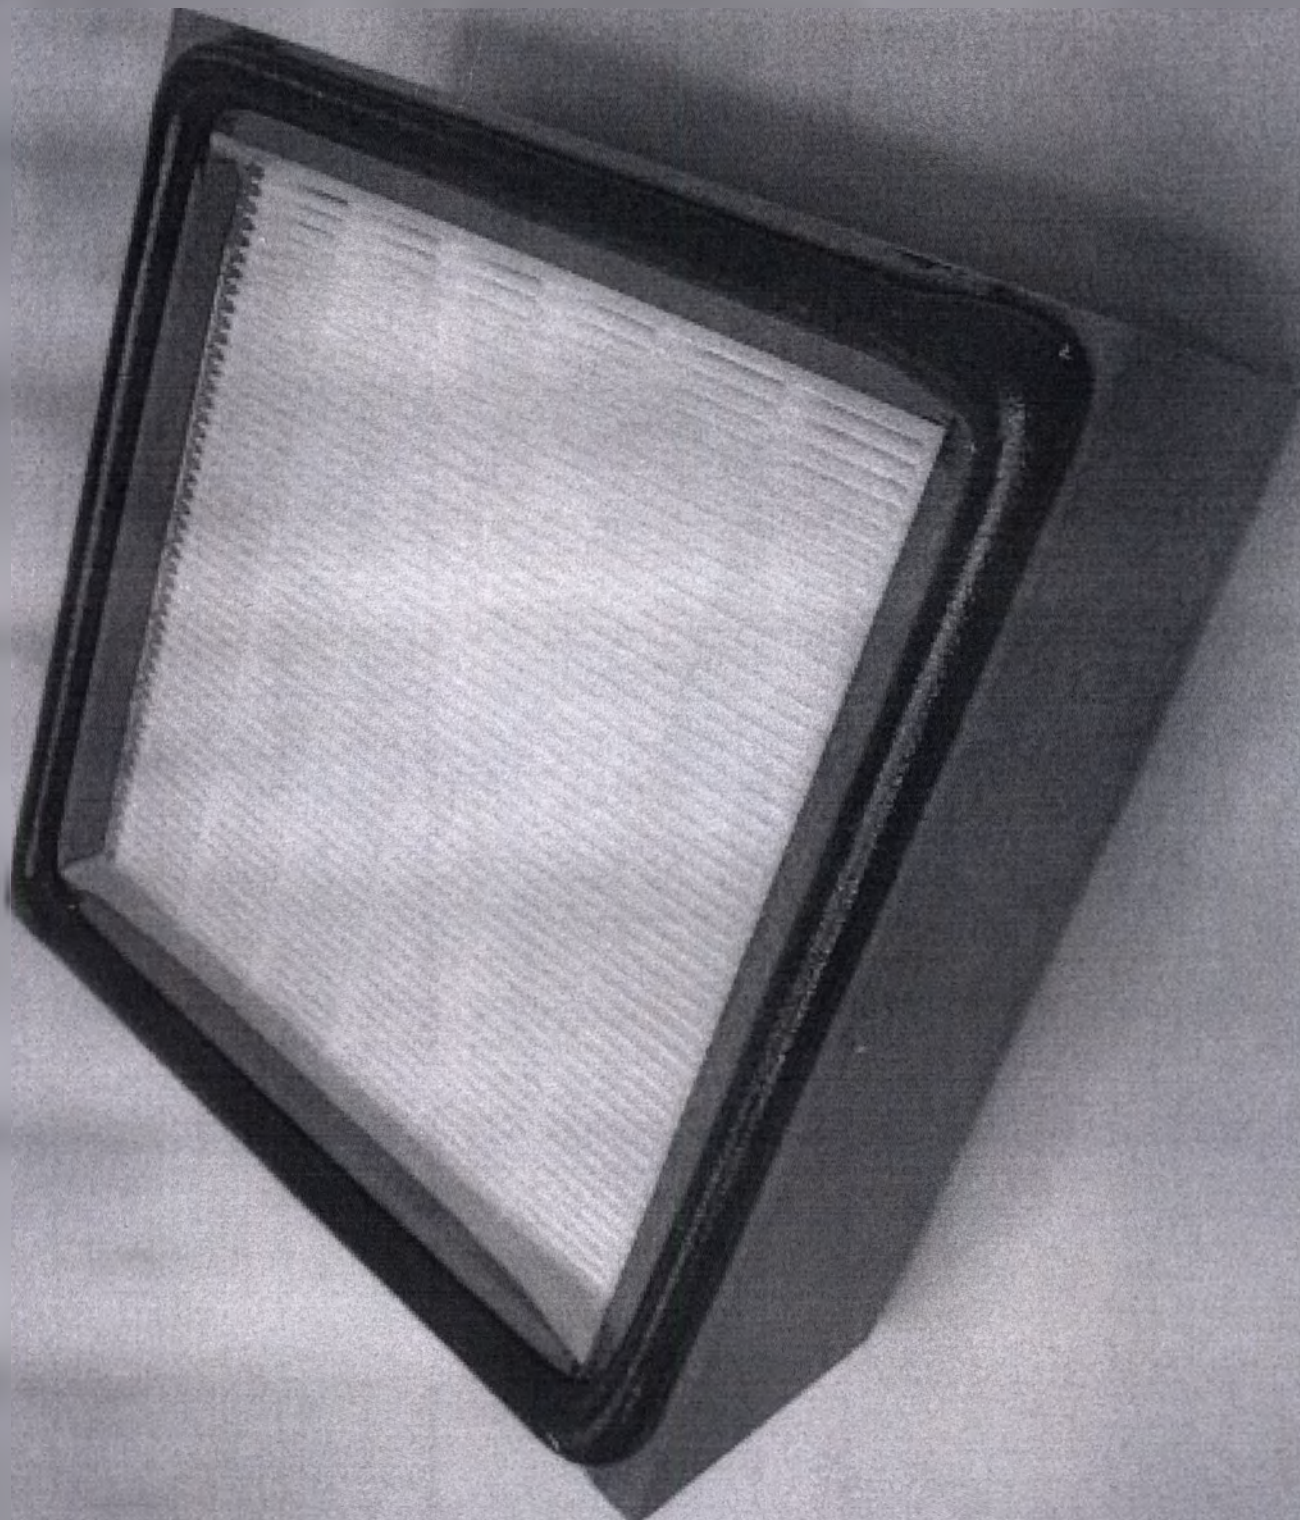


64

17.39 РМНТР 919 Б0961

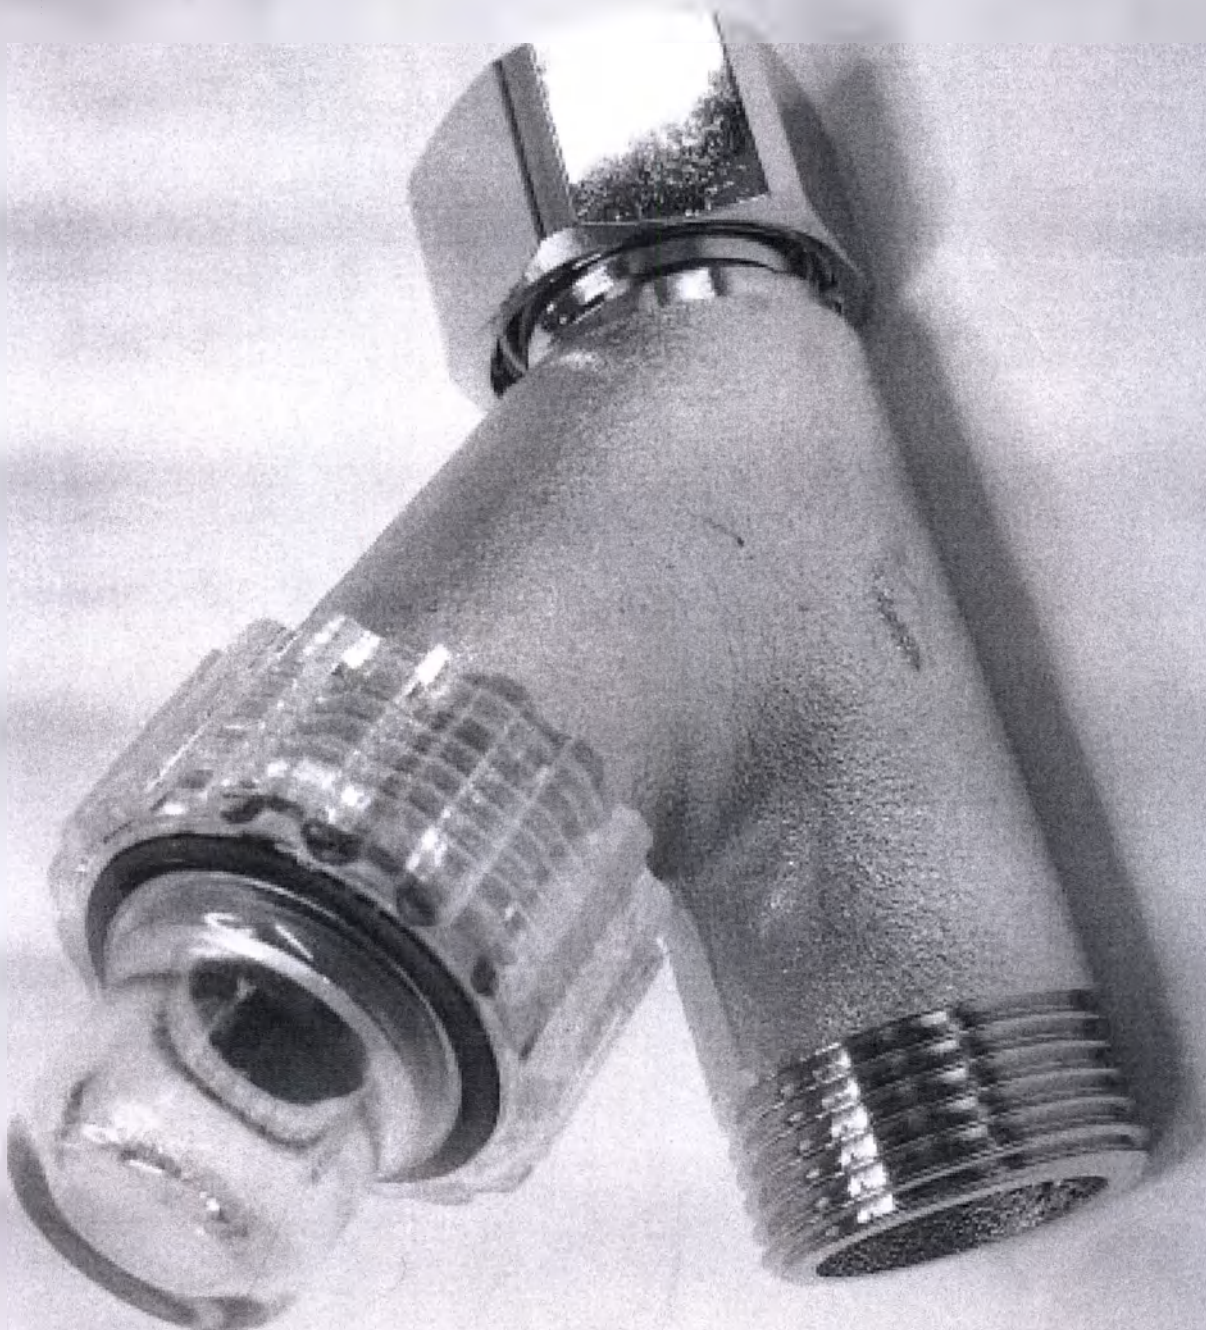



1741 Уполномоченная прокурора № 66

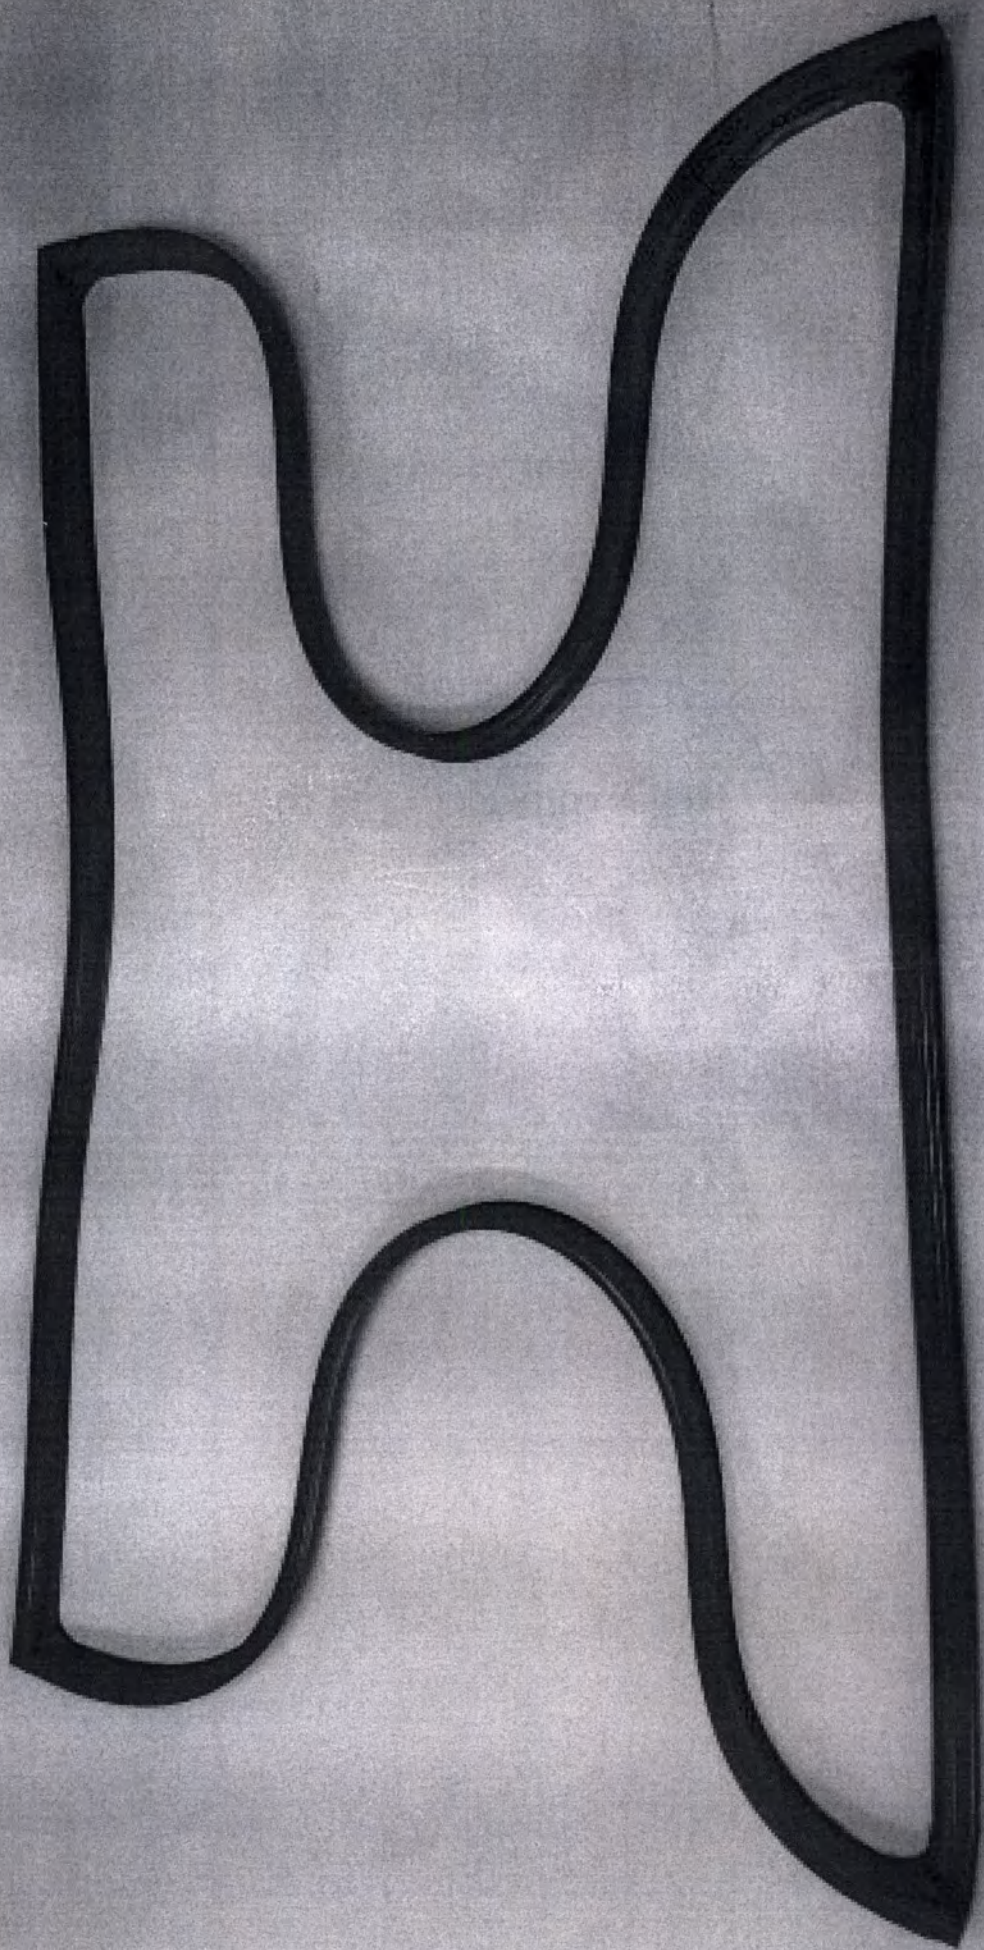

Всего прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 66 листов.

Генеральный директор
ООО «МК ВИТА-ПУЛ»

Конев А.Е.

