


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Цифровая ультразвуковая диагностическая система с цветным доплером «Arogee», варианты исполнения:

«Arogee 5300»

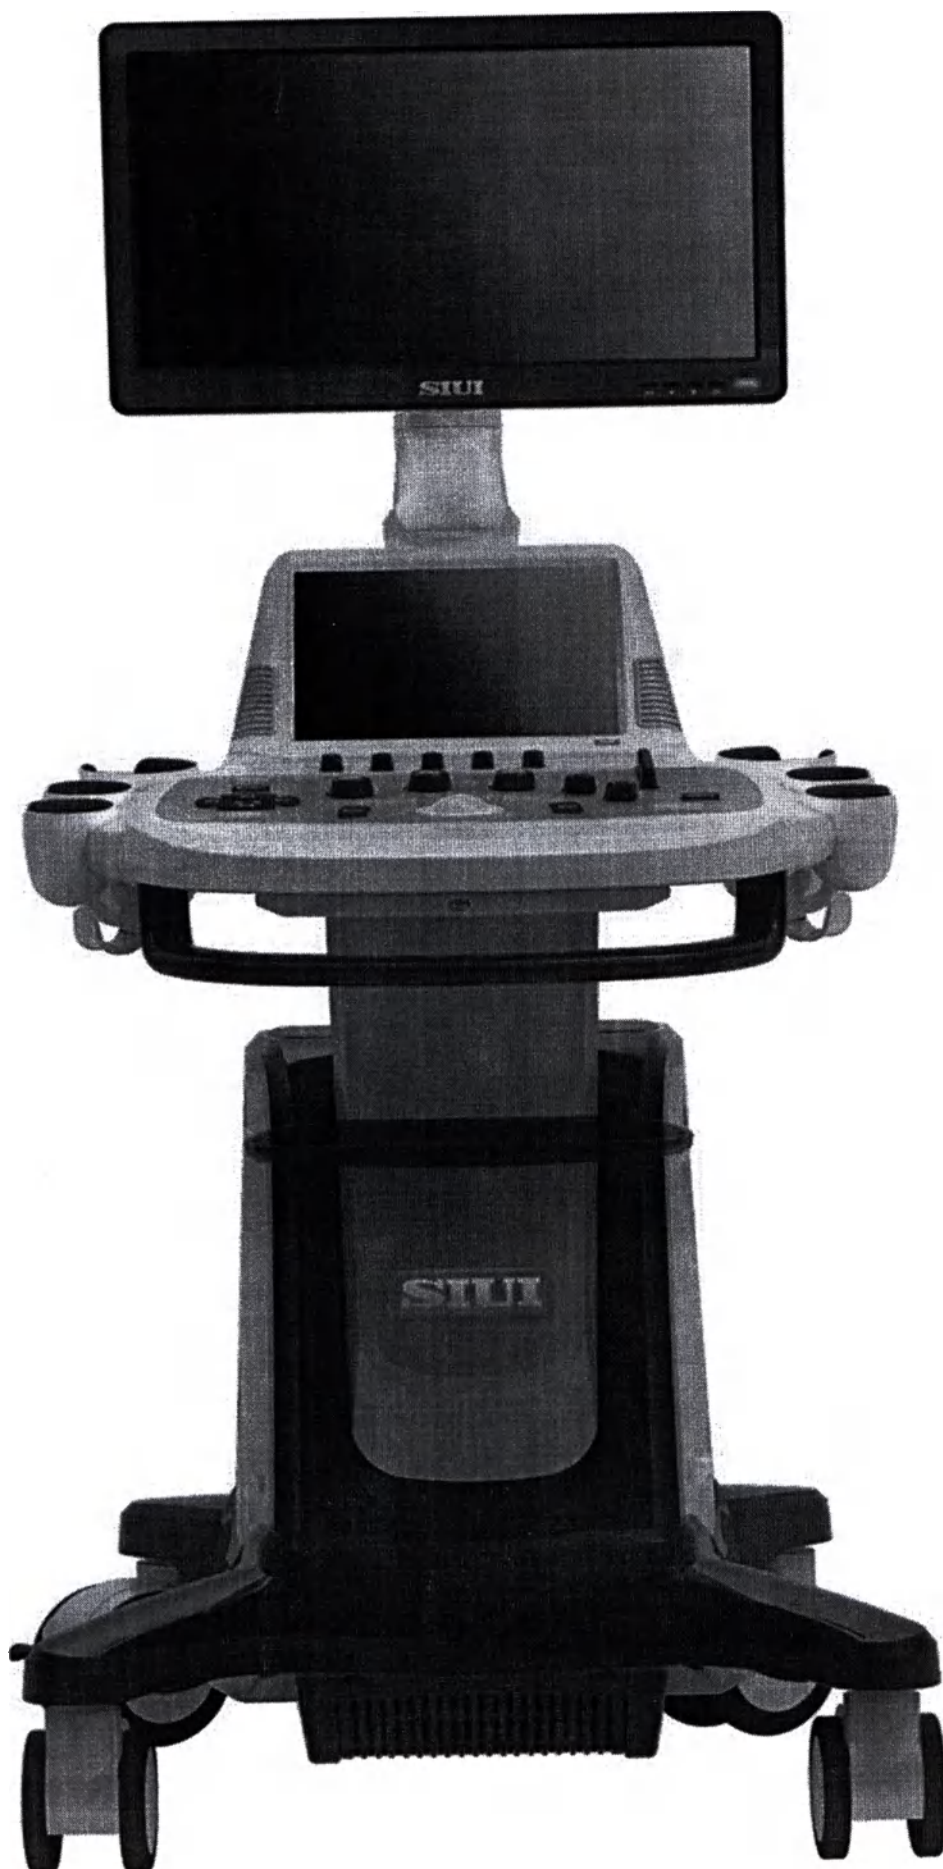

«Apogee 5500»



«Apogee 5800»



Состав:

1. Основной блок (включая монитор)


Apogee 5300



Основной блок (включая монитор)
Aropge 5500



**Основной блок (включая монитор)
Aproge 5800**

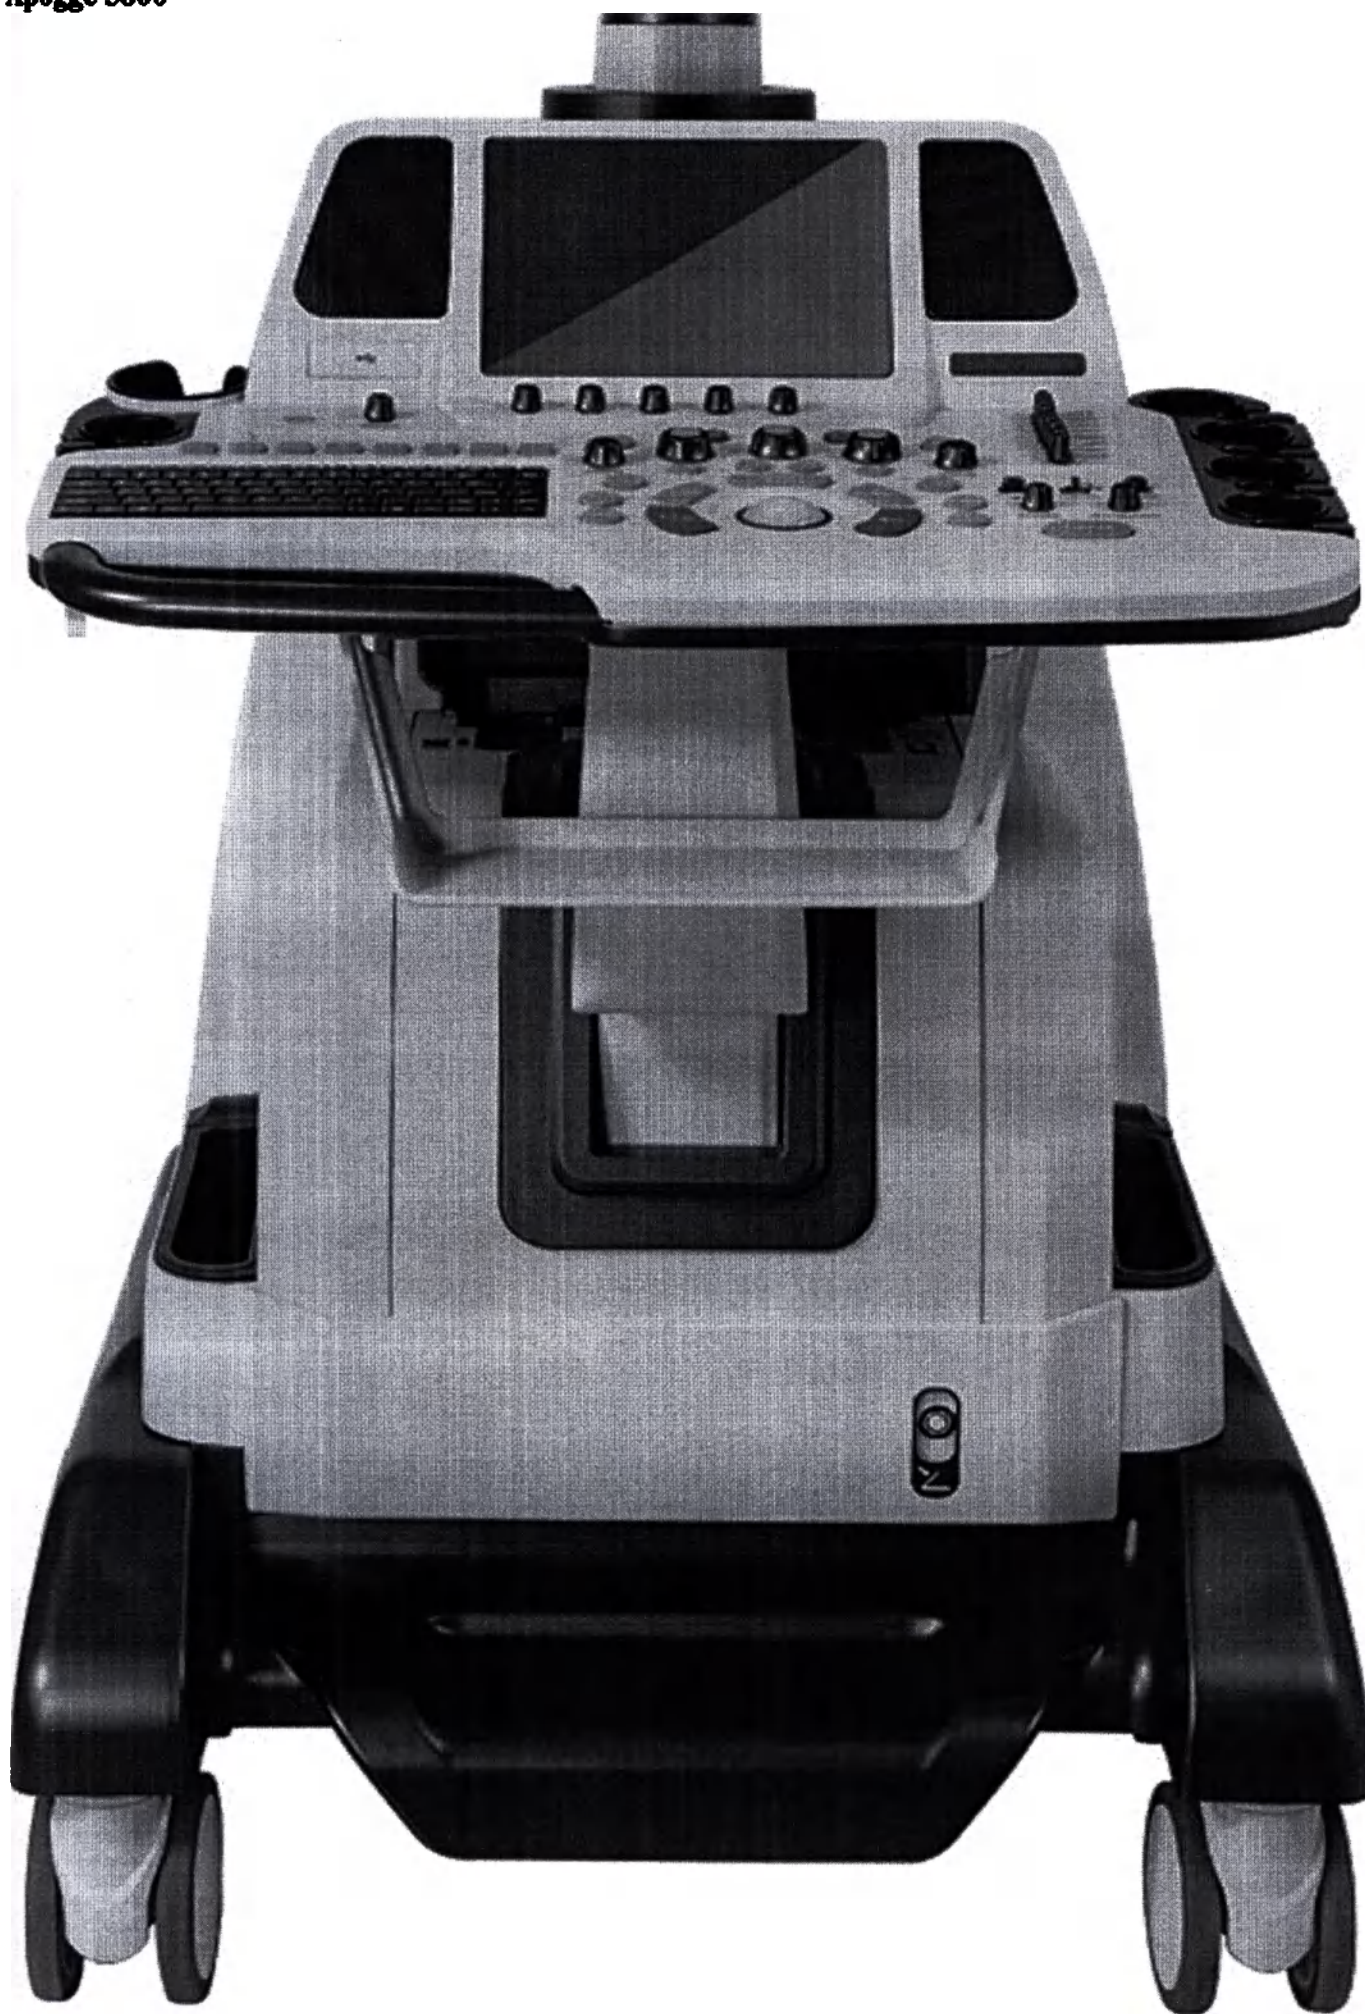


2. ЖК монитор



Принадлежности:


1. Датчик конвексный – не более 5 шт.

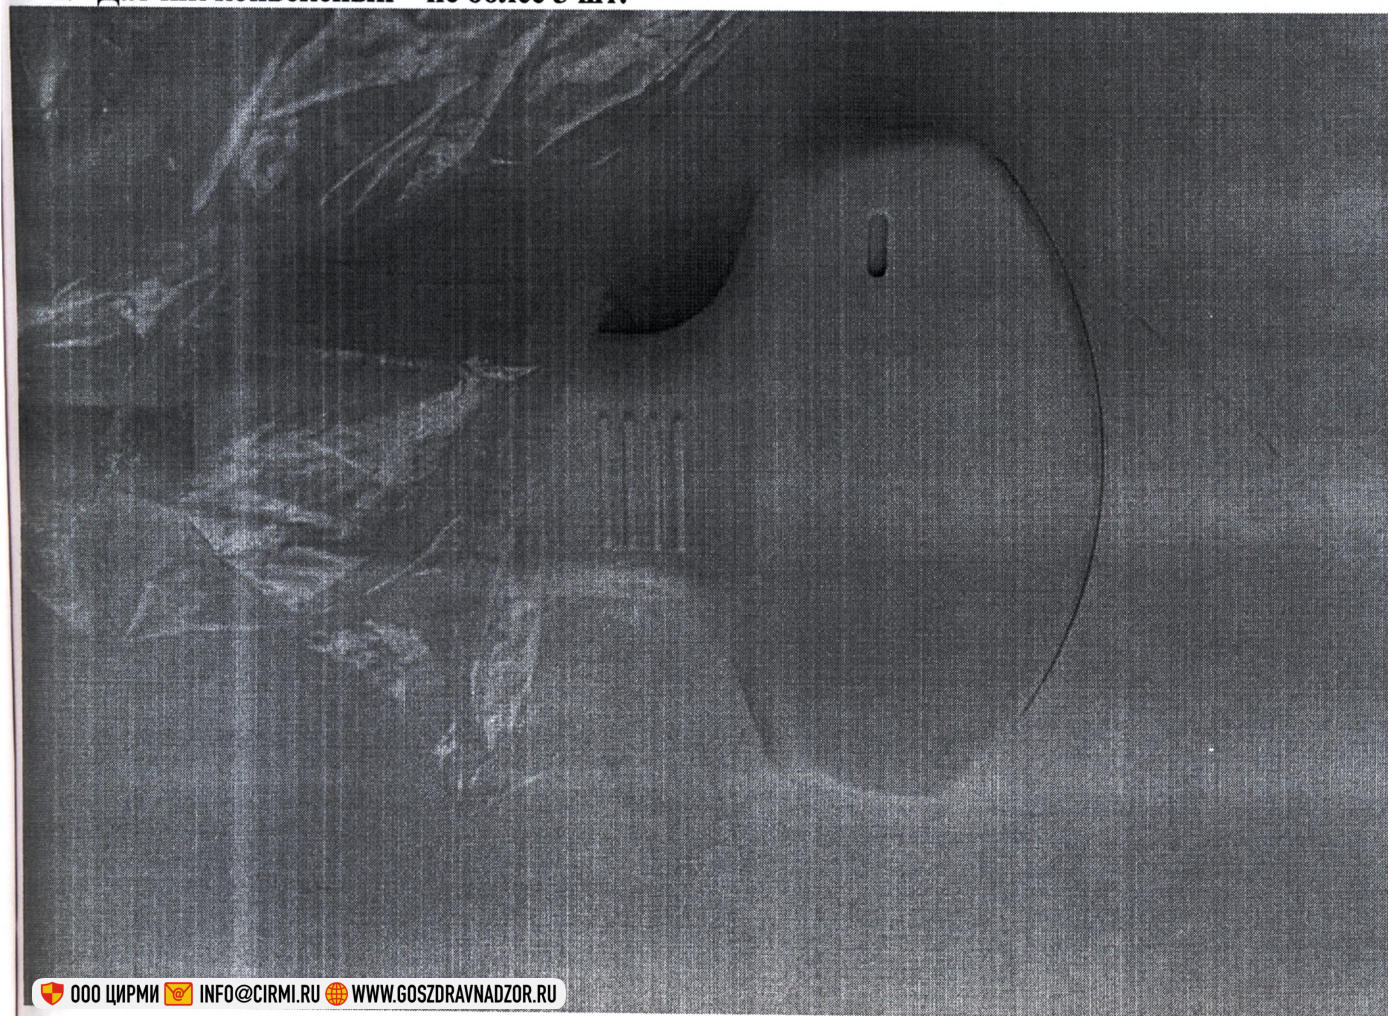

2. Датчик микроконвексный – не более 5 шт.




3. Датчик линейный – не более 5 шт.

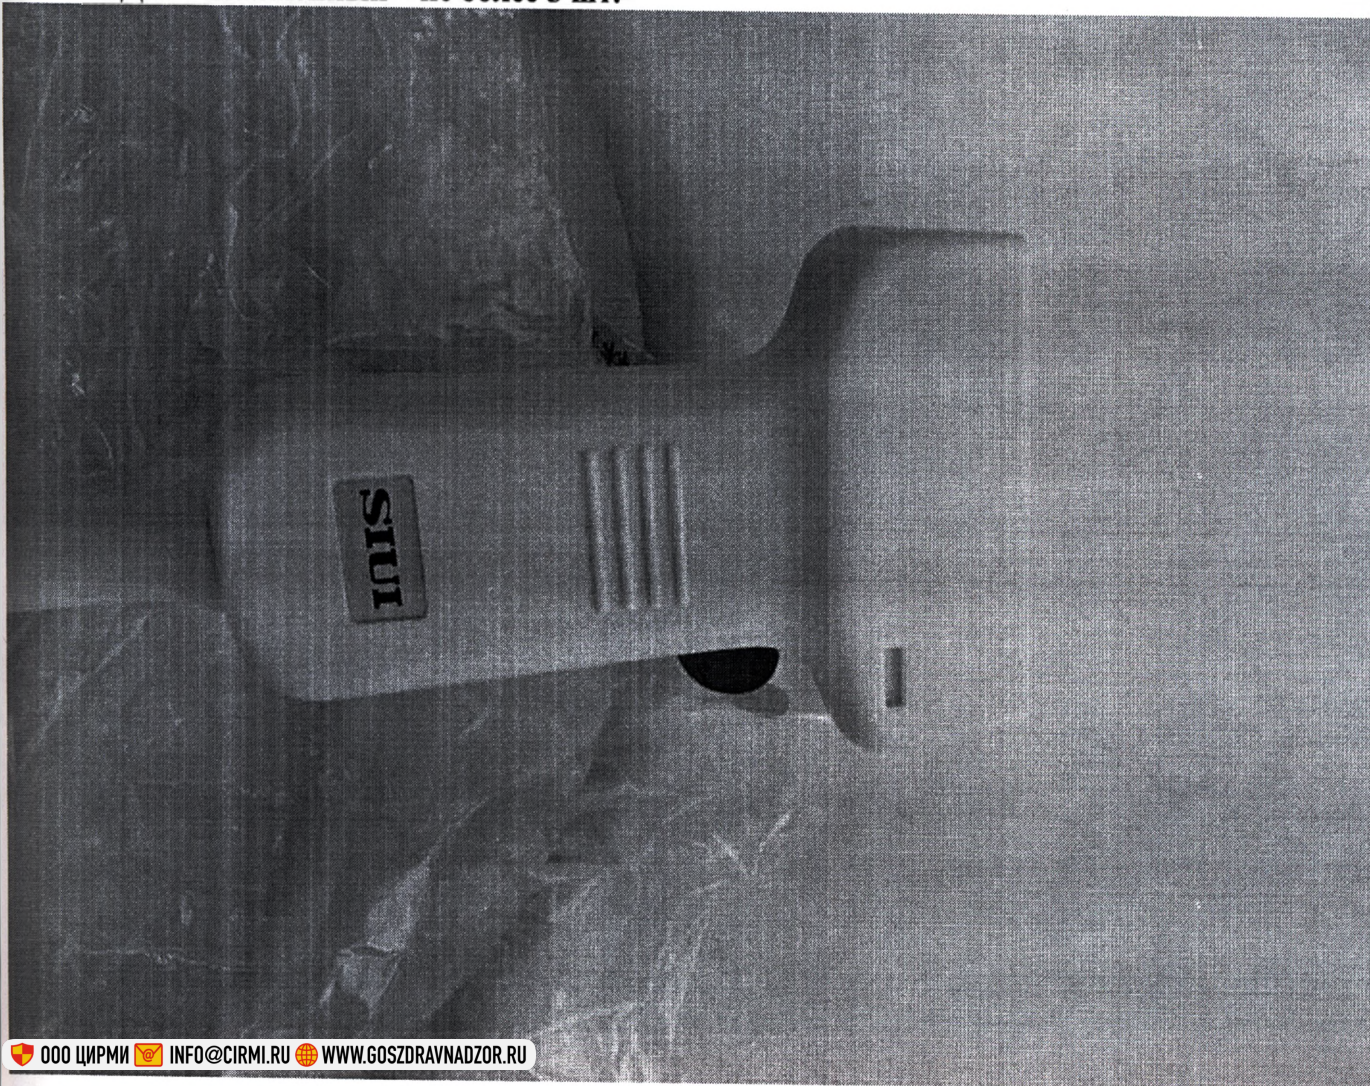


4. Датчик с фазированной решеткой – не более 5 шт



5. Датчик трансвагинальный – не более 5 шт.

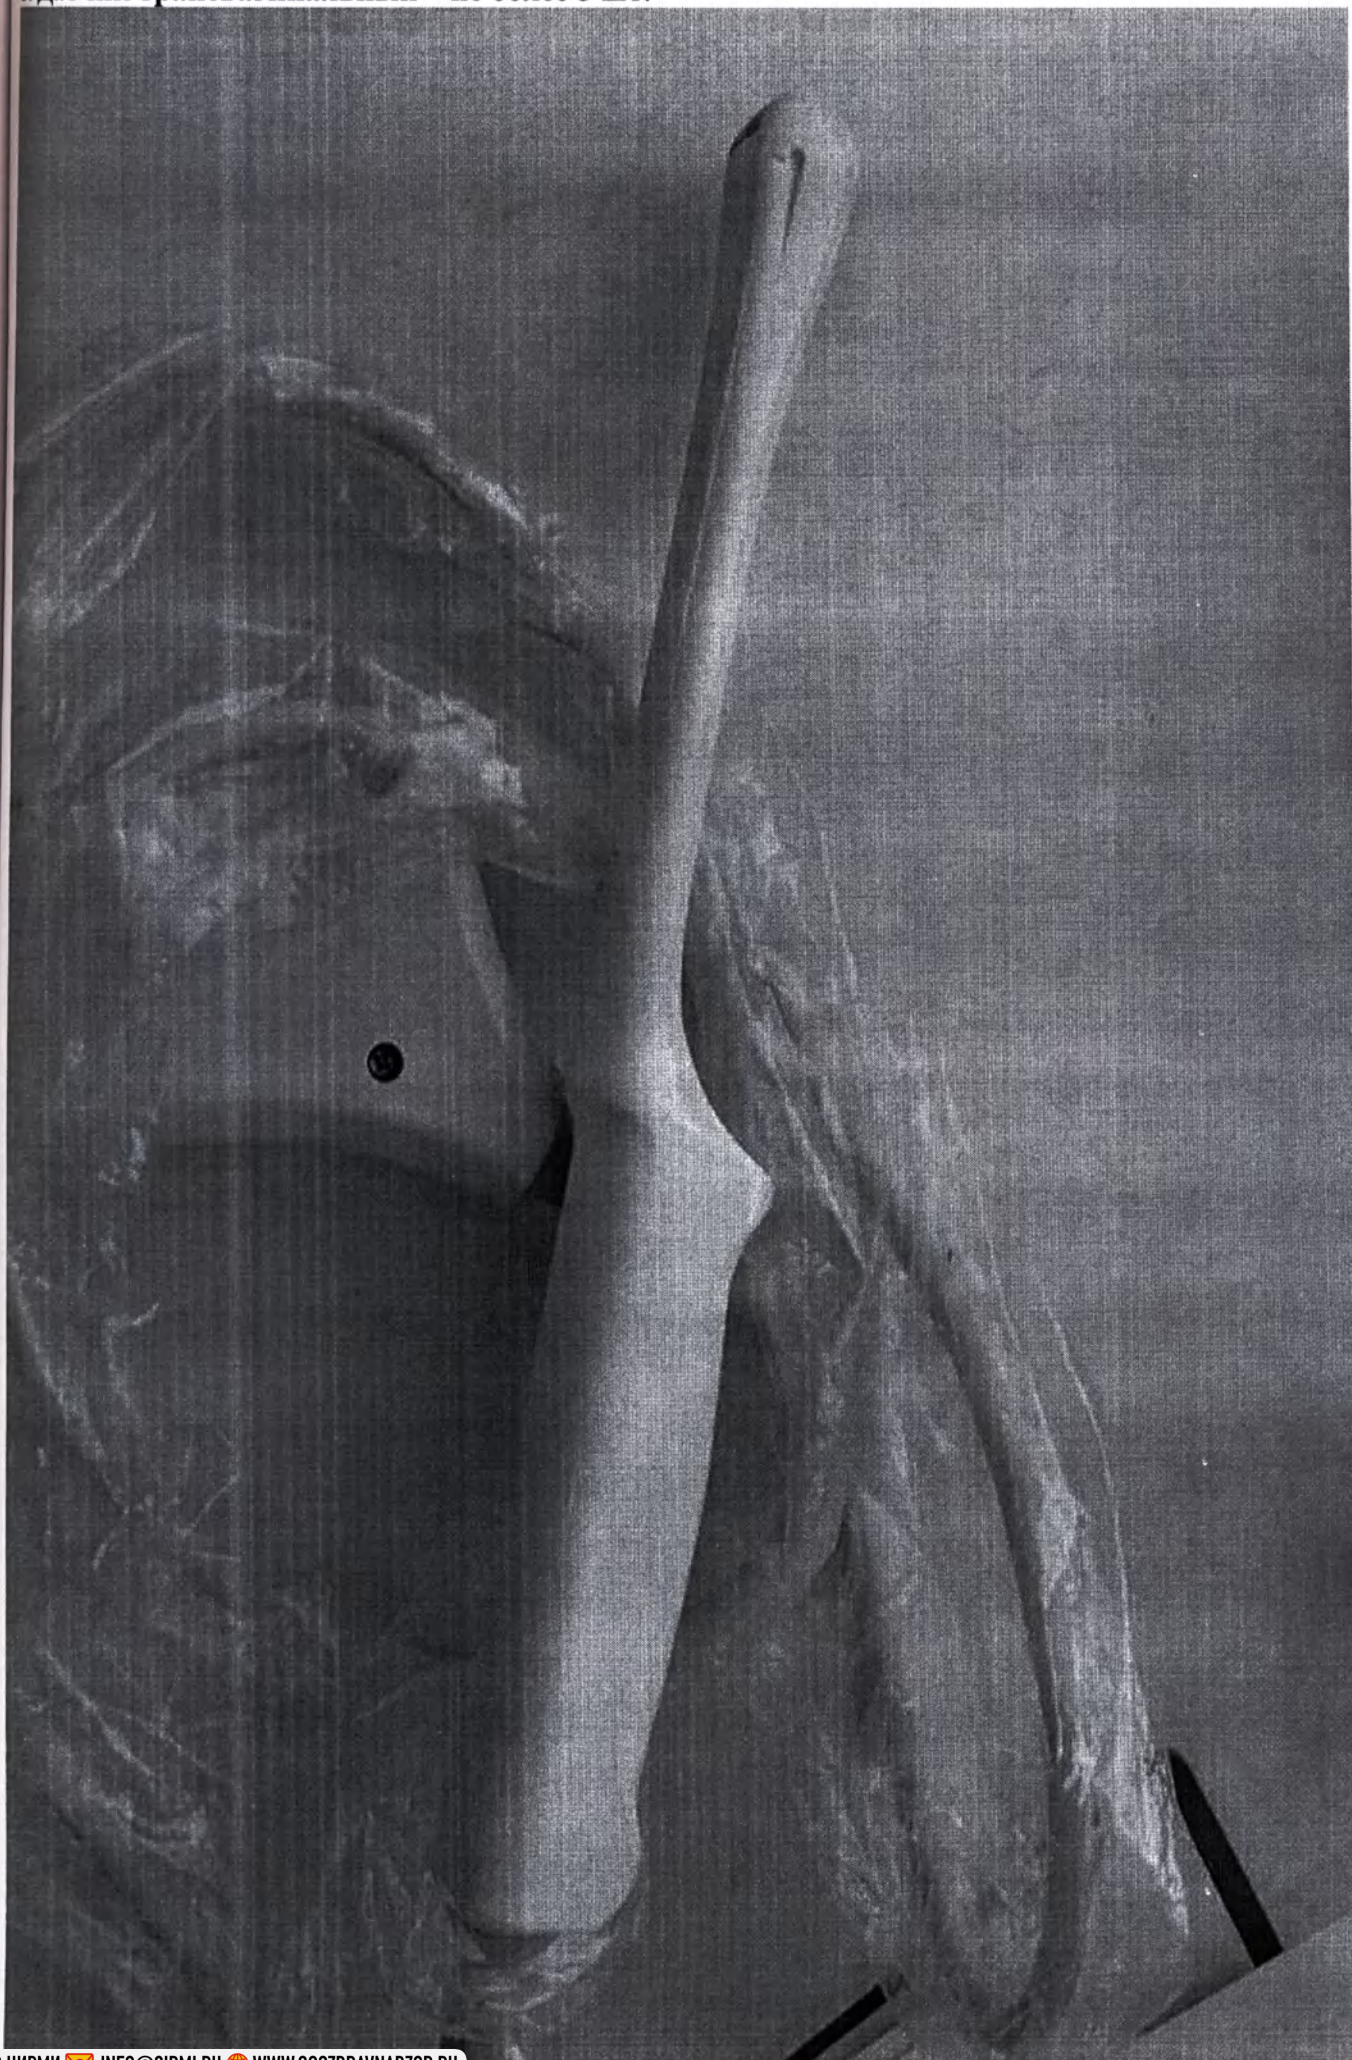

6. Датчик трансректальный – не более 5 шт.

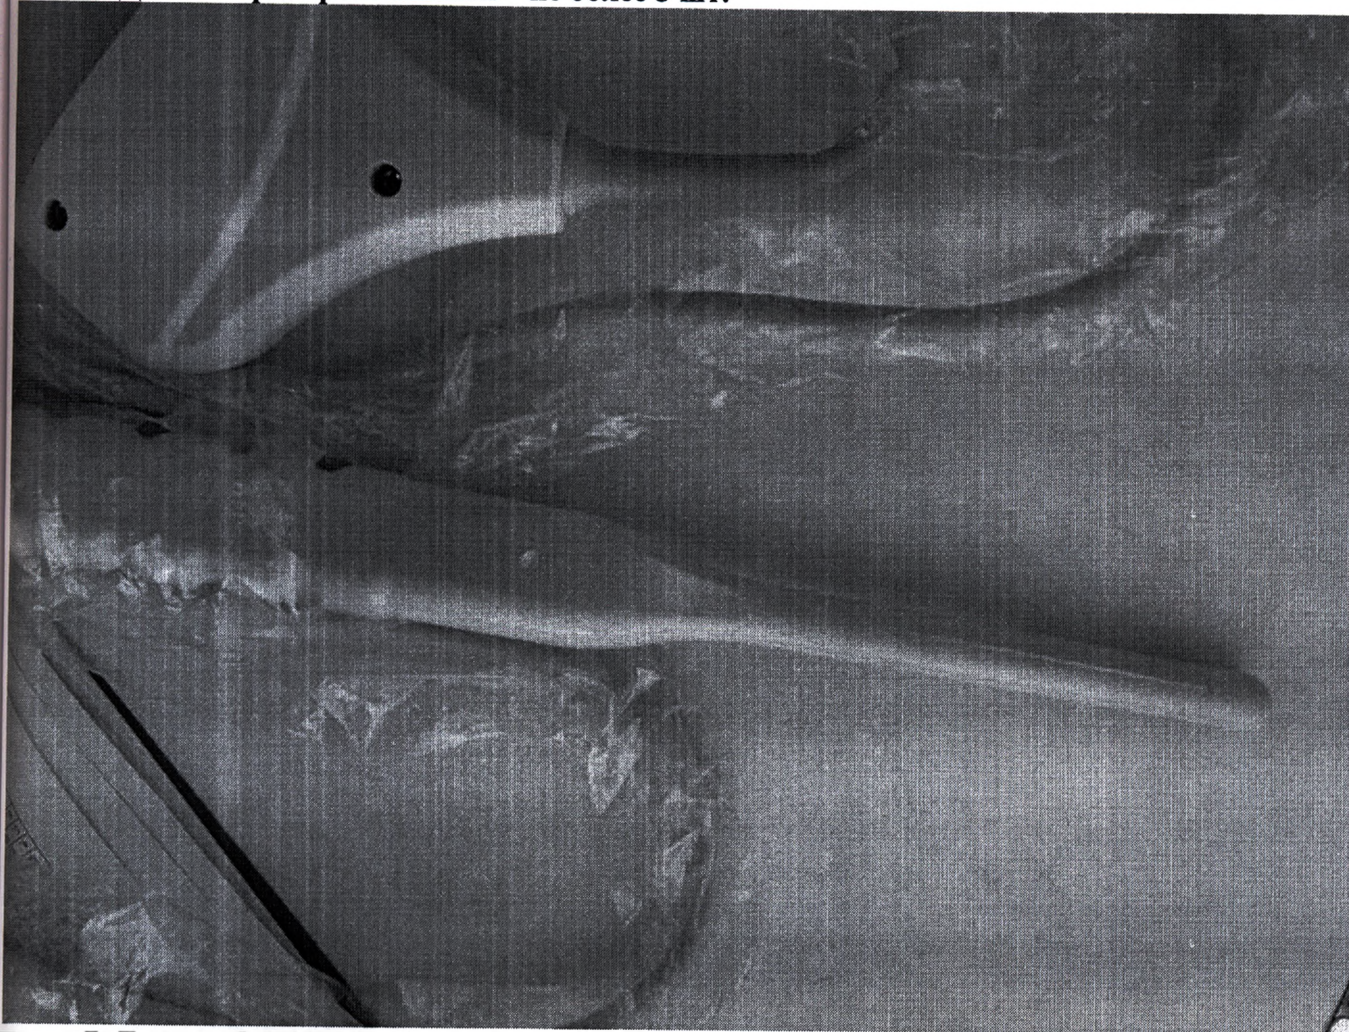


7. Датчик биплановый – не более 5 шт.




8. Датчик конвексный 4D – не более 5 шт.



9. Кабель питания

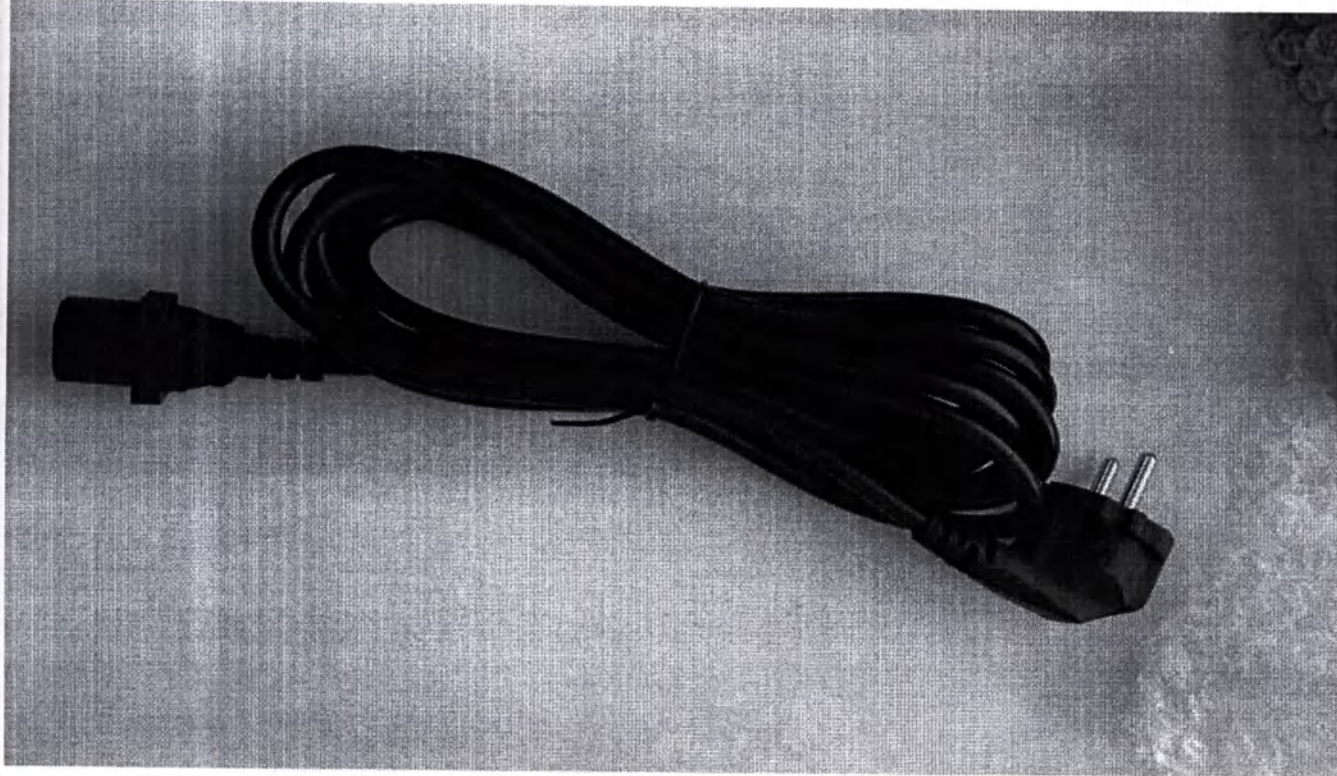


10. Проводник уравнивания потенциалов

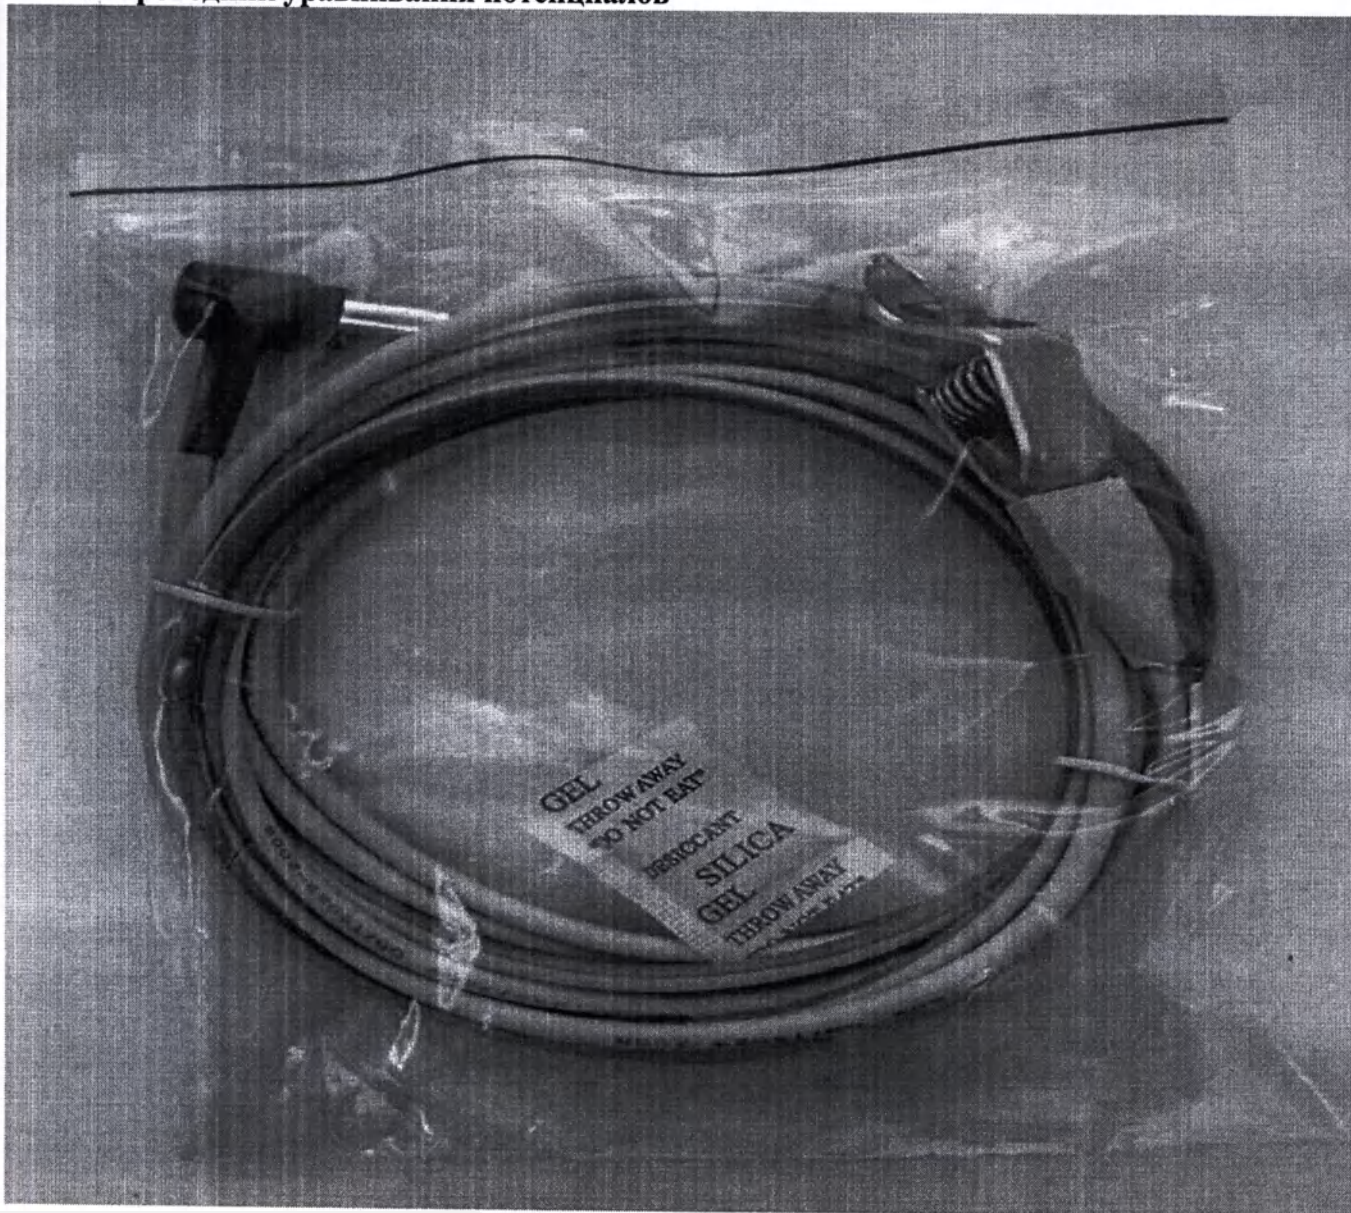


11. Кабель для подключения принтера




12. Кабель S-видео

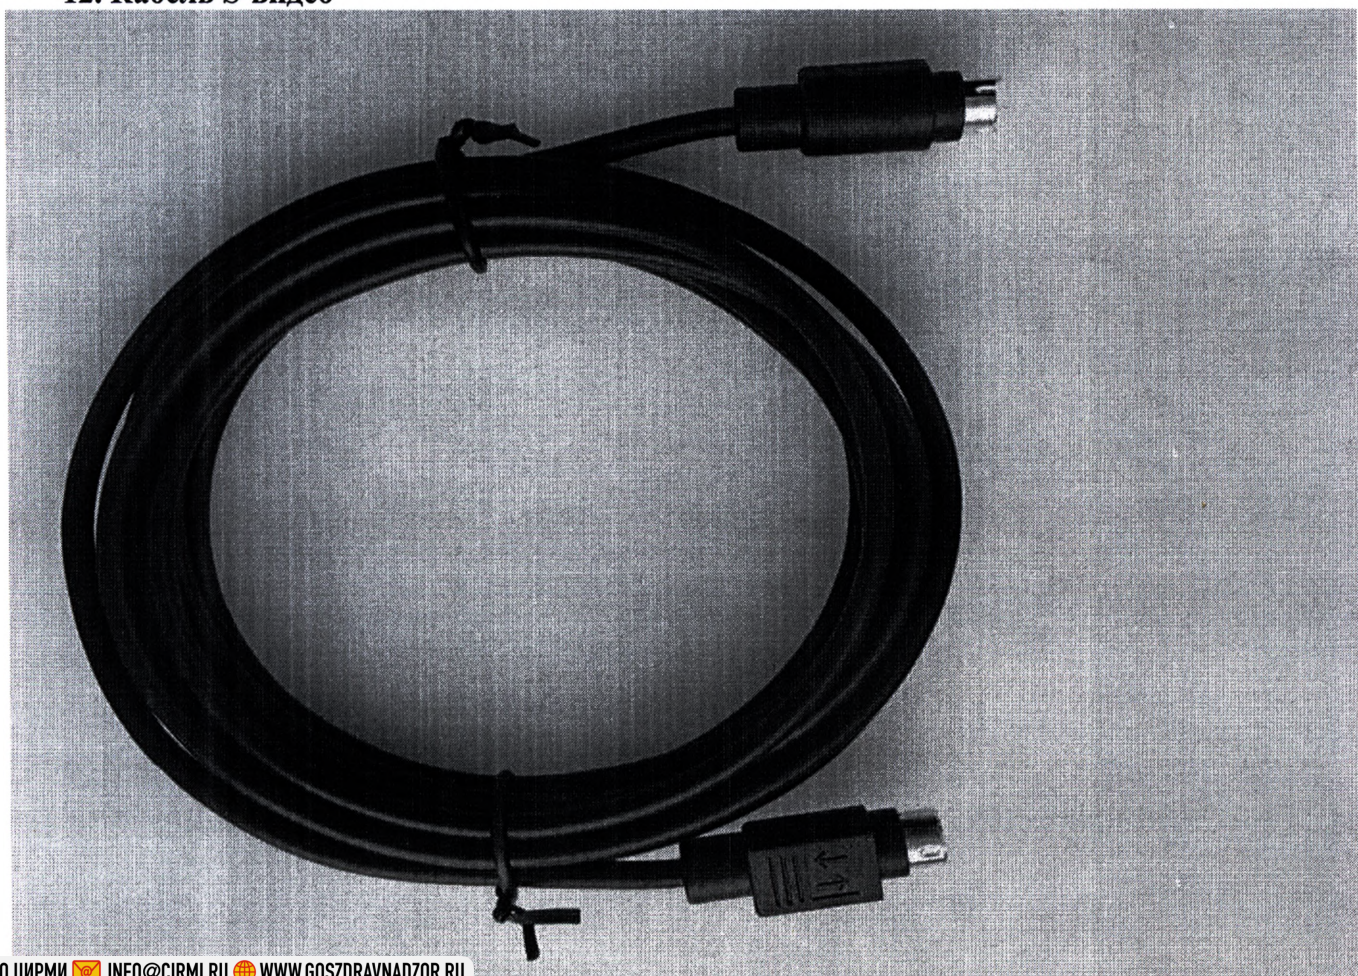


13. Кабель BNC/RCA

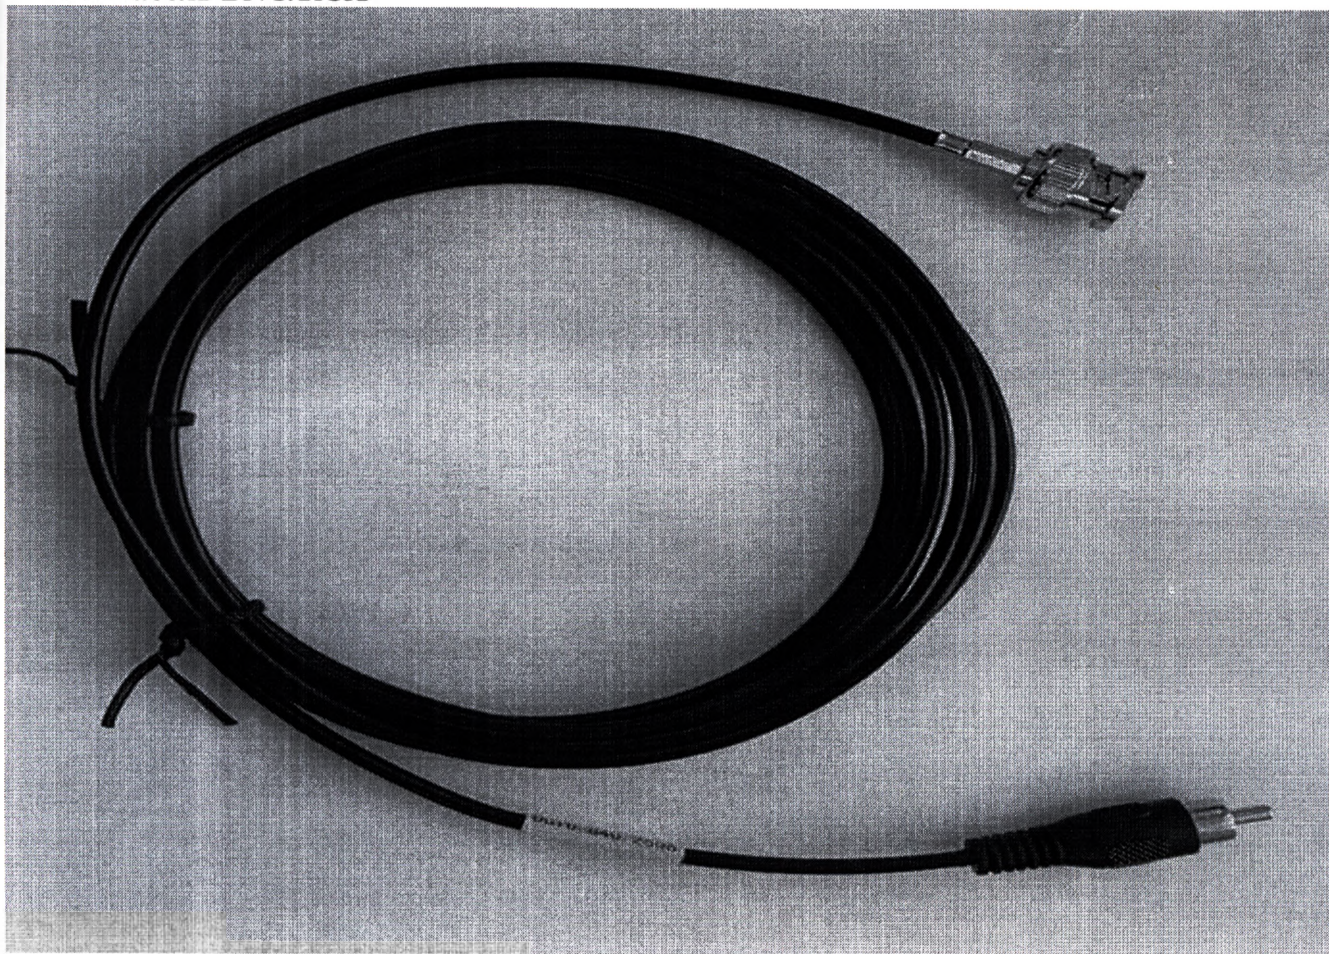


14. Пылезащитный чехол

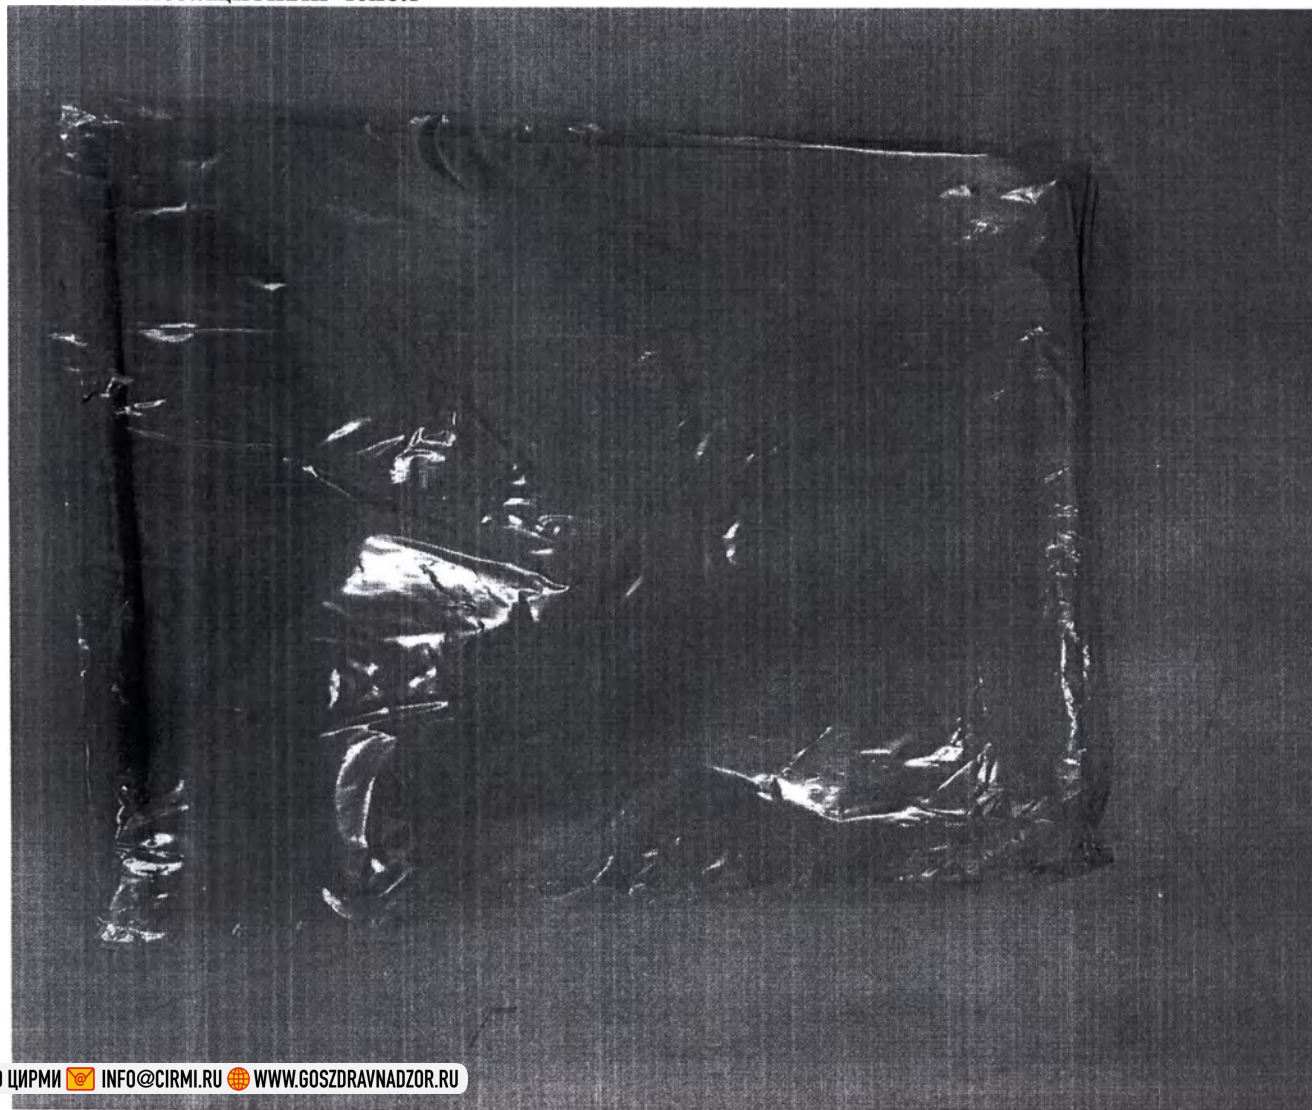


15. Восстановительный диск системы

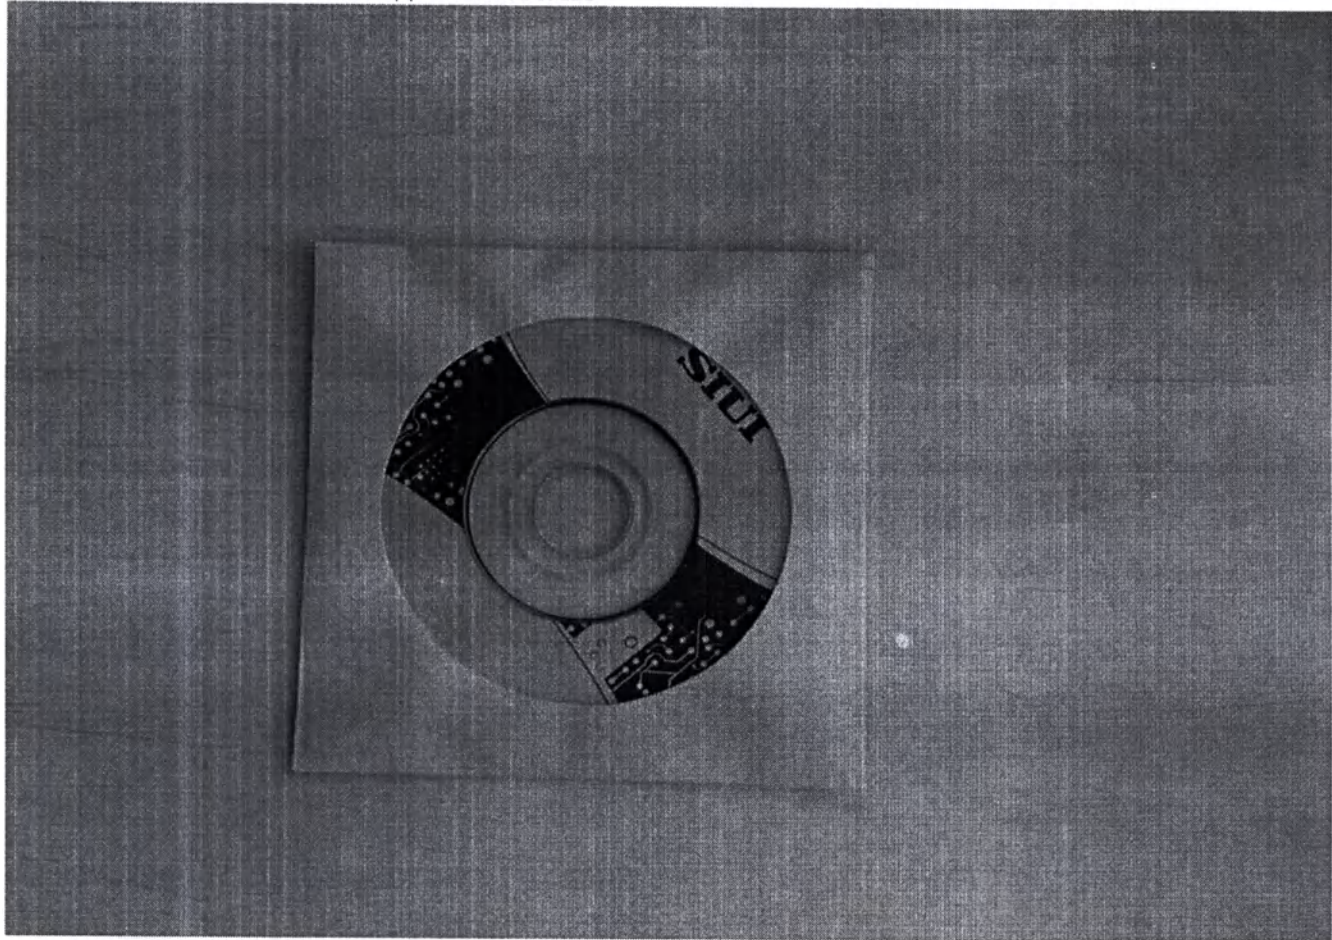

16. Беспроводная сетевая антенна

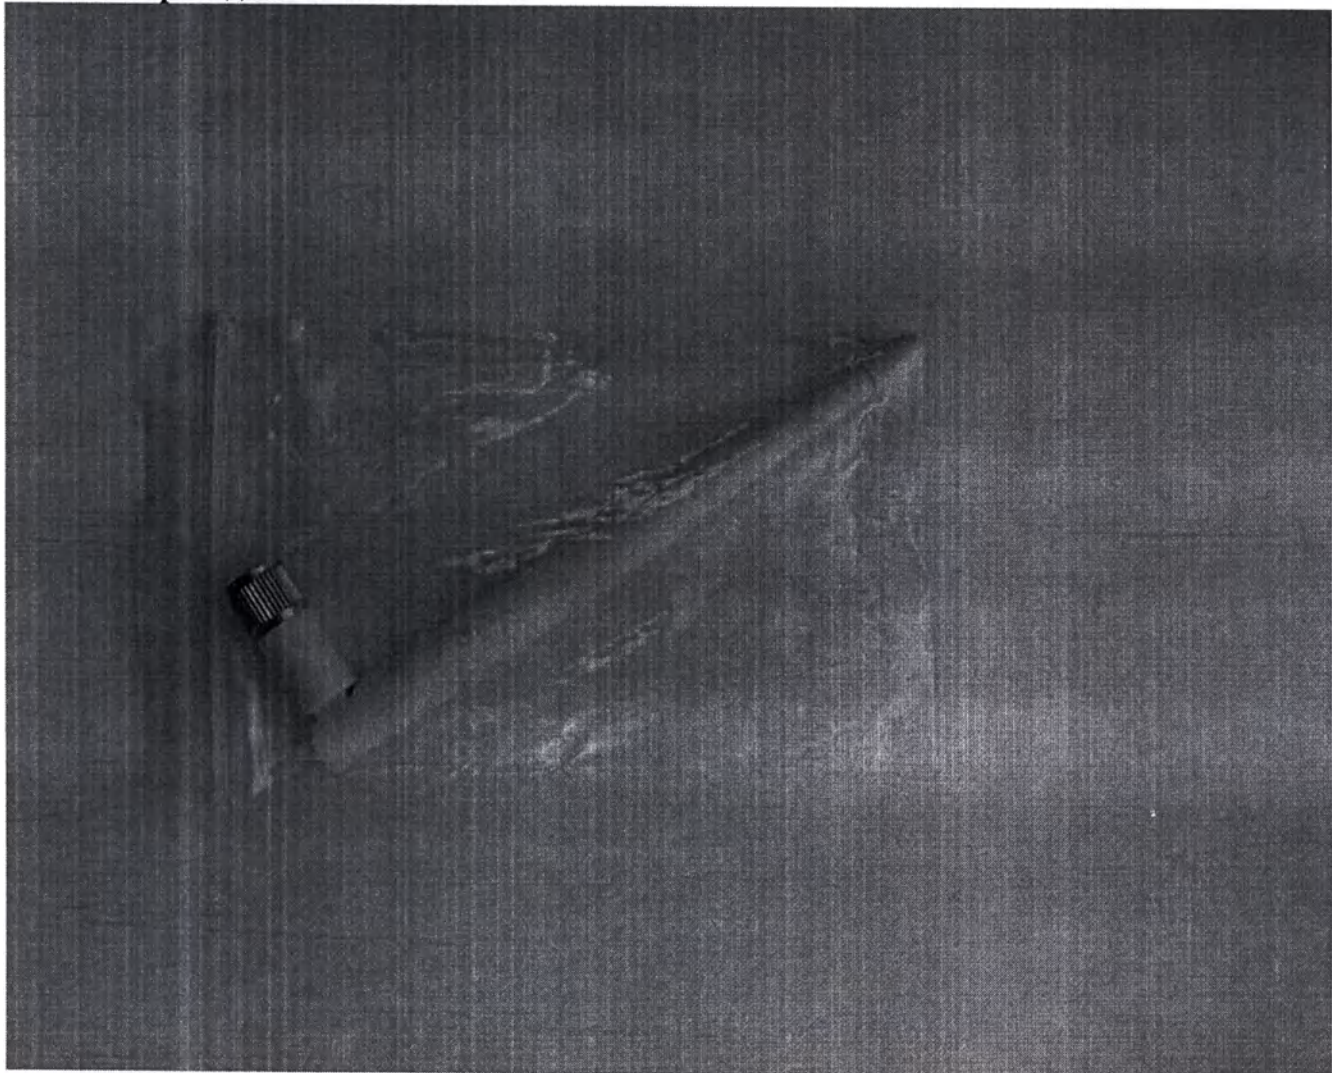


17. Держатель геля

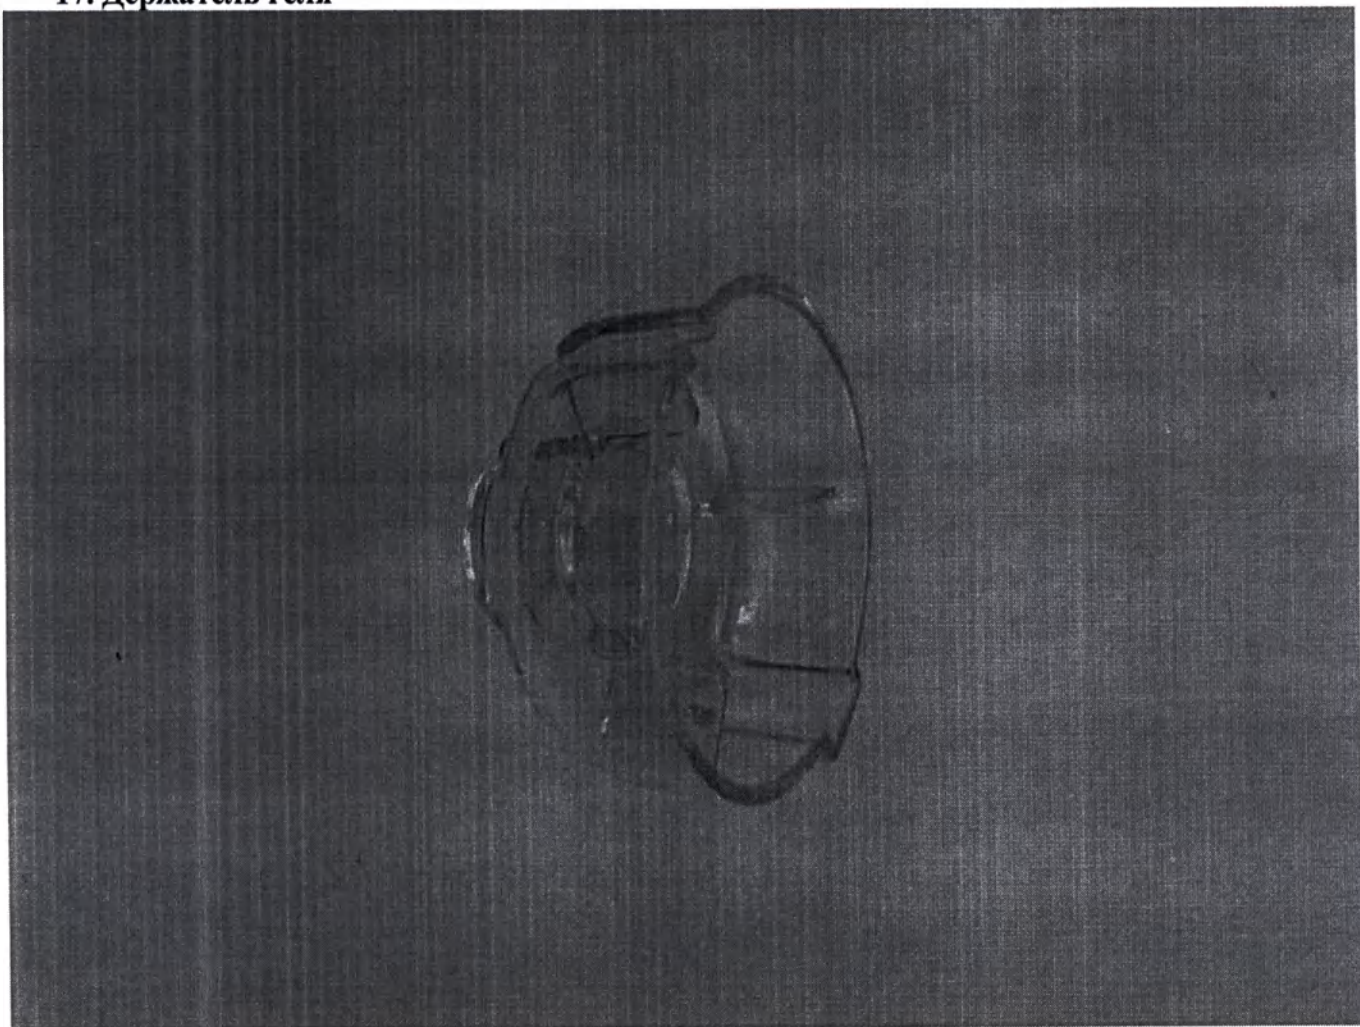

18. Подогреватель геля



19. Кабели ЭКГ

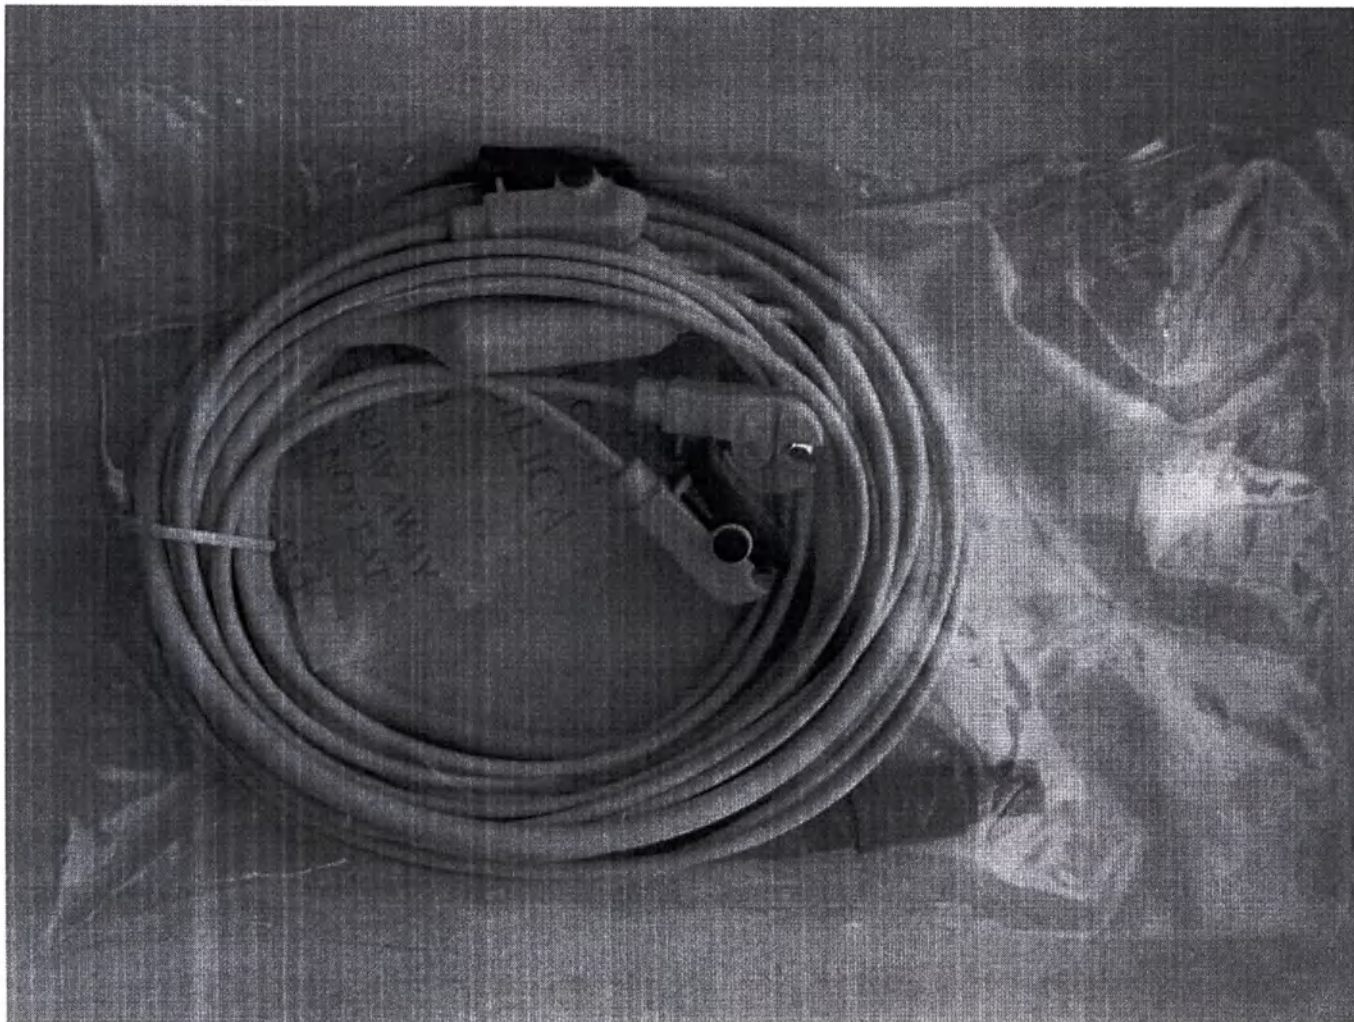

20. Педаль-выключатель



Apogee 5800

**Цифровая ультразвуковая
диагностическая система с цветным
доплером**

руководство по эксплуатации

SIUI

Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co., Ltd.

Ardee 5300

**Цифровая ультразвуковая
диагностическая система с цветным
доплером**

руководство по эксплуатации

SIUI

Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co., Ltd.

Ardee 5500

**Цифровая ультразвуковая
диагностическая система с цветным
доплером**

руководство по эксплуатации

SIUI

Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co., Ltd.

Генеральный директор
(должность)



Е.Е.Жвакина
(И.О. Фамилия)