



Передняя панель устройства:

Сигнал лазерного предупреждения

Аппликатор с охлаждением кожи
STD: 14x10 мм²

Ключи (2 ключа для включения)

Задняя панель устройства:

Кабель питания

Предупреждающая лампа /
дистанционный блокиратор

Ножной переключатель






Аппликатор с охлаждением кожи

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

СИД: 8Х6 ММ2 (4062)

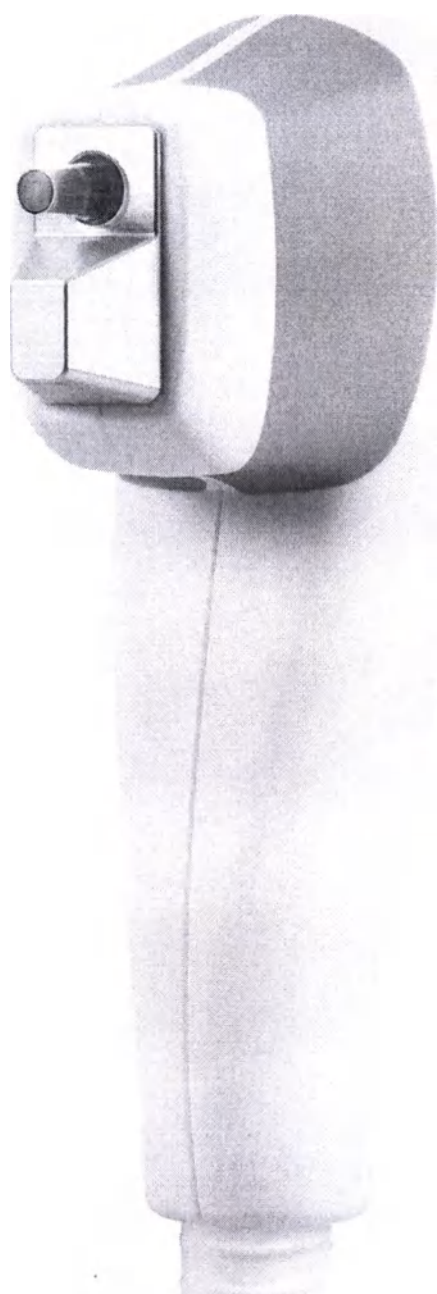

Аппликатор с охлаждением кожи

СТД: 1x2 мм² (4061)

Сшито и заверено печатью 3

Сшито

Генеральный директор
ООО «Лазер Мед Системс»

Кудакаев С.В.







Сшито и заверено печатью

(Signature)

Генеральный директор
ООО «Лазер Мед Системс»

Кудакаев С.В.

