



Генеральный директор
ЗАО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов

ЗАО «Вектор-Бест» (ООО «Вектор-Бест»)
г. Краснодар, ул. 131, ЗАО «Вектор-Бест»
Тел: (860) 227-67-84, 227-75-55, 930-34-08
Факс: (860) 220-13-42
E-mail: info@vector-best.ru

ПАСПОРТ № 1260-18
РеалБест-Генетика МСМ6
набор реагентов для определения однонуклеотидного полиморфизма -13910C/T гена МСМ6 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с детекцией кривых плавления



Идентификационный номер: 2
Дата изготовления: 03.04.2018
Дата выхода из партии: 03.04.2018
Срок годности набора: до 03.04.2019


ТУ 9398-520-22548172-2018

Состав набора	Характеристики и нормы	Размеры упаковки
Вспомогательный субстрат «Гамма-ГЛ» (M21), серия 2	Полупрозрачная бесцветная жидкость, 1 пробирка, 1 мл	Полупрозрачная бесцветная жидкость, 1 пробирка, 1 мл (соответствует)
Вспомогательный субстрат «Гамма-ГЛ» (M22), серия 2	Полупрозрачная бесцветная жидкость, 1 пробирка, 1 мл	Полупрозрачная бесцветная жидкость, 1 пробирка, 1 мл (соответствует)
Готовая реакционная смесь для ПЦР (M23), серия 2	Амбипрозрачная бесцветная масса, 48 пробирок по 0,1 мл (соответствует)	Амбипрозрачная бесцветная масса, 48 пробирок по 0,1 мл (соответствует)
Энзимный раствор «Гамма-ГЛ» (M24), серия 2	Полупрозрачная бесцветная жидкость, 2 флакона по 1,2 мл	Полупрозрачная бесцветная жидкость, 2 флакона по 1,2 мл (соответствует)
Примечание: Набор реагентов «Гамма-ГЛ» (M21-M24), серия 2	1 лист	1 лист (соответствует)

В комплект поставки входит: набор реагентов, инструкция по применению, паспорт.

Замечание: Показатели качества, целостности упаковки и маркировки соответствуют требованиям ТУ 9398-520-22548172-2018

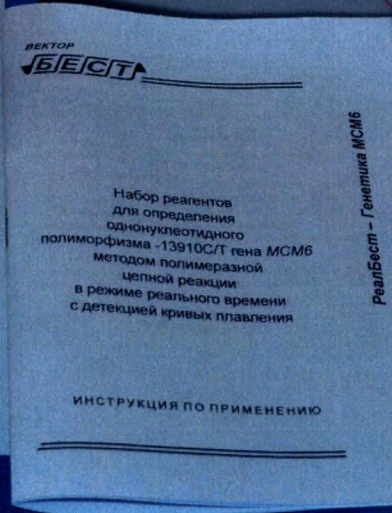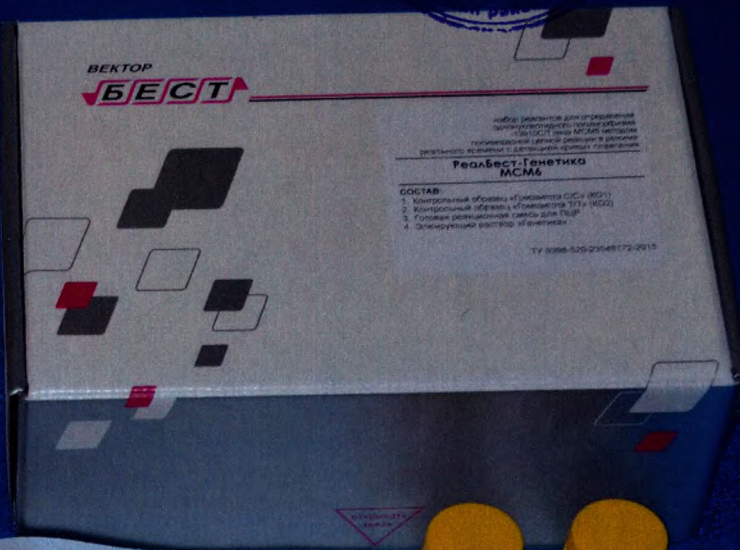

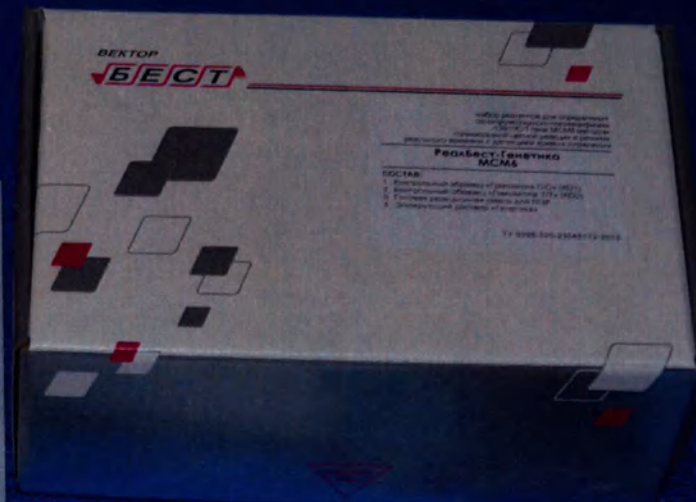[illegible]