




Фотографические изображения


Набор калибраторов для количественного определения тиреоглобулина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови для анализаторов иммунологических Elecsys 2010 (Rack/Disk), cobas e411(Rack/Disk) и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, Cobas 6000, Cobas 8000 (Tg II CalSet Elecsys and cobas e analyzers)

Набор калибраторов для количественного определения тиреоглобулина
 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови для анализаторов
 иммунологических Elecsys 2010 (Rack/Disk), cobas e411 (Rack/Disk) и платформ модульных
 MODULAR ANALYTICS, Cobas 6000, Cobas 8000 (Tg II CalSet Elecsys and cobas e analyzers)
 (общий вид)

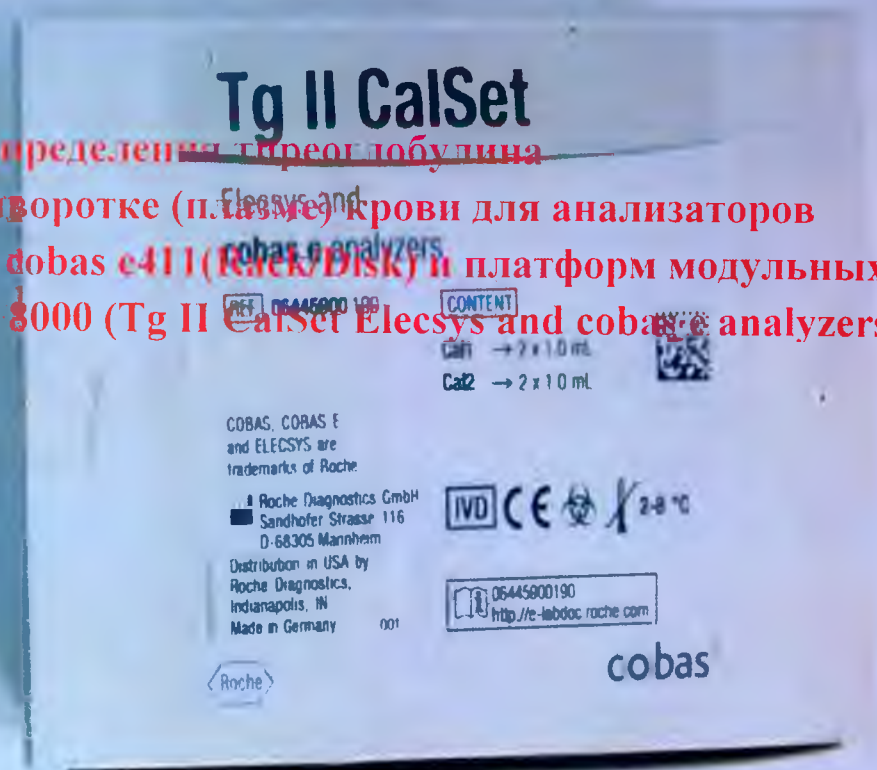


Набор калибраторов для количественного определения тиреоглобулина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови для анализаторов иммунологических Elecsys 2010 (Rack/Disk), cobas e411(Rack/Disk) и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, Cobas 6000, Cobas 8000 (Tg II CalSet Elecsys and cobas e analyzers)

Калибратор 1, флакон объемом 1,0 мл

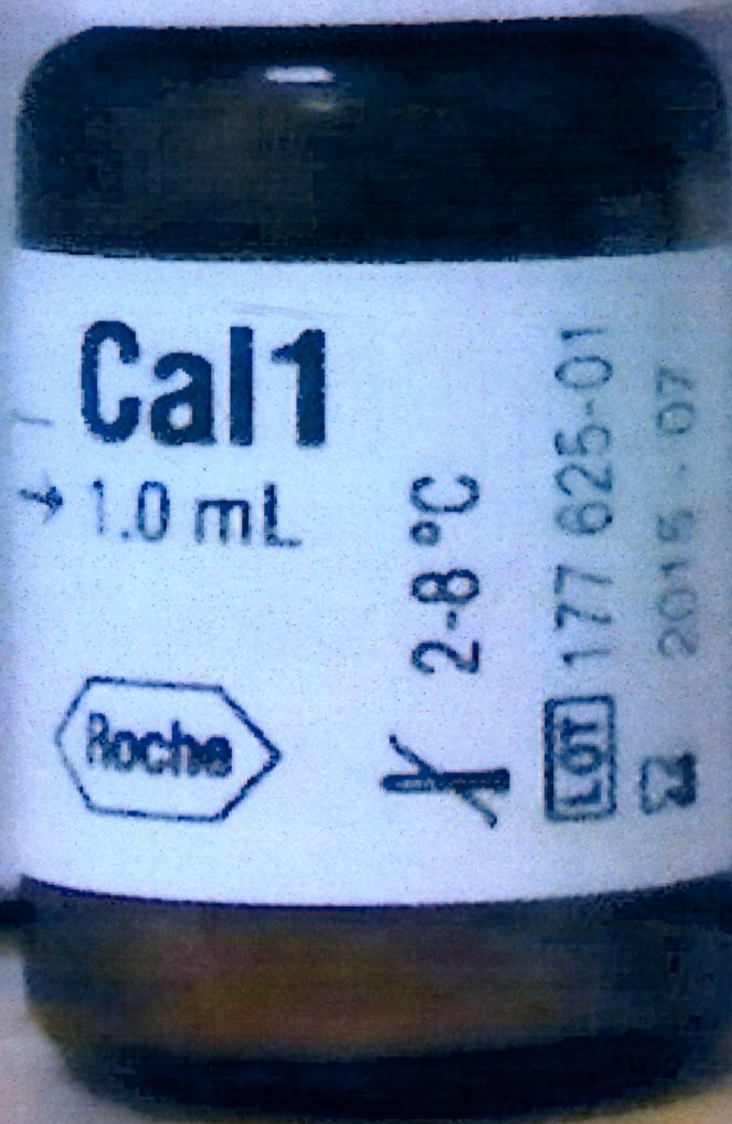

Набор калибраторов для количественного определения тиреоглобулина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови для анализаторов иммунологических Elecsys 2010 (Rack/Disk), cobas e411(Rack/Disk) и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, Cobas 6000, Cobas 8000 (Tg II CalSet Elecsys and cobas e analyzers)

Калибратор 2, флакон объемом 1,0 мл

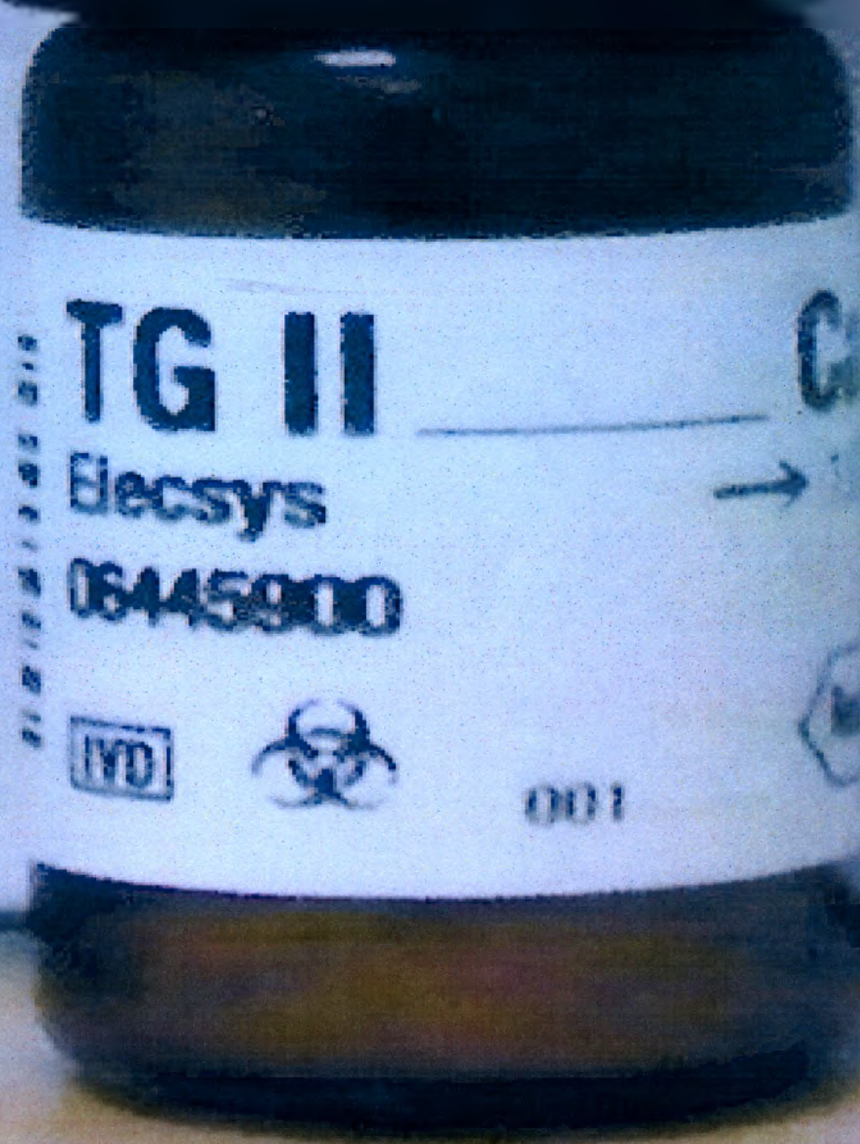

Набор калибраторов для количественного определения тиреоглобулина
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови для анализаторов
иммунологических Elecsys 2010 (Rack/Disk), cobas e411(Rack/Disk) и платформ модульных
MODULAR ANALYTICS, Cobas 6000, Cobas 8000 (Tg II CalSet Elecsys and cobas analyzers)

Флакон пустой, объемом 1,0 мл

Tg II
Elecsys
0644590
→ 1.0 ml
IVD
LOT 17762
2015
Roche

Tg II
Elecsys
0644590
→ 1.0 ml
IVD
LOT 17762
2015
Roche

Tg II
Elecsys
0644590
→ 1.0 ml
IVD
LOT 17762
2015
Roche

Набор калибраторов для количественного определения тиреоглобулина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови для анализаторов иммунологических Elecsys 2010 (Rack/Disk), cobas e411(Rack/Disk) и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, Cobas 6000, Cobas 8000 (Tg II CalSet Elecsys and cobas e analyzers)

Этикетка



Набор калибраторов для количественного определения тиреоглобулина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови для анализаторов иммунологических Elecsys 2010 (Rack/Disk), cobas e411(Rack/Disk) и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, Cobas 6000, Cobas 8000 (Tg II CalSet Elecsys and cobas e analyzers)

Карта со штрих-кодом

TG II

CalSet

Elecsys

and cobas e analyzers

06445900

1260

LOT 177625

Roche

01



Набор калибраторов для количественного определения тиреоглобулина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови для анализаторов иммунологических Elecsys 2010 (Rack/Disk), cobas e411(Rack/Disk) и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, Cobas 6000, Cobas 8000 (Tg II CalSet Elecsys and cobas e analyzers)

Лист со штрих-кодом



Инструкция по применению

В данной инструкции всегда используется для разделения дробных разрядов, чтобы отметить границы между целыми и дробными частями дробного числа. Разделители для групп разрядов не используются.





И. А. Лучина
Лучина И. А.
Руководитель отдела Логистики
и качества по доверенности от:

29 СЕН 2014