

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «МАКЕ»

К.Н. Ульянова

«10»

сентября

2015 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Аппарат искусственной вентиляции легких Servo Ventilator в
исполнении Servo-U и Servo-n с принадлежностями**

производства компании MAQUET CRITICAL CARE AB

(Маке Критикал Кэа АБ)

Аппарат искусственной вентиляции легких Servo Ventilator в исполнении Servo-U




Аппарат искусственной вентиляции легких Servo Ventilator в исполнении Servo-n





Блок пациента

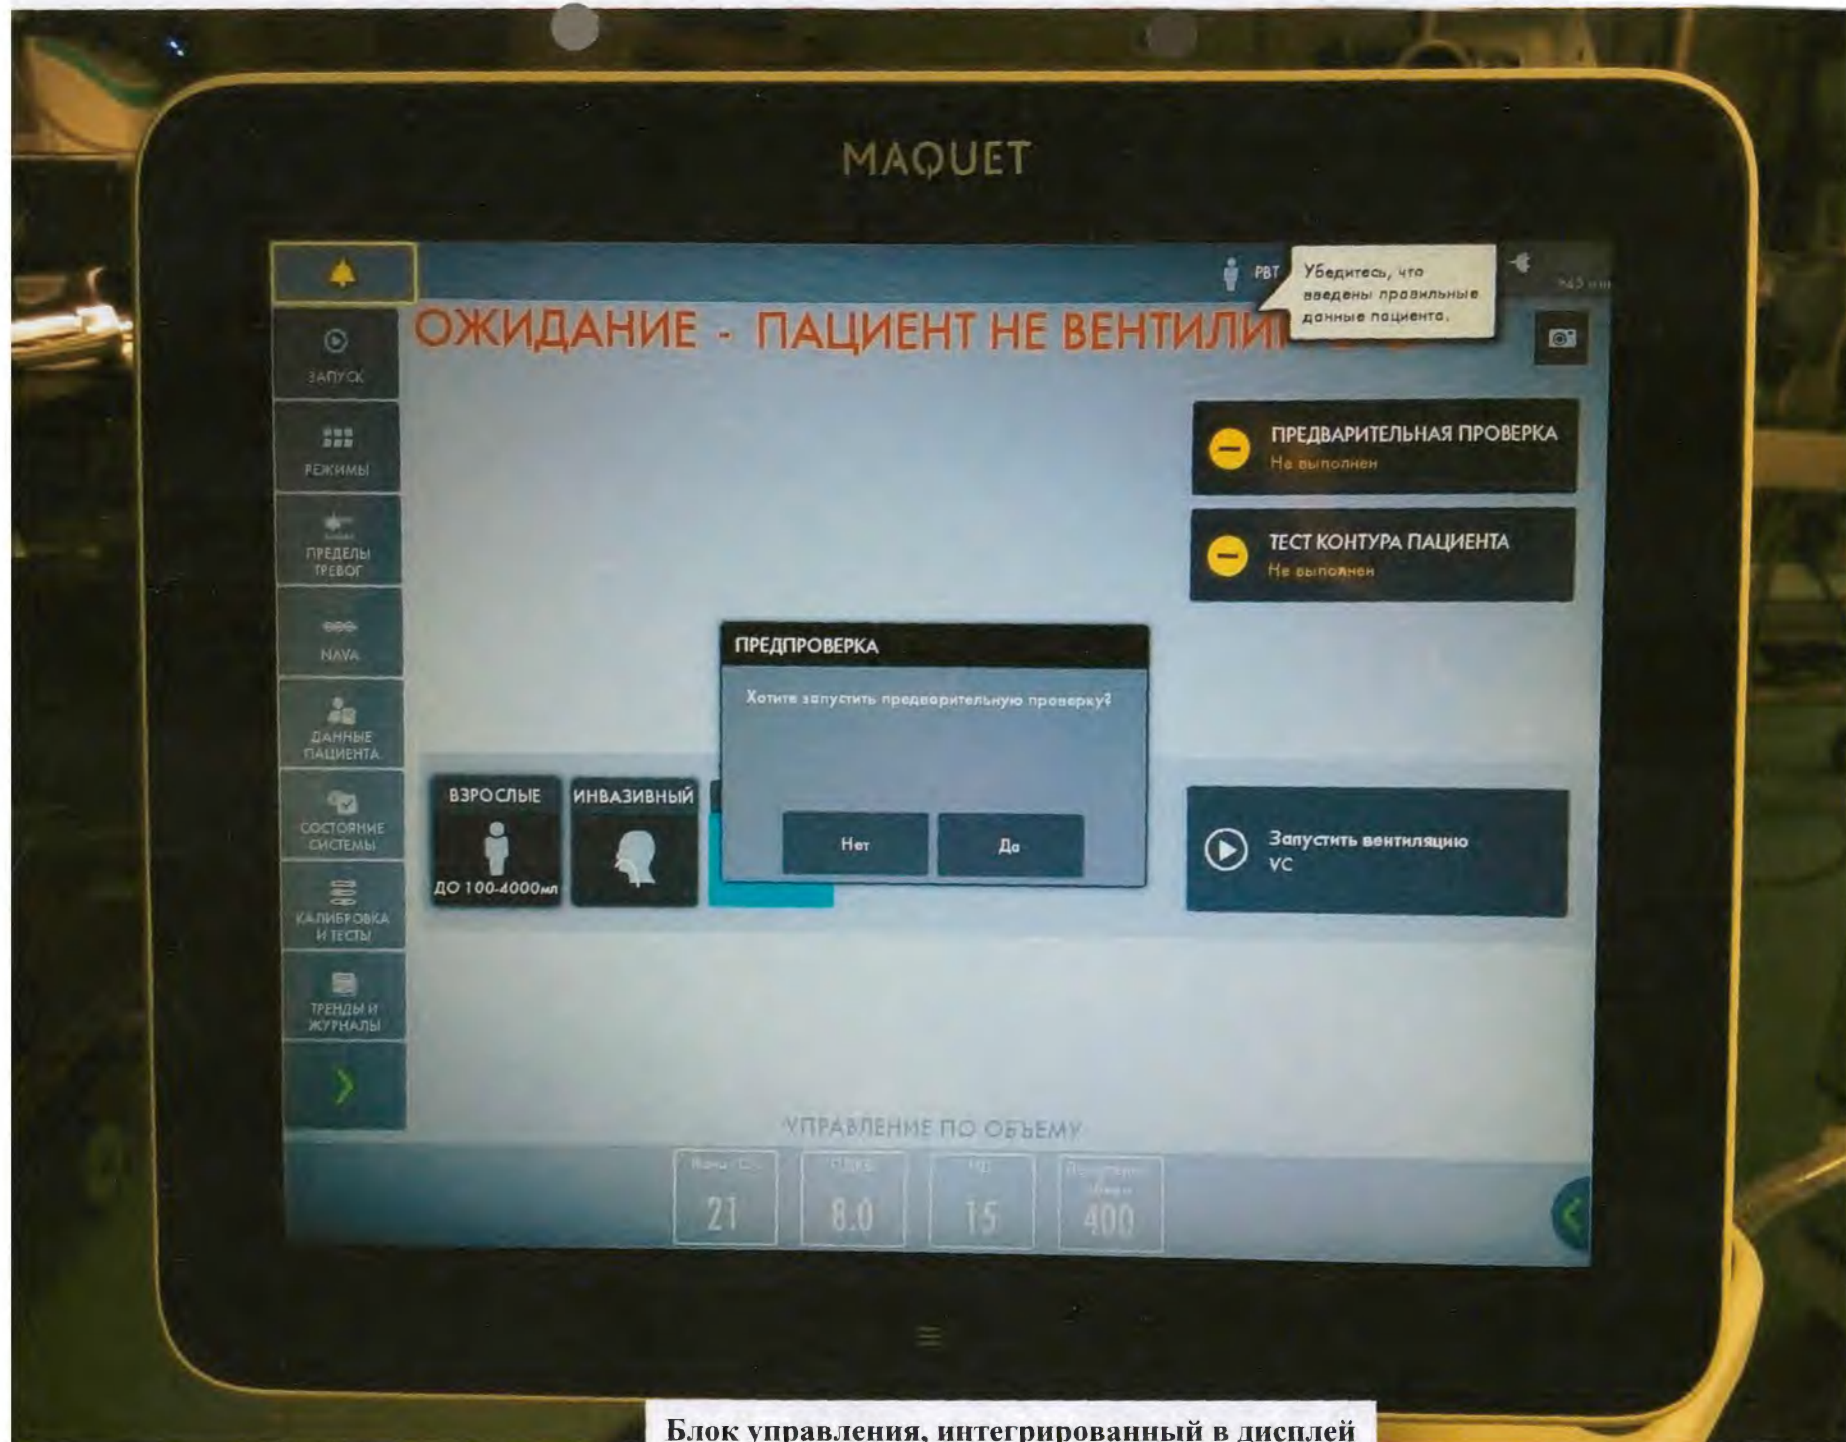

Блок управления, интегрированный в дисплей



Легкое тестовое



MAQUET

Battery Module

REF 64 87 180



Maquet Critical Care AB
Röntgenvägen 2
SE-171 54 Solna
Sweden

Модуль 6



Кассета экспираторная




**Кабель соединяющий для
небулайзера**



Небулайзер одноразовый

Т-образный алаптер небулайзера

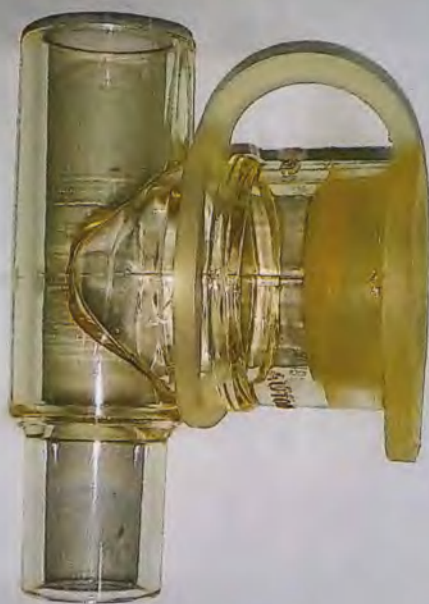



Кабель питания электрический



Кассета экспираторная

MAQUET


Edi Module

REF 64 87 180




Maquet Critical Care AB
Röntgenvägen 2
SE-171 54 Solna
Sweden


Модуль нейроконтроля

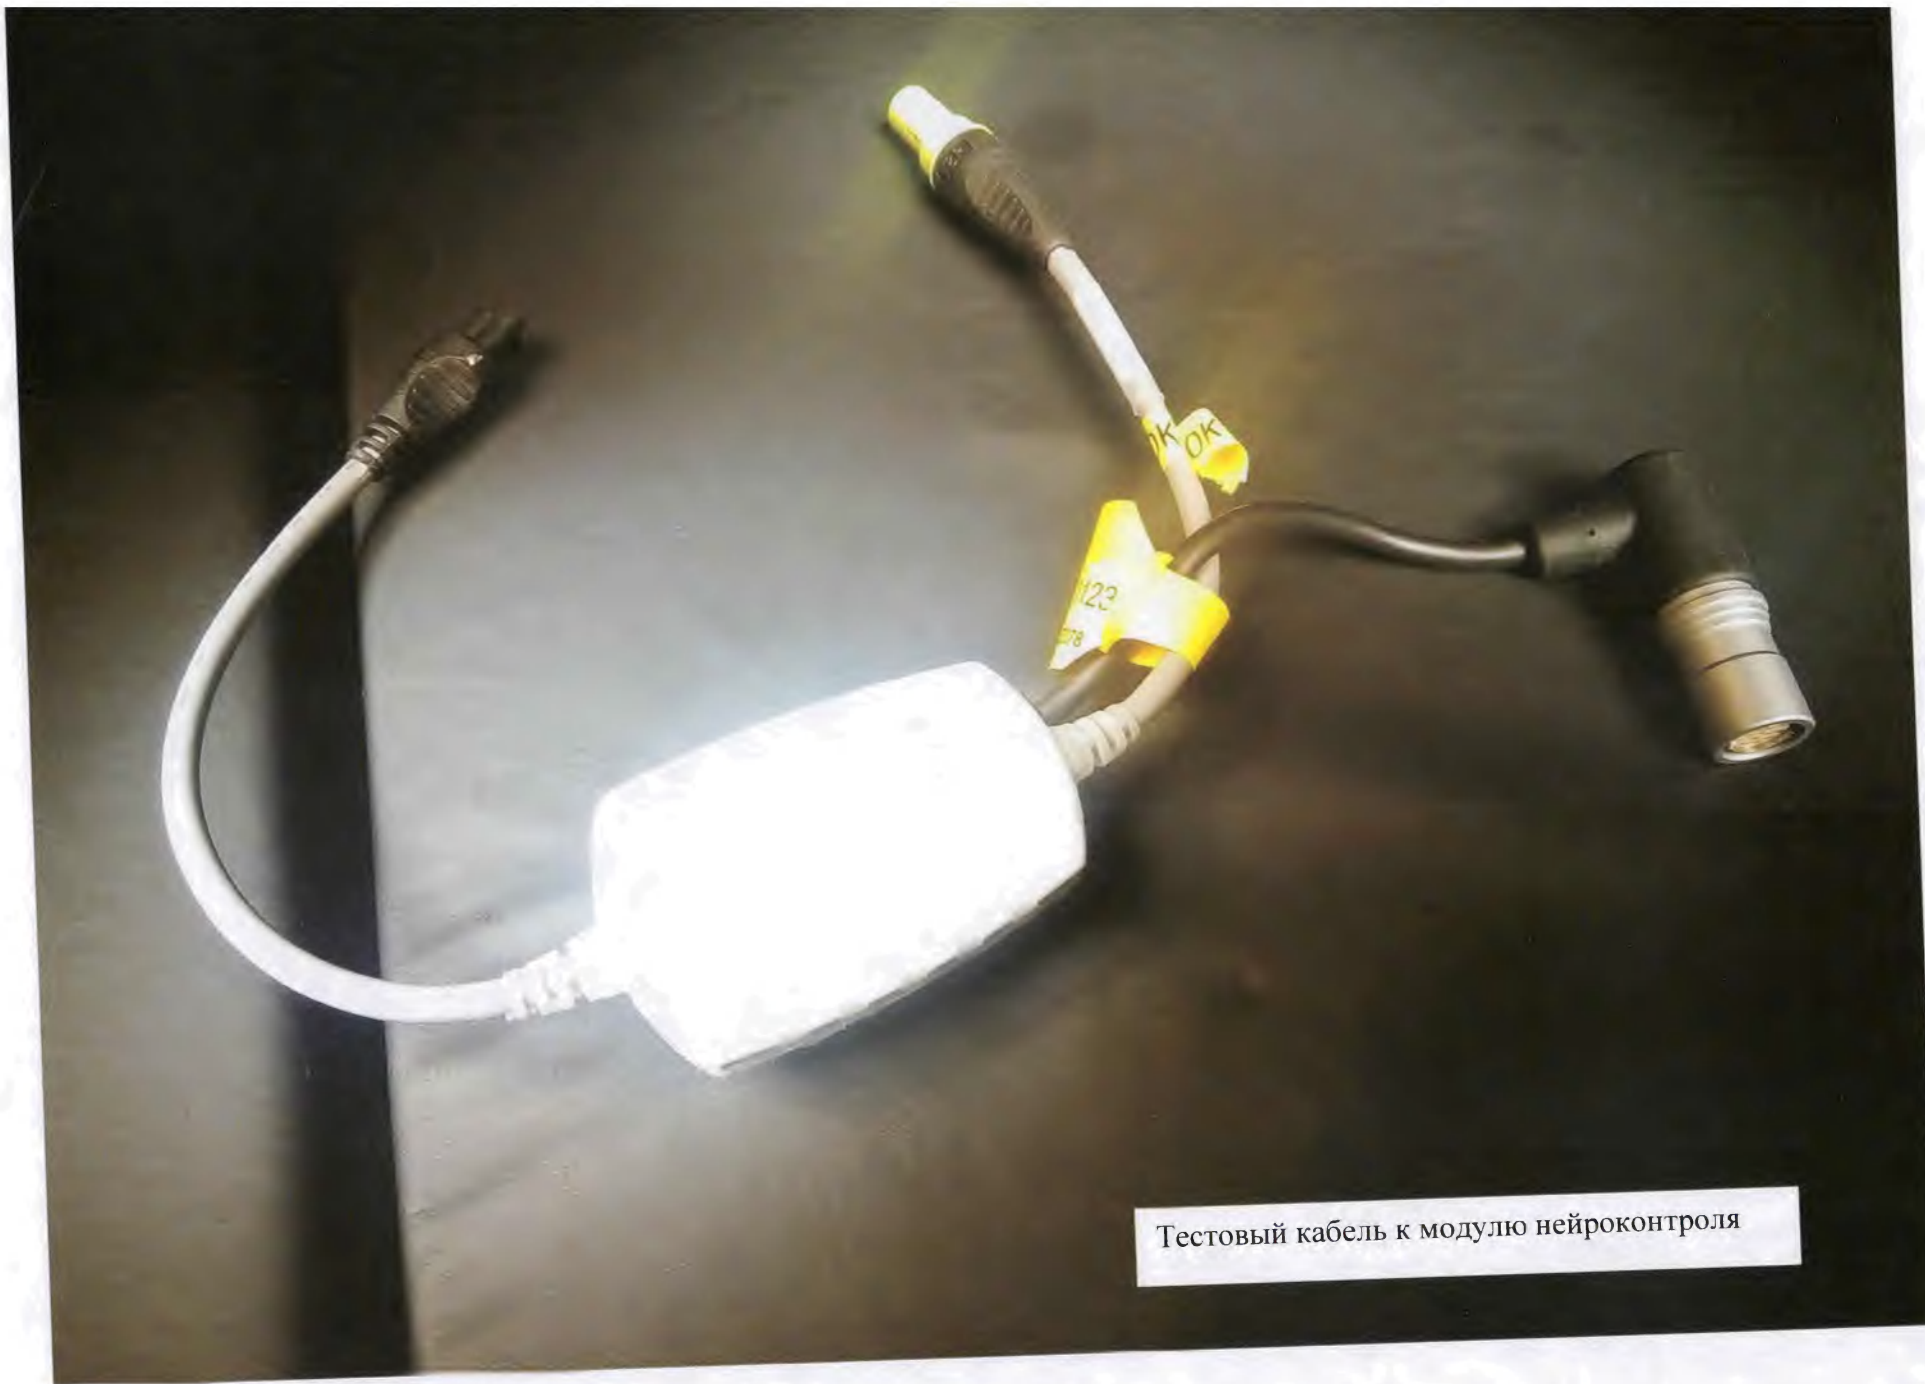

Тестовый кабель к модулю нейроконтроля

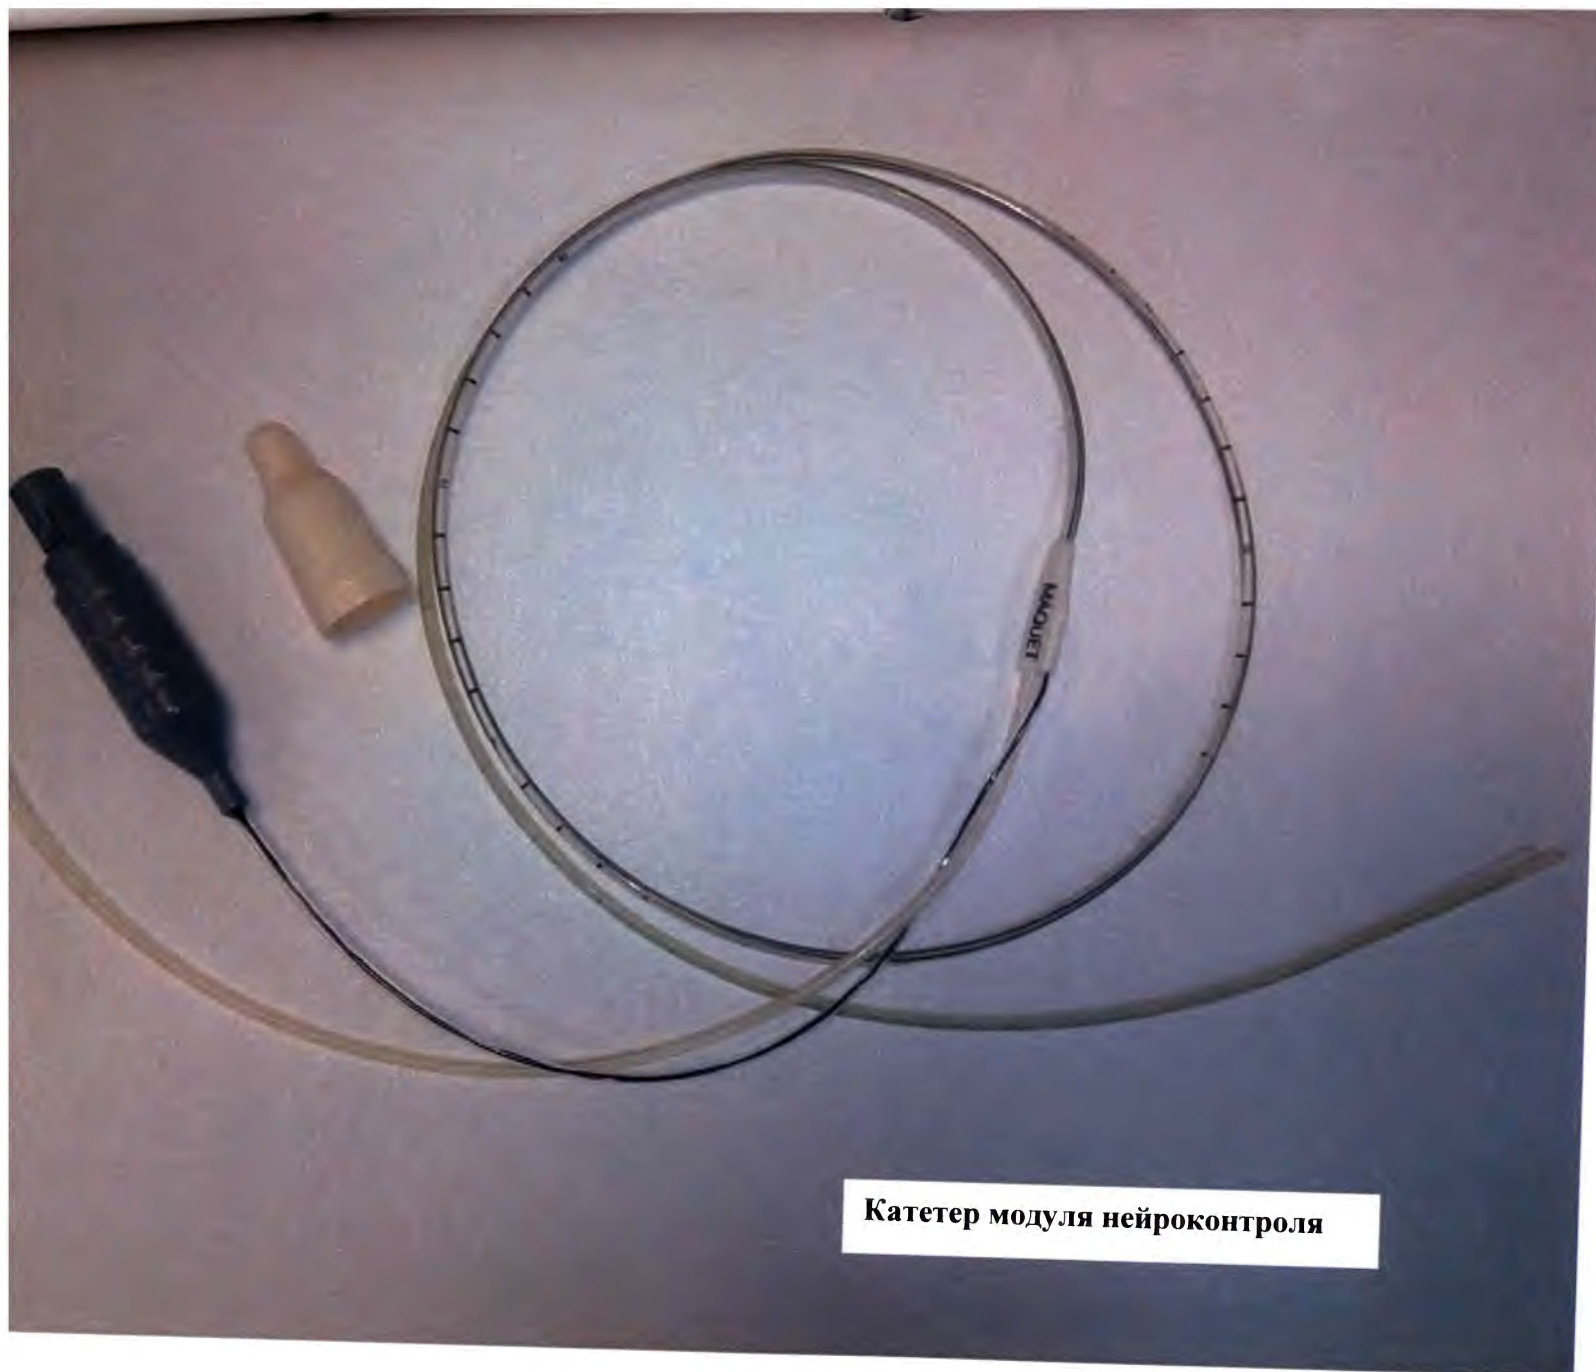

Катетер модуля нейроконтроля

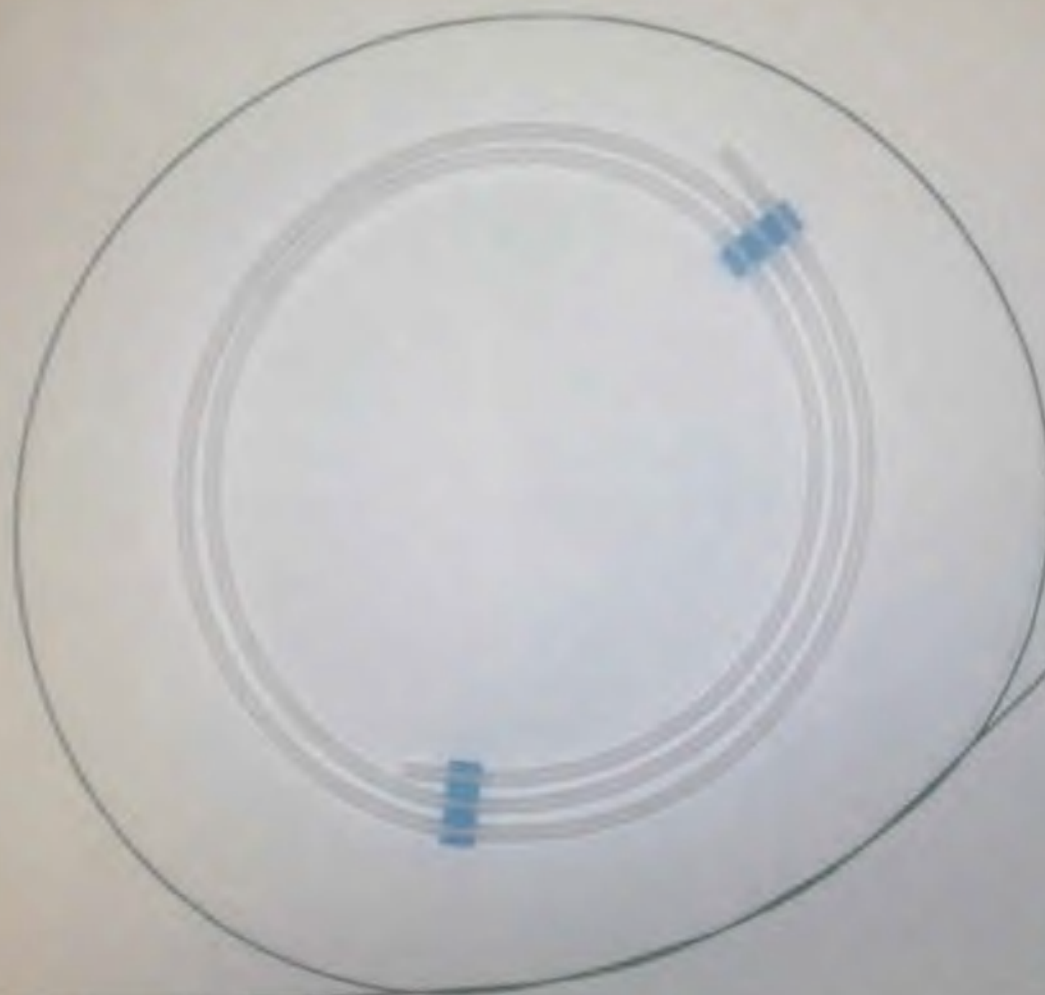

Проводник катетеров модуля
нейроконтроля

MAQUET

Y sensor Module

REF 66 93 662



Maquet Critical Care AB
Röntgenvägen 2
SE-171 54 Solna
Sweden

Модуль проксимального датчика



Кабель к модулю проксимального датчика

Линия давлених прок

Угловой адаптер проксимального
датчика с портом



Адаптер проксимального датчика при проведении
капнографии



Проксимальный датчик (Y-сенсор)

MAQUET


CO₂ Module

REF 66 81 766




Maquet Critical Care AB
Röntgenvägen 2
SE-171 54 Solna
Sweden

Модуль капнографический

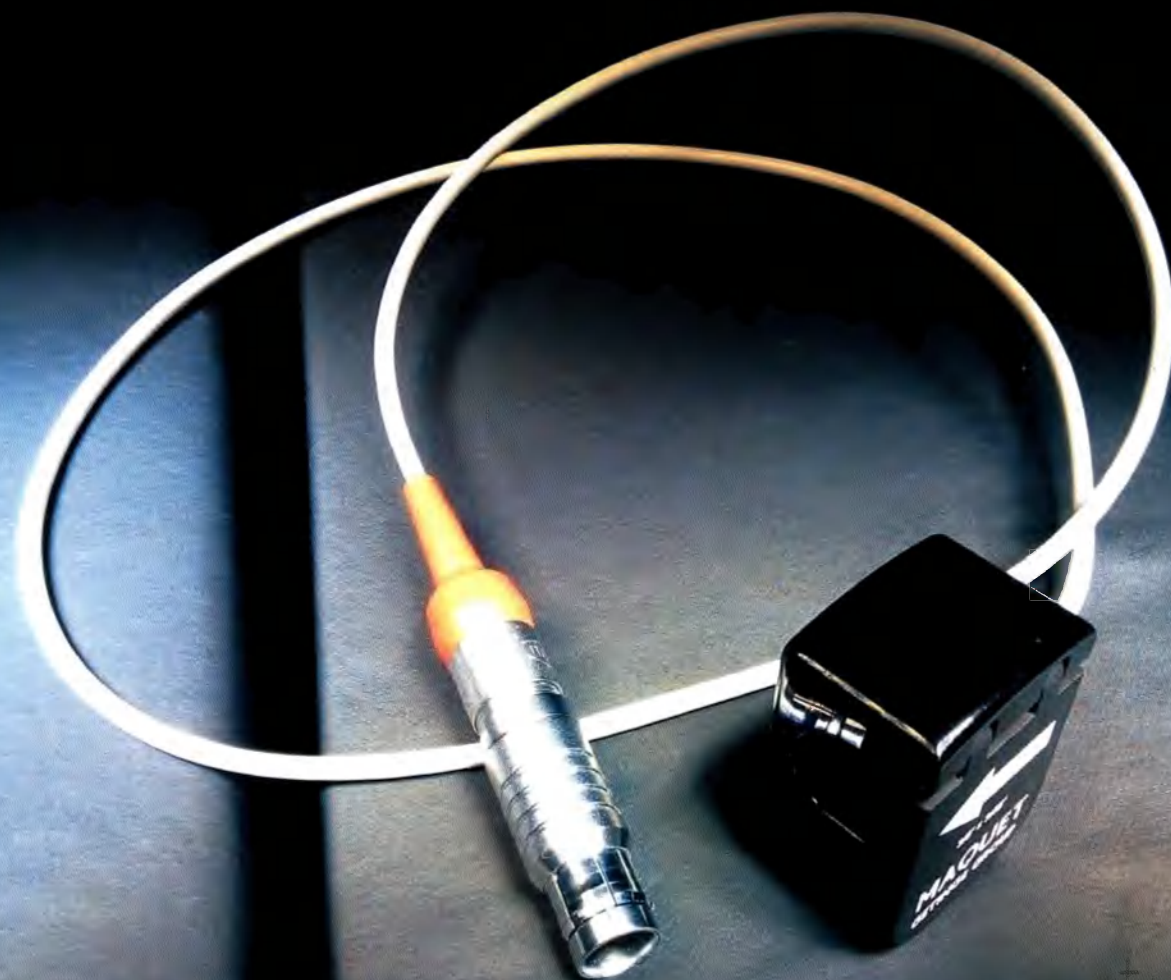

Датчик капнографический с нулевой
и референтной ячейкой для взрослых

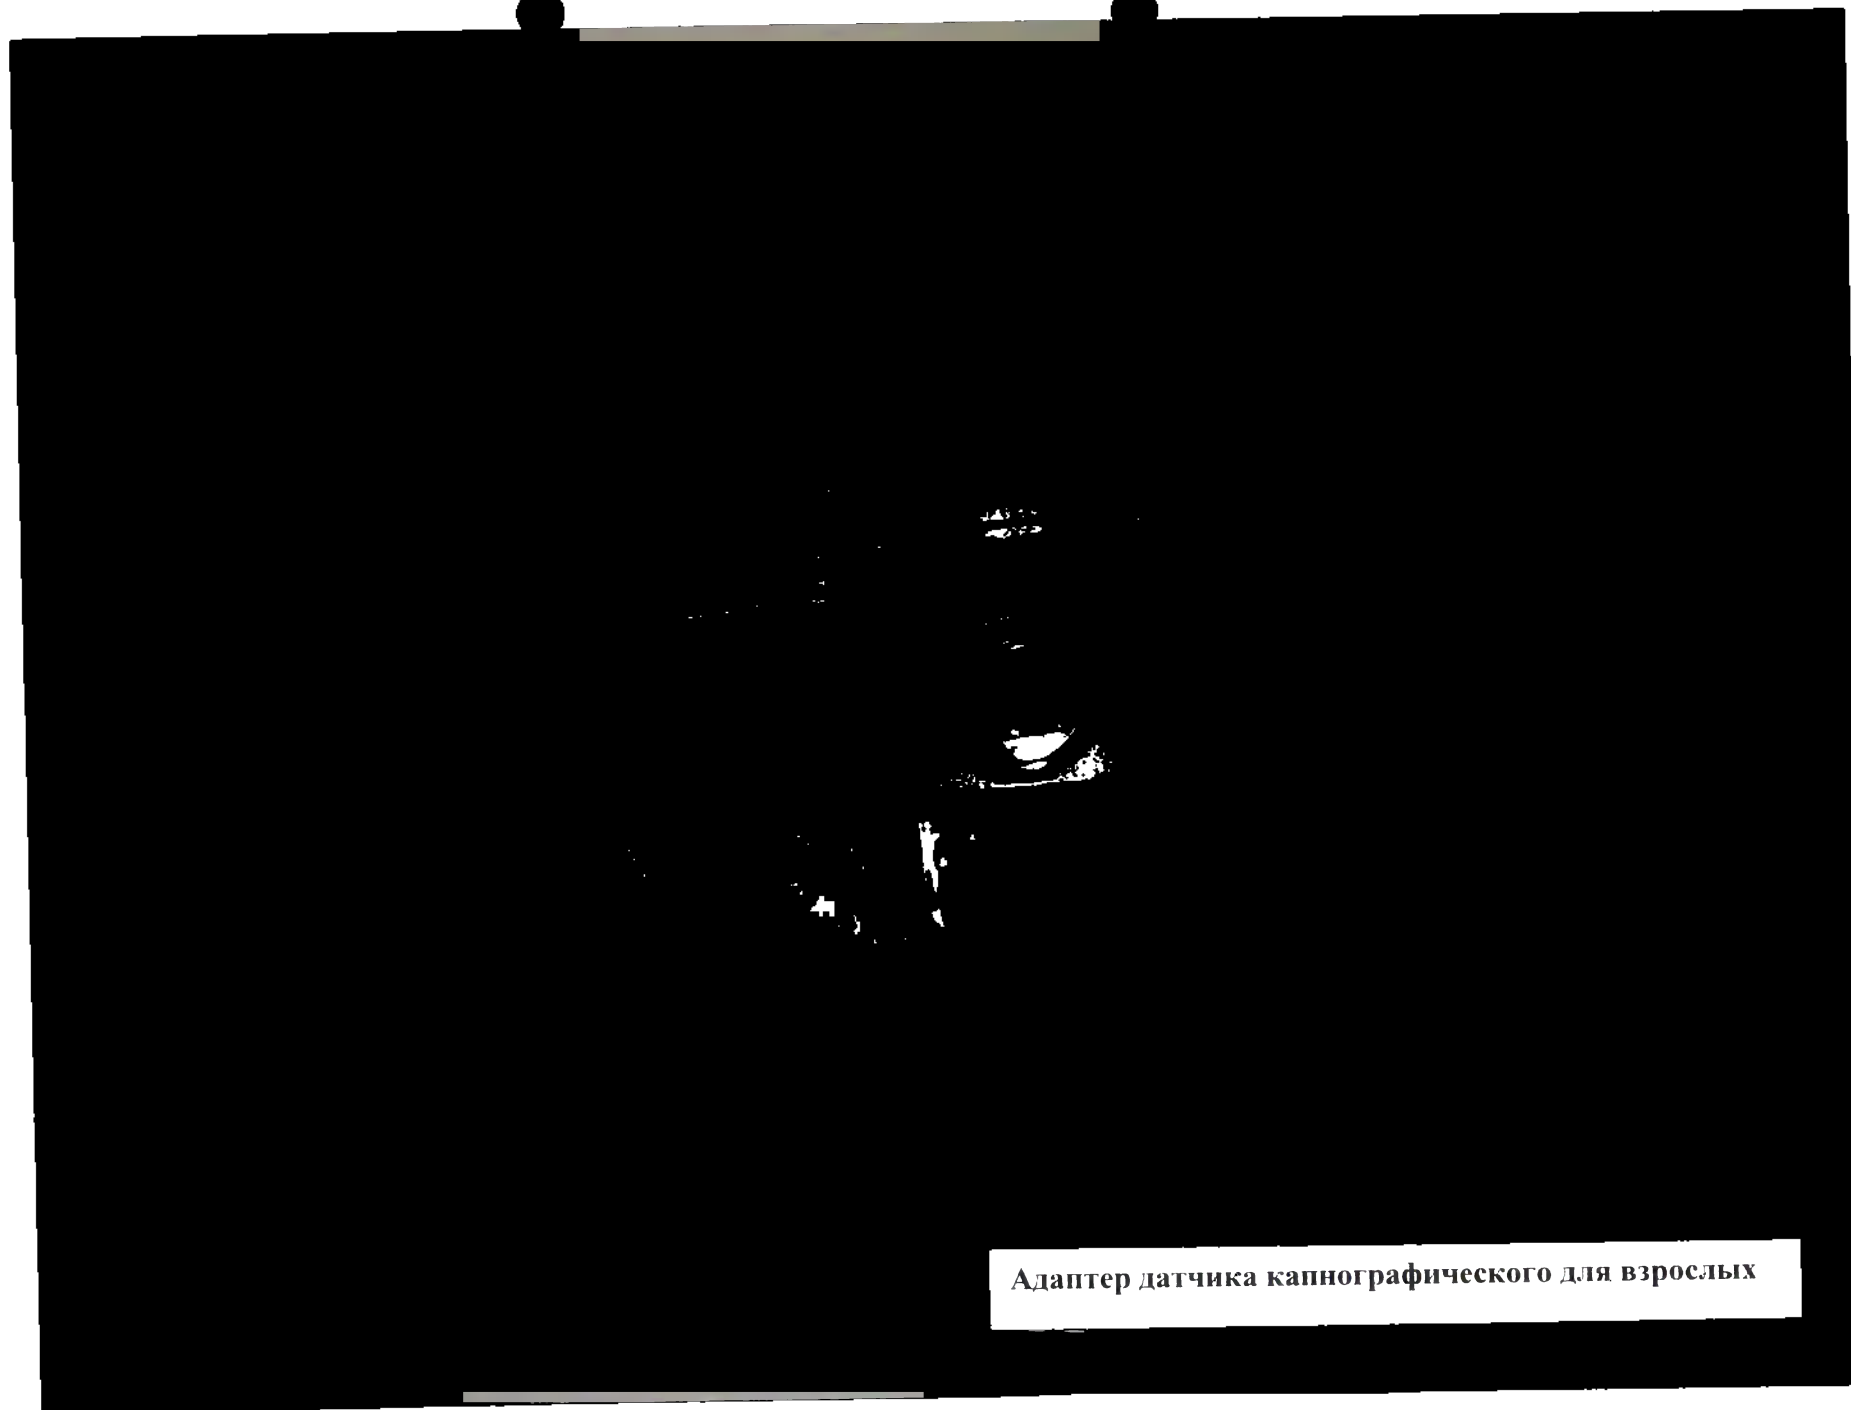

Адаптер датчика капнографического для взрослых



Адаптер датчика капнографического педиатрический



Шланг кислородный



Шланг воздушный



Компрессор специальный с набором для подключения к аппарату



Бутылочка для слива конденсата



Кабель сетевой электрический




Винты крепежные




Тележка специальная



Ящик для тележки

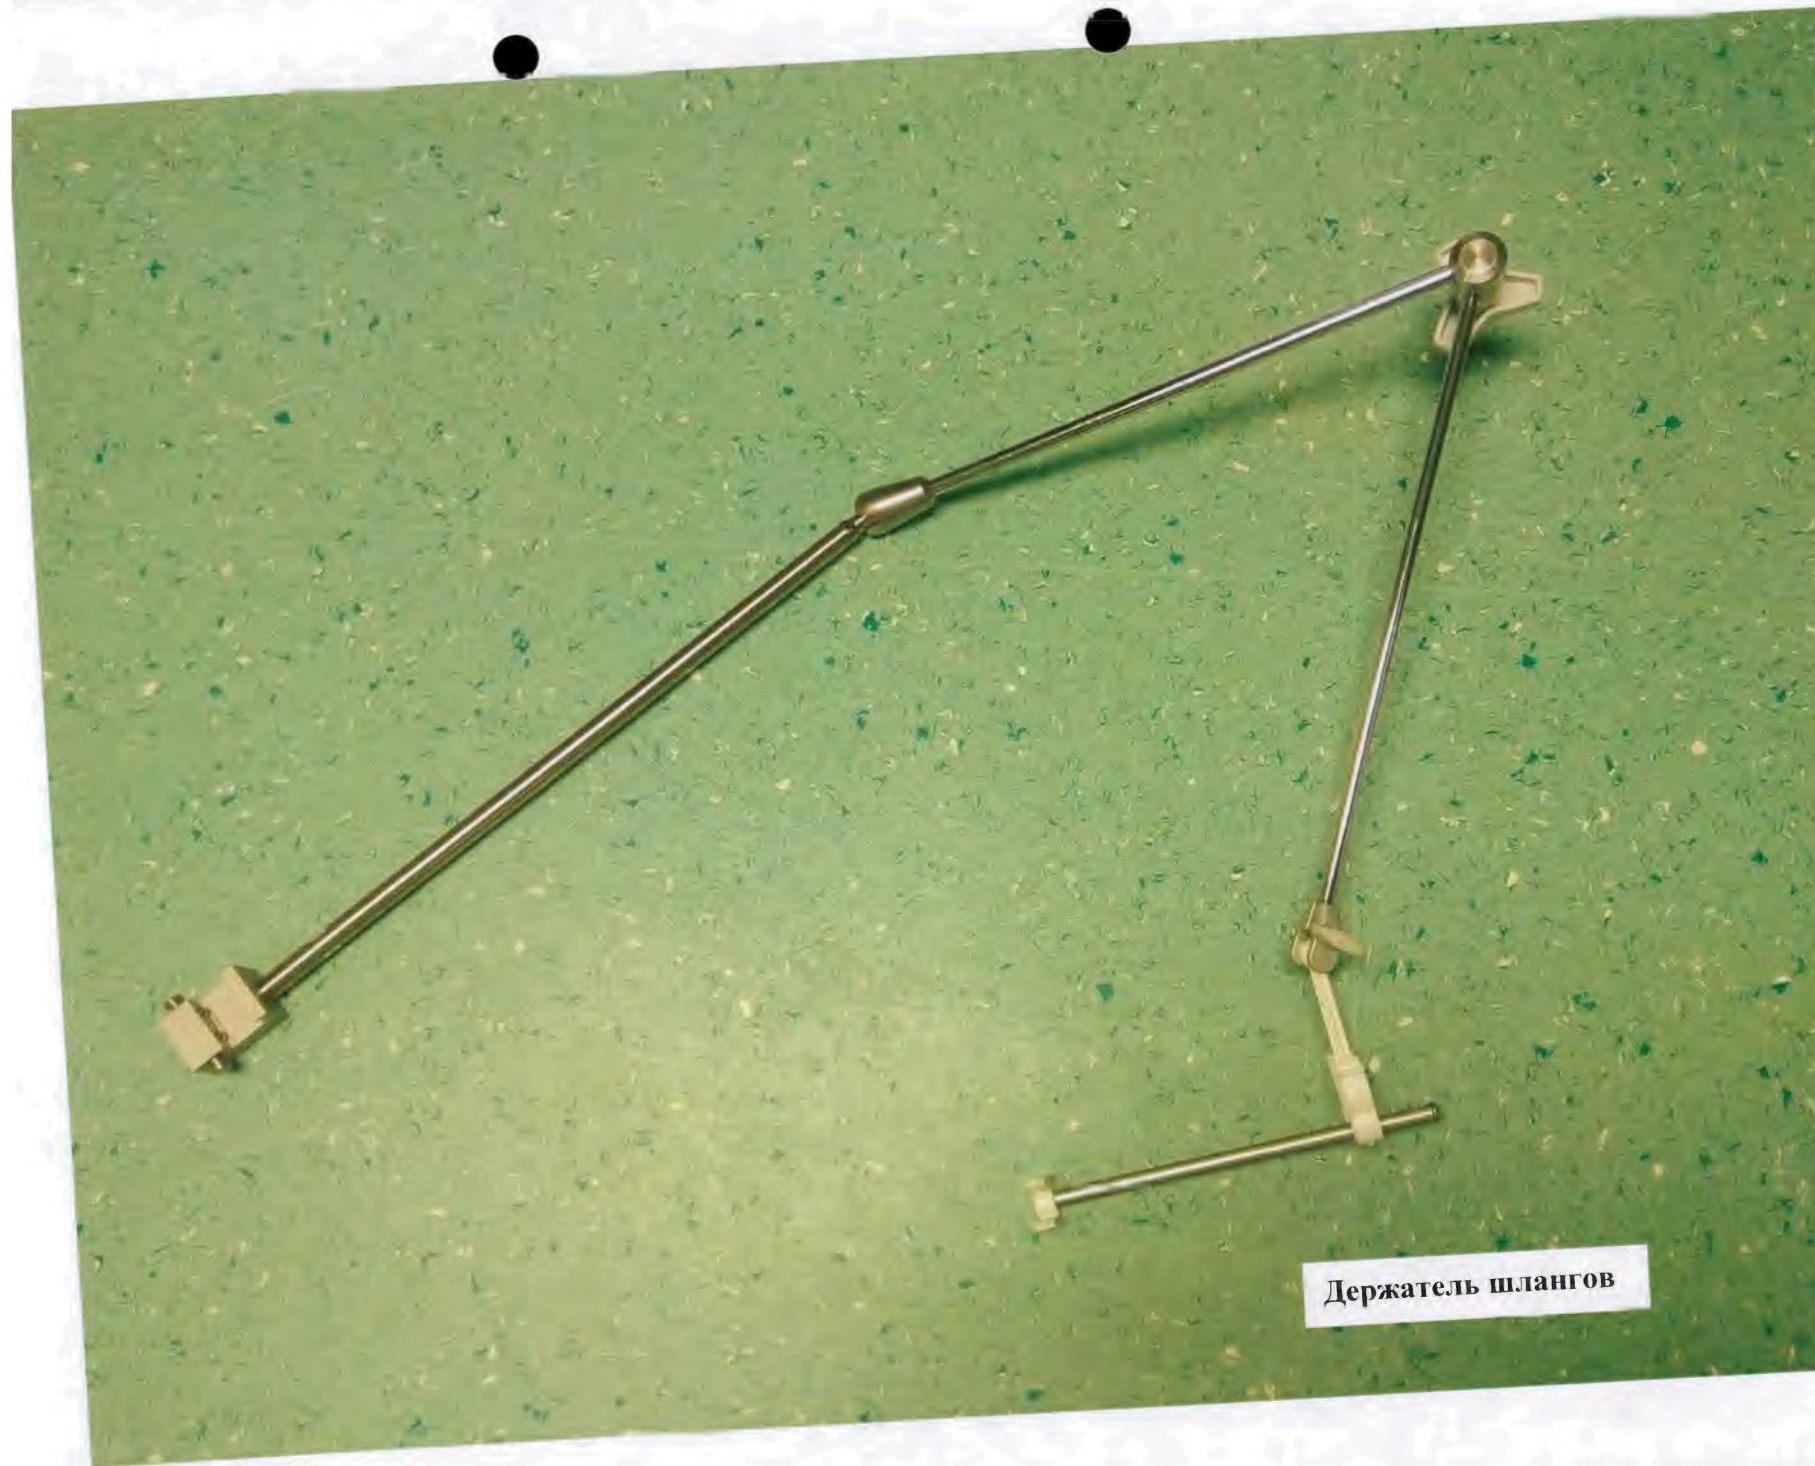


Держатель шлангов

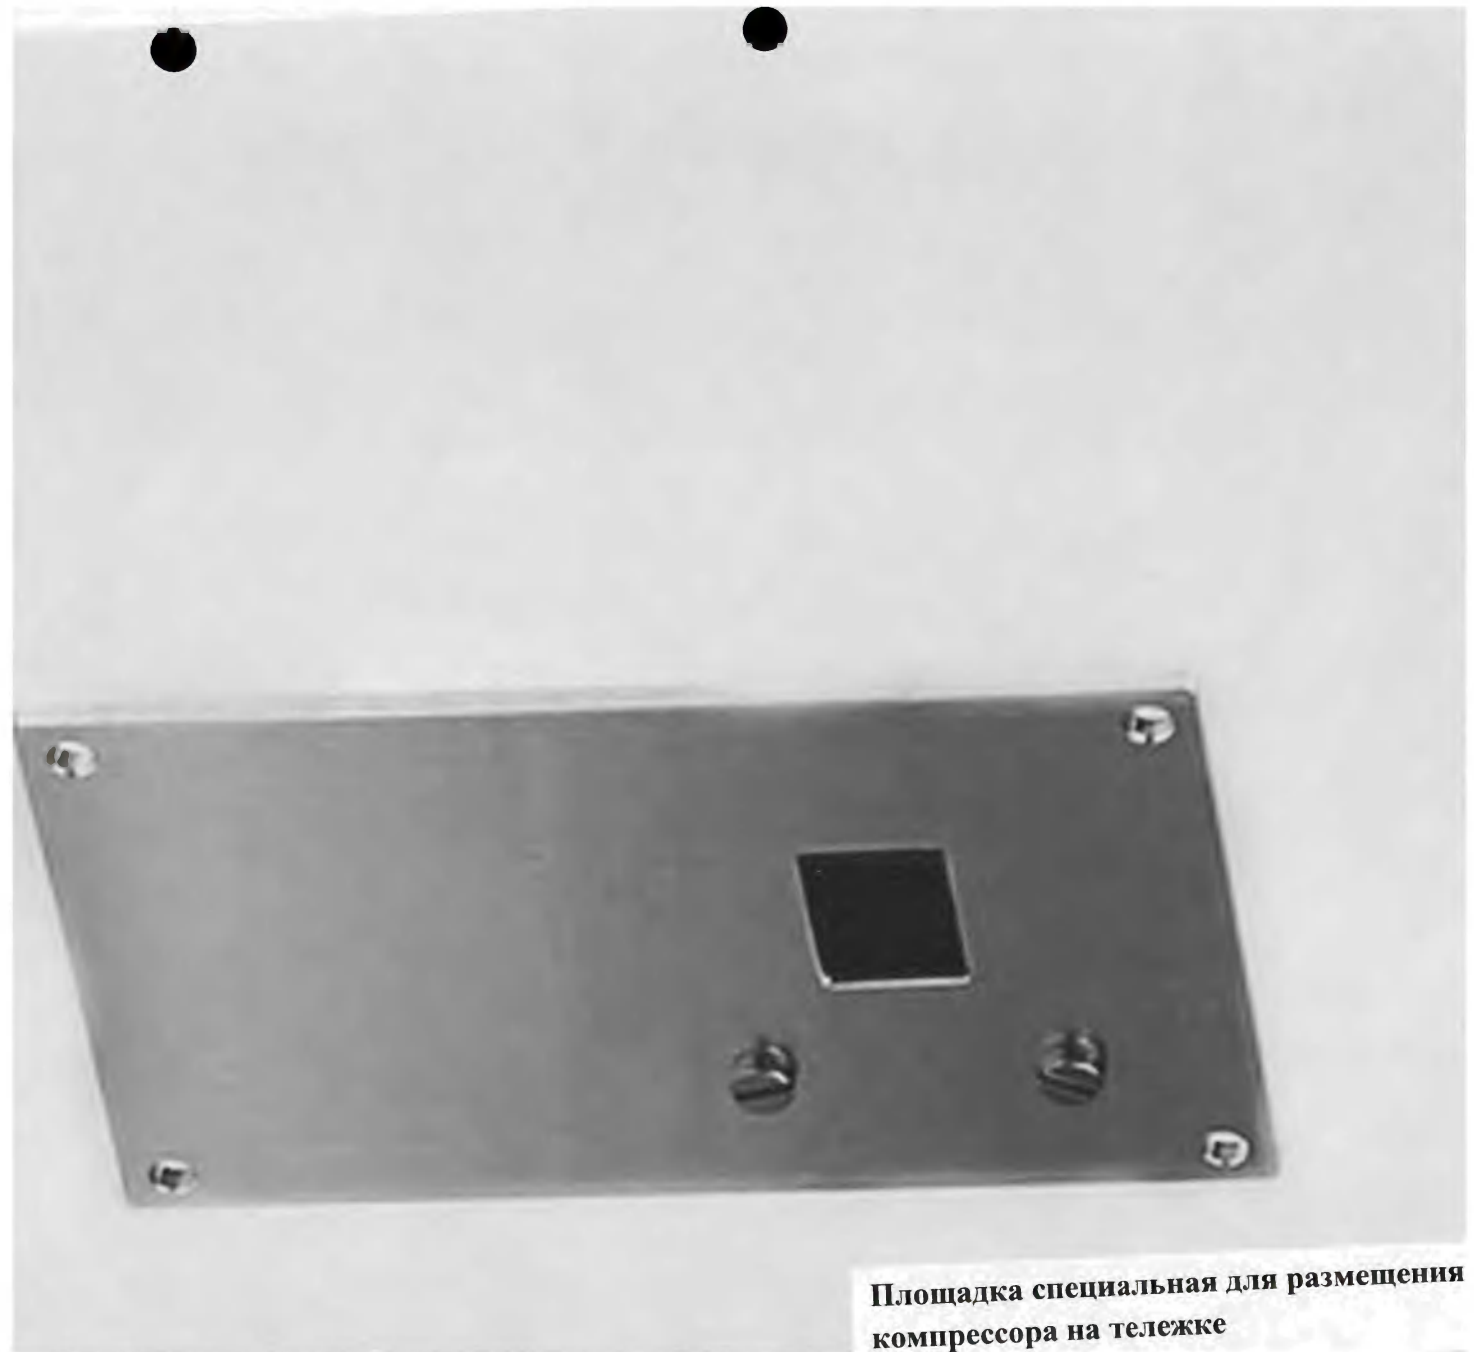


Площадка специальная для размещения компрессора на тележке



**Площадка специальная для крепления
аппарата на подвесе**

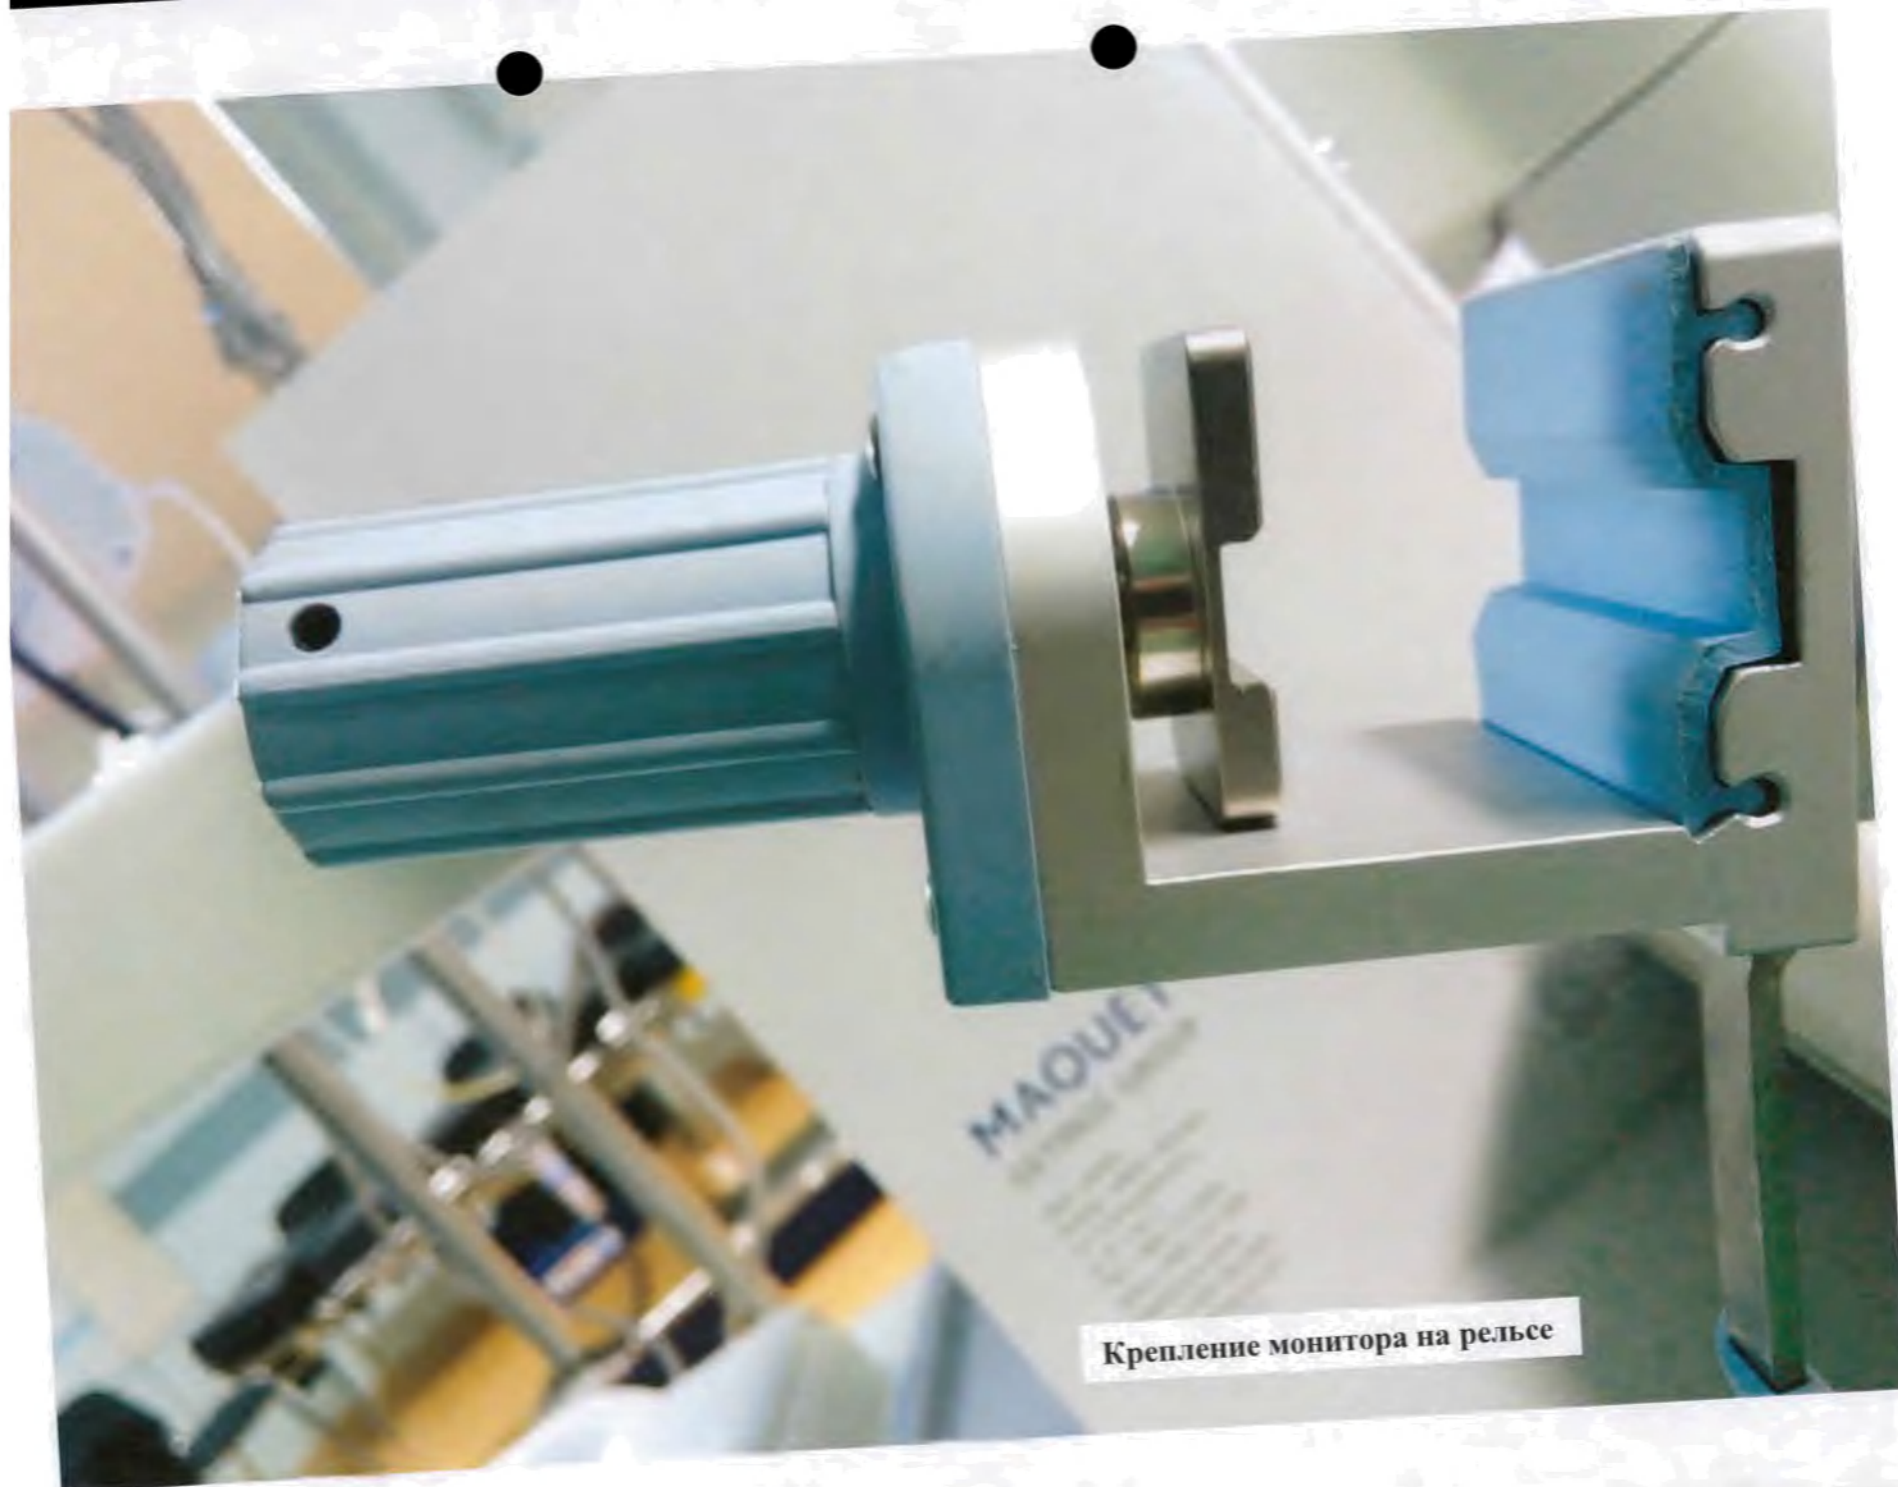

Крепление монитора на рельсе

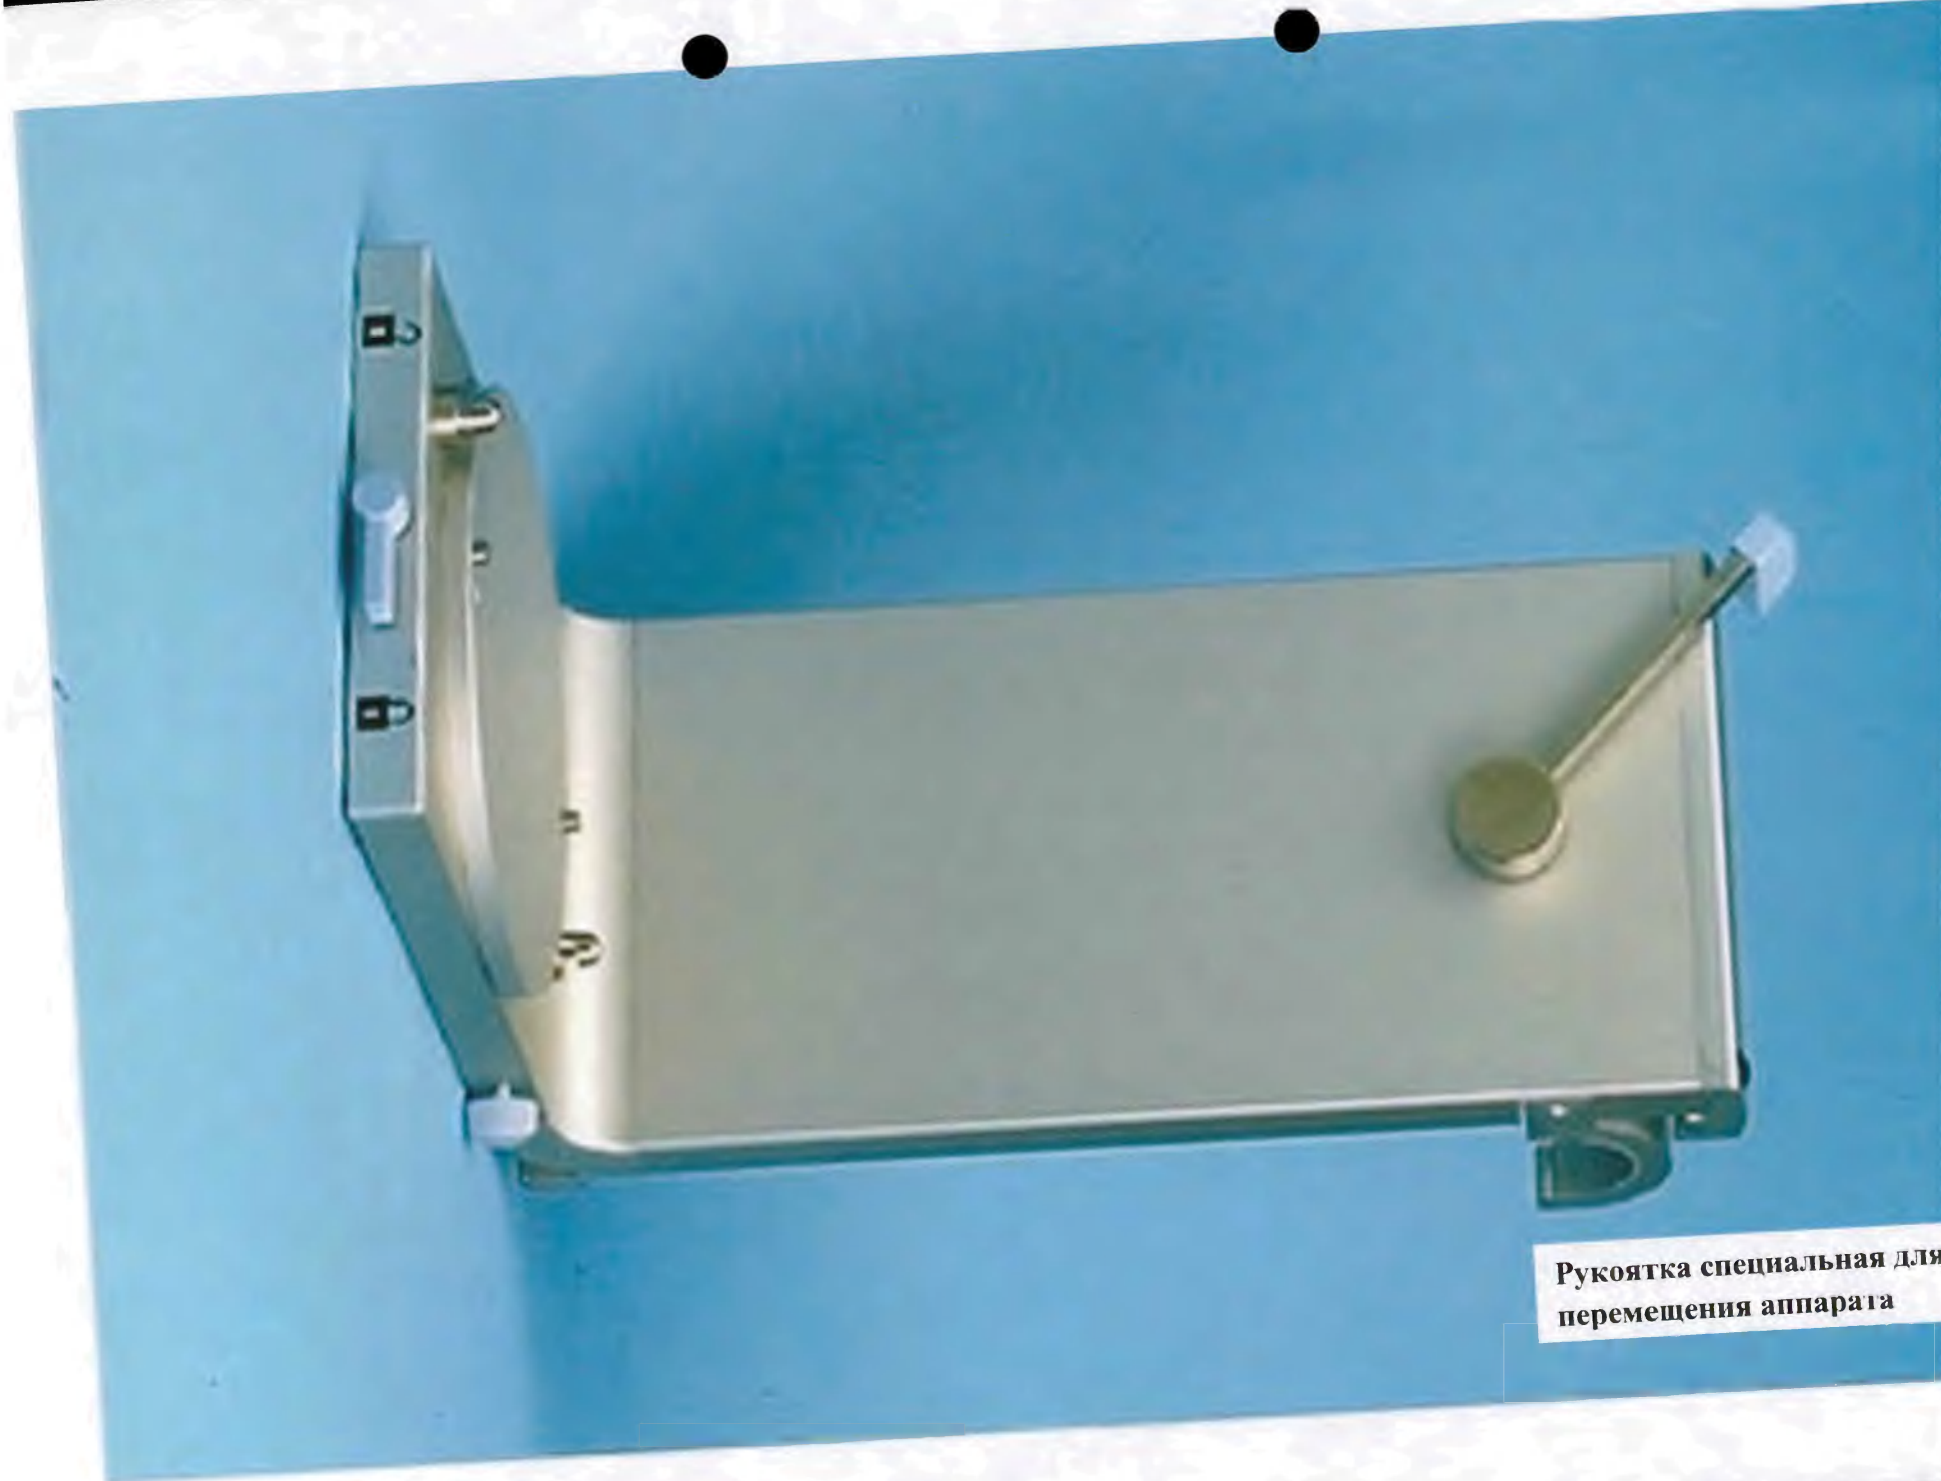


Рукоятка специальная для
перемещения аппарата



Держатель проксимального датчика



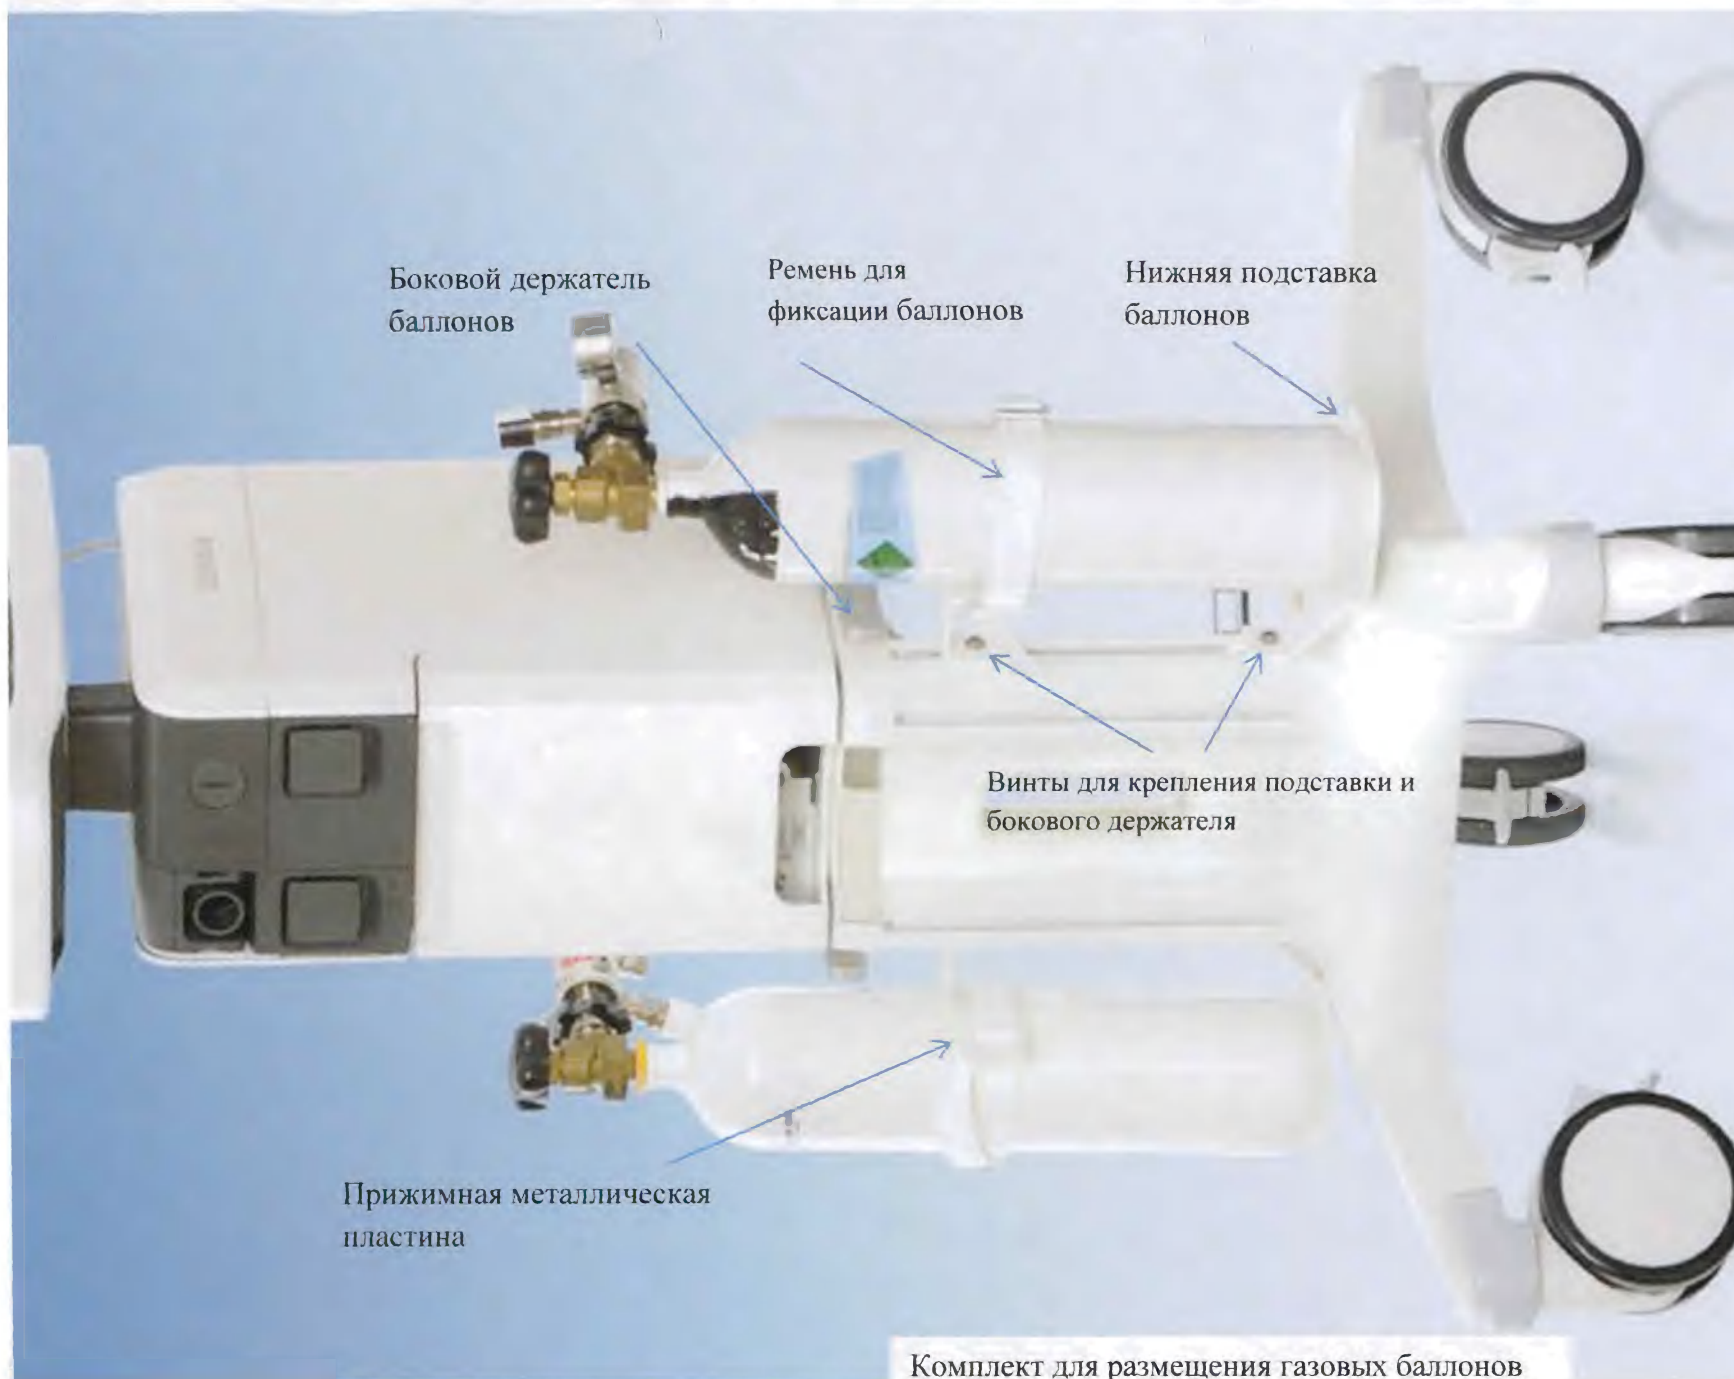




Кабель питания небулайзера



Небулайзер многоцветный



**Т-образный адаптер небулайзера
взрослый, педиатрический**

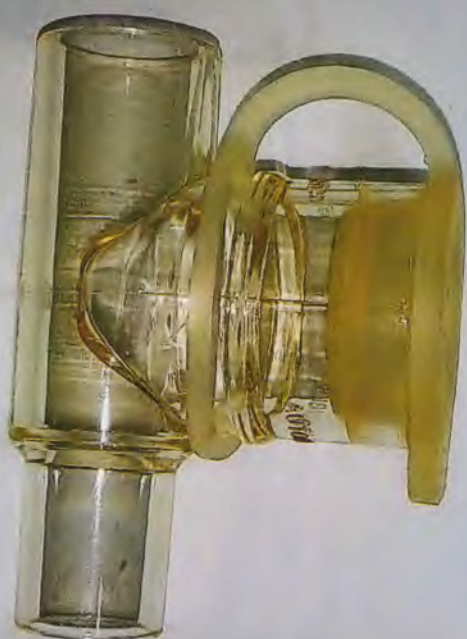

I-образный адаптер небулайзера, неонатальный



Адаптер небул



Трубка-удлиннитель для небулайзера



Фильтр выдоха



Пластиковый термодопус



Пластиковый антиконденсатный колпачок



Фильтр для пассивного увлажнения




Сжимаемый


Головой адаптер

Тройник пластиковый

Контур пациента для взрослых NME

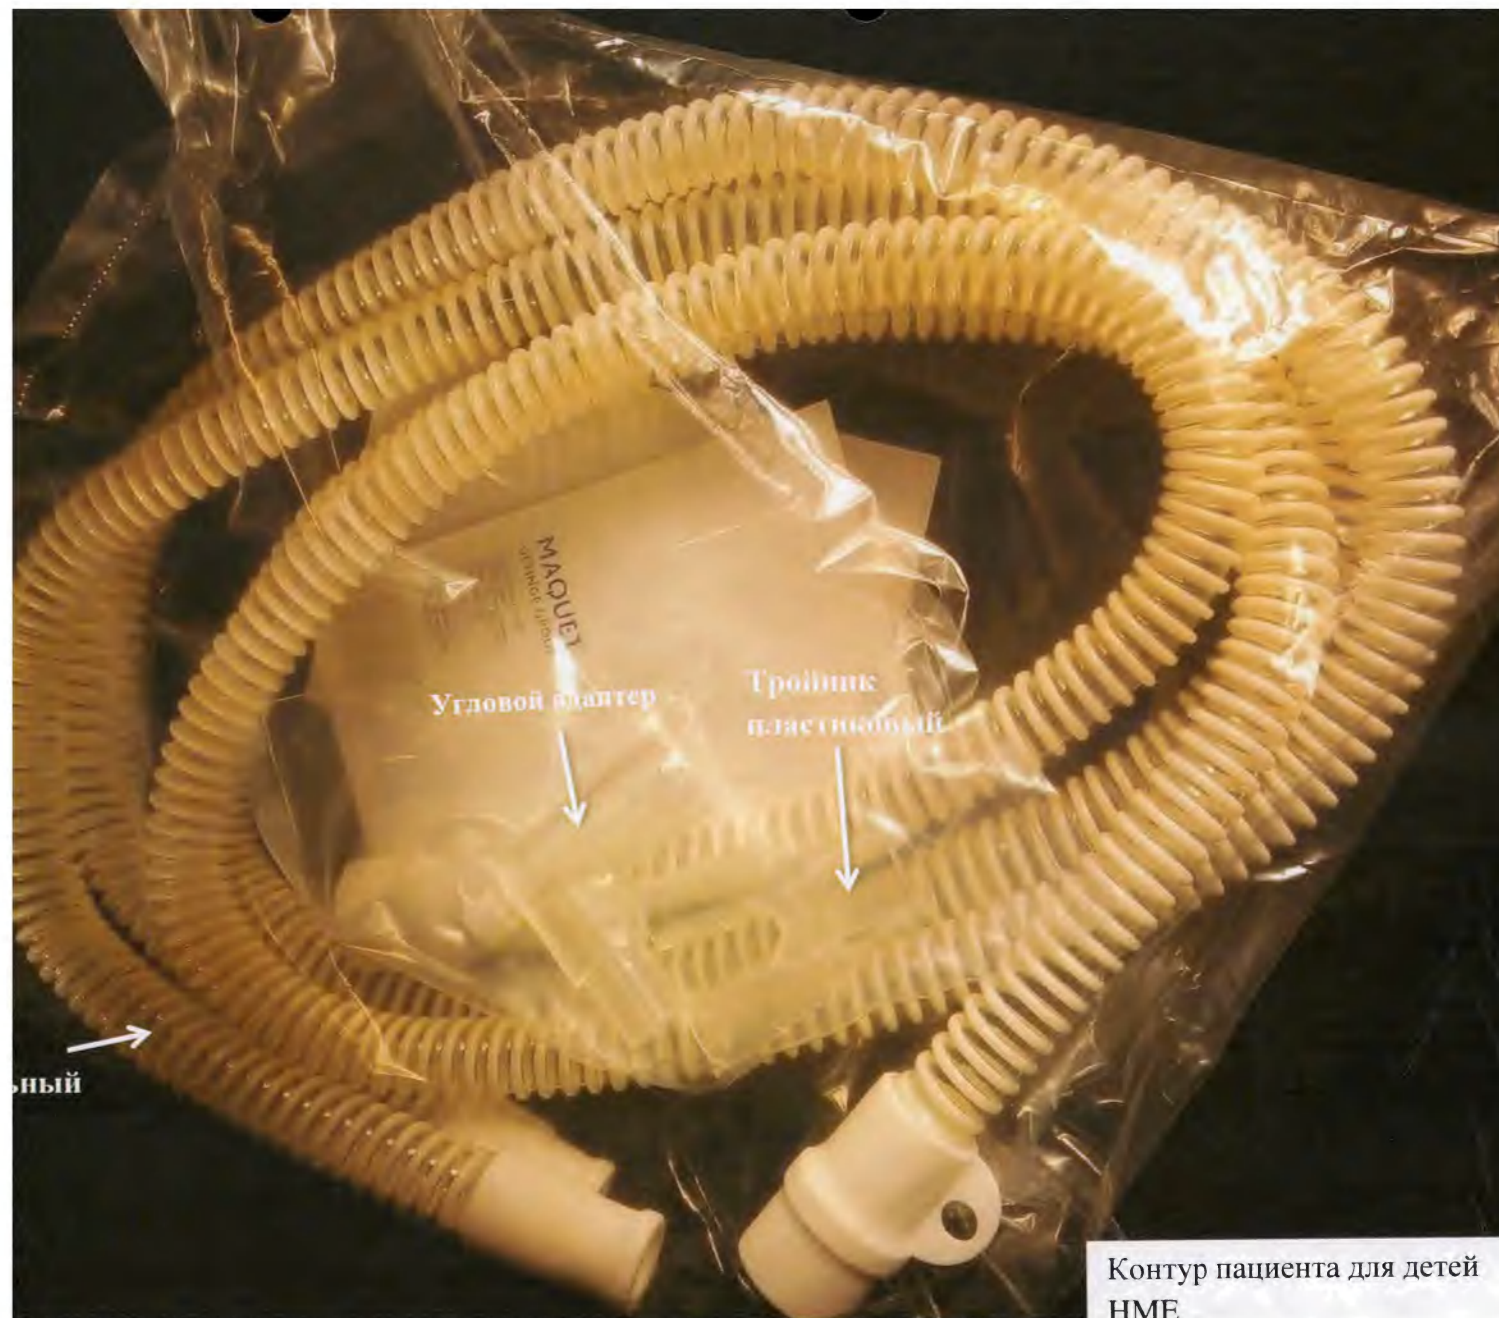

Контур пациента для детей
HME

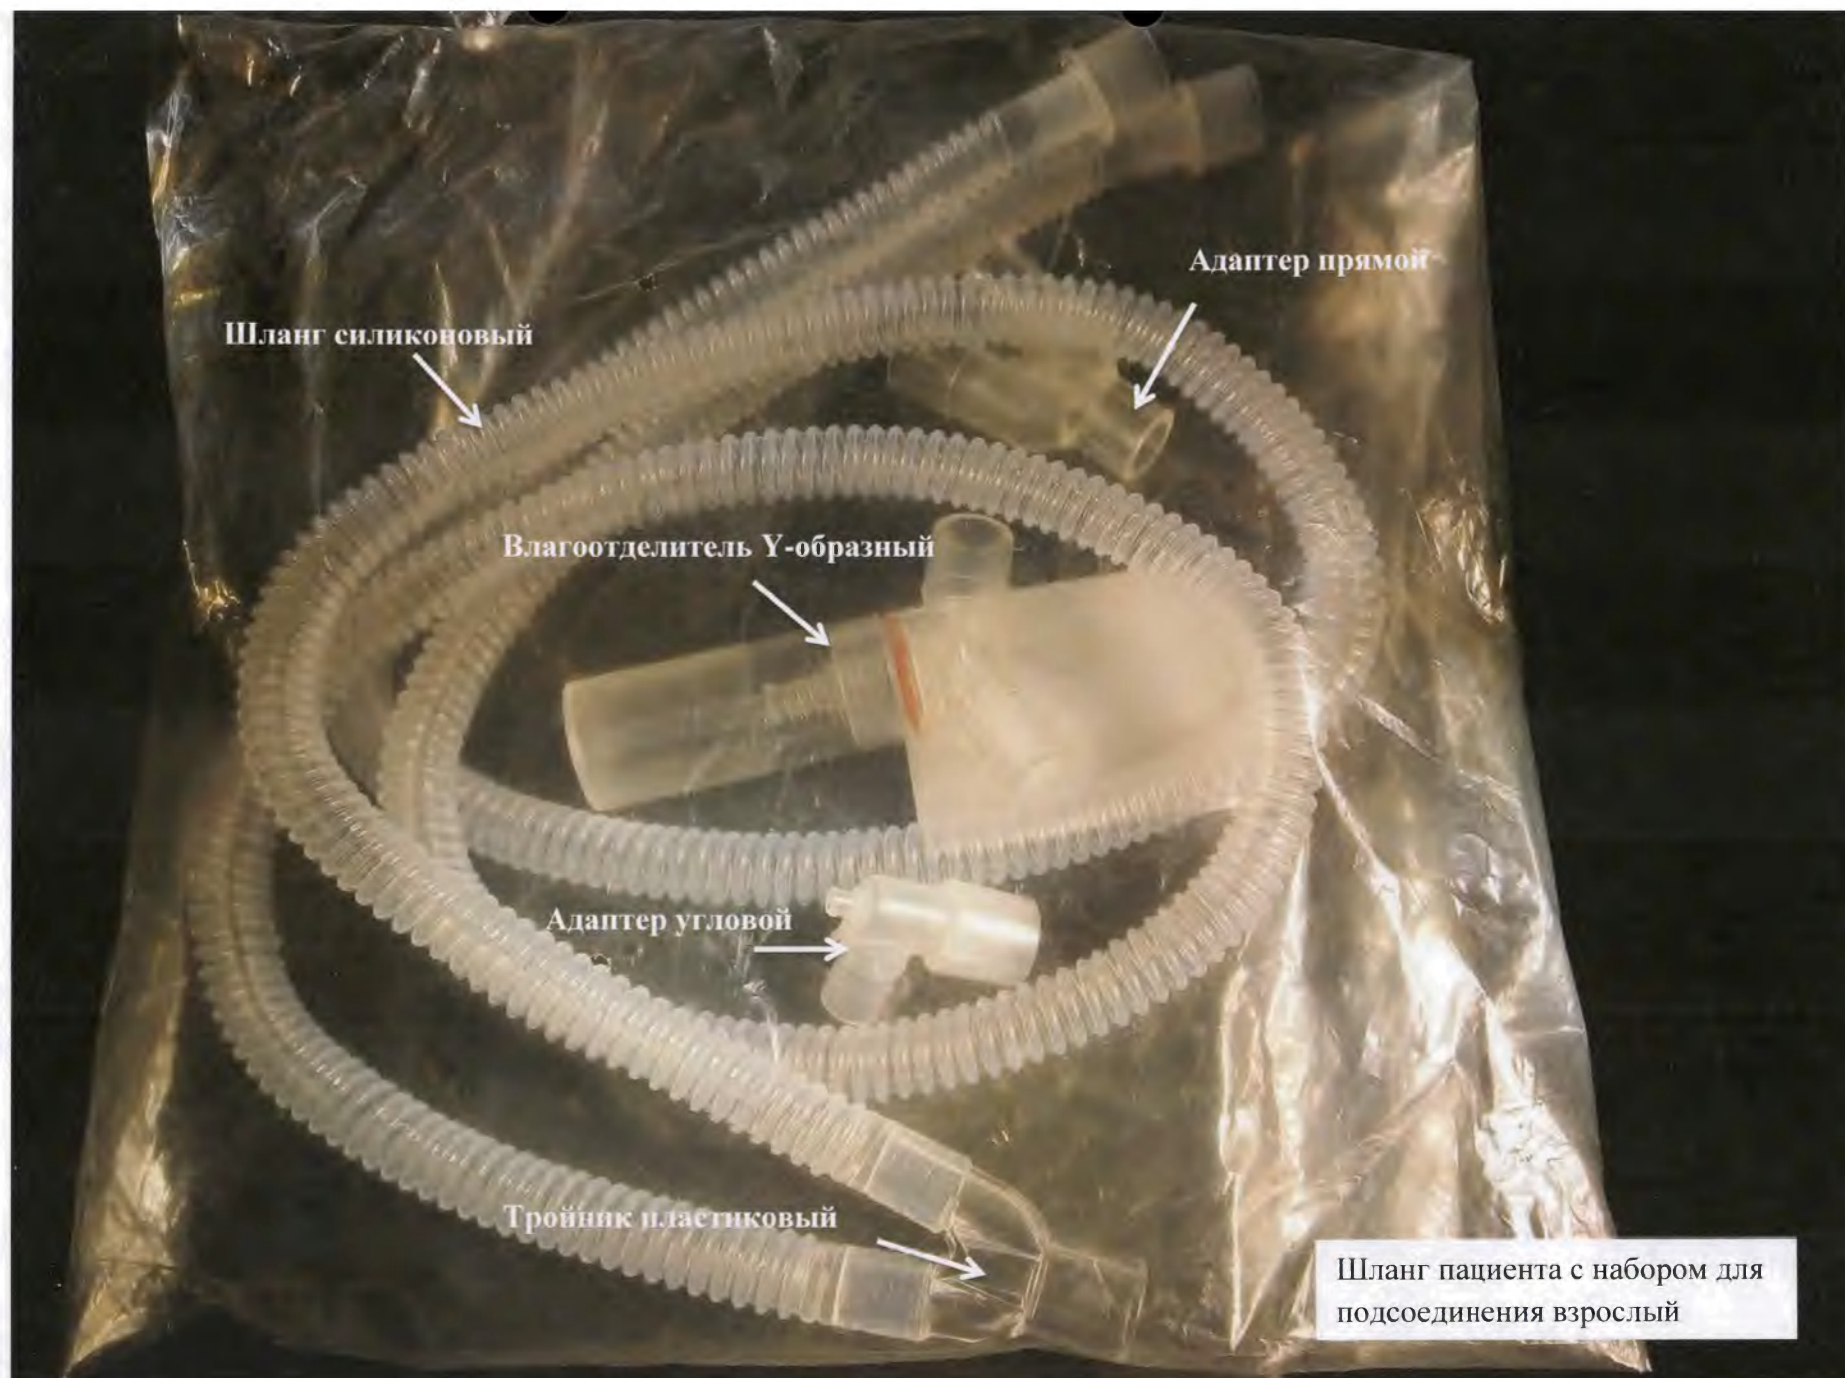

Шланг силиконовый


Адаптер прямой

Влагоотделитель Y-образный


Адаптер угловой

Тройник пластиковый

Шланг пациента с набором для
подсоединения взрослый

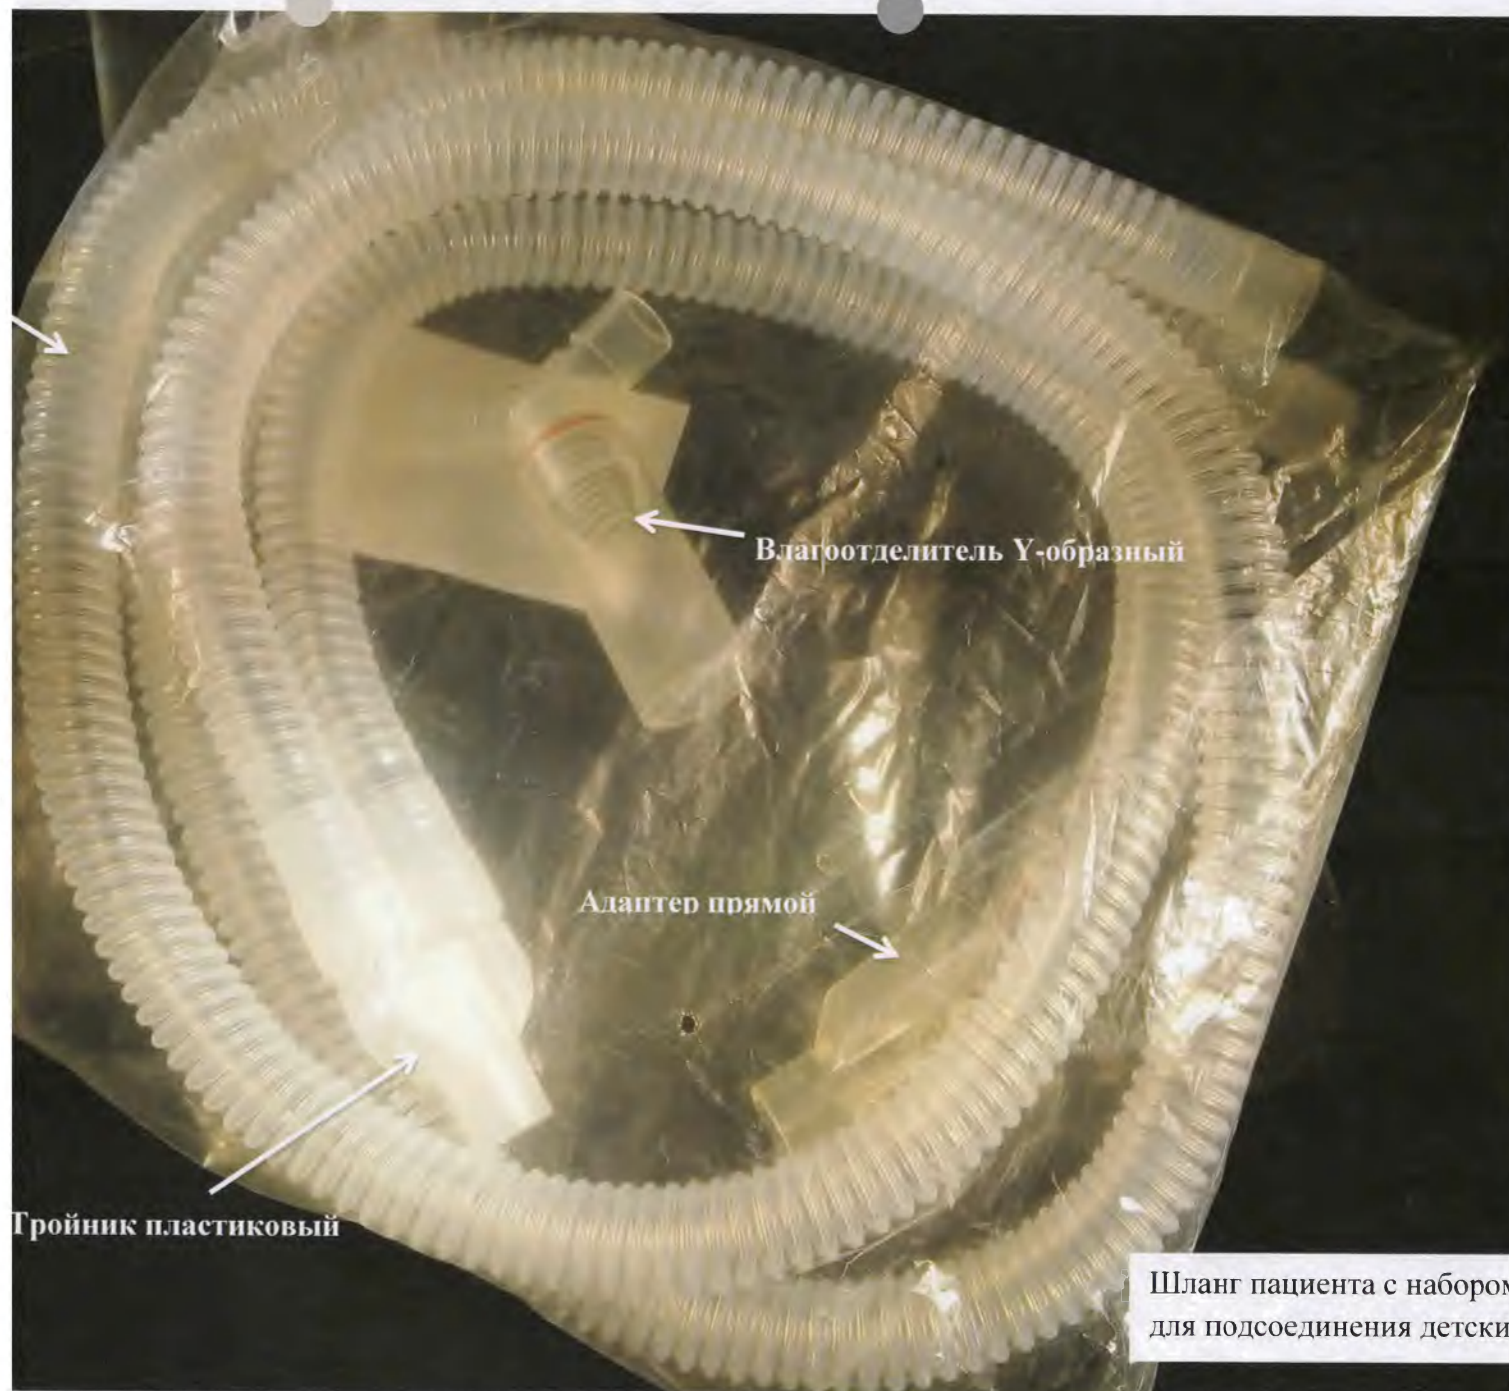

Шланг пациента с набором
для подсоединения детский

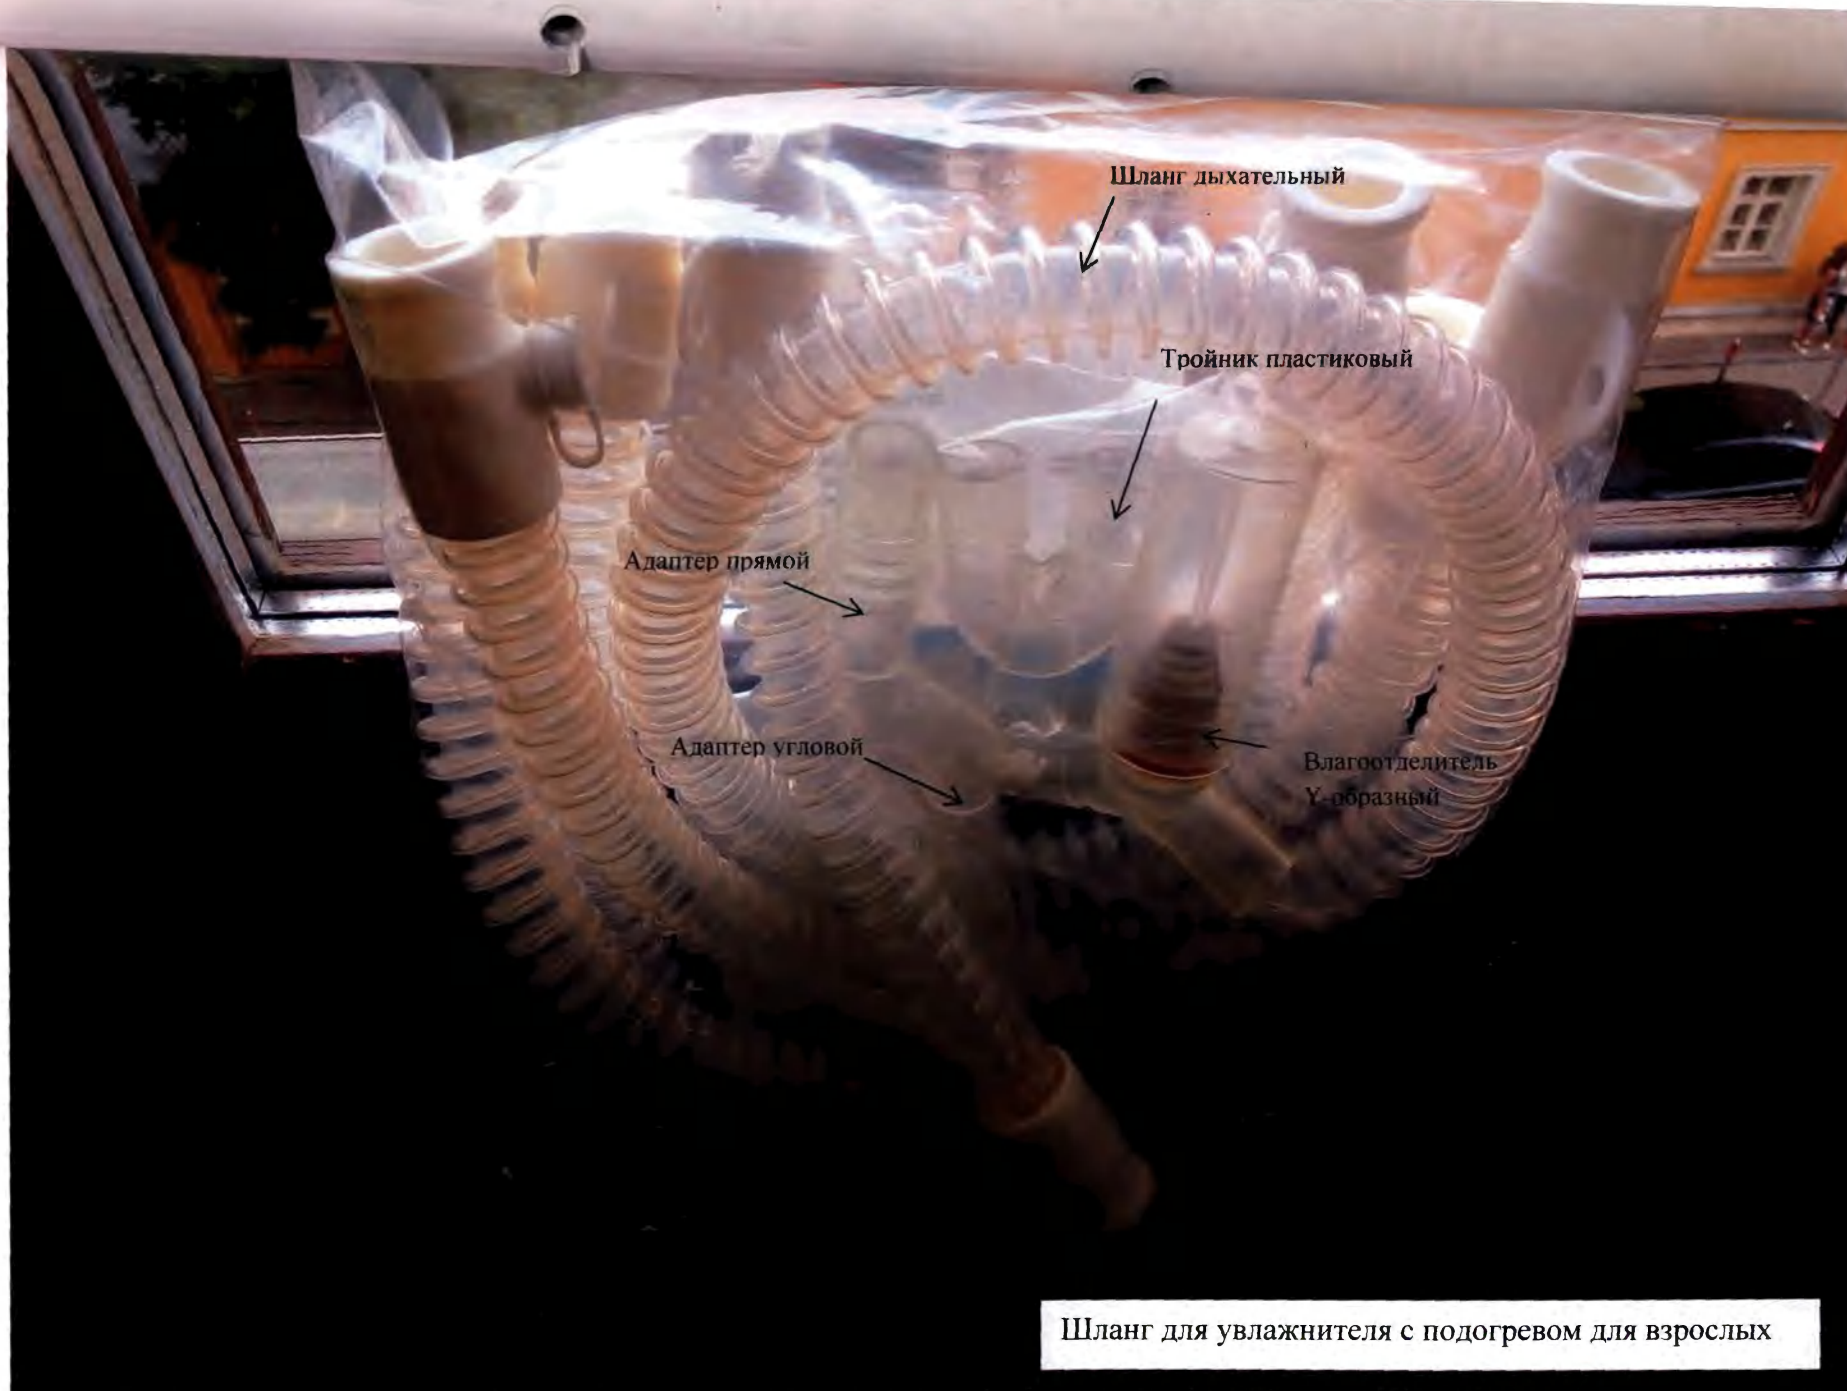





Контур пациента одноразовый взрослый, детский с подогревом контура выдоха и без него

Увлажнитель с подогревом






Держатель увлажнителя



Датчик температуры и потока увлажнителя

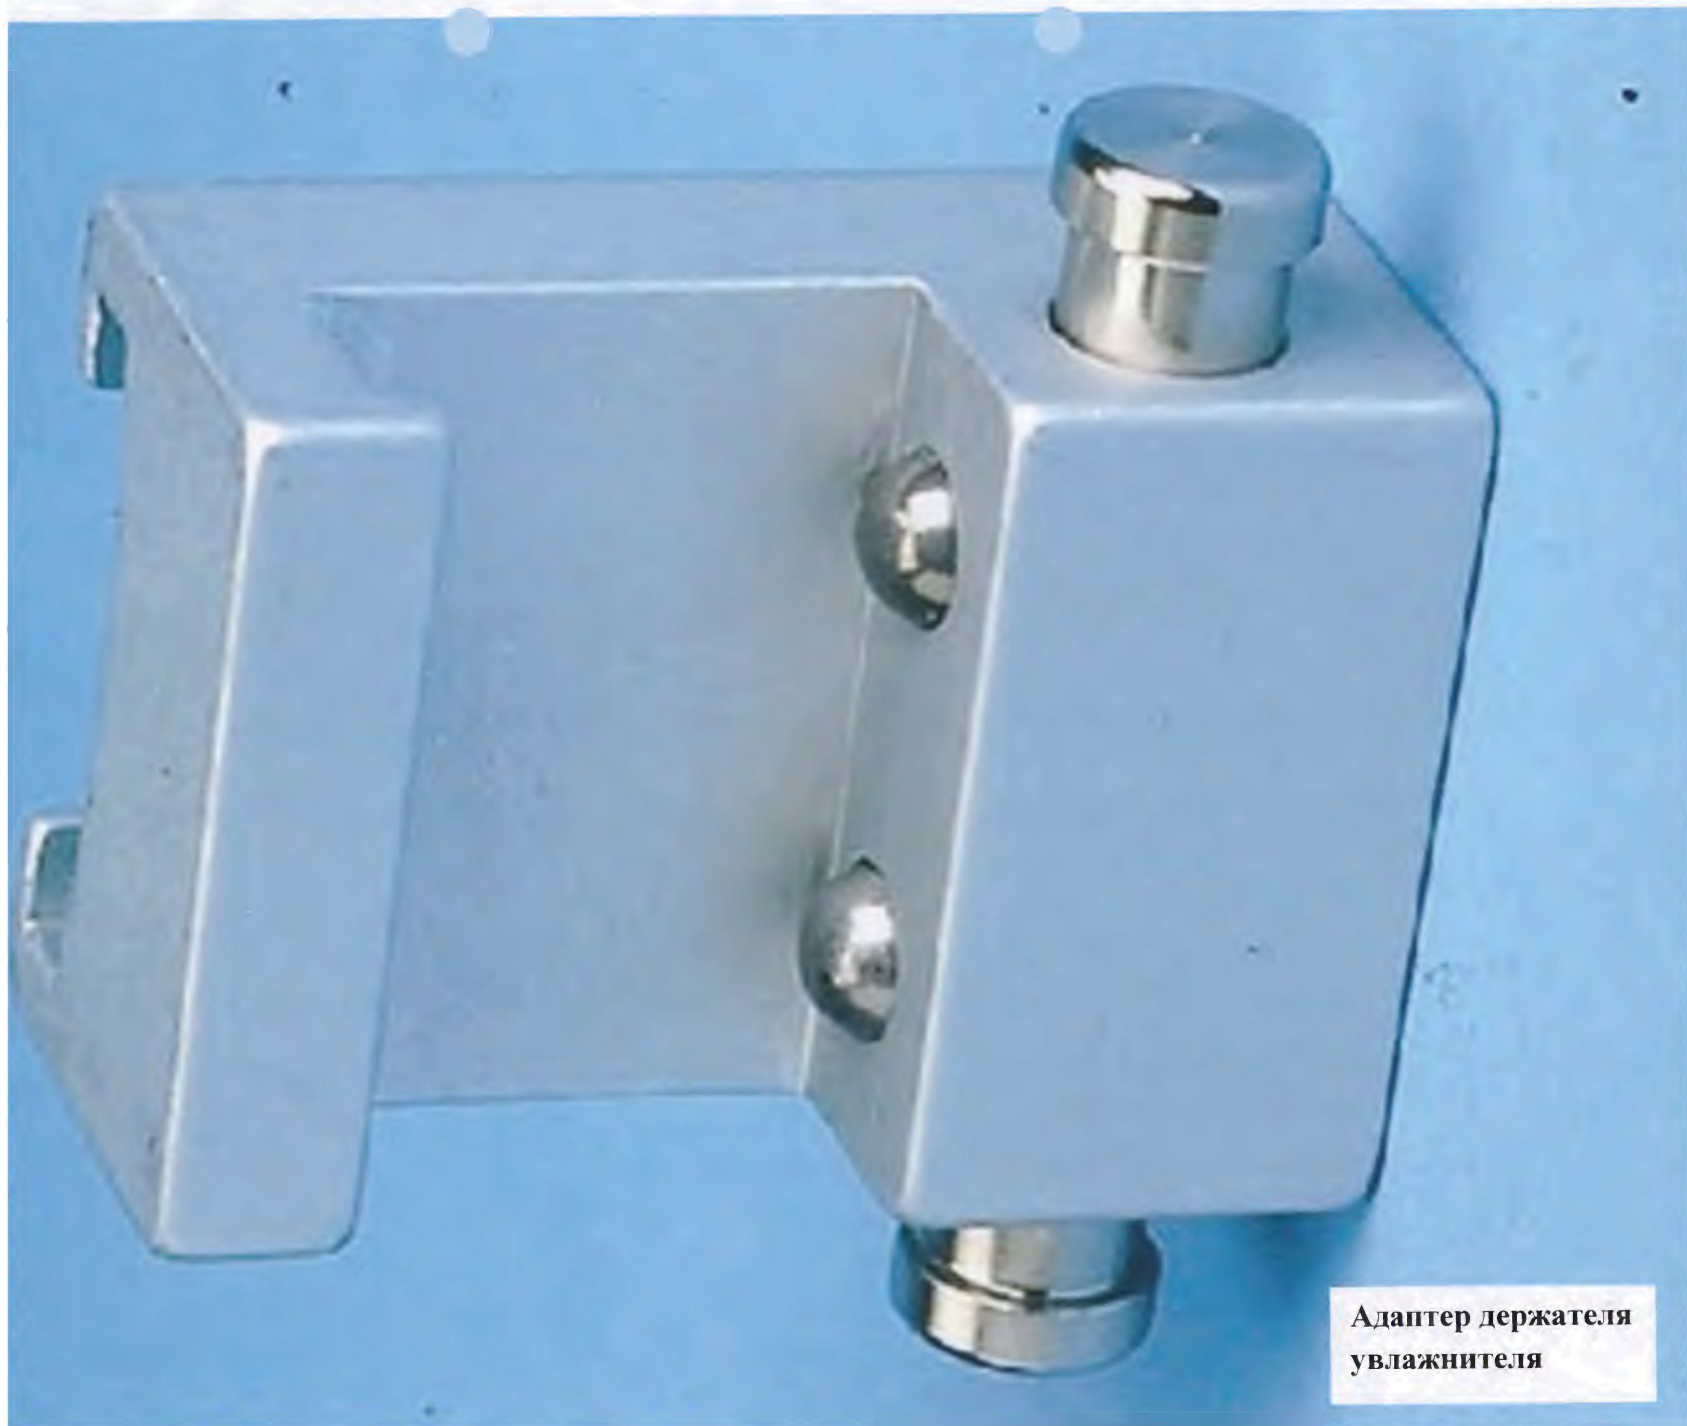


Адаптер держателя
увлажнителя



Соединительный кабель увлажнителя




Камера увлажнителя детская

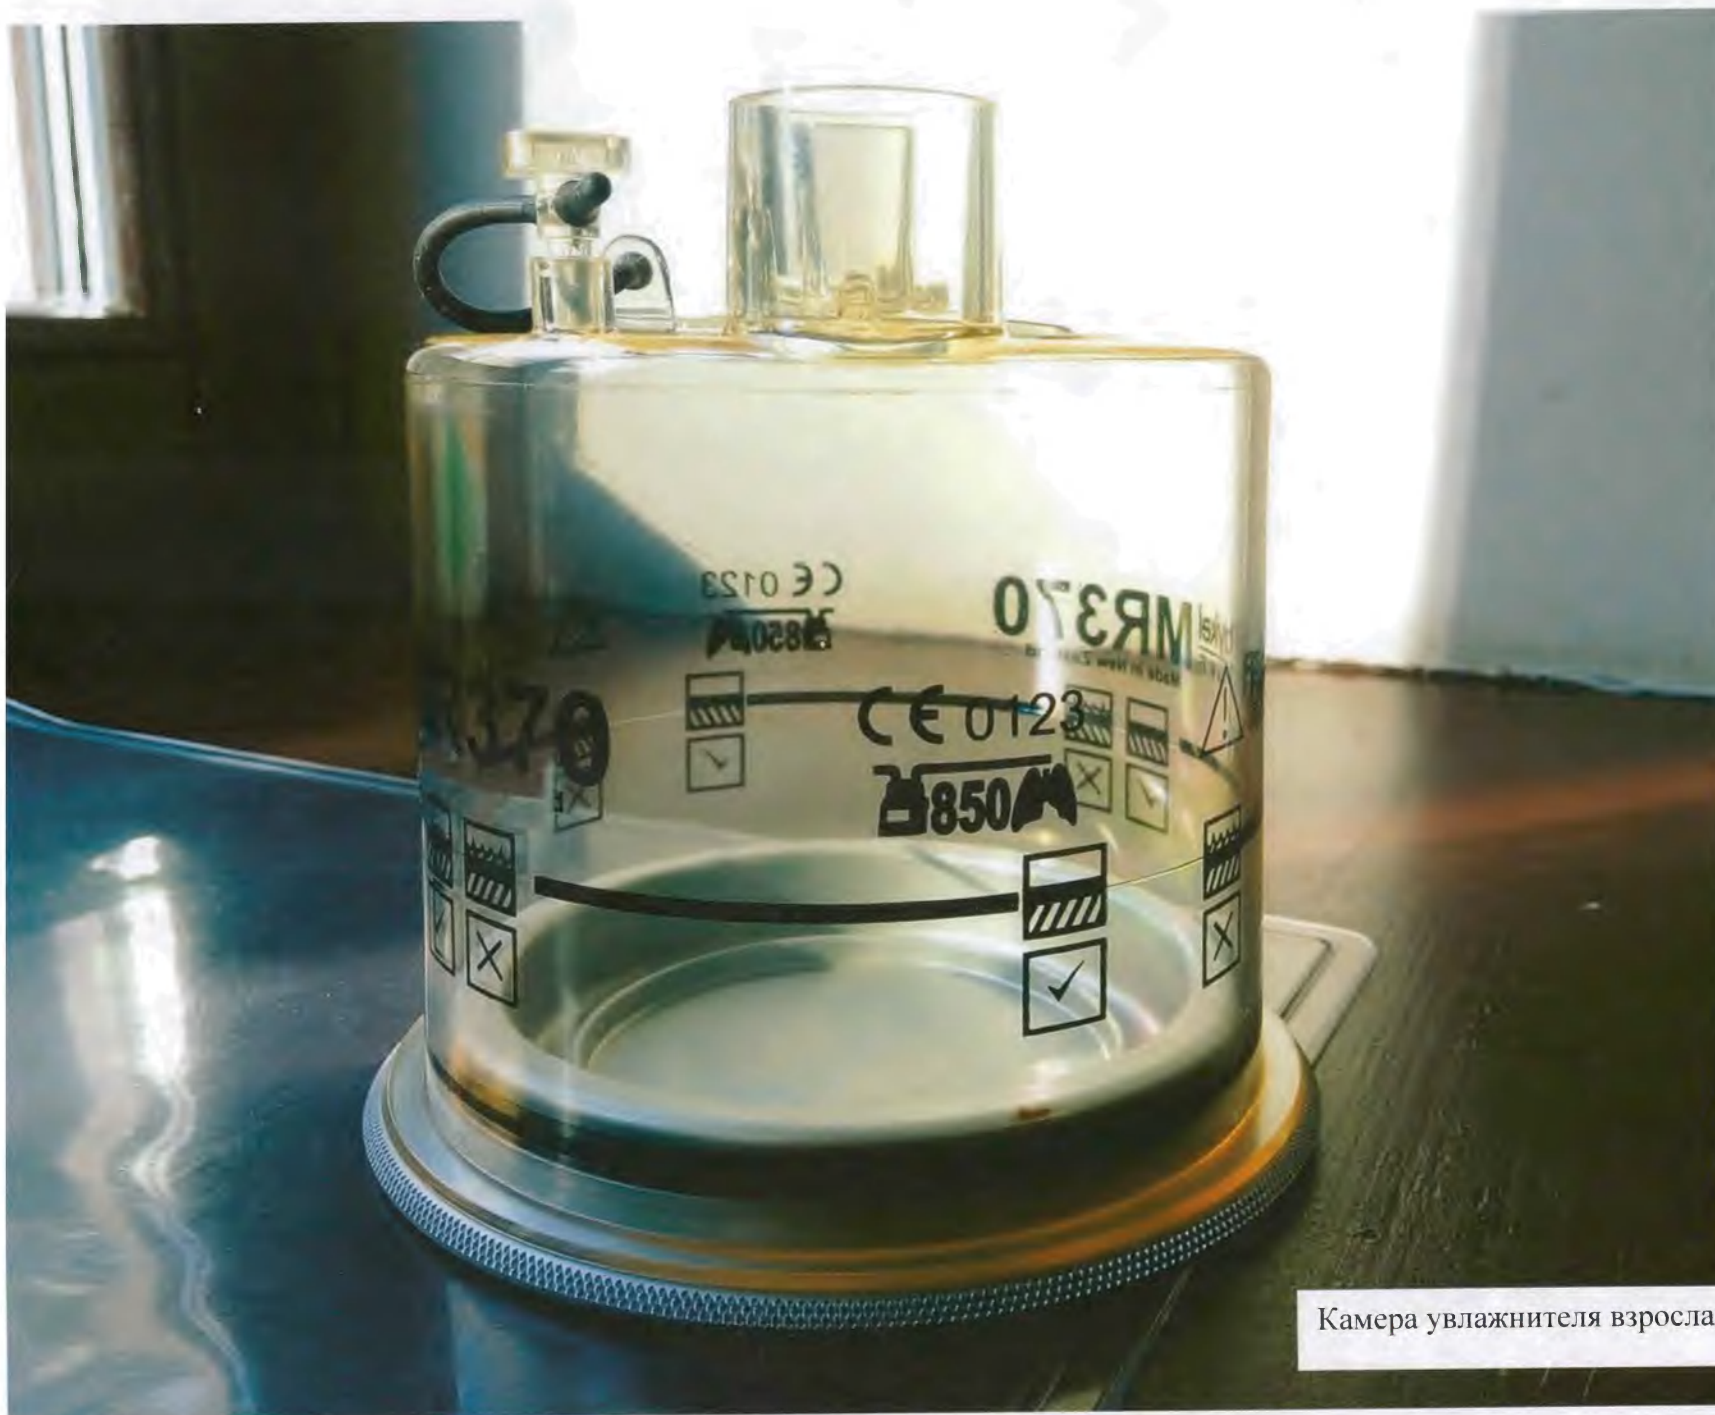

Камера увлажнителя взрослая



Стойка-держатель

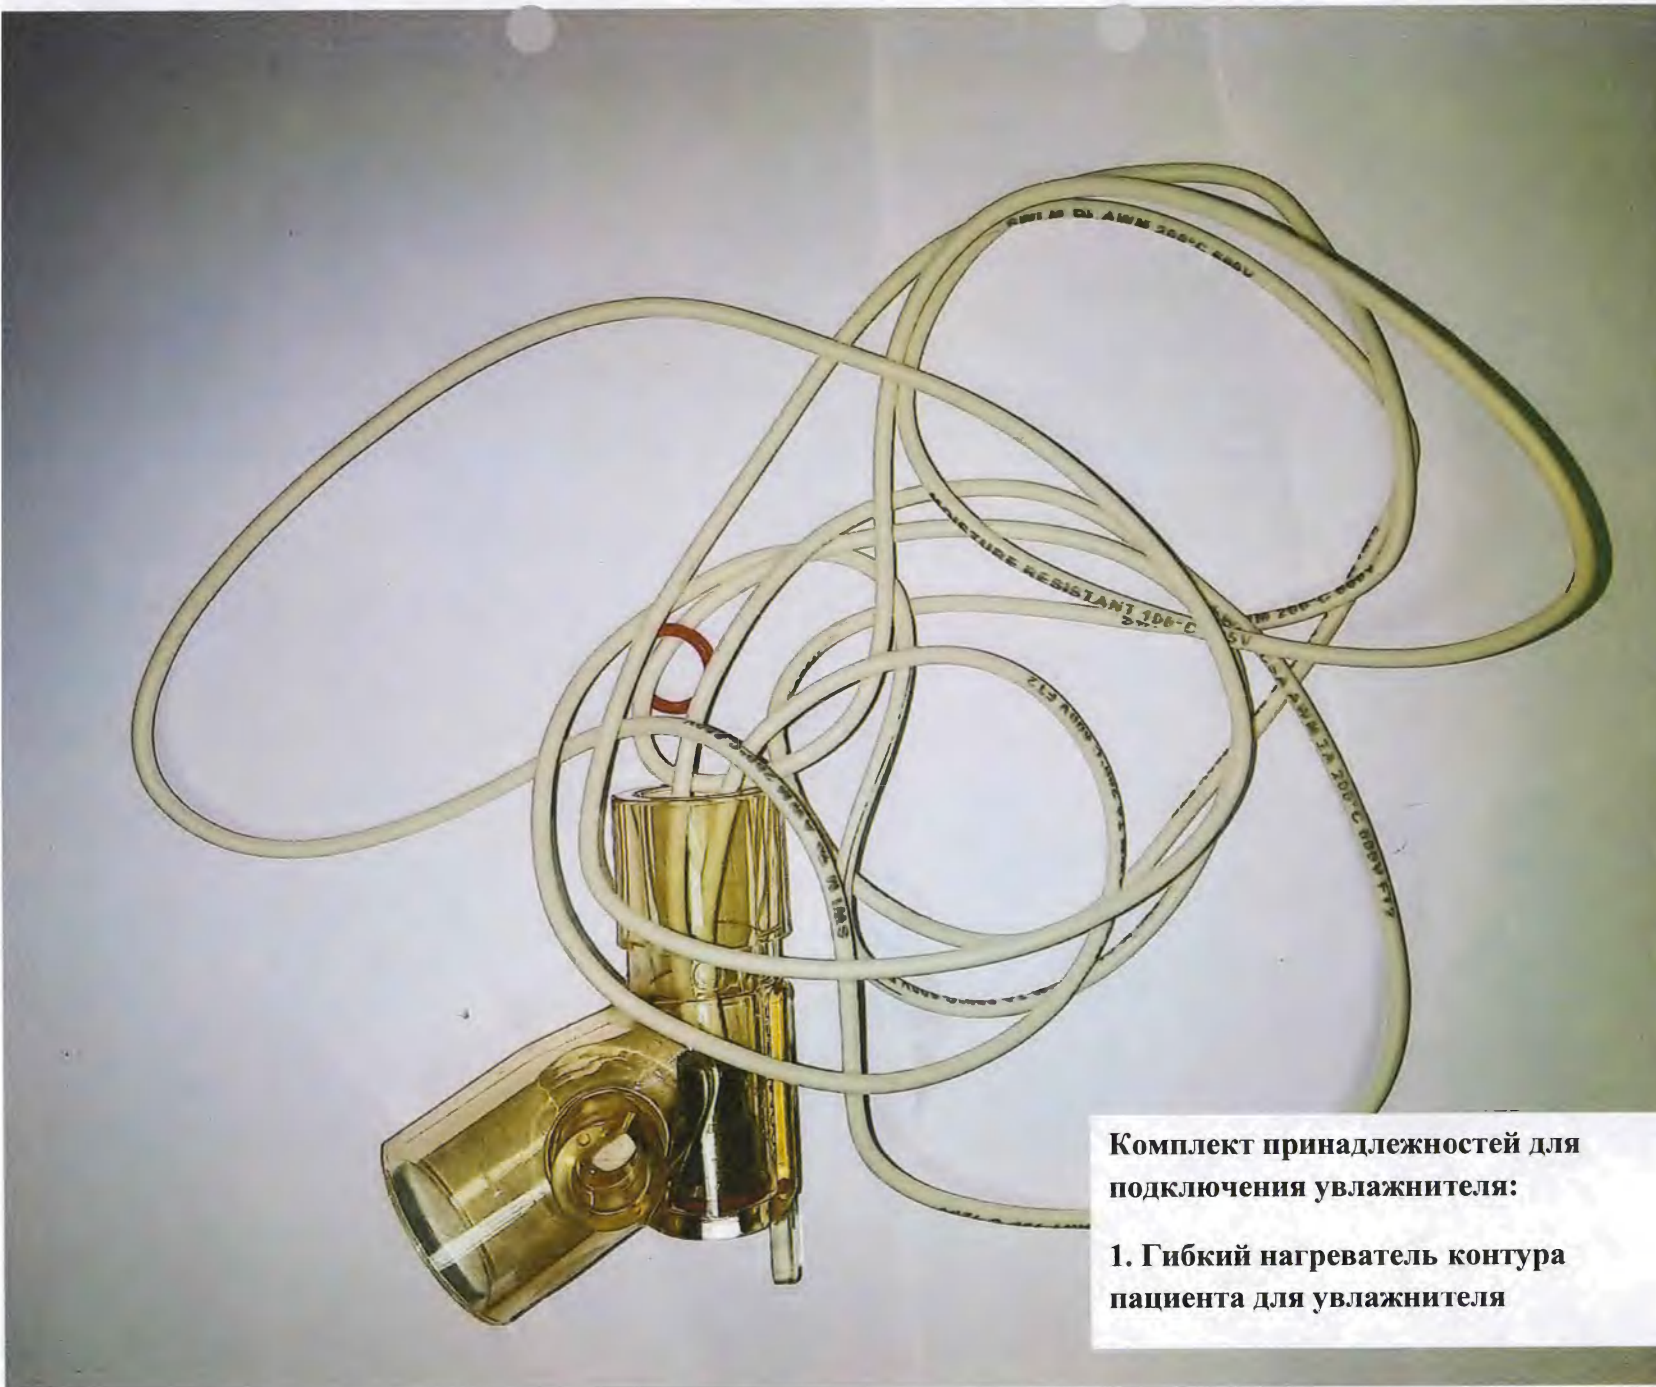

**Комплект принадлежностей для
подключения увлажнителя:**

**1. Гибкий нагреватель контура
пациента для увлажнителя**



**Комплект принадлежностей для
подключения увлажнителя:**

2. Фиксаторы пластиковые



Комплект принадлежностей для подключения увлажнителя:

3. Соединительный кабель для гибкого нагревателя контура пациента для увлажнителя




**Комплект принадлежностей для
подключения увлажнителя:**

4. Струна установочная для протяжки



**Комплект принадлежностей для
подключения увлажнителя:
5. Пластиковый штуцер**

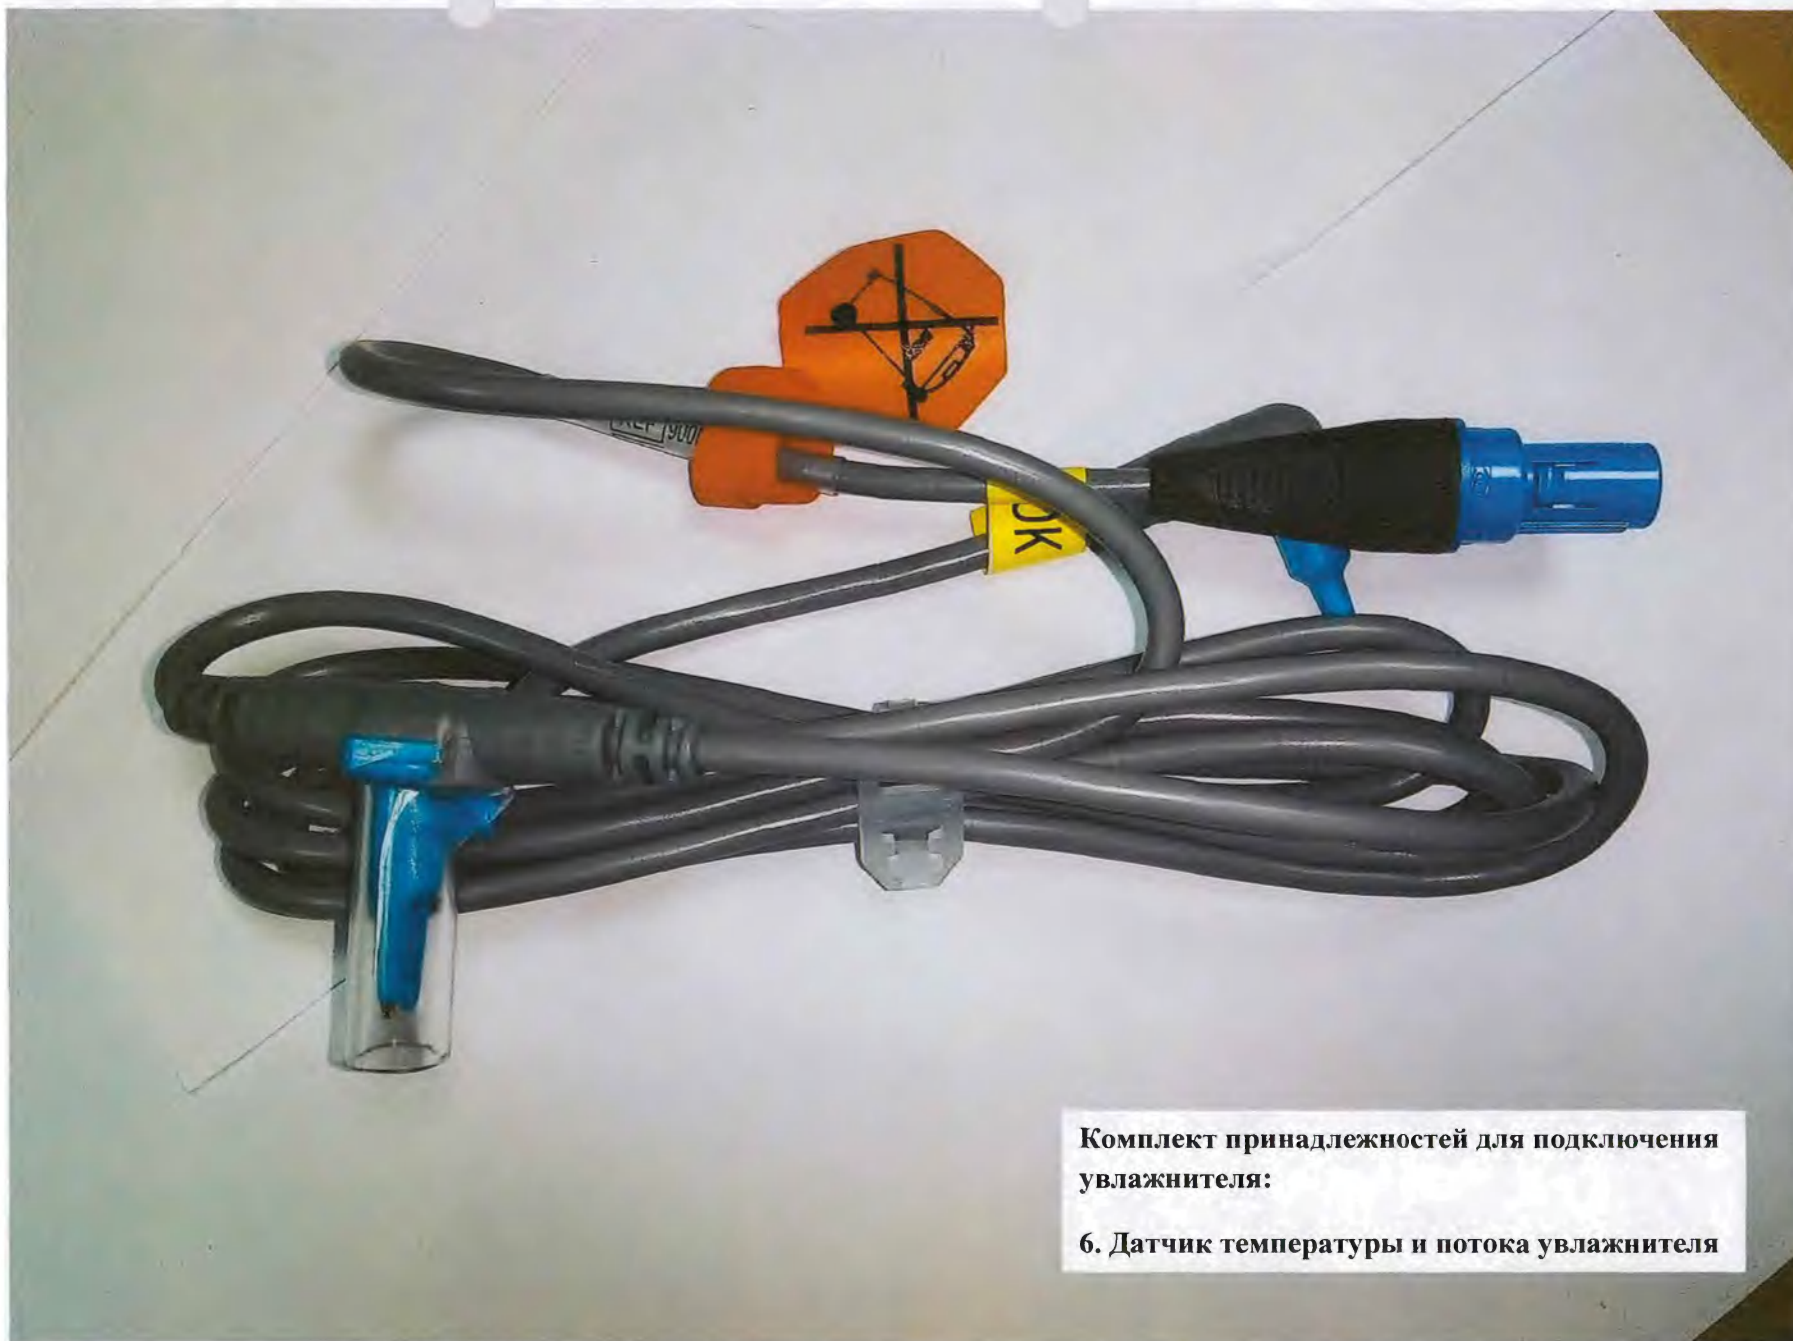

Комплект принадлежностей для подключения увлажнителя:


6. Датчик температуры и потока увлажнителя



Соединитель шлангов угловой



Маска лицевая для неинвазивной
вентиляции одноразовые

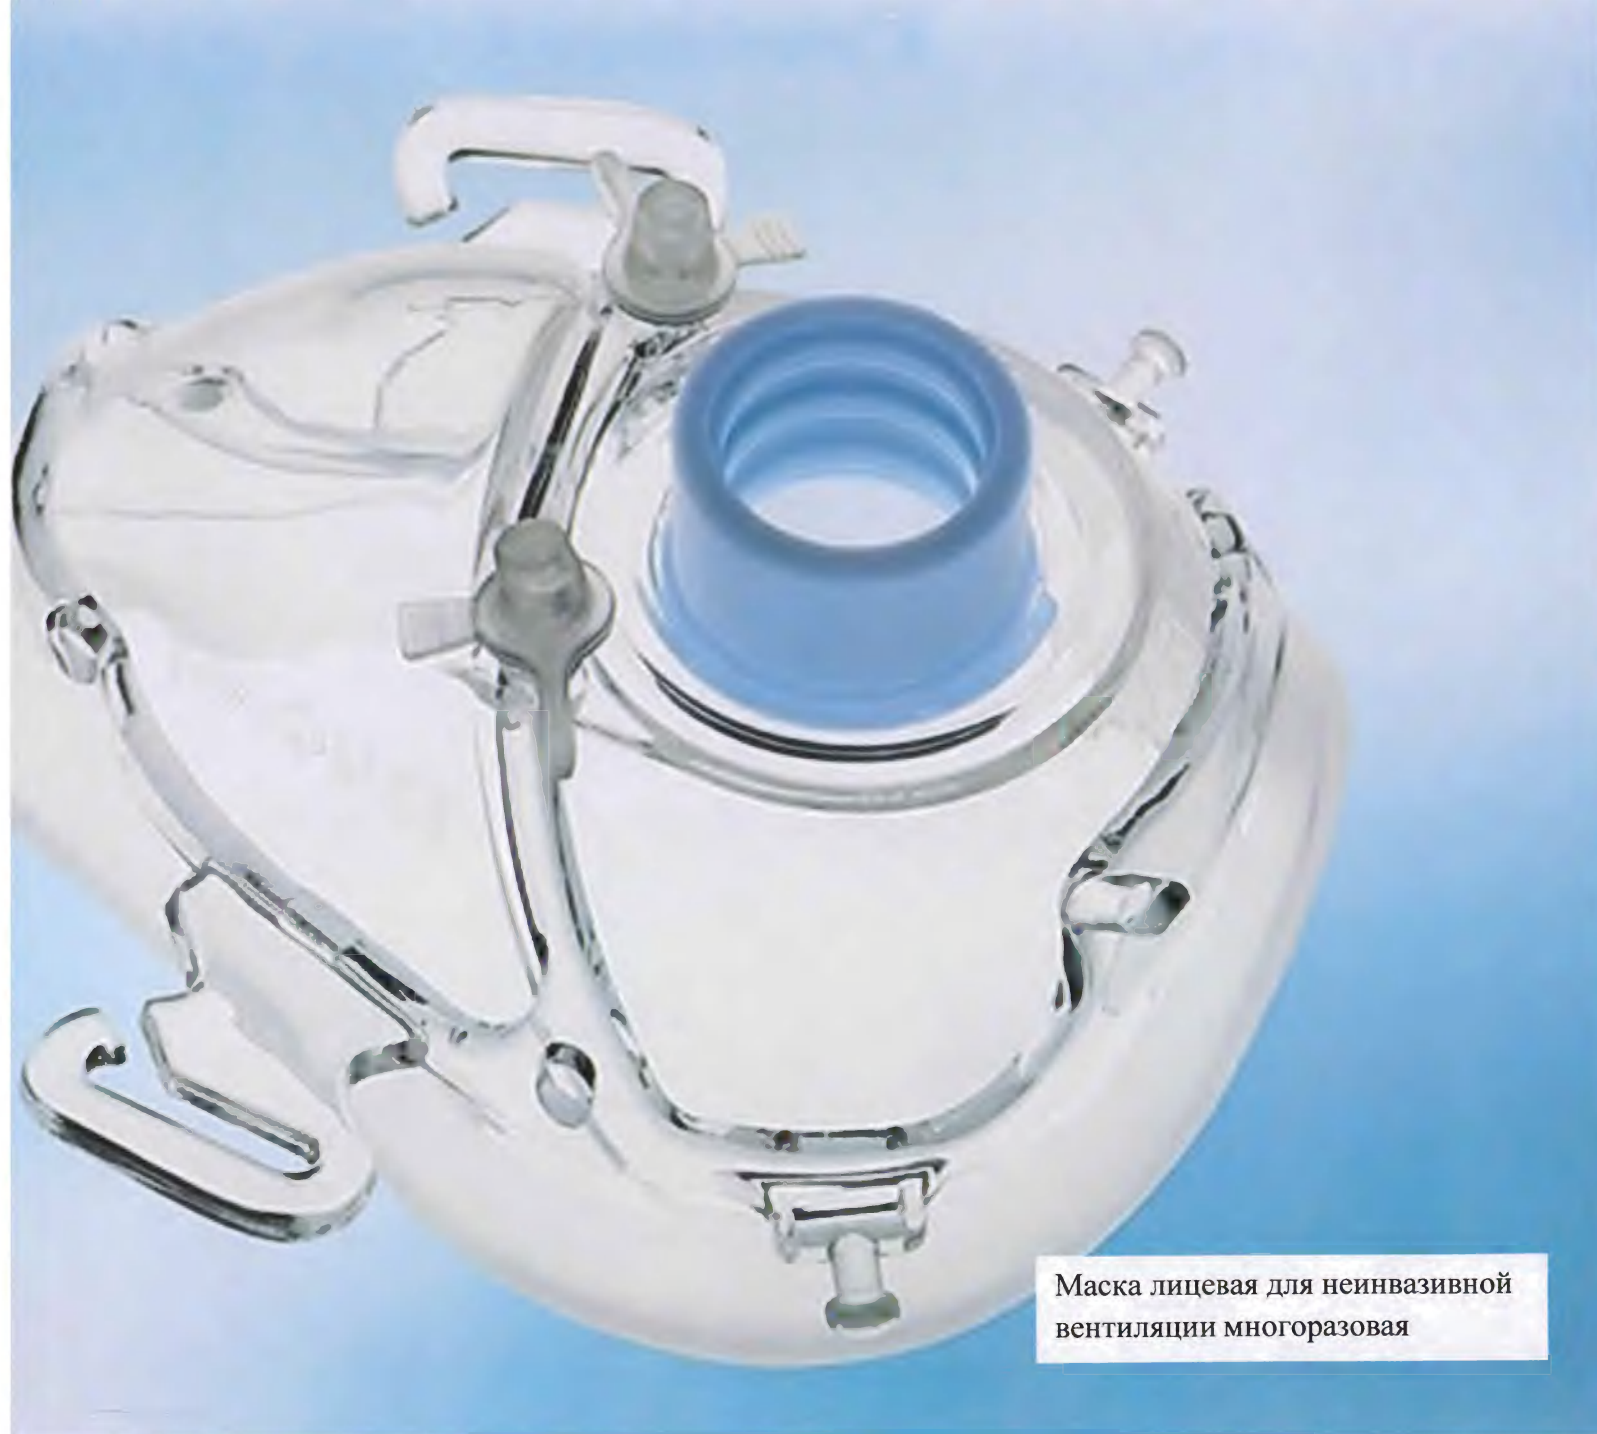

Маска лицевая для неинвазивной
вентиляции многоразовая



Канюли назальные для неинвазивной
вентиляции

MAQUET
GETTIGE GROUP

Маски назальные для неинвазивной вентиляции

Produkt

Manipululidrometres & Manipululidrometres

MAQUET

GETINGE GROUP

L packaging is
contains no latex.

E si l'emballage n'est
pas:

STERIL si el envase está
latex.

ESTÉRIL se a
o danificada. Sem latex.

Wszystkie jest STERIL, solange
nbeschädigt ist. Latexfrei.

STERIL a confezionamento
o lattice.

produit est STERIL, indien
angepönd ist. Latexfrei.

Wskazana jest ostrożność
jest STERYLNY, jeśli opak
uszkodzone. Nie zawiera

Na to χρειάζεστε με προ
ΑΠΟΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ε
αποστειλωμένο ή υγιεινό χυμό.

取り扱いには十分注意
包装袋に破れや傷があ
を使用しないで下さい。
天然ゴムを使用しない

ΑΠΣΑΡΓΙΑΙ ΕΛΓΤΙΣ (πα
jei pakuoje nepažeista ir
latexo.

VÝZADUJE GPO
předpokládá
Nieobsahuje latex

ZACHAZENÍ výrobek je STERILNÝ
předpokládá
Nieobsahuje latex

小心輕置。
如果包裝袋有破損或
天然橡膠成分，

Наголовники для крепления адаптера



Адаптер для неинвазивной вентиляции



Датчик ультразвуковой кислородный



Ремкомплект на 5000 часов:

1. Фильтр для газового модуля



Ремкомплект на 5000 часов:

2. Фильтр входа газового модуля



РЕКОМПЛЕКТ НА 5000 ЧАСОВ:
3. Насадки с клапаном

Держатель для навесного оборудования



Зажим специальный





Фиксаторы специальные

Наклейка на аппарат








Приставка для проведения вентиляции
с использованием оксида азота



Легкое тестовое детское

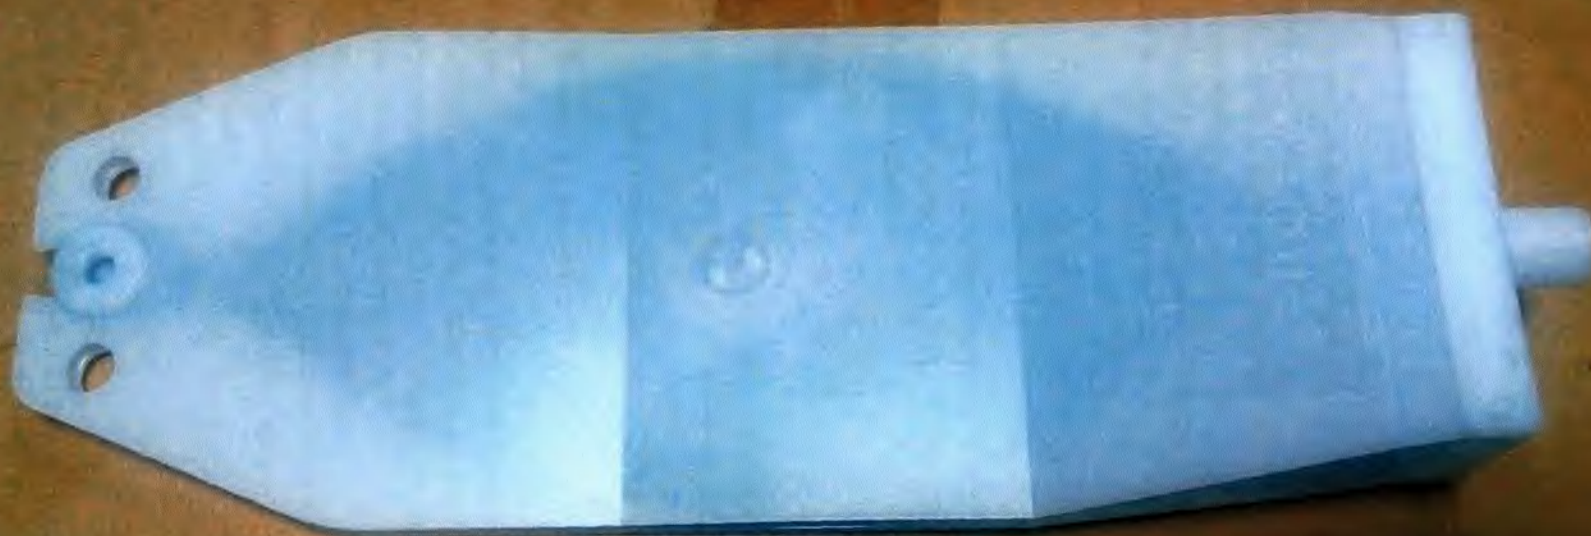

Легкое тестовое взрослое

ПРИЛОЖЕНИЕ

Аппарат искусственной вентиляции легких Servo Ventilator в исполнении Servo-U и Servo-n с принадлежностями:

1. Блок пациента.
2. Блок управления, интегрированный в дисплей.
3. Легкое тестовое, не более 2 шт.
4. Тест-трубка не более 2 шт.
5. Модуль батарейный, не более 6 шт.
6. Кассета экспираторная.
7. Кабель соединяющий для небулайзера, не более 2 шт.
8. Небулайзер одноразовый, не более 50 штук.
9. Т-образный адаптер небулайзера, не более 50 штук.
10. Кабель питания электрический.
11. Руководство по эксплуатации «Аппарат искусственной вентиляции легких Servo Ventilator в исполнении Servo-U и Servo-n», не более 5 шт.

Принадлежности:

1. Кассета экспираторная, не более 10 шт.
2. Модуль нейроконтроля с тестовым кабелем, не более 5 шт.
3. Катетеры модуля нейроконтроля 6 Fr, 8 Fr, 12 Fr, 16 Fr, длина 49 см, 50 см, 100 см, 125 см, 5 шт. в упаковке, не более 10 упаковок.
4. Проводники катетеров модуля нейроконтроля 6 Fr, 8 Fr, 50 см, 100 см, 125 см, 5 шт. в упаковке, не более 10 упаковок.
5. Модуль проксимального датчика с кабелем.
6. Линия давления проксимального датчика (10 шт. в упаковке), не более 20 упаковок.
7. Угловой адаптер проксимального датчика с портом (5 шт. в упаковке), не более 20 упаковок.
8. Адаптер проксимального датчика при проведении капнографии (10 шт. в упаковке), не более 20 упаковок.
9. Проксимальный датчик (Y-сенсор), не более 25 шт.
10. Модуль капнографический.
11. Датчик капнографический с нулевой и референтной ячейкой для взрослых.
12. Адаптер датчика капнографического для взрослых, не более 10 шт.
13. Адаптер датчика капнографического педиатрический, не более 10 шт.
14. Шланг кислородный длина 3 м, 5 м, не более 5 шт.
15. Шланг воздушный, длина 1,5 м, 3 м, 5 м, не более 5 шт.
16. Компрессор специальный с набором для подключения к аппарату:
 - 16.1. Бутылочка для слива конденсата;
 - 16.2. Кабель сетевой электрический;
 - 16.3. Винты крепежные, не более 4 шт.;
17. Тележка специальная.
18. Ящик для тележки, не более 4 шт.
19. Держатель шлангов.
20. Площадка специальная для размещения компрессора на тележке.
21. Площадка специальная для крепления аппарата на подвесе, не более 4 шт.
22. Крепление монитора на рельсе, не более 10 шт.
23. Рукоятка специальная для перемещения аппарата, не более 4 шт.
24. Держатель проксимального датчика, не более 4 шт.
25. Универсальный держатель для кабелей.
26. Комплект для размещения газовых баллонов: