

**Фотографии набора реагентов
Андрофлор®, Андрофлор® Скрин**

Организация-производитель
Место производства (1)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ДНК-Технология ТС»



С.А. Самарин

«10» декабря 2020 г.

**ФОТОГРАФИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ *IN VITRO***

Набор реагентов

для исследования микрофлоры урогенитального тракта мужчин

методом ПЦР в режиме реального времени

по ТУ 9398-090-46482062-2015

Андрофлор®, Андрофлор® Скрин

2020

**Набор реагентов для исследования микрофлоры урогенитального тракта мужчин методом ПЦР в режиме реального времени
по ТУ 9398-090-46482062-2015**

Андрофлор®, фасовка S
Пример внутренней упаковки

Паспорт качества

МАКЕТ ПАСПОРТА!!!

ООО «ДНК-Тех»

Паспорт качества № XXXXXX

Набор реагентов для исследования микрофлоры урогенитального тракта мужчин методом ПЦР в режиме реального времени Андрофлор®

Фасовка: S

Получен: 2016.08.01

Дана: 2016.08.01

Срок годности: 24 мес.

Результат: XXXXXX

1. Проверка комплектности, упаковки и маркировки – соответствует требованиям ТУ 9398-090-46482062-2015.

2. Проверка системы набора и внешнего вида компонентов

Компонент	Количество	Характеристики и условия хранения	Результат
Смесь для амплификации, запечатанная парфенином (Стрип №1)	12 стрипов по 8 пробирок	Хранить в холодильнике при -20 °C до 6 °C	Соответствует
Смесь для амплификации, запечатанная парфенином (Стрип №2)	12 стрипов по 8 пробирок	Хранить в холодильнике при -20 °C до 6 °C	Соответствует
Раствор Taq-полимеразы	4 пробирки	Хранить в холодильнике при -20 °C до 6 °C	Соответствует
Минеральное масло	4 пробирки	Хранить в холодильнике при -20 °C до 6 °C	Соответствует
Положительный контрольный образец	1 пробирка	Хранить в холодильнике при -20 °C до 6 °C	Соответствует

ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ

Real-time

REF R1-P008-S3M

LOT XXXXXX

Андрофлор®

Набор реагентов для исследования микрофлоры урогенитального тракта мужчин методом ПЦР в режиме реального времени

Система: Система для амплификации, запечатанная парфенином

- Стрип №1 12 стрипов по 8 пробирок по 20 мкл
- Стрип №2 12 стрипов по 8 пробирок по 20 мкл
- Раствор Taq-полимеразы 4 пробирки по 500 мкл
- Минеральное масло 4 пробирки по 1,8 мл
- Положительный контрольный образец 1 пробирка 180 мкл

Примечания:

- Крышки для стрипов 24 шт.

Технический документ
ТУ 9398-090-46482062-2015

Крышки для стрипов – 24шт.

Минеральное масло
4 пробирки

Положительный
контрольный образец
1 пробирка

Смеси для амплификации
Стрип №2
12 стрипов по 8 пробирок

Раствор Taq-полимеразы
4 пробирки

Смеси для амплификации
Стрип №1
12 стрипов по 8 пробирок

Андрофлор®
Стрип №1

Смесь для амплификации, запечатанная парфенином

12 стрипов по 8 пробирок по 20 мкл

Real-time

LOT XXXXXX

Фасовка S

NO

Андрофлор®
Стрип №2

Смесь для амплификации, запечатанная парфенином

12 стрипов по 8 пробирок по 20 мкл

Real-time

LOT XXXXXX

Фасовка S

NO

Набор реагентов для исследования микрофлоры урогенитального тракта мужчин методом ПЦР в режиме реального времени по ТУ 9398-090-46482062-2015

Андрофлор®, фасовка S
Пример внутренней упаковки

Паспорт качества

МАКЕТ ПАСПОРТА!!!

ООО «ДНК-Технология»

Паспорт качества № XXXXXX

Набор реагентов для исследования микрофлоры урогенитального тракта мужчин методом ПЦР в режиме реального времени Андрофлор®

Фасовка: S

Фасовка: S

Результат контроля

Параметр	Значение	Единица измерения	Статус
Срок годности	12 месяцев	мес	Состоятелен
Срок хранения	24 месяца	мес	Состоятелен
Срок годности	12 месяцев	мес	Состоятелен
Срок хранения	24 месяца	мес	Состоятелен
Срок годности	12 месяцев	мес	Состоятелен
Срок хранения	24 месяца	мес	Состоятелен

ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ

Real-time

REF 81-988-838

LOT XXXXXX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

2-4 °C

Фасовка S

Фасовка S

Набор реагентов для исследования микрофлоры урогенитального тракта мужчин методом ПЦР в режиме реального времени

Андрофлор®

Содержит:

Смесь для амплификации

Смесь для амплификации

Смесь для амплификации

Смесь для амплификации

Смесь для амплификации

Смесь для амплификации

Смесь для амплификации

Смесь для амплификации

Смесь для амплификации

Смесь для амплификации

Смесь для амплификации

Смесь для амплификации

Смесь для амплификации

Смесь для амплификации

Смесь для амплификации

Смесь для амплификации

Смесь для амплификации

Смесь для амплификации

Смесь для амплификации

Смесь для амплификации

Смесь для амплификации

Смесь для амплификации

Смесь для амплификации

Смесь для амплификации

Смесь для амплификации

Смесь для амплификации

Смесь для амплификации

Смесь для амплификации

Смесь для амплификации

Смесь для амплификации

Смесь для амплификации

Смесь для амплификации

Смесь для амплификации

Смесь для амплификации

Смесь для амплификации

Крышки для стрипов – 24шт.

Минеральное масло
4 пробирки

Положительный
контрольный образец
1 пробирка

Раствор Таq-полимеразы
4 пробирки

Смеси для амплификации
Стрип № 1
12 стрипов по 8 пробирок

Смеси для амплификации
Стрип № 2
12 стрипов по 8 пробирок

Андрофлор®

Стрип №1

Смесь для амплификации,
запечатанная парафином

12 стрипов по 8 пробирок по 20 мкл

Real-time

LOT XXXXXX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

2-4 °C

Фасовка S

Фасовка S

Андрофлор®

Стрип №2

Смесь для амплификации,
запечатанная парафином

12 стрипов по 8 пробирок по 20 мкл

Real-time

LOT XXXXXX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

2-4 °C

Фасовка S

Фасовка S

Набор реагентов для исследования микрофлоры урогенитального тракта мужчин методом ПЦР в режиме реального времени по ТУ 9398-090-46482062-2015

Андрофлор® Скрин, фасовка S
Пример внутренней упаковки

Паспорт качества

Положительный
контрольный образец
1 пробирка

Раствор Таq-полимеразы
4 пробирки

Крышки для стрипов – 24шт.

Смеси для амплификации
24 стрипа по 8 пробирок

Минеральное масло

Набор реагентов для исследования микрофлоры урогенитального тракта мужчин методом ПЦР в режиме реального времени по ТУ 9398-090-46482062-2015

Андрофлор® Скрин, фасовка S
Пример внутренней упаковки

Паспорт качества

Положительный контрольный образец
1 пробирка

Раствор Таq-полимеразы
4 пробирки

Крышки для стрипов – 24шт.

Смеси для амплификации
24 стрипа по 8 пробирок

Минеральное масло

Цвет крышек для микропробирок и стрипов не является функционально значимым и может быть изменен производителем.

Набор реагентов для исследования микрофлоры урогенитального тракта мужчин методом ПЦР в режиме реального времени по ТУ 9398-090-46482062-2015

Андрофлор®, фасовка А
Пример внутренней упаковки

Паспорт качества

МАКЕТ ПАСПОРТА!!!

ООО «ДНК-Технология ТС»

Паспорт качества № XXXXXX
Набор реагентов для исследования микрофлоры урогенитального тракта мужчин методом ПЦР в режиме реального времени. Андрофлор®

Фасовка: А
Номер серии: XXXXXX-XX
Дата изготовления: XXXX-XX-XX
Срок годности: до XXXX-XX-XX*

Результат контроля

1. Проверка комплектности, упаковки и маркировки – соответствует требованиям ТУ.

2. Проверка состава набора и внешнего вида компонентов

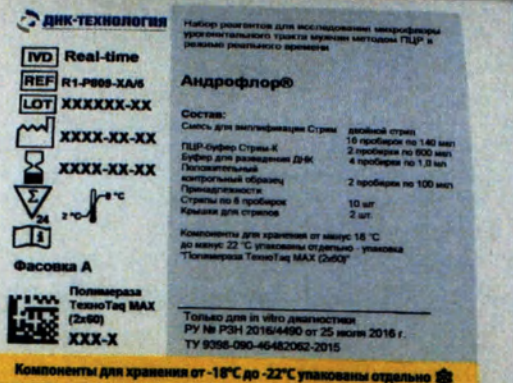
Компонент	Количество	Характеристика и условия хранения	Результат
Смесь для амплификации	16 пробирок	Внутренняя упаковка: двойной стрип. Хранить при температуре от 2 °C до 8 °C.	Соответствует
ПЦР-буфер Стрим-К	2 пробирки	Прозрачная бесцветная жидкость. Хранить при температуре от 2 °C до 8 °C.	Соответствует
Полимераза ТехноTaq MAX	2 пробирки	Прозрачная бесцветная жидкость. Хранить при температуре от минус 18 °C до минус 22 °C.	Соответствует
Буфер для разведения ДНК	4 пробирки	Прозрачная бесцветная жидкость. Хранить при температуре от 2 °C до 8 °C.	Соответствует
Положительный контрольный образец	2 пробирки		
Примарные смеси по 8 пробирок	10 шт.		
Крышки для стрипов	2 шт.		

3. Проверка функциональности

Компонент	Для чего требуется	Результат
Аналитическая чувствительность, выявлять не более	Для выявления минимального количества ДНК. Для МП (микропробирки) – 100 мкл.	Соответствует
Аналитическая специфичность	Показывает, что реакция выявляет только целевые микроорганизмы, исключая перекрестные реакции. Определение отрицательного результата при отсутствии ДНК.	Соответствует

Заключение ОТК: соответствует требованиям ТУ 9398-090-46482062-2015
Дата выдачи паспорта: XXXX-XX-XX

*Срок годности 12 месяцев от даты изготовления



Крышки для стрипов – 2шт.

Стрипы по 8 пробирок – 10шт.

Положительный контрольный образец 2 пробирки

ПЦР-буфер Стрим-К 2 пробирки

Буфер для разведения ДНК 4 пробирки

Полимераза ТехноTaq MAX 2 пробирки

Смеси для амплификации двойной стрип 16 пробирок

Цвет крышек для микропробирок и стрипов не является функционально значимым и может быть изменен производителем.

Андрофлор®, фасовка А
Пример внутренней упаковки

Паспорт качества

МАКЕТ ПАСПОРТА!!!

ООО «ДНК-Технология ТС»

Паспорт качества № XXXXXX

Набор реагентов для исследования микрофлоры урогенитального тракта мужчин методом ПЦР в режиме реального времени. Андрофлор®

Фасовка: А

Доплер серии: XXXXXX-XX

Дата изготовления: XXXX-XX-XX

Срок годности: до XXXX-XX-XX*

Результат контроля

1. Проверка комплектности, упаковки и маркировки – соответствуют требованиям ТУ.

2. Проверка состава набора и внешнего вида компонентов

Компонент	Количество	Характеристика и внешний вид	Условия хранения	Результат
Смесь для амплификации Стрим	16 пробирок	Наличие смеси и отсутствие влаги	от 2 °C до 8 °C	Соответствует
ПЦР-буфер Стрим-К	2 пробирки	Прозрачная бесцветная жидкость	от 2 °C до 8 °C	Соответствует
Полимераза ТехноТaq MAX	2 пробирки	Прозрачная бесцветная жидкость	от минус 18 °C до минус 22 °C	Соответствует
Буфер для разведения ДНК	4 пробирки	Прозрачная бесцветная жидкость	от 2 °C до 8 °C	Соответствует
Положительный контрольный образец	2 пробирки	Прозрачная бесцветная жидкость	от 2 °C до 8 °C	Соответствует
Примечание: Смесь по 8 пробирок Крышка для стрипов	16 шт. 2 шт.			

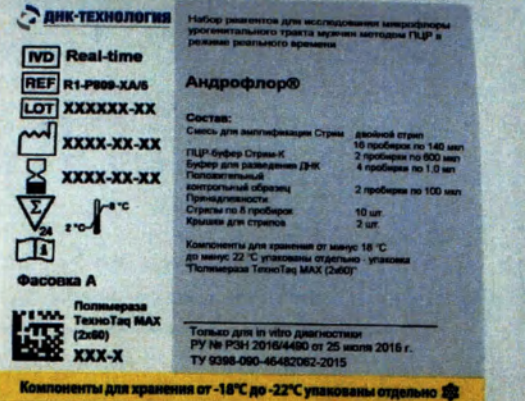
3. Проверка функциональности и

Компонент	Для чего	Результат
Аналитическая чувствительность, выявление бланка	Таблица Скорости ДНК Матрицы	Соответствует
Аналитическая специфичность	Рост культуры, наличие специфического амплификационного продукта	Соответствует

Заключение ОТК: соответствует требованиям ТУ 9398-090-46482062-2015

Дата выдачи паспорта: XXXX-XX-XX

*Срок годности 12 месяцев от даты изготовления



Крышки для стрипов – 2шт.

Стрипы по 8 пробирок – 10шт.

Положительный контрольный образец 2 пробирки

ПЦР-буфер Стрим-К 2 пробирки

Буфер для разведения ДНК 4 пробирки

Полимераза ТехноТaq MAX 2 пробирки

Смеси для амплификации двойной стрип 16 пробирок

Цвет крышек для микропробирок и стрипов не является функционально значимым и может быть изменен производителем.

Набор реагентов для исследования микрофлоры урогенитального тракта мужчин методом ПЦР в режиме реального времени по ТУ 9398-090-46482062-2015

Андрофлор® Скрин, фасовка А
Пример внутренней упаковки

Паспорт качества

МАКЕТ ПАСПОРТА!!!

ООО «ДНК-Технология ТС»

Паспорт качества № XXXXXX
Набор реагентов для исследования микрофлоры урогенитального тракта мужчин методом ПЦР в режиме реального времени. Андрофлор® Скрин

Фасовка: А
Номер серии: XXXXXX-XX
Дата изготовления: XXXX-XX-XX
Срок годности: по XXXX-XX-XX*

Результат контроля

1. Проверка комплектности, упаковки и маркировки – соответствует требованиям ТУ.

2. Проверка состава набора и внешнего вида компонентов

Компонент	Количество	Характеристика и условия хранения	Результат
Смесь для амплификации Стрим	2 стрипа по 8 пробирок	Микробная смесь для амплификации в режиме реального времени. Хранить при -18 °С до 8 °С.	Соответствует
ПЦР-буфер Стрим-К	2 пробирки	Прочистка биологической активности. Хранить при -18 °С до 8 °С.	Соответствует
Полимераза ТехноТaq MAX	2 пробирки	Прочистка биологической активности. Хранить при -18 °С до 22 °С.	Соответствует
Буфер для разведения ДНК	4 пробирки	Прочистка биологической активности. Хранить при -18 °С до 8 °С.	Соответствует
Положительный контрольный образец	2 пробирки	Прочистка биологической активности. Хранить при -18 °С до 8 °С.	Соответствует
Крышки для стрипов	16 шт. 2 шт.	-	-

3. Проверка функциональных показателей

Компонент	Характеристика и условия хранения
Аналитическая чувствительность, копий/мг не более	Для микр. кроме Mycoplasma genitalium: 1000 копий/мг. Для Mycoplasma genitalium: 1000 копий/мг. Для Mycoplasma genitalium: 1000 копий/мг.
Аналитическая специфичность	Положительный результат (полоса) на микробы. Для микр. кроме Mycoplasma genitalium: 1000 копий/мг. Для Mycoplasma genitalium: 1000 копий/мг.

Заключение ОТК: соответствует требованиям ТУ 9398-090-46482062-2015
Дата выдачи паспорта: XXXX-XX-XX
*Срок годности 12 месяцев от даты изготовления

Полимераза ТехноТaq MAX
2 пробирки

Смеси для амплификации
2 стрипа по 8 пробирок

ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ

Real-time
REF R1-R10-XAM
LOT XXXXX-XX
XXXX-XX-XX
XXXX-XX-XX
XXXX-XX-XX
2 °C
Фасовка А
Полимераза ТехноТaq MAX (2x60)
XXXX-X

Андрофлор® Скрин

Состав:
Смесь для амплификации Стрим 2 стрипа по 8 пробирок по 140 мкл
ПЦР-буфер Стрим-К 2 пробирки по 100 мкл
Буфер для разведения ДНК 4 пробирки по 1,0 мл
Положительный контрольный образец 2 пробирки по 100 мкл
Примечания:
- Стрипы по 8 пробирок 10 шт.
- Крышки для стрипов 2 шт.

Компоненты для хранения от -18 °С до -22 °С упакованы отдельно

Только для in vitro диагностики
РУ № РОН 2016/4490 от 25 июля 2016 г.
ТУ 9398-090-46482062-2015

Крышки для стрипов – 2шт.

Стрипы по 8 пробирок – 10 шт.

Положительный контрольный образец
2 пробирки

ПЦР-буфер Стрим-К
2 пробирки

Буфер для разведения ДНК
4 пробирки

Цвет крышек для микропробирок и стрипов не является функционально значимым и может быть изменен производителем.

Андрофлор® Скрин, фасовка А
Пример внутренней упаковки

Паспорт качества

МАКЕТ ПАСПОРТА!!!

ООО «ДНК-Технология ТС»

Паспорт качества № XXXXXX

Набор реагентов для исследования микрофлоры урогенитального тракта мужчин методом ПЦР в режиме реального времени. Андрофлор® Скрин

Фасовка: А

Номер серии: XXXXXX-XX

Дата изготовления: XXXX-XX-XX

Срок годности: до XXXX-XX-XX*

Результат контроля

1. Проверка комплектности, упаковки и маркировки – соответствует требованиям ТУ.

2. Проверка состава набора и внешнего вида компонентов

Компонент	Количество	Характеристика и внешний вид	Условия хранения	Результат
Смесь для амплификации Стрим	2 стрипы по 8 пробирок	Прочность бесцветная жидкость	от 2 °C до 8 °C	Соответствует
ПЦР-буфер Стрим-К	2 пробирки	Прочность бесцветная жидкость	от 2 °C до 8 °C	Соответствует
Полимераза ТехноТаг МАХ	2 пробирки	Прочность бесцветная жидкость	от 2 °C до 8 °C	Соответствует
Буфер для разведения ДНК	4 пробирки	Прочность бесцветная жидкость	от 2 °C до 8 °C	Соответствует
Положительный контрольный образец	2 пробирки	Прочность бесцветная жидкость	от 2 °C до 8 °C	Соответствует
Примечание:	10 шт.			
Смеси по 8 пробирок	2 шт.			

3. Проверка функциональных показателей

Компонент	Характеристика и внешний вид
Аналитическая чувствительность, количество не более	Для всех, кроме Микоплазмы для Тихомирова, Микоплазмы для Сидельникова – 4000. Для Микоплазмы genitalium, Тихомирова, Микоплазмы genitalium, Сидельникова – 1000.
Аналитическая специфичность	Положительный результат (амплификация) не должен быть, в анализе соответствующего лабораторного образца. Отрицательный результат (отсутствие амплификации) не должен быть, в анализе соответствующего лабораторного образца.

Заключение ОТК: соответствует требованиям ТУ 9398-090-46482062-2015

Дата выдачи паспорта: XXXX-XX-XX

*Срок годности 12 месяцев от даты изготовления

Полимераза ТехноТаг МАХ
2 пробирки

Смеси для амплификации
2 стрипа по 8 пробирок

ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ

Real-time

REF R1-R16-XAM

LOT XXXXX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

Набор реагентов для исследования микрофлоры урогенитального тракта мужчин методом ПЦР в режиме реального времени

Андрофлор® Скрин

Состав:

Смесь для амплификации Стрим 2 стрипы по 8 пробирок по 140 мкл

ПЦР-буфер Стрим-К 2 пробирки по 600 мкл

Буфер для разведения ДНК 4 пробирки по 1,0 мл

Положительный контрольный образец 2 пробирки по 100 мкл

Примечание:

- Стрипы по 8 пробирок 10 шт.
- Крышки для стрипов 2 шт.

Компоненты для хранения от минус 18 °C до минус 22 °C упакованы отдельно - упаковка "Полимераза ТехноТаг МАХ (2x60)"

Только для in vitro диагностики
РУ № РОН 2016/4490 от 25 июля 2016 г.
ТУ 9398-090-46482062-2015

Компоненты для хранения от -18°C до -22°C упакованы отдельно

Крышки для стрипов – 2шт.

Стрипы по 8 пробирок – 10 шт.

Положительный контрольный образец
2 пробирки

ПЦР-буфер Стрим-К
2 пробирки

Буфер для разведения ДНК
4 пробирки

**Набор реагентов для исследования микрофлоры урогенитального тракта мужчин методом ПЦР в режиме реального времени
по ТУ 9398-090-46482062-2015**

Информация о месте производства нанесена типографским способом на внешнюю упаковку изделия – коробку. Код места производства указан на этикетке (см. последнюю цифру в серии)



**Набор реагентов для исследования микрофлоры урогенитального тракта мужчин методом ПЦР в режиме реального времени
по ТУ 9398-090-46482062-2015**

Информация о производителе нанесена типографским способом на внешнюю упаковку изделия – коробку.
Код производителя указан на этикетке (см. последнюю букву в серии)



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 11

(Сербакова Н.И.) листа (ов)
специалист по регистрации
Сербакова Н.И.



Организация-производитель
Место производства (1)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ДНК-Технология ТС»



С.А. Самарин

2020 г.

**МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ *IN VITRO***

**Набор реагентов
для исследования микрофлоры урогенитального тракта мужчин
методом ПЦР в режиме реального времени
по ТУ 9398-090-46482062-2015
Андрофлор[®], Андрофлор[®] Скрин**

2020

Маркировка изделия

Маркировка медицинского изделия для диагностики *in vitro* «Набор реагентов для исследования микрофлоры урогенитального тракта мужчин методом ПЦР в режиме реального времени по ТУ 9398-090-46482062-2015 Андрофлор®, Андрофлор® Скрин» соответствует требованиям:

- п.6.2 ГОСТ Р 51088-2013 «Медицинские изделия для диагностики *in vitro*. Реагенты, наборы реагентов, тест-системы, контрольные материалы, питательные среды. Требования к изделиям и поддерживающей документации»;

- ГОСТ Р ИСО 18113-2-2015 «Медицинские изделия для диагностики *in vitro*. Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 2. Реагенты для диагностики *in vitro* для профессионального применения»;

- ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014 «Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Ч.1. Основные требования»;

- требованиям п. 1.5 ТУ 9398-090-46482062-2015.

Маркировка медицинского изделия для диагностики *in vitro* «Набор реагентов для исследования микрофлоры урогенитального тракта мужчин методом ПЦР в режиме реального времени по ТУ 9398-090-46482062-2015 Андрофлор®, Андрофлор® Скрин» выполнена печатным способом и включает:

- **информацию непосредственно на коробке**, нанесенную типографским способом, содержащую:

- логотип;
- адрес изготовителя и его контактные данные (лист 6, 7, 8, 10);

- **этикетку на коробку набора реагентов**, содержащую информацию (образцы см. лист 5, 7, 8, 10):

- логотип;
- полное название набора, вариант комплектации и фасовки;
- состав набора;
- условия хранения набора;
- надпись «Только для диагностики *in vitro*» или символ «IVD»;
- номер серии набора;
- дату изготовления набора;
- срок годности набора;
- номер настоящих технических условий;
- номер регистрационного удостоверения;
- указание на наличие холодильной части (при наличии);
- каталожный номер;
- символ «Количество определений»;
- символ «Обратитесь к инструкции по применению».

Примечания

1. Требование об указании «каталожного номера» не распространяется на упаковку «холодовой части» набора реагентов.
2. При маркировке набора реагентов допускается нанесение QR-кода и надписи «Real-time».
3. Дизайн (включая цвет этикеток) и способ маркировки могут быть изменены производителем при условии соблюдения требований п. 6.2 ГОСТ Р 51088 и ГОСТ Р ИСО 15223-1.
4. Допускается нанесение на внешнюю упаковку (потребительскую тару) иных специальных светящихся, не имеющих рекламного характера, а также пиктограмм и голограмм (ГОСТ Р 51088, подпункт 6.2.10). Например, надписи: «Сделано в России».

- этикетку на каждый компонент или блок компонентов, входящий в состав набора реагентов, содержащую следующую информацию (образцы см. лист 5, 7-11):

- логотип;
- сокращенное название варианта комплектации набора;
- наименование компонента;
- объём/количество компонента;
- номер серии;
- срок годности;
- условия хранения;
- символ «Не допускается воздействие солнечного света» (при необходимости);
- надпись «Только для диагностики *in vitro*» или символ «IVD».

Примечания

1. Размер внутренней упаковки не достаточен для размещения указанного содержания информации на этикетках компонентов, в связи с чем, надпись «Только для диагностики *in vitro*» или символ «IVD» опущены.
2. Требование об указании «сокращенного наименования изделия» и «варианта исполнения» распространяется только на специфичные компоненты для данного набора реагентов: смеси для амплификации и контрольные образцы.
3. Надписи при маркировке изделия частично заменены символами, соответствующими требованиям ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014.
4. При маркировке компонентов набора допускается нанесение QR-кода.
5. Дизайн (включая цвет этикеток) и способ маркировки могут быть изменены производителем при условии соблюдения требований п. 6.2 ГОСТ Р 51088 и ГОСТ Р ИСО 15223-1.

Символы, используемые при маркировке набора

	Только для диагностики <i>in vitro</i>
	Температурный диапазон
	Количество определений
	Годеи до
	Серия набора
	Дата изготовления
	Обратитесь к инструкции по применению
	Каталожный номер
	Адрес изготовителя
	Не допускается воздействие солнечного света

- этикетку на транспортную тару, содержащую информацию (образцы см. лист 12-14):

- торговое (при наличии) и полное наименование набора;
- наименование и адрес изготовителя;
- срок годности набора (год, месяц включительно);
- дату изготовления (год, месяц);
- требования к условиям хранения и транспортирования набора (при необходимости – особые условия обращения с набором);
- номер серии;
- количество наборов в транспортной таре;
- масса нетто и масса брутто на транспортной таре;
- масса нетто потребительской упаковки;

Примечания

1. Требование об указании знака обращения на рынке не применимо.
2. Надписи на транспортной таре, содержащие данные о числе изделий, дате изготовления и сроке годности, номера серии допускается выполнять от руки или с помощью клише (ГОСТ Р 51088, подпункт 6.2.4).
3. Надписи при маркировке изделия могут быть заменены символами в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-1.
4. Дизайн (включая цвет этикеток) и способ маркировки могут быть изменены производителем при условии соблюдения требований п. 6.2 ГОСТ Р 51088 и ГОСТ Р ИСО 15223-1.

Примечание – В данном документе приведены образцы дизайна этикеток.

Дизайн (включая цвет этикеток) и способ маркировки могут быть изменены производителем при условии соблюдения требований п. 6.2 ГОСТ Р 51088, ГОСТ Р ИСО 15223-1 и ТУ 9398-090-46482062-2015.

**Набор реагентов для исследования микрофлоры урогенитального тракта мужчин
методом ПЦР в режиме реального времени по ТУ 9398-090-46482062-2015
Андрофлор®, Андрофлор® Скрин**

Андрофлор®, фасовка S

Условия хранения от 2°C до 8°C

Этикетка на коробку

IVD Real-time
REF R1-P809-S3/6

LOT XXXXXX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

12 2°C 8°C


Фасовка S

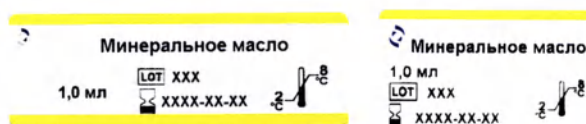
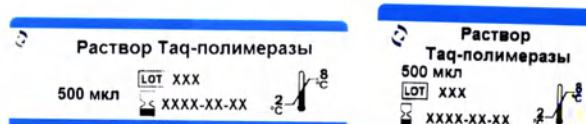
 Набор реагентов для исследования
микрофлоры урогенитального тракта мужчин
методом ПЦР в режиме реального времени

Андрофлор®
Состав:

 Смесь для амплификации, запечатанная
парафином:

- Стрип № 1 12 стрипов по 8 пробирок по 20 мкл
- Стрип № 2 12 стрипов по 8 пробирок по 20 мкл
- Раствор Таq-полимеразы 4 пробирки по 500 мкл
- Минеральное масло 4 пробирки по 1,0 мл
- Положительный контрольный образец 1 пробирка 160 мкл
- Принадлежности:
- Крышки для стрипов 24 шт.

 Только для in vitro диагностики
РУ № РЗН 2016/4490 от 25 июля 2016 г.
ТУ 9398-090-46482062-2015

**Этикетки на компоненты (пробирки)
Примеры дизайна этикеток**
**Минеральное масло
4 пробирки по 1,0 мл**

**Раствор Таq-полимеразы
4 пробирки по 500 мкл**

**Положительный контрольный образец
1 пробирка 160 мкл**

Этикетки на полиэтиленовые пакеты (грипперы)
**Смесь для амплификации,
запечатанная парафином**
Стрип №1

12 стрипов по 8 пробирок по 20 мкл


Андрофлор®
Стрип №1

 Смесь для амплификации,
запечатанная парафином

12 стрипов по 8 пробирок по 20 мкл

Real-time
LOT XXXXXX

XXXX-XX-XX

Фасовка S

IVD

**Смесь для амплификации,
запечатанная парафином**
Стрип №2

12 стрипов по 8 пробирок по 20 мкл


Андрофлор®
Стрип №2

 Смесь для амплификации,
запечатанная парафином

12 стрипов по 8 пробирок по 20 мкл

Real-time
LOT XXXXXX

XXXX-XX-XX


Фасовка S
IVD


Информация о производителе и месте производства нанесена типографским способом на внешнюю упаковку изделия – коробку.

Код места производства указан на этикетке набора (см. последнюю цифру в серии).



Код места производства указан на этикетке

(см. последнюю цифру в серии):

1. ООО «НПО ДНК-Технология»,
Россия, 142281, Московская обл.,
г. Протвино, ул. Железнодорожная, д.20

2. ООО «ДНК-Технология ТС»,
Россия, 117246, г. Москва,
Научный проезд, д.20, стр.4

Тел./факс: +7 (495) 640 17 71
mail@dna-technology.ru

Служба клиентской поддержки:
8 (800) 200 75 15
(для России, звонок бесплатный)
+7 (495) 640-16-93 (для стран СНГ
и зарубежья, звонок платный)

hotline@dna-technology.ru
www.dna-technology.ru

Сделано в России



Код производителя указан на этикетке/Code of manufacturer is shown on the label (см. последнюю букву в серии)/ see the last letter in the lot:

Р. ООО «НПО ДНК-Технология»,
Россия, 142281, Московская обл.,
г. Протвино, ул. Железнодорожная, д.20

«DNA-Technology Research & Production», LLC, Russia, 142281,
Moscow region, Protvino,
Zheleznodorozhnaya street, 20

М. ООО «ДНК-Технология ТС»,
Россия, 117246, г. Москва,
Научный проезд, д.20, стр.4

«DNA-Technology Research & Production», LLC, Russia, 142281,
Moscow

Made in Russia

Андрофлор® Скрин, фасовка S

Условия хранения от 2°C до 8°C

Этикетка на коробку

IVD Real-time
REF R1-P810-S3/5

LOT XXXXXX-XX

 XXXX-XX-XX

 XXXX-XX-XX

 2°C

Фасовка S

 Набор реагентов для исследования
микрофлоры урогенитального тракта мужчин
методом ПЦР в режиме реального времени

Андрофлор® Скрин

Состав:
Смесь для амплификации, запечатанная парафином 24 стрипа по 8 пробирок по 20 мкл
Раствор Taq-полимеразы 4 пробирки по 500 мкл
Минеральное масло 4 пробирки по 1,0 мл
Положительный контрольный образец 1 пробирка 160 мкл
Принадлежности:
- Крышки для стрипов 24 шт.

 Только для in vitro диагностики
РУ № РЗН 2016/4490 от 25 июля 2016 г.
ТУ 9398-090-46482062-2015

Этикетка на полиэтиленовый пакет (гриппер)
**Смесь для амплификации,
запечатанная парафином**
24 стрипа по 8 пробирок по 20 мкл

Андрофлор® Скрин

 Смесь для амплификации,
запечатанная парафином
24 стрипа по 8 пробирок по 20 мкл

Real-time
LOT XXXXXX

 XXXX-XX-XX

Фасовка S
 2°C

 Информация о производителе и месте производства нанесена
типографским способом на внешнюю упаковку изделия – коробку.
Код места производства указан на этикетке набора (см.
последнюю цифру в серии).

 Код места производства указан на
этикетке
(см. последнюю цифру в серии):

1. ООО «НПО ДНК-Технология»,
Россия, 142281, Московская обл.,
г. Протвино, ул. Железнодорожная, д.20
2. ООО «ДНК-Технология ТС»,
Россия, 117246, г. Москва,
Научный проезд, д.20, стр.4

 Тел./факс: +7 (495) 640 17 71
mail@dna-technology.ru

 Служба клиентской поддержки:
8 (800) 200 75 15
(для России, звонок бесплатный)
+7 (495) 640-16-93 (для стран СНГ
и зарубежья, звонок платный)

 hotline@dna-technology.ru
www.dna-technology.ru

Сделано в России


 Код производителя указан
на этикетке/Code of
manufacturer is shown on the label
(см. последнюю букву в серии)/
see the last letter in the lot:

 Р. ООО «НПО ДНК-Технология»,
Россия, 142281, Московская обл.,
г. Протвино, ул. Железнодорожная, д.20

 «DNA-Technology Research &
Production», LLC, Russia, 142281,
Moscow region, Protvino,
Zhelezнодорожная street, 20


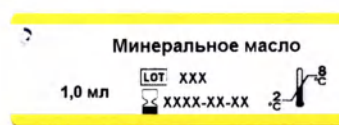
 М. ООО «ДНК-Технология ТС»,
Россия, 117246, г. Москва,
Научный проезд, д.20, стр.4

 «DNA-Technology Research &
Production», LLC, Russia, 142281,
Moscow


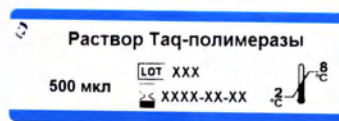
Made in Russia

Этикетки на компоненты (пробирки)
Примеры дизайна этикеток
Минеральное масло


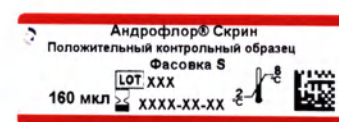
4 пробирки по 1,0 мл


Раствор Taq-полимеразы

4 пробирки по 500 мкл


Положительный контрольный образец


1 пробирка 160 мкл



Андрофлор®, фасовка А

Часть 1 из 2 (условия хранения от 2 °С до 8 °С)

Этикетка на коробку

IVD Real-time
REF R1-P809-XA/5
LOT XXXXXX-XX
XXXX-XX-XX
XXXX-XX-XX
 2 °С

Фасовка А

**Полимераза
ТехноТaq MAX
(2х60)**
XXX-X

 Набор реагентов для исследования микрофлоры
урогенитального тракта мужчин методом ПЦР в
режиме реального времени

Андрофлор®
Состав:

Смесь для амплификации Стрим	двойной стрип
ПЦР-буфер Стрим-К	16 пробирок по 140 мкл
Буфер для разведения ДНК	2 пробирки по 600 мкл
Положительный контрольный образец	4 пробирки по 1,0 мл
Принадлежности:	
Стрипы по 8 пробирок	2 пробирки по 100 мкл
Крышки для стрипов	10 шт.
	2 шт.

 Компоненты для хранения от минус 18 °С
до минус 22 °С упакованы отдельно - упаковка
"Полимераза ТехноТaq MAX (2х60)"


 Только для in vitro диагностики
РУ № РЗН 2016/4490 от 25 июля 2016 г.
ТУ 9398-090-46482062-2015

Компоненты для хранения от -18°С до -22°С упакованы отдельно


Этикетка на полиэтиленовый пакет (гриппер)
**Смесь для амплификации Стрим
двойной стрип 16 пробирок по 140 мкл**


Андрофлор®


 Смесь для амплификации Стрим
двойной стрип 16 пробирок по 140 мкл


Real-time
LOT XXXXXX
XXXX-XX-XX
 2 °С


Фасовка А


**Этикетки на компоненты (пробирки)
Примеры дизайна этикеток**
**ПЦР-буфер Стрим-К
2 пробирки по 600 мкл**

ПЦР-буфер Стрим-К
600 мкл **LOT XXX**
XXXX-XX-XX


ПЦР-буфер Стрим-К
600 мкл **LOT XXX**
XXXX-XX-XX

**Буфер для разведения ДНК
4 пробирки по 1,0 мл**

Буфер для разведения ДНК
1,0 мл **LOT XXX**
XXXX-XX-XX


Буфер для разведения ДНК
1,0 мл **LOT XXX**
XXXX-XX-XX

**Положительный контрольный образец
2 пробирки по 100 мкл**

Андрофлор®
Положительный контрольный образец
Фасовка А
100 мкл **LOT XXX**
XXXX-XX-XX


Андрофлор®
Положительный контрольный образец
Фасовка А
100 мкл **LOT XXX**
XXXX-XX-XX

 Информация о производителе и месте производства нанесена
типографским способом на внешнюю упаковку изделия – коробку.
Код места производства указан на этикетке набора (см.
последнюю цифру в серии).

 Код места производства указан на
этикетке
(см. последнюю цифру в серии):

 1. ООО «НПО ДНК-Технология»,
Россия, 142281, Московская обл.,
г. Протвино, ул. Железнодорожная, д.20

 2. ООО «ДНК-Технология ТС»,
Россия, 117246, г. Москва,
Научный проезд, д.20, стр.4

 Тел./факс: +7 (495) 640 17 71
mail@dna-technology.ru

 Служба клиентской поддержки:
8 (800) 200 75 15
(для России, звонок бесплатный)
+7 (495) 640-16-93 (для стран СНГ
и зарубежья, звонок платный)

 hotline@dna-technology.ru
www.dna-technology.ru

Сделано в России


 Код производителя указан
на этикетке/Code of
manufacturer is shown on the label
(см. последнюю букву в серии)/
see the last letter in the lot:

 Р. ООО «НПО ДНК-Технология»,
Россия, 142281, Московская обл.,
г. Протвино, ул. Железнодорожная, д.20

 «DNA-Technology Research &
Production», LLC, Russia, 142281,
Moscow region, Protvino,
Zheleznodorozhnaya street, 20

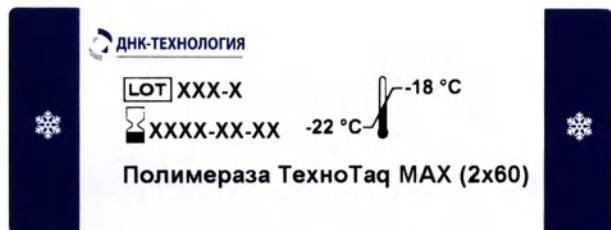
 М. ООО «ДНК-Технология ТС»,
Россия, 117246, г. Москва,
Научный проезд, д.20, стр.4

 «DNA-Technology Research &
Production», LLC, Russia, 142281,
Moscow

Made in Russia

Часть 2 из 2 (условия хранения от минус 18 °С до минус 22 °С)



Этикетка на коробку



Этикетки на компоненты (пробирки)

Примеры дизайна этикеток

Полимераза ТехноТaq МАХ
2 пробирки по 60 мкл



Андрофлор® Скрин, фасовка А

Часть 1 из 2 (условия хранения от 2 °С до 8 °С)

Этикетка на коробку

IVD Real-time
REF R1-P810-XA/4
LOT XXXXXX-XX
XXXX-XX-XX
XXXX-XX-XX
2 °С

Фасовка А
**Полимераза
ТехноTaq MAX
(2x60)**
XXX-X

 Набор реагентов для исследования микрофлоры
урогенитального тракта мужчин методом ПЦР в
режиме реального времени

Андрофлор® Скрин
Состав:

 Смесь для амплификации Стрим 2 стрипа
 по 8 пробирок по 140 мкл
 ПЦР-буфер Стрим-К 2 пробирки по 600 мкл
 Буфер для разведения ДНК 4 пробирки по 1,0 мл
 Положительный контрольный образец 2 пробирки по 100 мкл
 Принадлежности:
 - Стрипы по 8 пробирок 10 шт.
 - Крышки для стрипов 2 шт.

 Компоненты для хранения от минус 18 °С
до минус 22 °С упакованы отдельно - упаковка
"Топимераза ТехноTaq MAX (2x60)"

 Только для in vitro диагностики
 РУ № РЗН 2016/4490 от 25 июля 2016 г.
 ТУ 9398-090-46482062-2015

Компоненты для хранения от -18°С до -22°С упакованы отдельно

Этикетка на полиэтиленовый пакет (гриппер)
Смесь для амплификации Стрим
 2 стрипа по 8 пробирок по 140 мкл

Андрофлор® Скрин

 Смесь для амплификации Стрим
 2 стрипа по 8 пробирок по 140 мкл

Real-time
LOT XXXXXX
XXXX-XX-XX
Фасовка А
2 °С

Этикетки на компоненты (пробирки)
Примеры дизайна этикеток
ПЦР-буфер Стрим-К
 2 пробирки по 600 мкл

ПЦР-буфер Стрим-К

 600 мкл **LOT XXX**
XXXX-XX-XX
**ПЦР-буфер
Стрим-К**

 600 мкл **LOT XXX**
XXXX-XX-XX
Буфер для разведения ДНК
 4 пробирки по 1,0 мл

Буфер для разведения ДНК

 1,0 мл **LOT XXX**
XXXX-XX-XX
**Буфер для
разведения ДНК**

 1,0 мл **LOT XXX**
XXXX-XX-XX
Положительный контрольный образец
 2 пробирки по 100 мкл

Андрофлор® Скрин

Положительный контрольный образец

 100 мкл **LOT XXX**
XXXX-XX-XX
Андрофлор® Скрин

Положительный контрольный образец

 100 мкл **LOT XXX**
XXXX-XX-XX

 Информация о производителе и месте производства нанесена
типографским способом на внешнюю упаковку изделия – коробку.
Код места производства указан на этикетке набора (см.
последнюю цифру в серии).

 Код места производства указан на
этикетке

(см. последнюю цифру в серии):

 1. ООО «НПО ДНК-Технология»,
Россия, 142281, Московская обл.,
г. Протвино, ул. Железнодорожная, д.20

 2. ООО «ДНК-Технология ТС»,
Россия, 117246, г. Москва,
Научный проезд, д.20, стр.4

 Тел./факс: +7 (495) 640 17 71
 mail@dna-technology.ru

 Служба клиентской поддержки:
 8 (800) 200 75 15
 (для России, звонок бесплатный)
 +7 (495) 640-16-93 (для стран СНГ
и зарубежья, звонок платный)

 hotline@dna-technology.ru
 www.dna-technology.ru

Сделано в России


 Код производителя указан
на этикетке/Code of
manufacturer is shown on the label
(см. последнюю букву в серии)/
see the last letter in the lot:

 Р. ООО «НПО ДНК-Технология»,
Россия, 142281, Московская обл.,
г. Протвино, ул. Железнодорожная, д.20

 «DNA-Technology Research &
Production», LLC, Russia, 142281,
Moscow region, Protvino,
Zheleznodorozhnaya street, 20

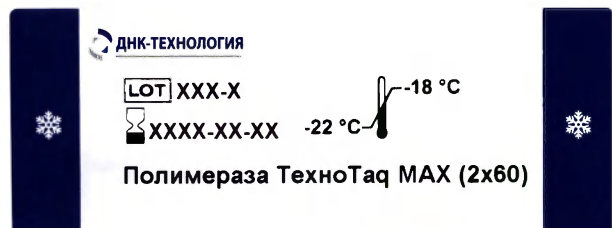
 М. ООО «ДНК-Технология ТС»,
Россия, 117246, г. Москва,
Научный проезд, д.20, стр.4

 «DNA-Technology Research &
Production», LLC, Russia, 142281,
Moscow

Made in Russia


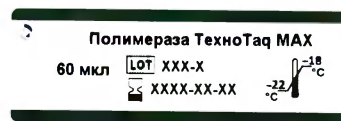
Часть 2 из 2 (условия хранения от минус 18 °С до минус 22 °С)

Этикетка на коробку



Этикетки на компоненты (пробирки)

Примеры дизайна этикеток
Полимераза ТехноТaq МАХ
2 пробирки по 60 мкл



**Набор реагентов для исследования микрофлоры
урогенитального тракта мужчин методом ПЦР
в режиме реального времени
Андрофлор®**

IVD	Фасовка S	
	_____	Количество наборов: _____ шт. Условия транспортирования и хранения наборов
	_____	
LOT	_____	
		2 °C  8 °C

**Масса нетто потребительской
упаковки:** _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____




ООО «ДНК-Технология ТС»

117246, Москва, Научный проезд, д. 20, стр. 4.

E-mail: mail@dna-technology.ru

По вопросам, касающимся качества набора реагентов, следует обращаться к официальному представителю производителя по адресу:

ООО "ДНК-Технология", 117587, Москва, Варшавское шоссе, д.125ж, к.6,
тел./факс +7(495)980-45-55, www.dna-technology.ru

 ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

**Набор реагентов для исследования микрофлоры
урогенитального тракта мужчин методом ПЦР
в режиме реального времени
Андрофлор® Скрин**

IVD	Фасовка S	
	_____	Количество наборов: _____ шт. Условия транспортирования и хранения наборов
	_____	
LOT	_____	
		2 °C  8 °C

**Масса нетто потребительской
упаковки:** _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____



ООО «ДНК-Технология ТС»

117246, Москва, Научный проезд, д. 20, стр. 4.

E-mail: mail@dna-technology.ru

По вопросам, касающимся качества набора реагентов, следует обращаться к официальному представителю производителя по адресу:

ООО "ДНК-Технология", 117587, Москва, Варшавское шоссе, д.125ж, к.6,
тел./факс +7(495)980-45-55, www.dna-technology.ru

**Набор реагентов для исследования микрофлоры
урогенитального тракта мужчин методом ПЦР
в режиме реального времени
Андрофлор®**

IVD	Фасовка А
	Количество наборов: _____ шт. Условия транспортирования и хранения наборов  8 °C 2 °C
	
LOT	

**Масса нетто потребительской
упаковки: _____**

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Внимание! Полимераза ТехноТaq МАХ упакована отдельно



ООО «ДНК-Технология ТС»

117246, Москва, Научный проезд, д. 20, стр. 4.

E-mail: mail@dna-technology.ru

По вопросам, касающимся качества набора реагентов, следует обращаться к официальному представителю производителя по адресу:

ООО "ДНК-Технология", 117587, Москва, Варшавское шоссе, д.125ж, к.6,

☎ 000 ЦИРМИ ☎ INFO@CIRMI.RU 🌐 WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU dna-technology.ru

**Набор реагентов для исследования микрофлоры
урогенитального тракта мужчин методом ПЦР
в режиме реального времени
Андрофлор® Скрин**

IVD	Фасовка А
	Количество наборов: _____ шт. Условия транспортирования и хранения наборов  8 °C 2 °C
	
LOT	

**Масса нетто потребительской
упаковки: _____**

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Внимание! Полимераза ТехноТaq МАХ упакована отдельно



ООО «ДНК-Технология ТС»

117246, Москва, Научный проезд, д. 20, стр. 4.

E-mail: mail@dna-technology.ru

По вопросам, касающимся качества набора реагентов, следует обращаться к официальному представителю производителя по адресу:

ООО "ДНК-Технология", 117587, Москва, Варшавское шоссе, д.125ж, к.6,

тел./факс +7(495)980-45-55, www.dna-technology.ru

**Набор реагентов для исследования микрофлоры
урогенитального тракта мужчин методом ПЦР
в режиме реального времени
Андрофлор®**

IVD	Фасовка А	Полимераза ТехноТaq МАХ
	_____	Количество: _____ шт. Условия транспортирования и хранения  -18 °C -22 °C
	_____	
LOT	_____	

**Масса нетто потребительской
упаковки:** _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____



ООО «ДНК-Технология ТС»

117246, Москва, Научный проезд, д. 20, стр. 4.

E-mail: mail@dna-technology.ru

По вопросам, касающимся качества набора реагентов, следует обращаться к официальному представителю производителя по адресу:

ООО "ДНК-Технология", 117587, Москва, Варшавское шоссе, д.125ж, к.6,
тел./факс +7(495)980-45-55, www.dna-technology.ru

**Набор реагентов для исследования микрофлоры
урогенитального тракта мужчин методом ПЦР
в режиме реального времени
Андрофлор® Скрин**

IVD	Фасовка А	Полимераза ТехноТaq МАХ
	_____	Количество: _____ шт. Условия транспортирования и хранения  -18 °C -22 °C
	_____	
LOT	_____	

**Масса нетто потребительской
упаковки:** _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____



ООО «ДНК-Технология ТС»

117246, Москва, Научный проезд, д. 20, стр. 4.

E-mail: mail@dna-technology.ru

По вопросам, касающимся качества набора реагентов, следует обращаться к официальному представителю производителя по адресу:

ООО "ДНК-Технология", 117587, Москва, Варшавское шоссе, д.125ж, к.6,
тел./факс +7(495)980-45-55, www.dna-technology.ru

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 14

(содержит) листа (ов)

специалист по регистрации

Щербакова Н.И.

