

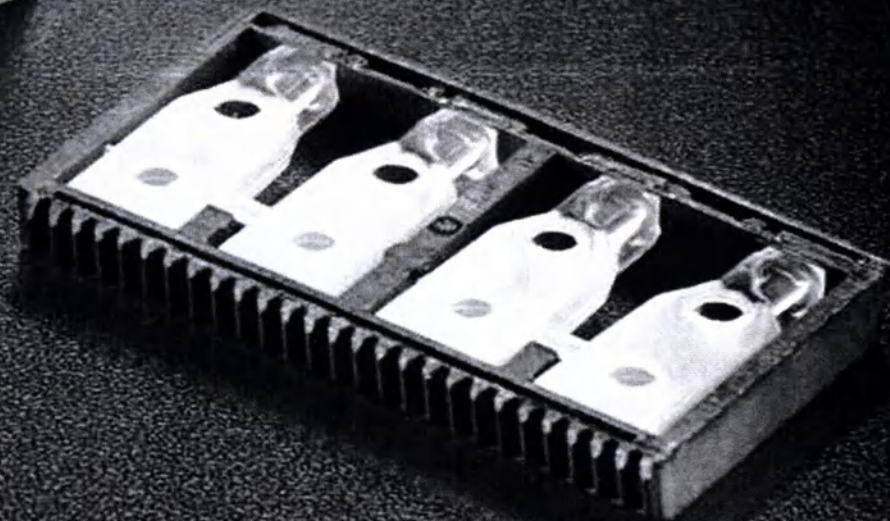


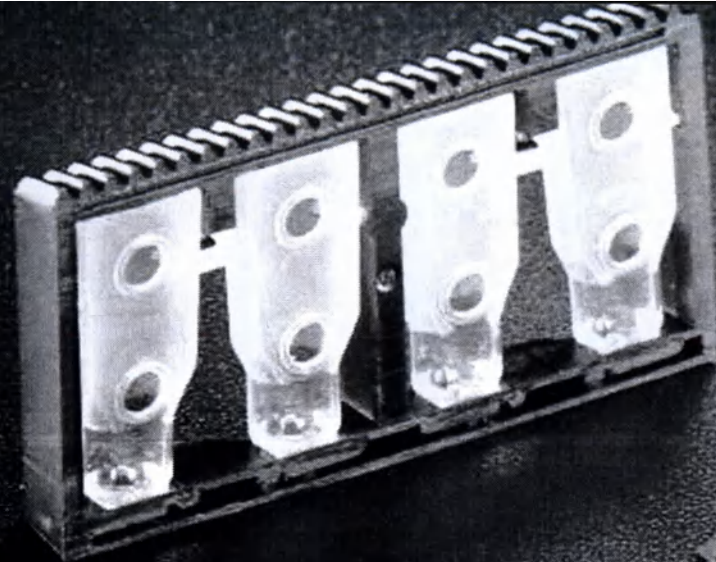

A01


Рис.1. Кювета для лабораторного анализа одноразовая стерильная из пластика.

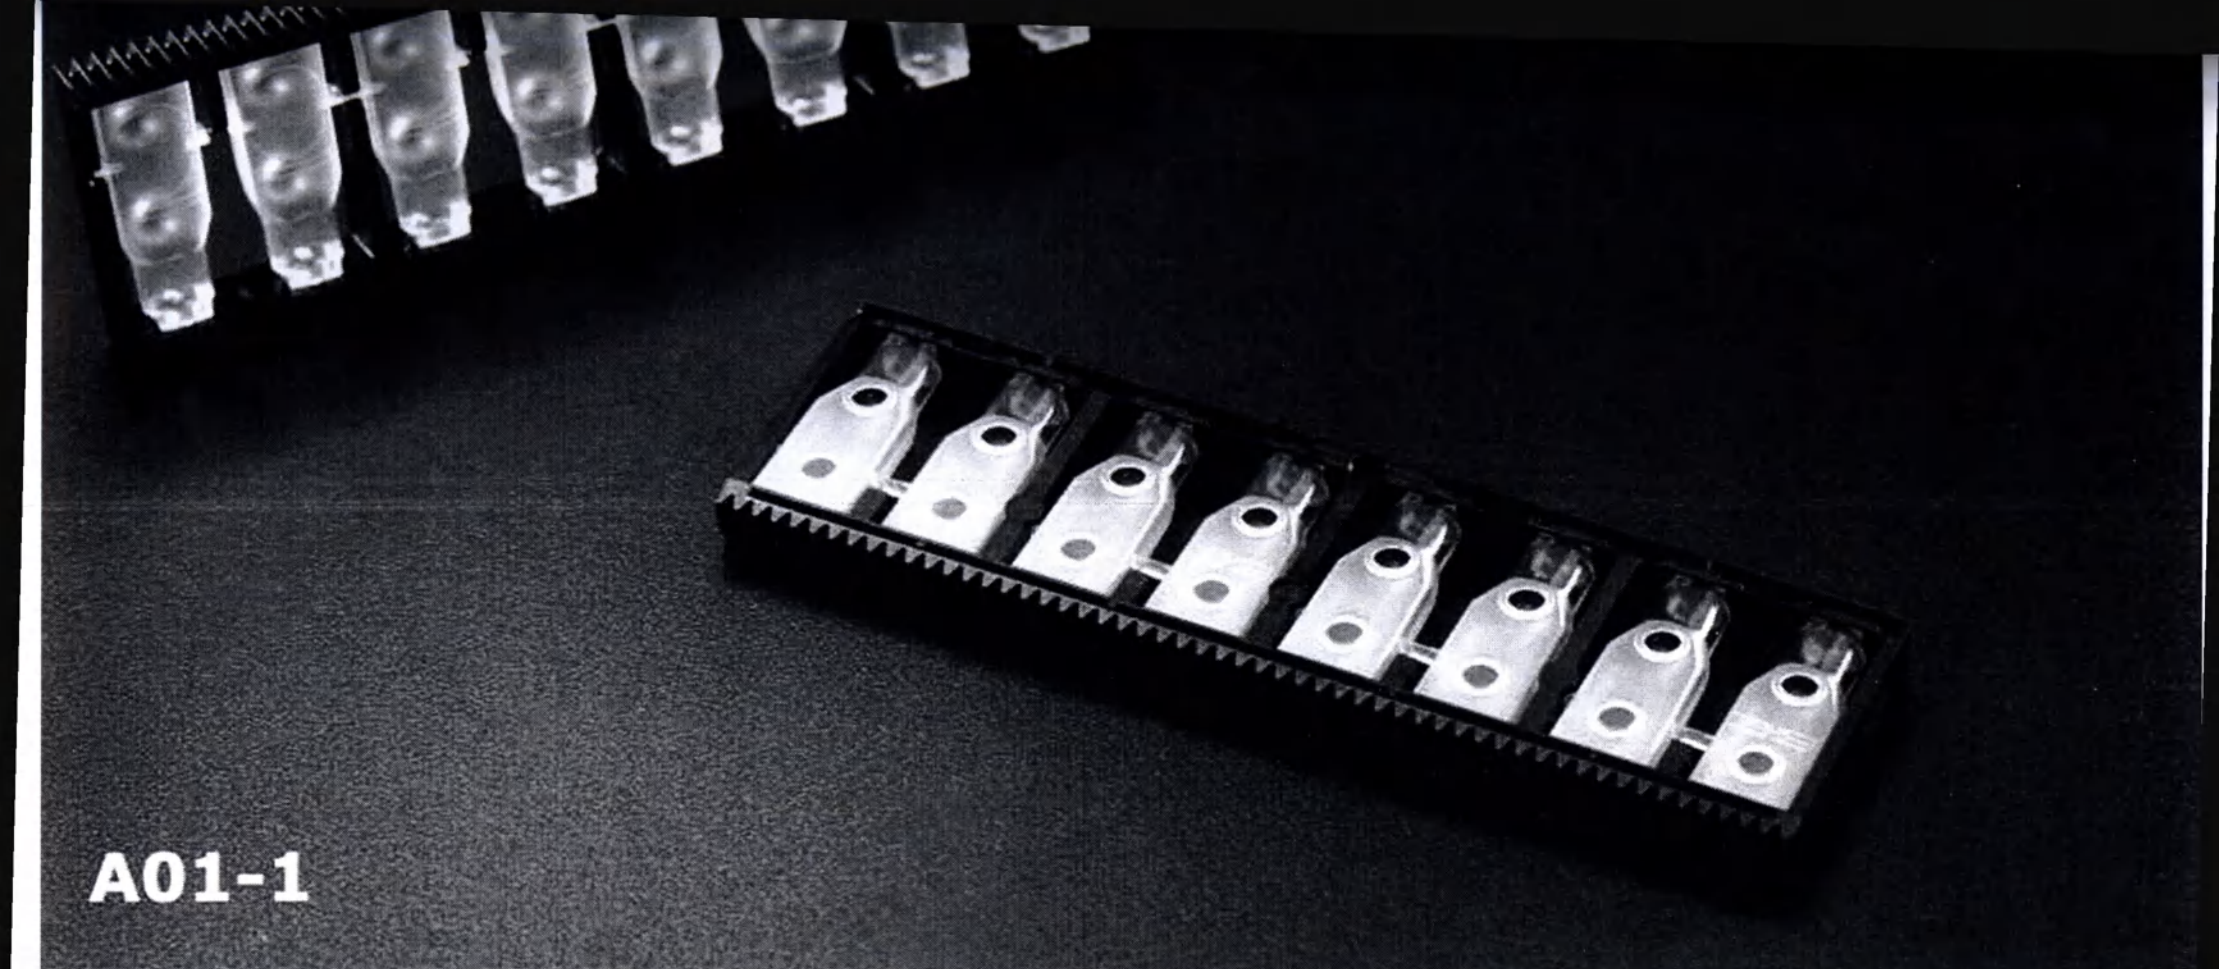


A01-1

Рис.2. Кювета для лабораторного анализа одноразовая стерильная из пластика.

A02
A02-1

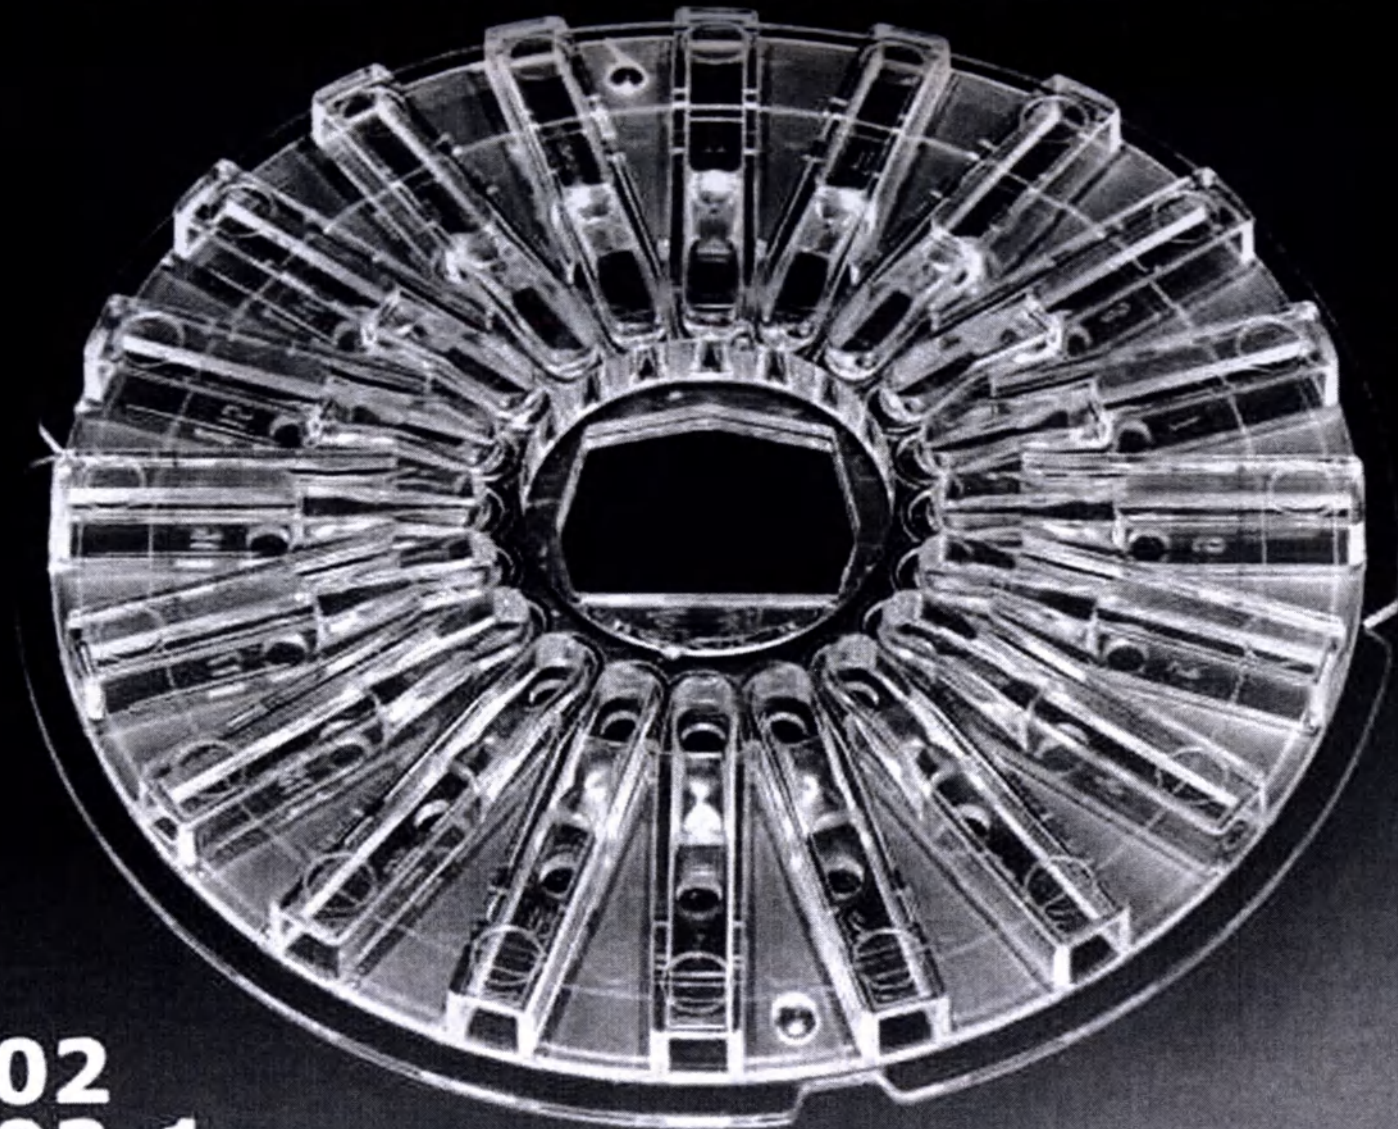

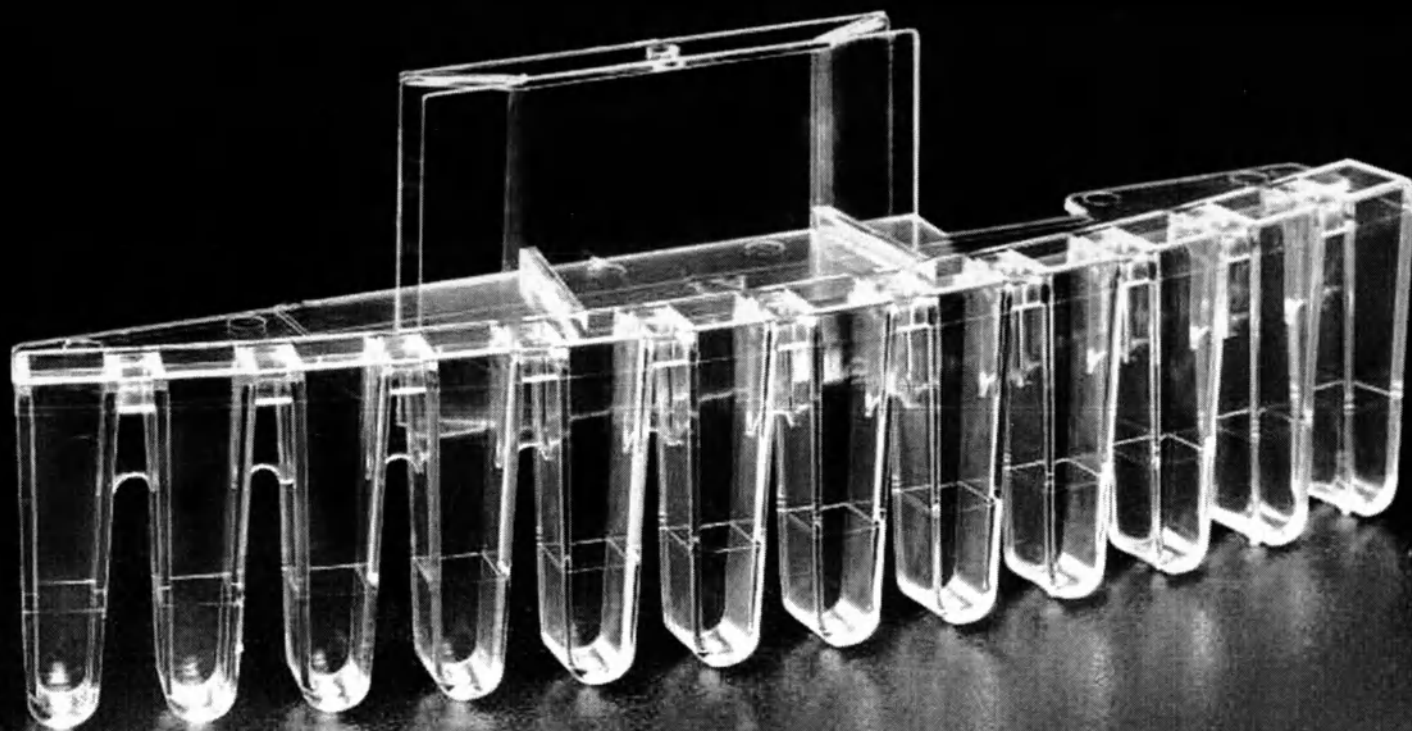

A03

Рис.4. Кювета для лабораторного анализа одноразовая стерильная из пластика.

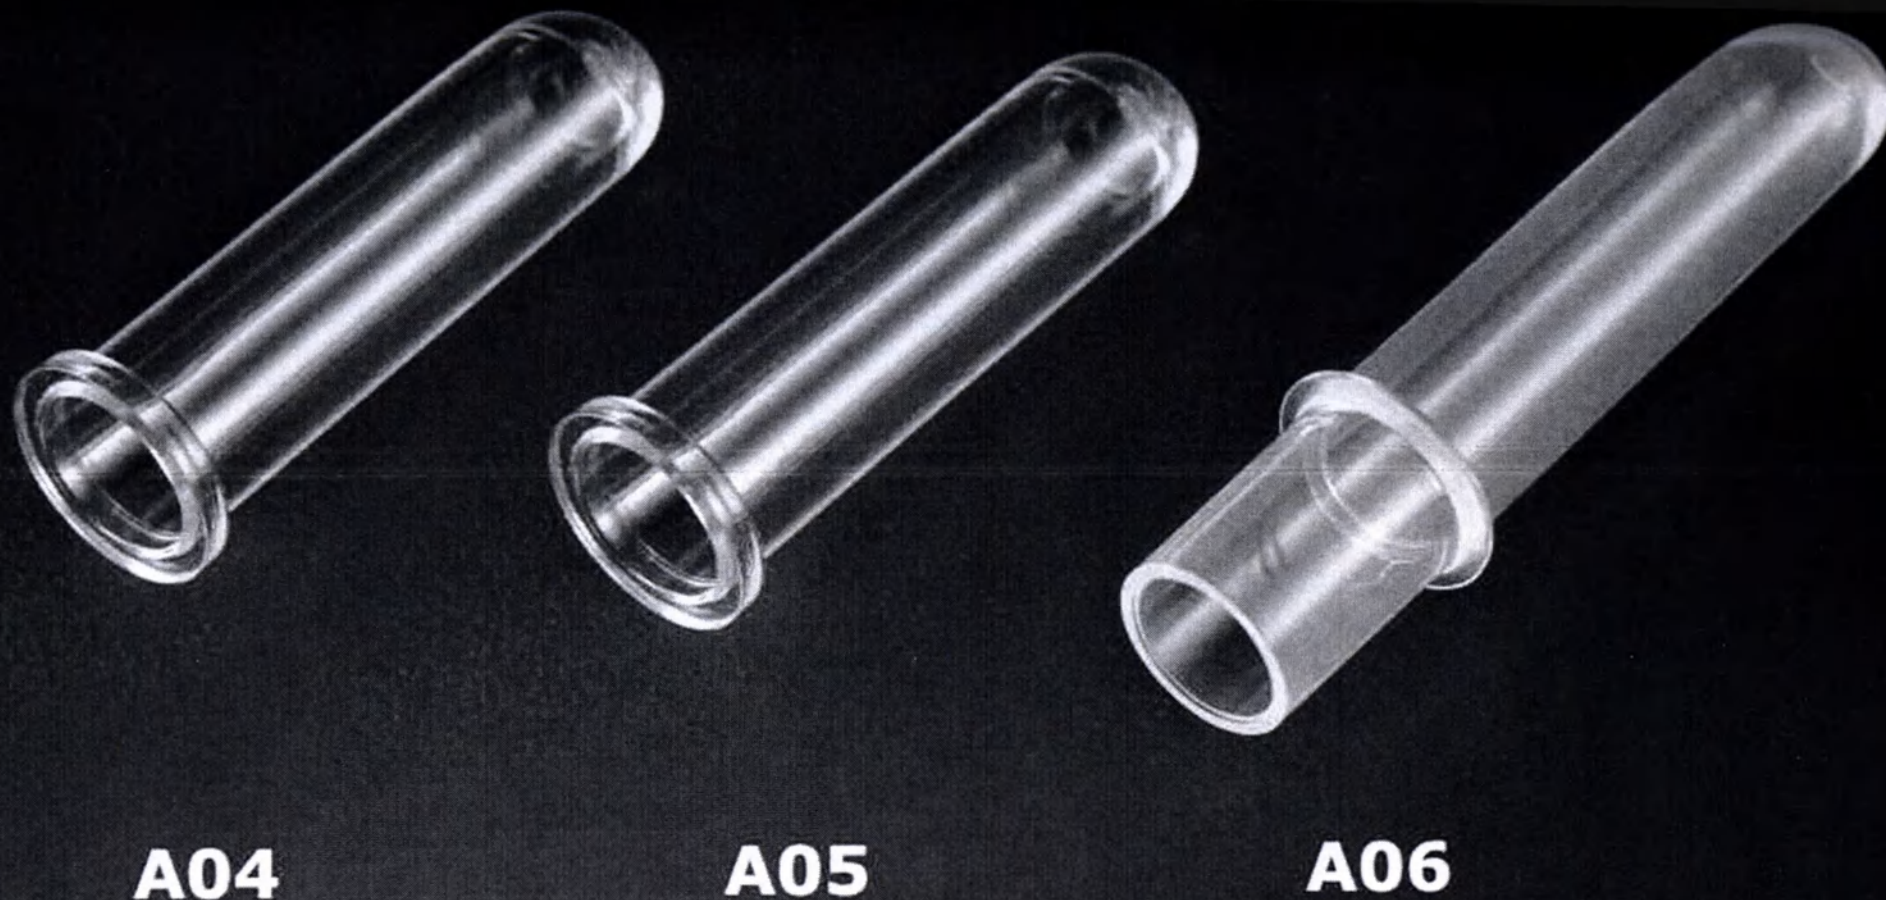


Рис.5. Кювета для лабораторного анализа одноразовая стерильная из пластика.



A07

Рис.6. Кювета для лабораторного анализа одноразовая стерильная из пластика.



A08



A09




A09-1




A09-2

Рис. 7. Кювета для лабораторного анализа одноразовая стерильная из пластика.

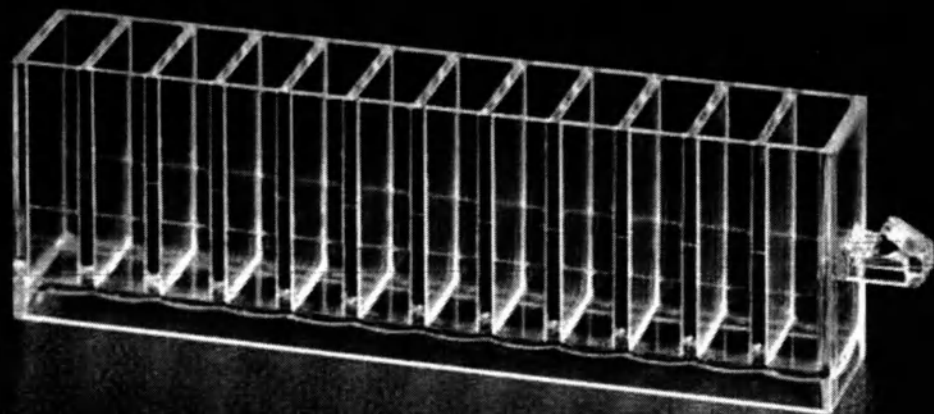


A11
A11-1

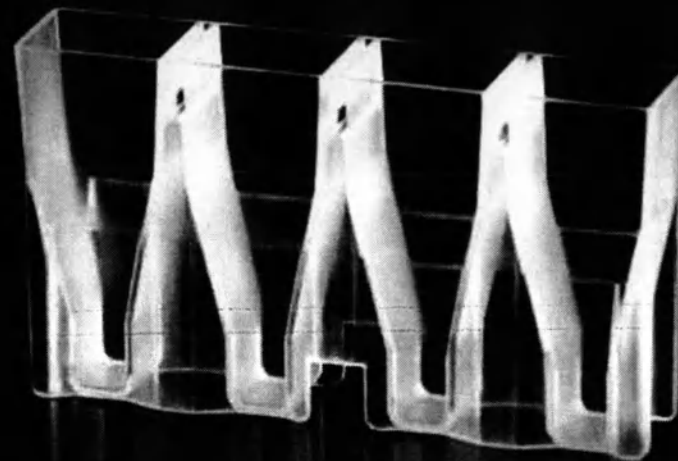


A12

Рис.8. Кювета для лабораторного анализа одноразовая стерильная из пластика.

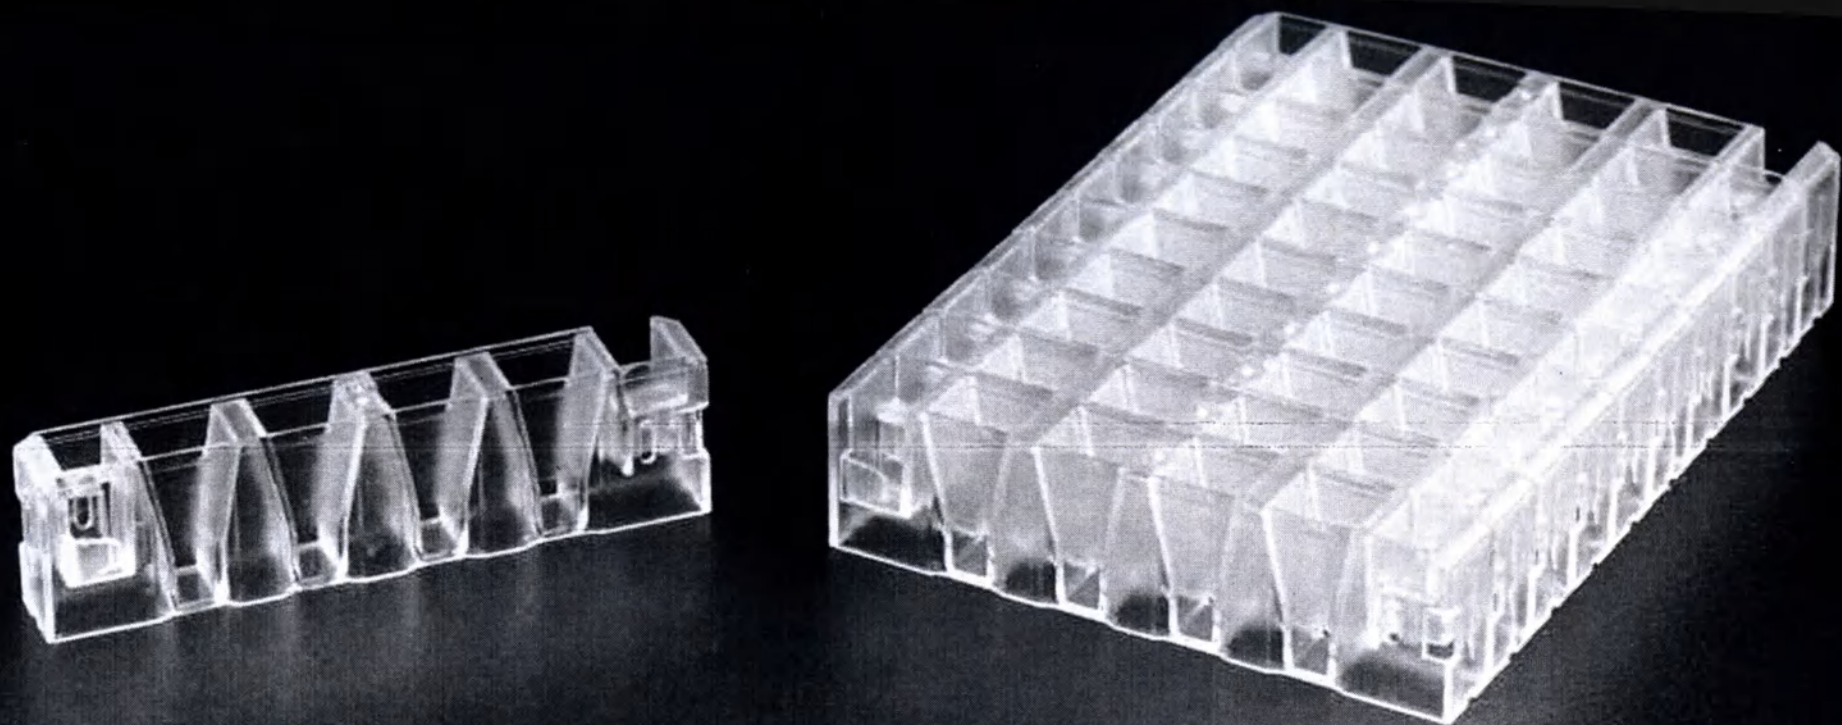


A13

Рис.9. Кювета для лабораторного анализа одноразовая стерильная из пластика.

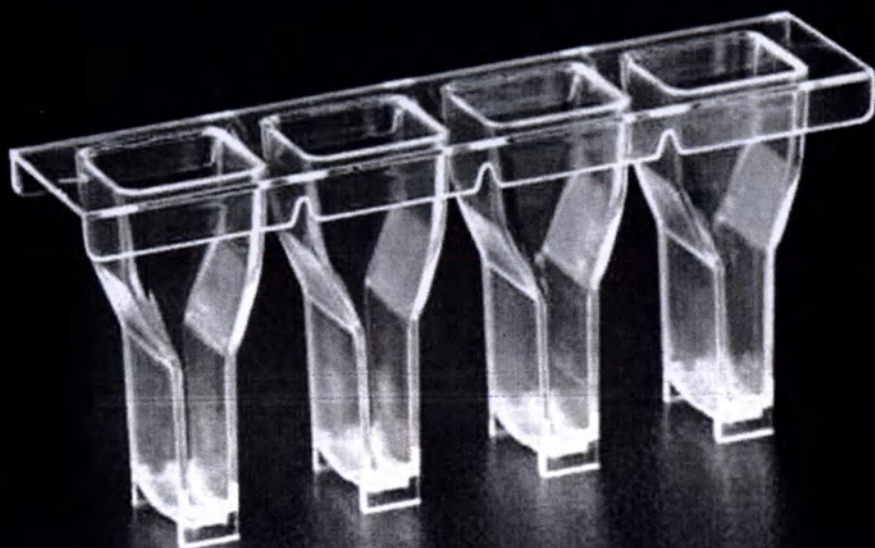

A14

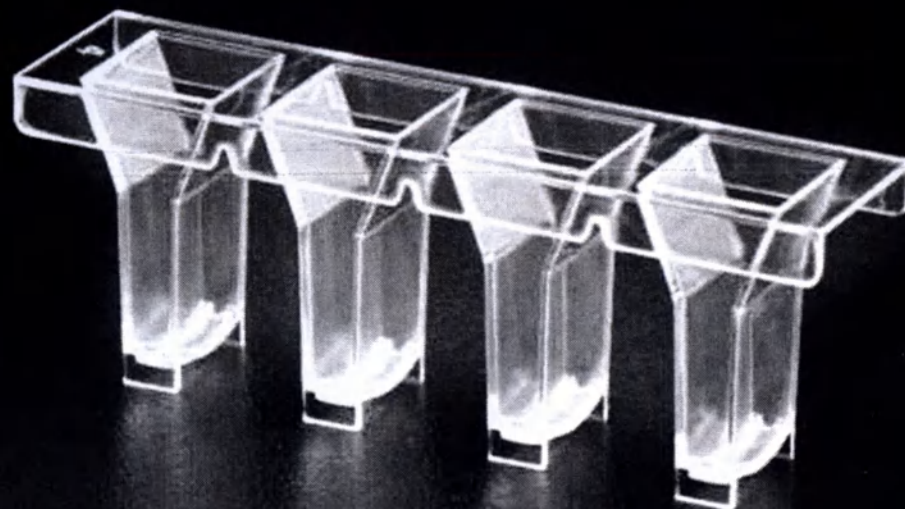

A15

Рис.10. Кювета для лабораторного анализа одноразовая стерильная из пластика.

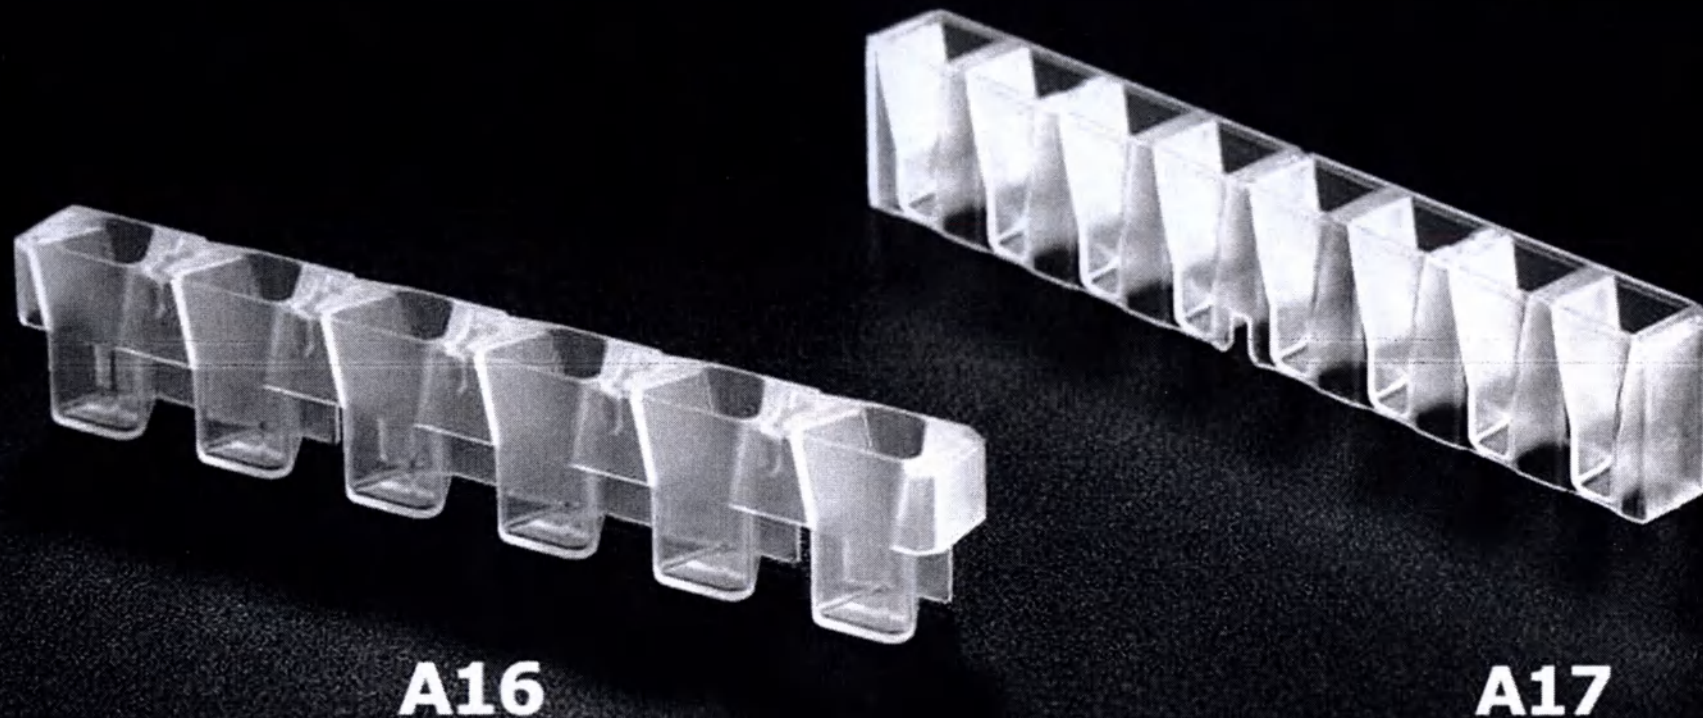


Рис.11. Кювета для лабораторного анализа одноразовая стерильная из пластика.



A18



A19



A20


Рис.12. Кювета для лабораторного анализа одноразовая стерильная из пластика.



A21



A22

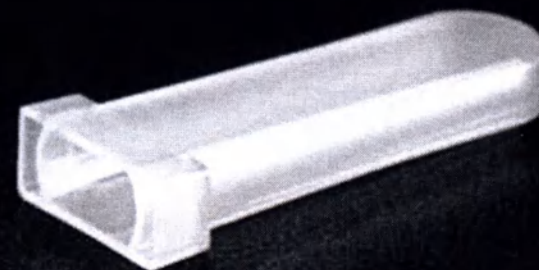

A23

Рис.13. Кювета для лабораторного анализа одноразовая стерильная из пластика.


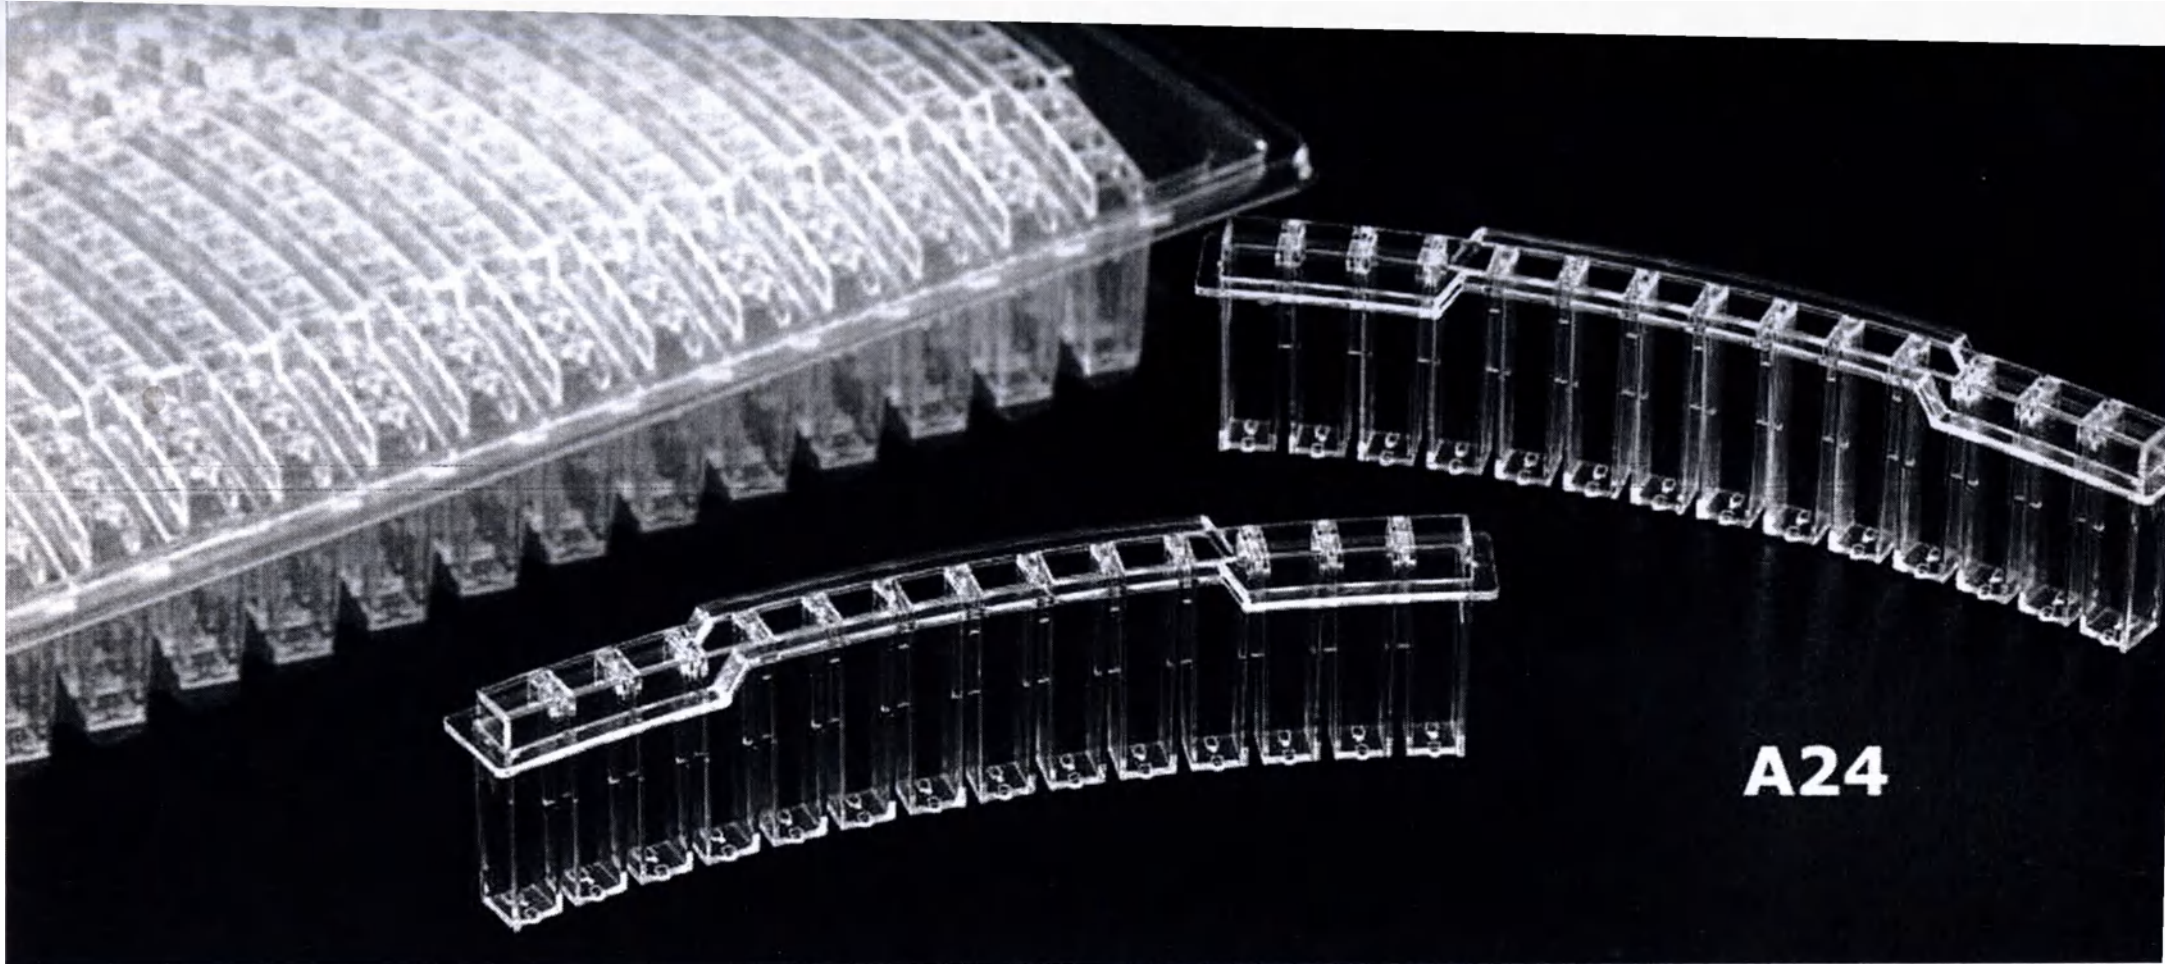


Рис.14. Кювета для лабораторного анализа одноразовая стерильная из пластика.



A25

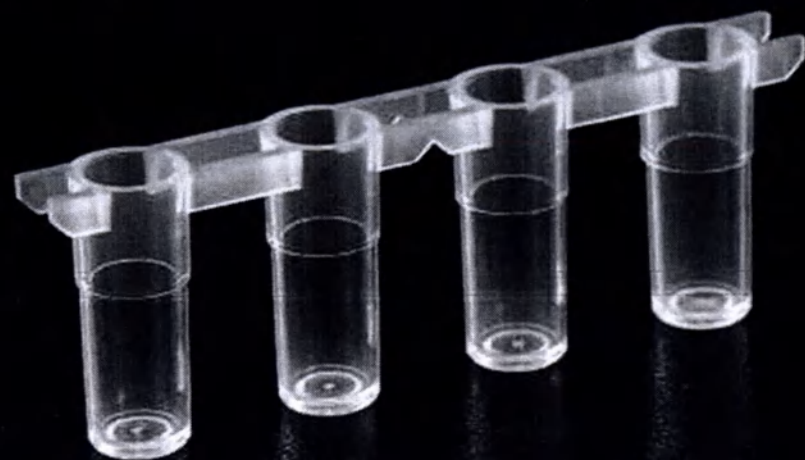

A25-1



A25-2

Рис.15. Кювета для лабораторного анализа одноразовая стерильная из пластика.



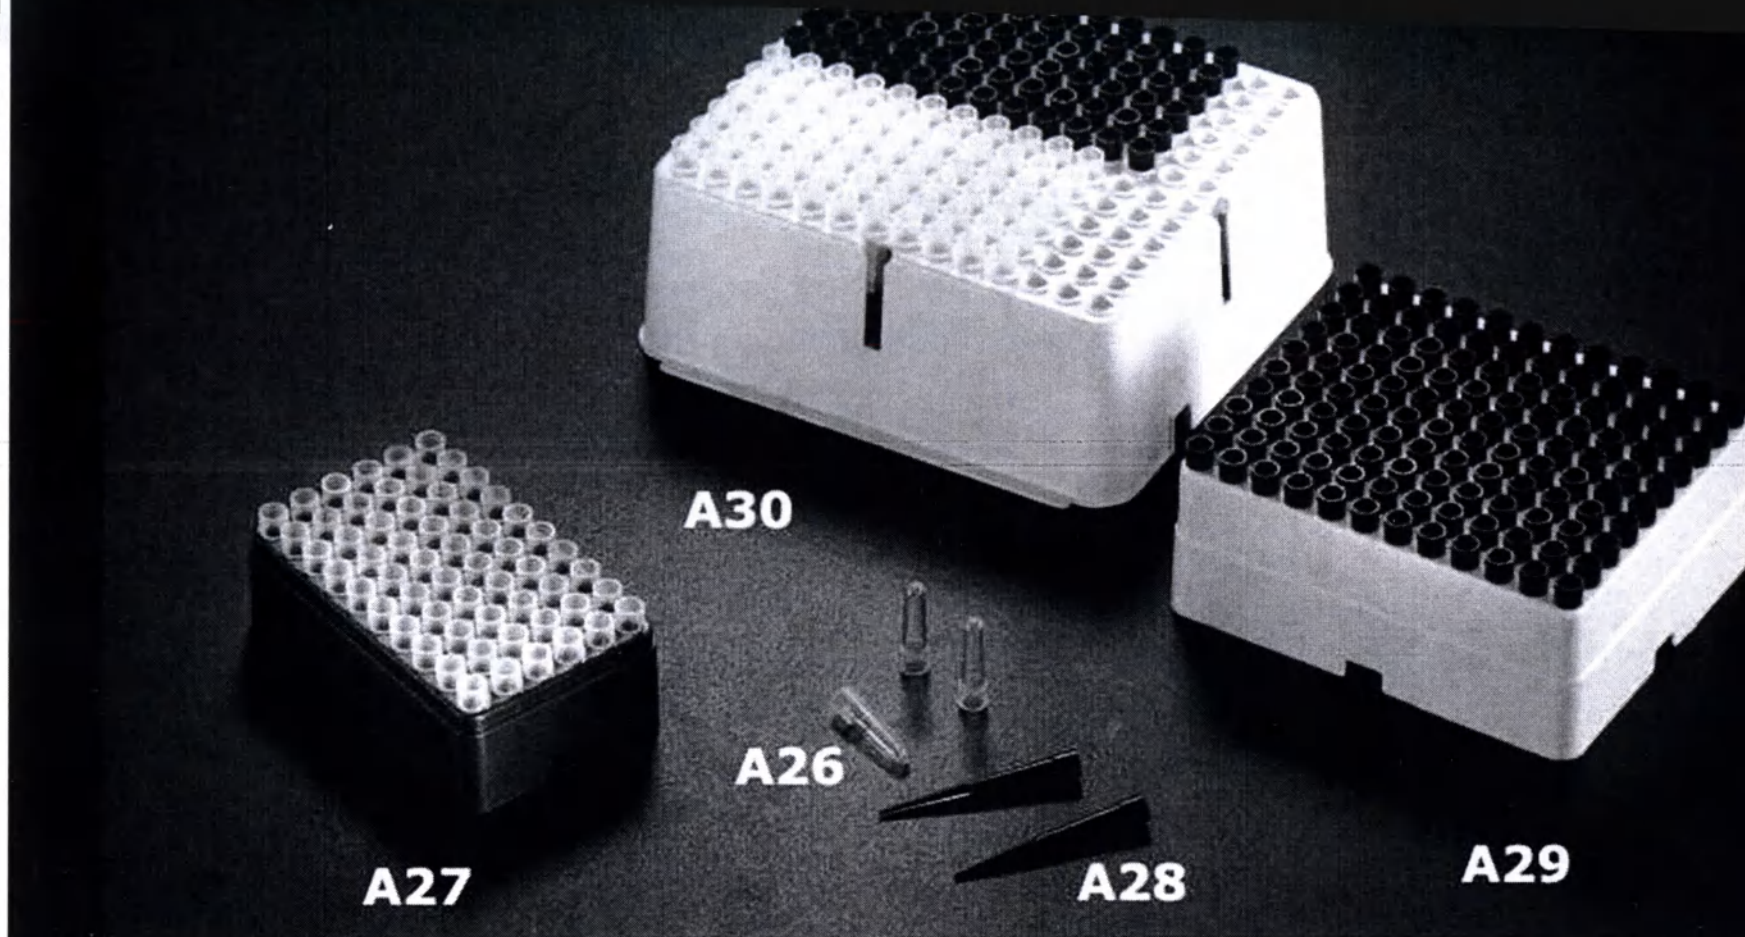


Рис.16. Кювета для лабораторного анализа одноразовая стерильная из пластика.



A31

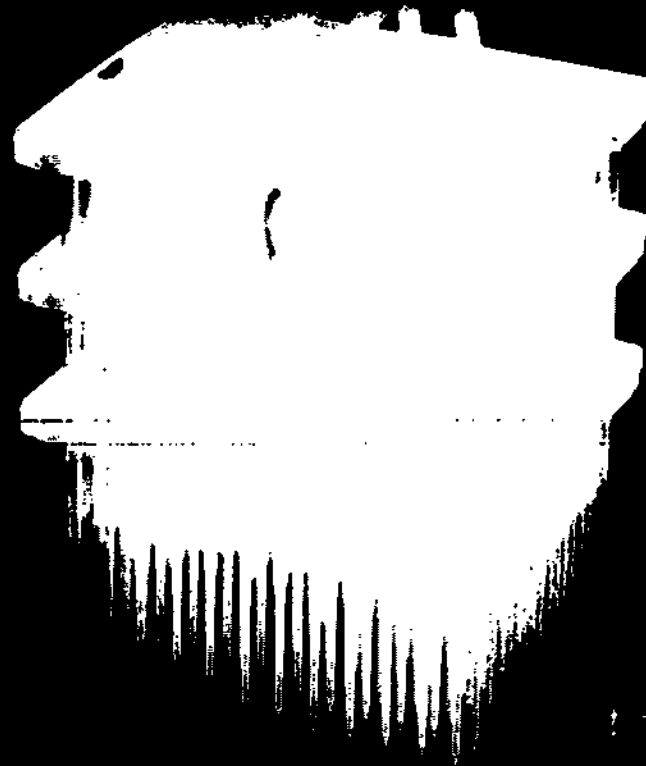

A32

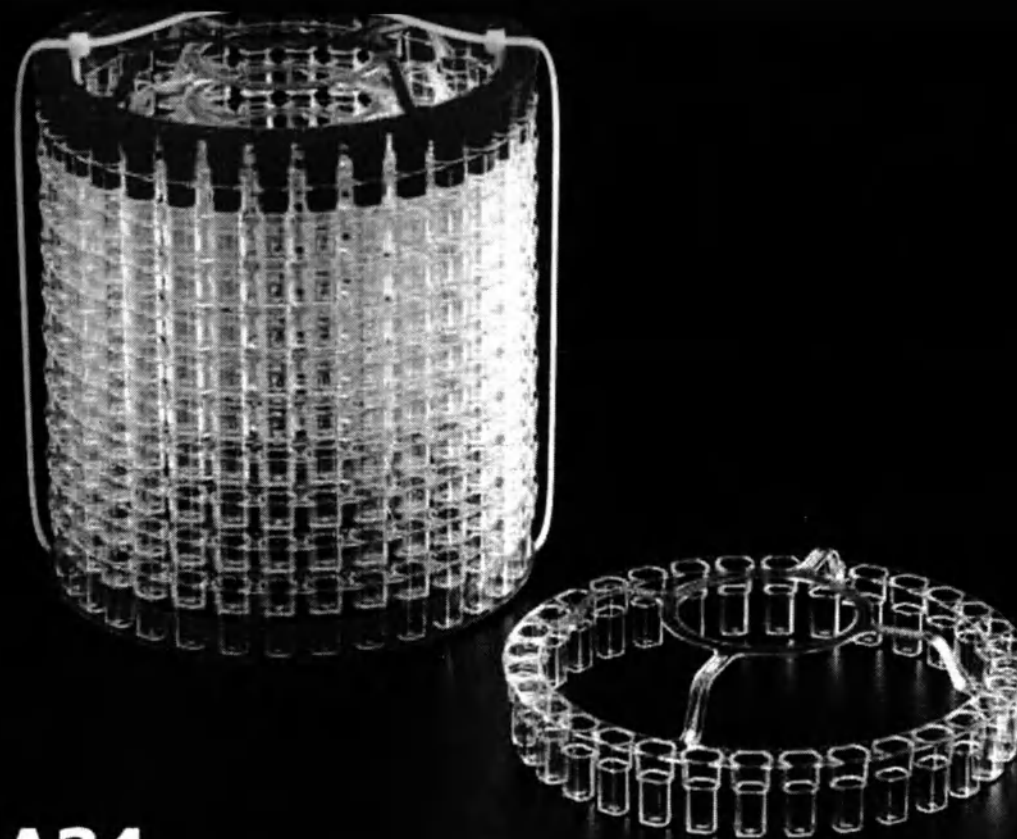


Рис.17. Кювета для лабораторного анализа одноразовая стерильная из пластика.

A33

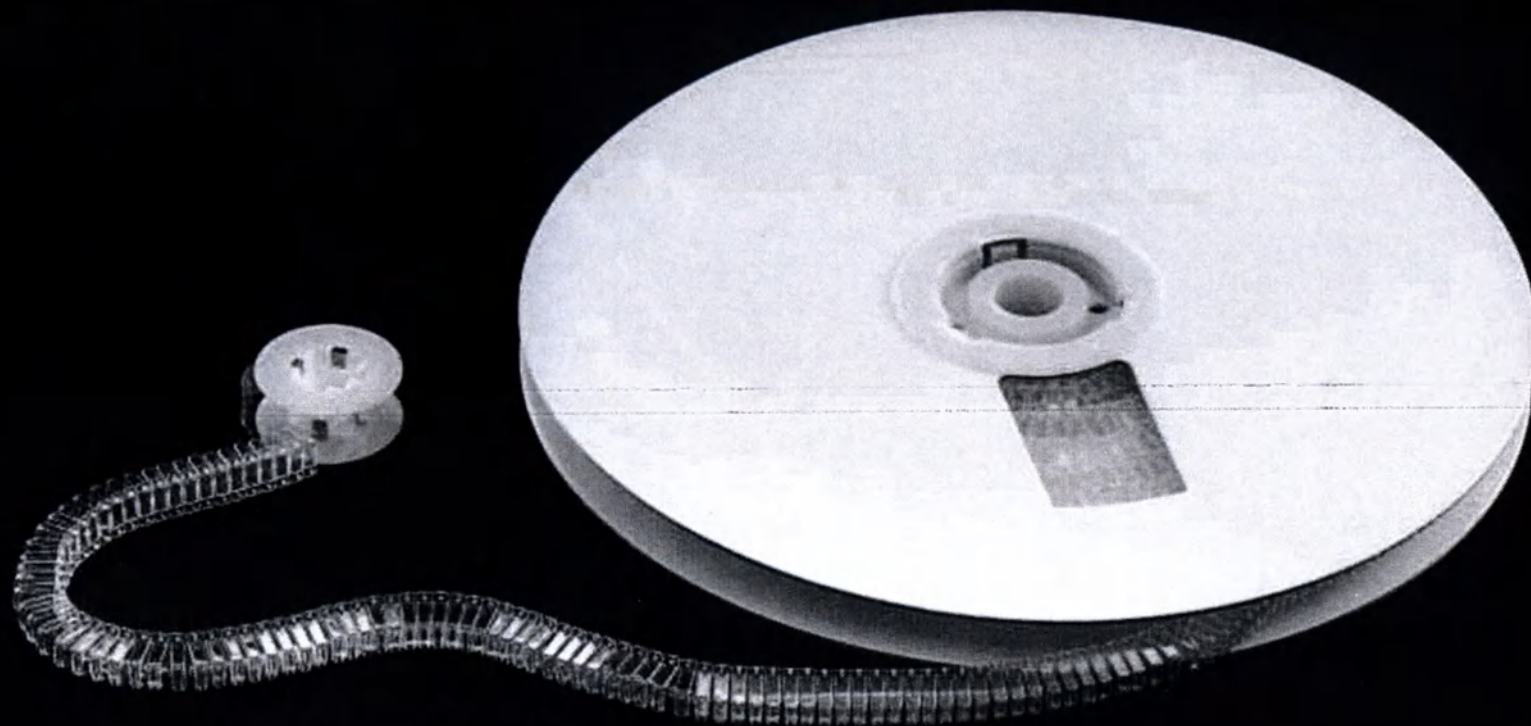


Рис.18. Кювета для лабораторного анализа одноразовая стерильная из пластика.



A34

Рис.19. Кювета для лабораторного анализа одноразовая стерильная из пластика.



A35

Рис. 20. Кювета для лабораторного анализа одноразовая стерильная из пластика.

A36



Рис.21. Кювета для лабораторного анализа одноразовая стерильная из пластика.

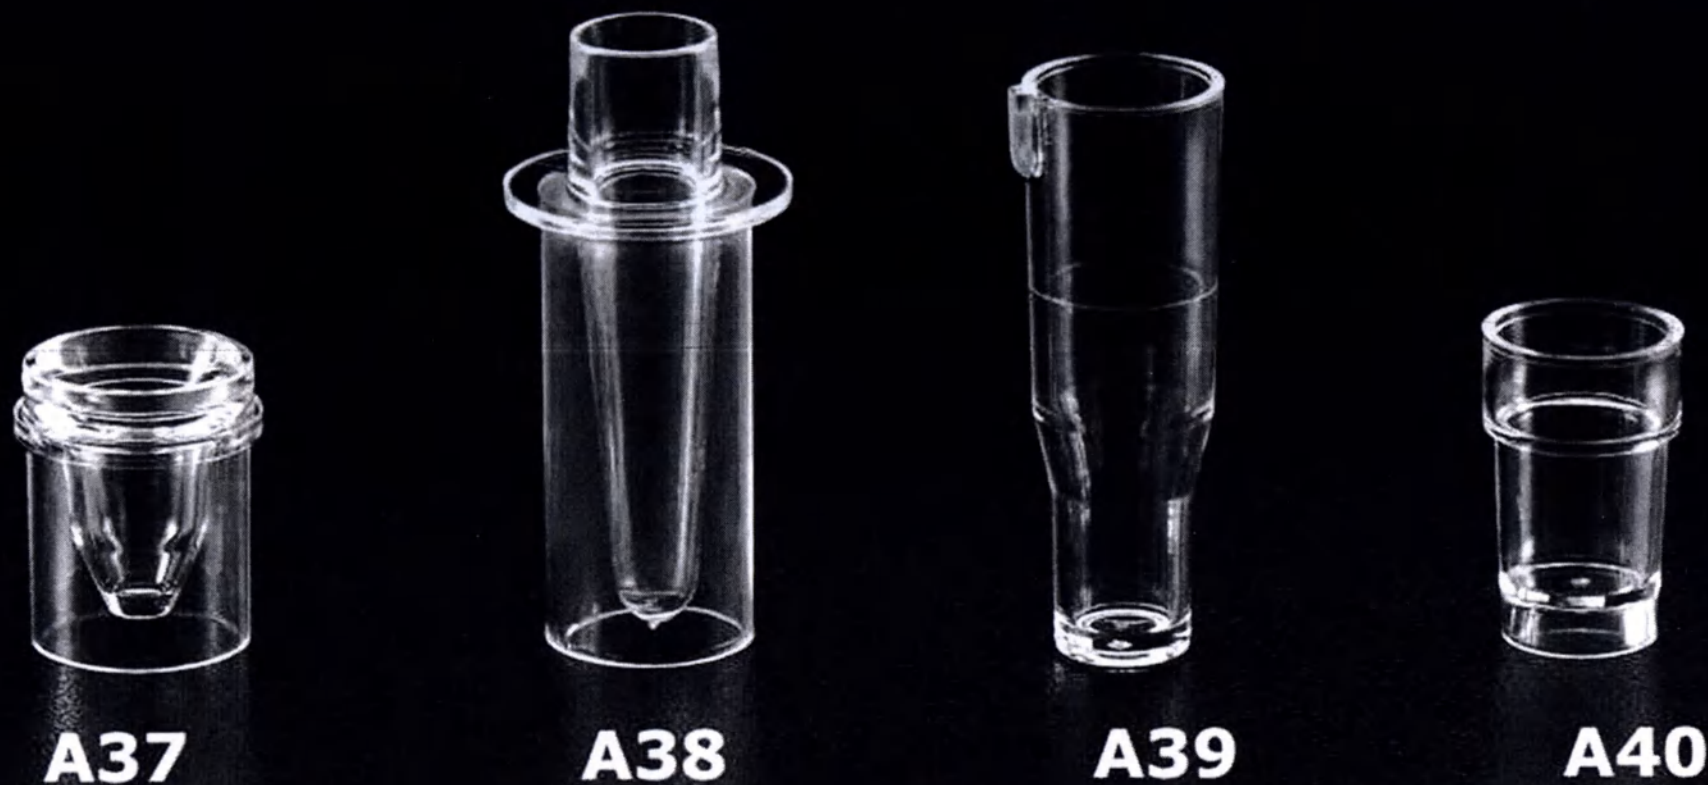


Рис.22. Кювета для лабораторного анализа одноразовая стерильная из пластика.




A41

Рис.23. Кювета для лабораторного анализа одноразовая стерильная из пластика.



Рис.24. Кювета для лабораторного анализа одноразовая стерильная из пластика.

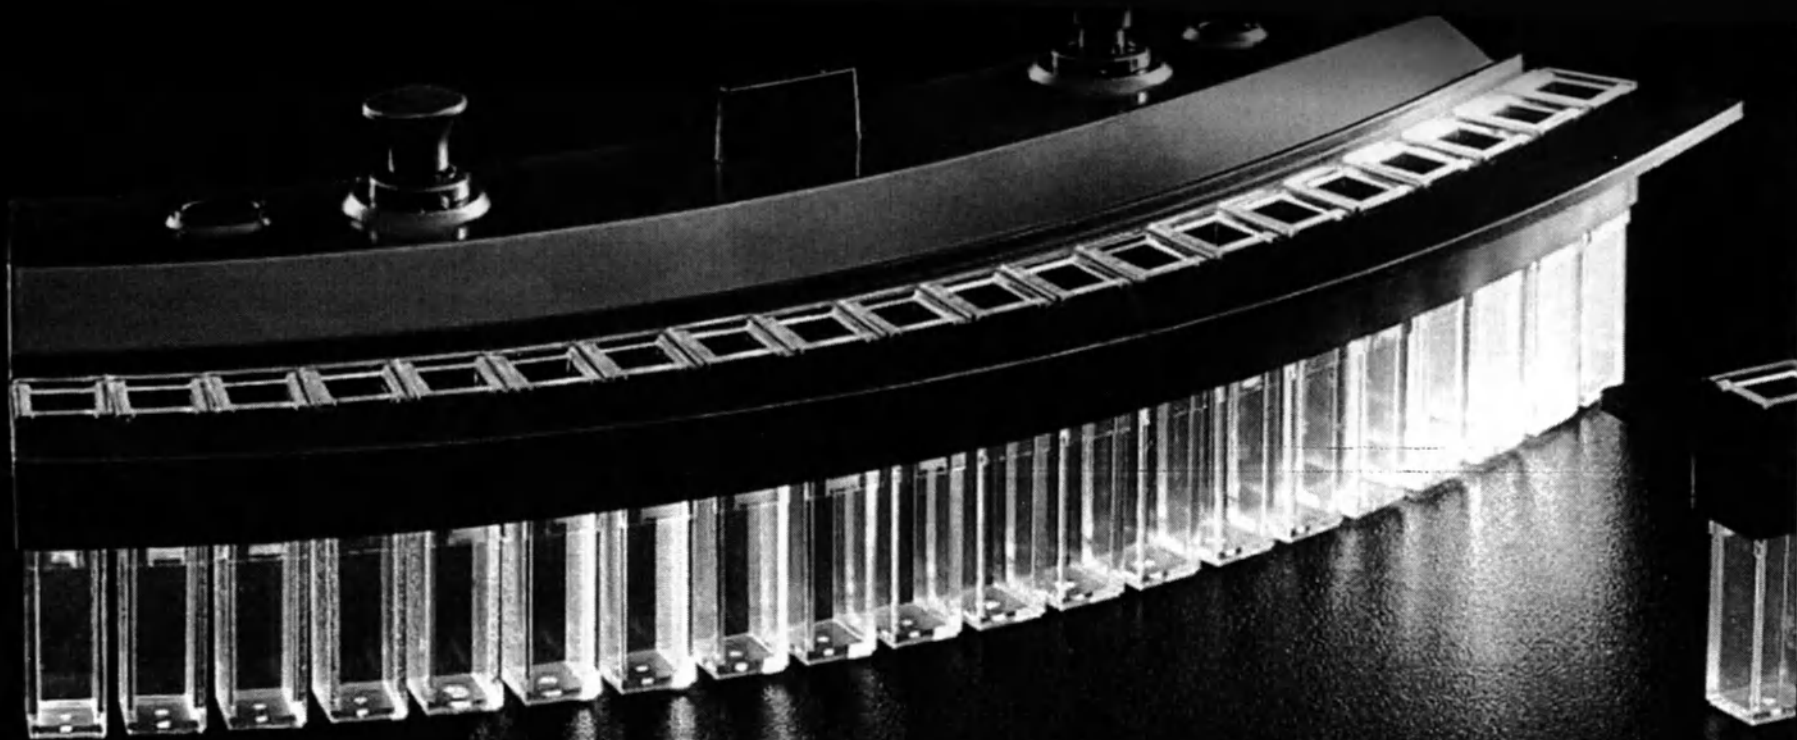

A43

Рис.25. Кювета для лабораторного анализа одноразовая стерильная из пластика.

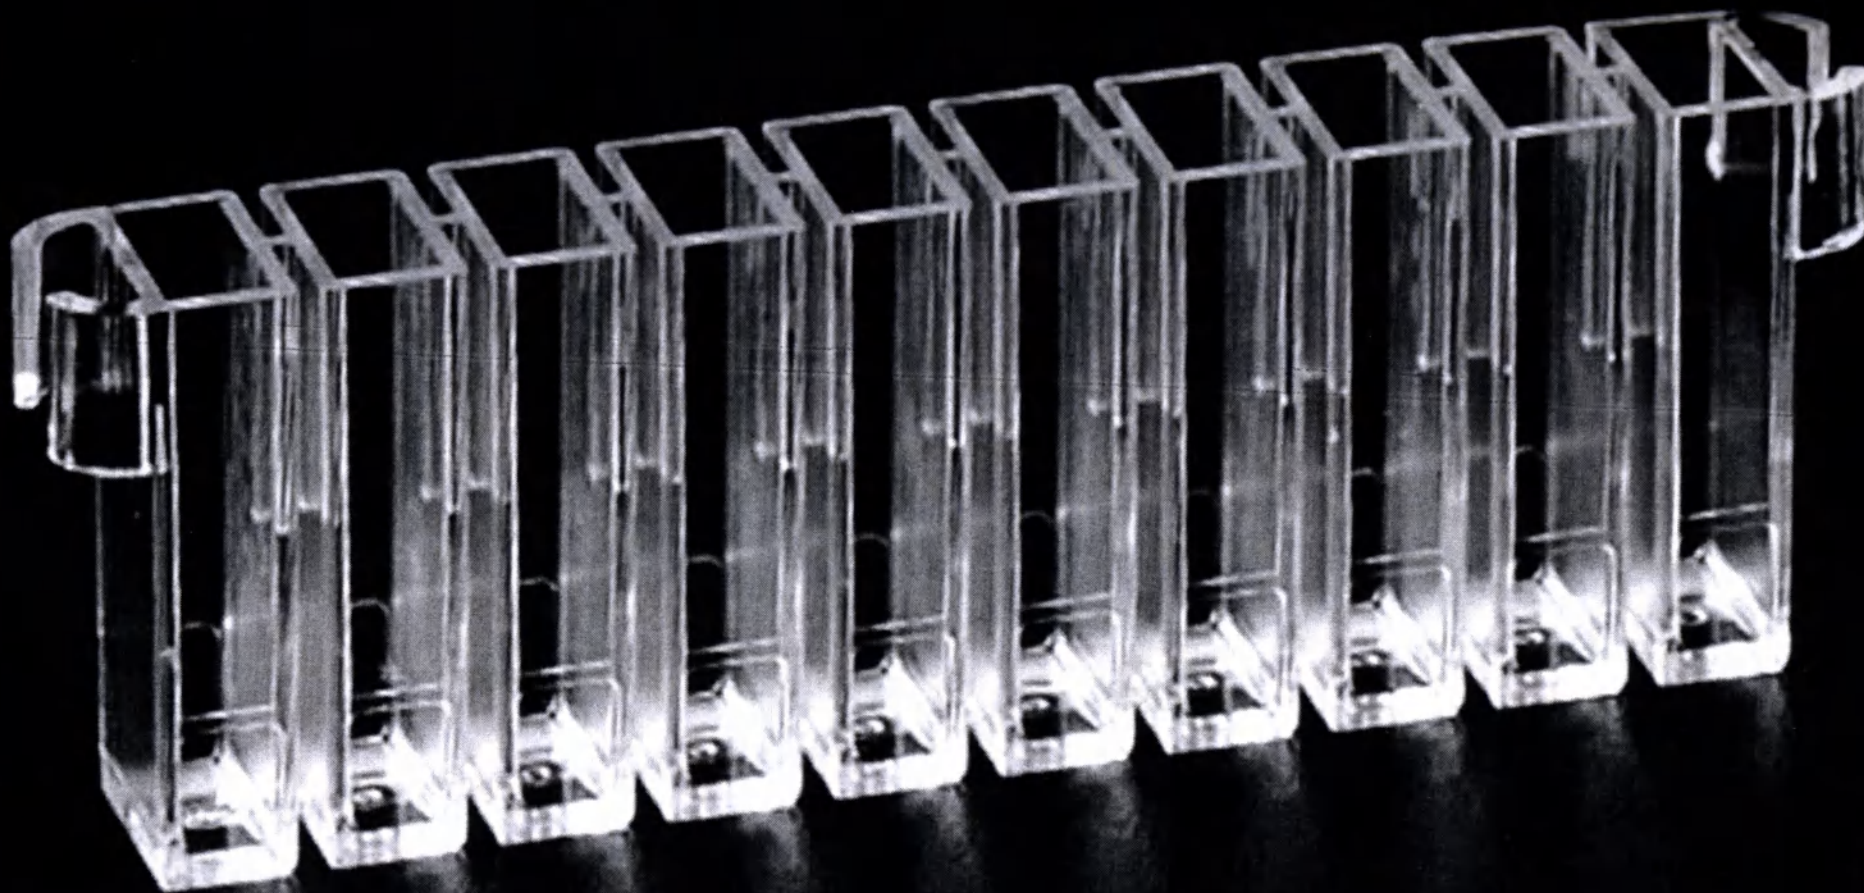


Рис.26. Кювета для лабораторного анализа одноразовая стерильная из пластика.

Кювета для лабораторного анализа одноразовая стерильная из пластика

Z, 1.5 мл

Количество: 100 шт/упак

LOT AE22343

REF A37



2015-02



2017-02



Zhejiang Aicor Medical Technology Co., Ltd
No.48 Jingang Road, Jiangkou Development Area, Huangyan
Taizhou, Zhejiang 318020, China.




Рис.27. Кювета для лабораторного анализа одноразовая стерильная из пластика – Маркировка.

Всего прошито, проклеено и скреплено
печатью и подписью 22 листов (-а)

Директор
ООО «Самас»

Фадеев О.Г.

