




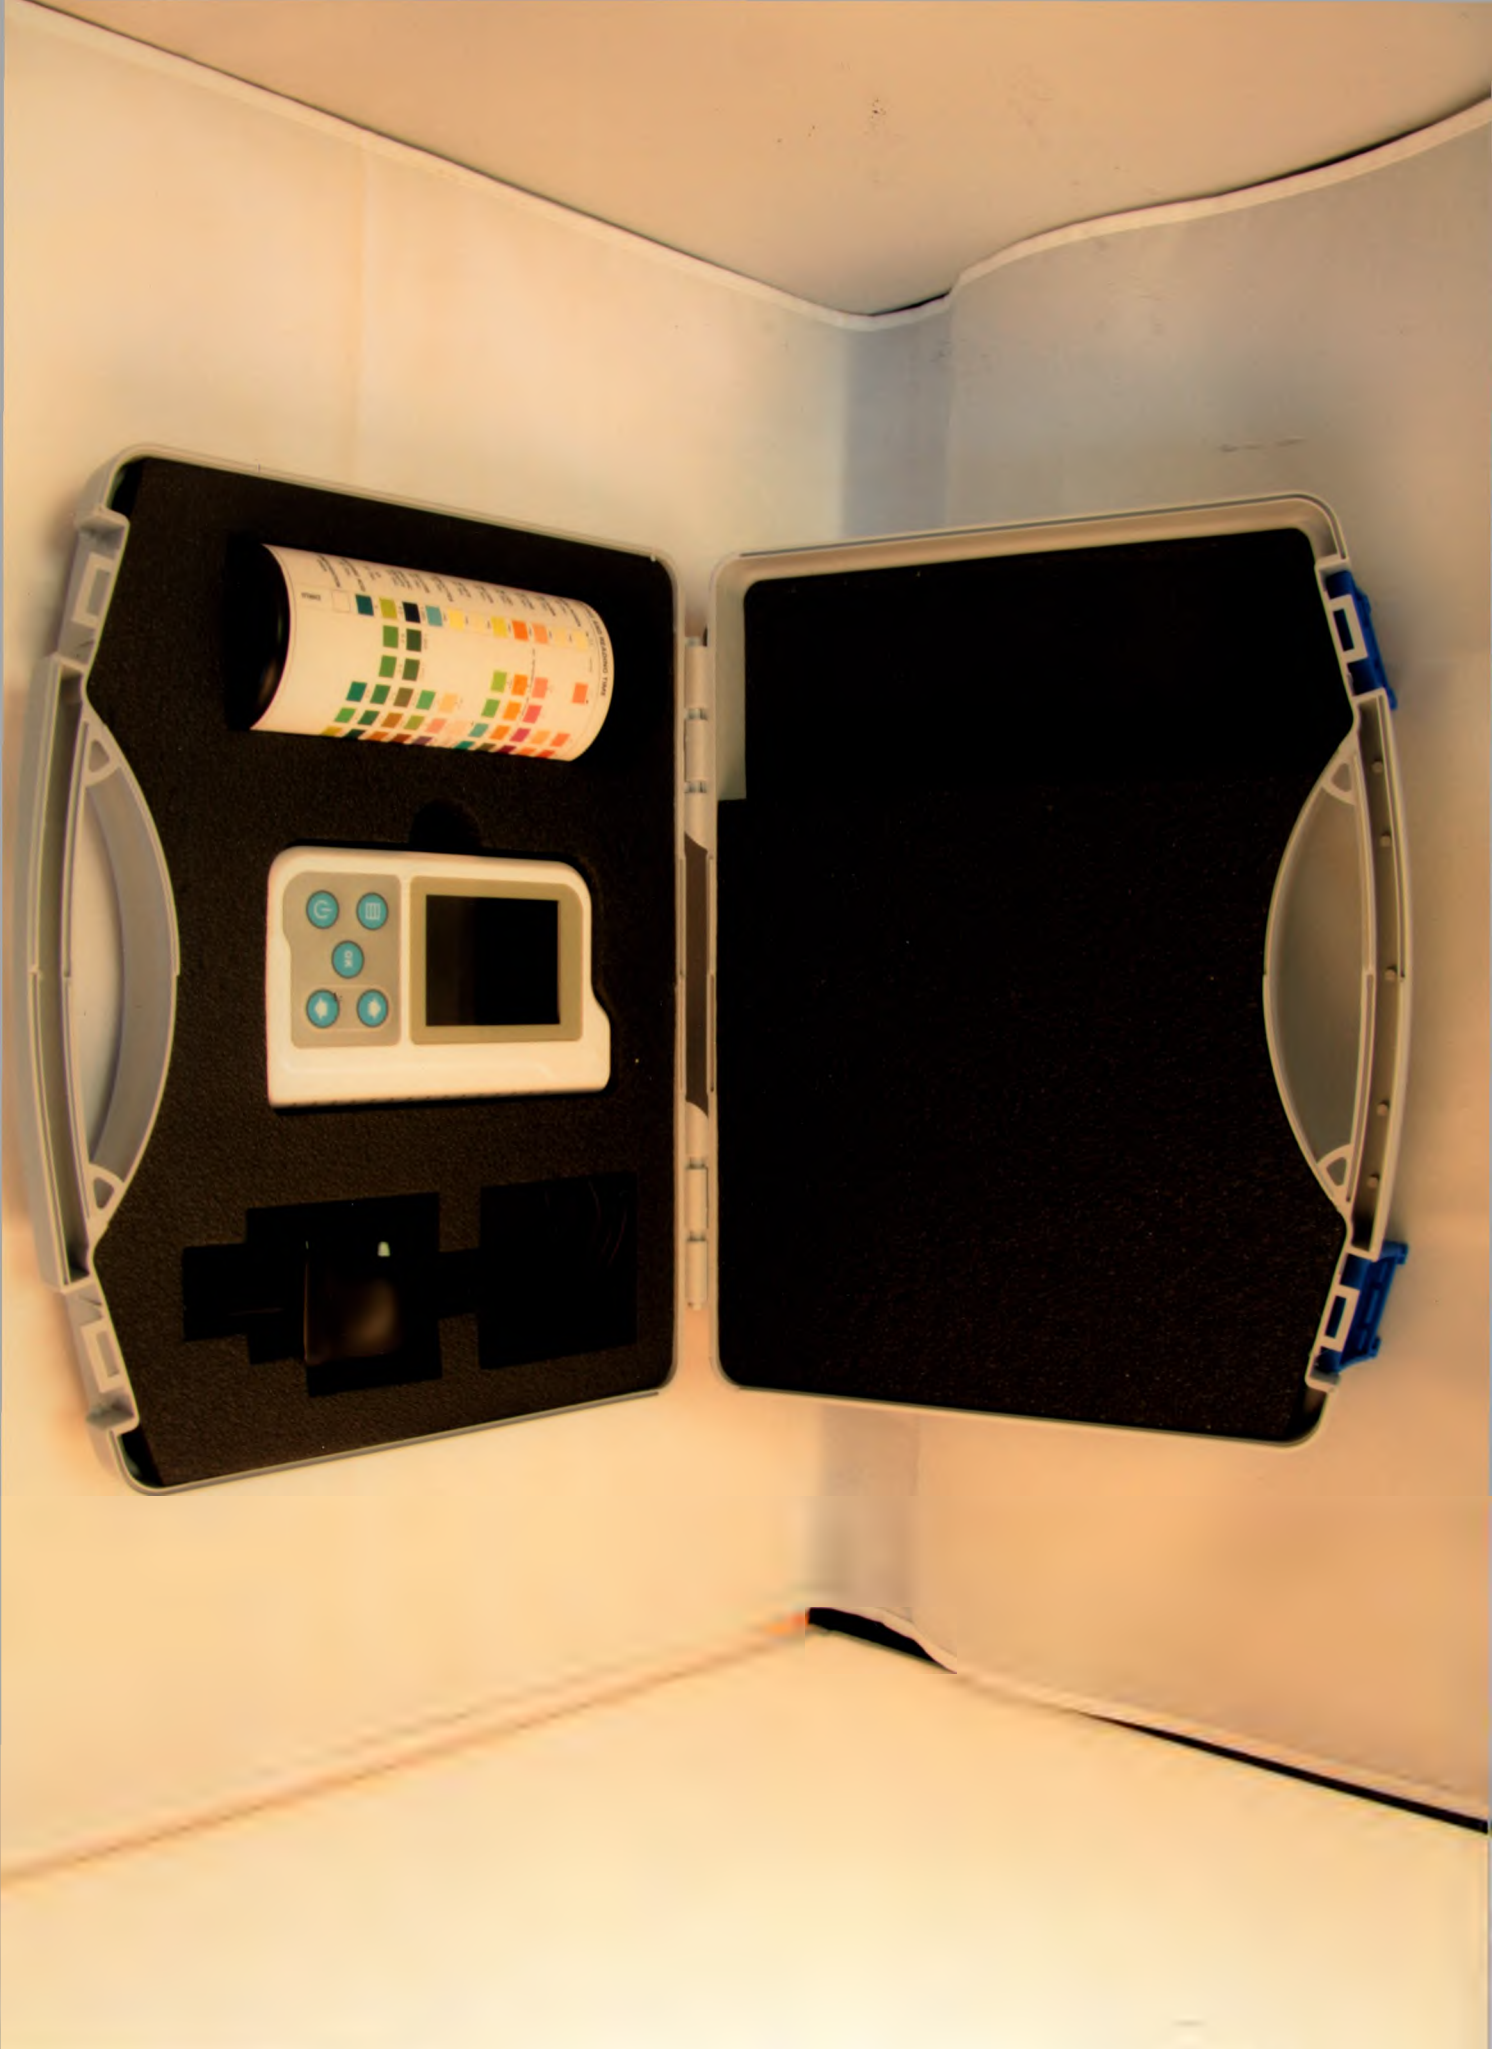

DIRIN LAKSHI  
PUSH H

Фото 2. . Внешний вид анализатора мочи «ЭТТА АМП-01» по ТУ 9443-001-17140544-

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU юй кассетой и тест-полоской.



Фото 3. Анализатор мочи «ЭТТА АМП-01 по ТУ 9443-001-17140544-2015, задняя часть и этикетка.

ООО ЦИРМИ [info@cirmi.ru](mailto:info@cirmi.ru) [www.goszdravnadzor.ru](http://www.goszdravnadzor.ru)