

2017-01-21

SN 499293

60D142-300

Boston
Scientific




INOGEN™ EL ICD

REF D142

Кардиовертер-дефибриллятор
имплантируемый
двухкамерный с
принадлежностями



IS-1
BI
DF4-LLHH



www.bostonscientific-international.com/manuals



STERILE EO



2015-01-30

SN

499293



2017-01-21

LOT

A15103



CE0086

N 20593
Z 1088

Canada 310
IC 4794A-CRMG1792
402 - 405 MHz
Made in Ireland



Boston Scientific
4100 Hamline Avenue North
St Paul, MN 55112-5798 USA



Guidant Europe NV/SA, Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium



15528-001
EN EU

Рис. 1. Кардиовертер-дефибриллятор имплантируемый двухкамерный. Внешняя упаковка. Вид спереди

Boston
Scientific

INOGEN™ EL ICD DR

REF

D142



İmplantе Edilеbilir Kardiyoverter Defibrilatör DR
Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор DR

Çözümler için lütfen bizi arayın

Запросите спецификацию

Taşı Modu Storage (Saklama)	Rejim değişiklikleri için taktirler Storage (Хранение)
Taşı Tedavisi Kullanılabilir Shock (Şok), ATP	Yükseklik, taktirler Shock (Şok), ATP
Pacing Modu Storage (Saklama)	Rejim değişiklikleri için taktirler Storage (Хранение)
Pacing Tedavisi DDDR	DDDR
Sensor Accelerometer (Akselerometre)	Sensor Accelerometer (Akselerometre)
PaceSense Konfigürasyonu RA: B/BI RV: B/BI	Konfigürasyon (Konfigürasyon) RA: B/BI RV: B/BI

Taşı Modu Storage (Saklama)	Rejim değişiklikleri için taktirler Storage (Хранение)
Taşı Tedavisi Kullanılabilir Shock (Şok), ATP	Yükseklik, taktirler Shock (Şok), ATP
Pacing Modu Storage (Saklama)	Rejim değişiklikleri için taktirler Storage (Хранение)
Pacing Tedavisi DDDR	DDDR
Sensor Accelerometer (Akselerometre)	Sensor Accelerometer (Akselerometre)
PaceSense Konfigürasyonu RA: B/BI RV: B/BI	Konfigürasyon (Konfigürasyon) RA: B/BI RV: B/BI



Bu sembolün daha geniş versiyonu telemetri
çubuğunun yerleşimini işaret eder
Крупное изображение этого символа сообщает
о положении телеметрической головки

Eğer kabin mührü bozulmuşsa, Boston Scientific içindekileri kredi veya geri almak için kabul etmeyecektir.
При повреждении упаковки Boston Scientific не принимает содержимое для возмещения финансовых претензий или возврата на склад

Tüm programlanabilir parametreler ve değerler için Sistem/Referans Klavyuzuna bakınız.
Все программируемые параметры и их значения см. в руководстве по работе с системой или справочном руководстве.
Dikkat: Mikatizler veya manyetik cihazlar yakınında tutulmalı.
Предупреждение: не хранить вблизи магнитов или магнитных приборов.

15554-001
TRRU Europe

Рис.2. Кардиовертер-дефибриллятор имплантируемый двухкамерный. Внешняя упаковка. Вид сзади

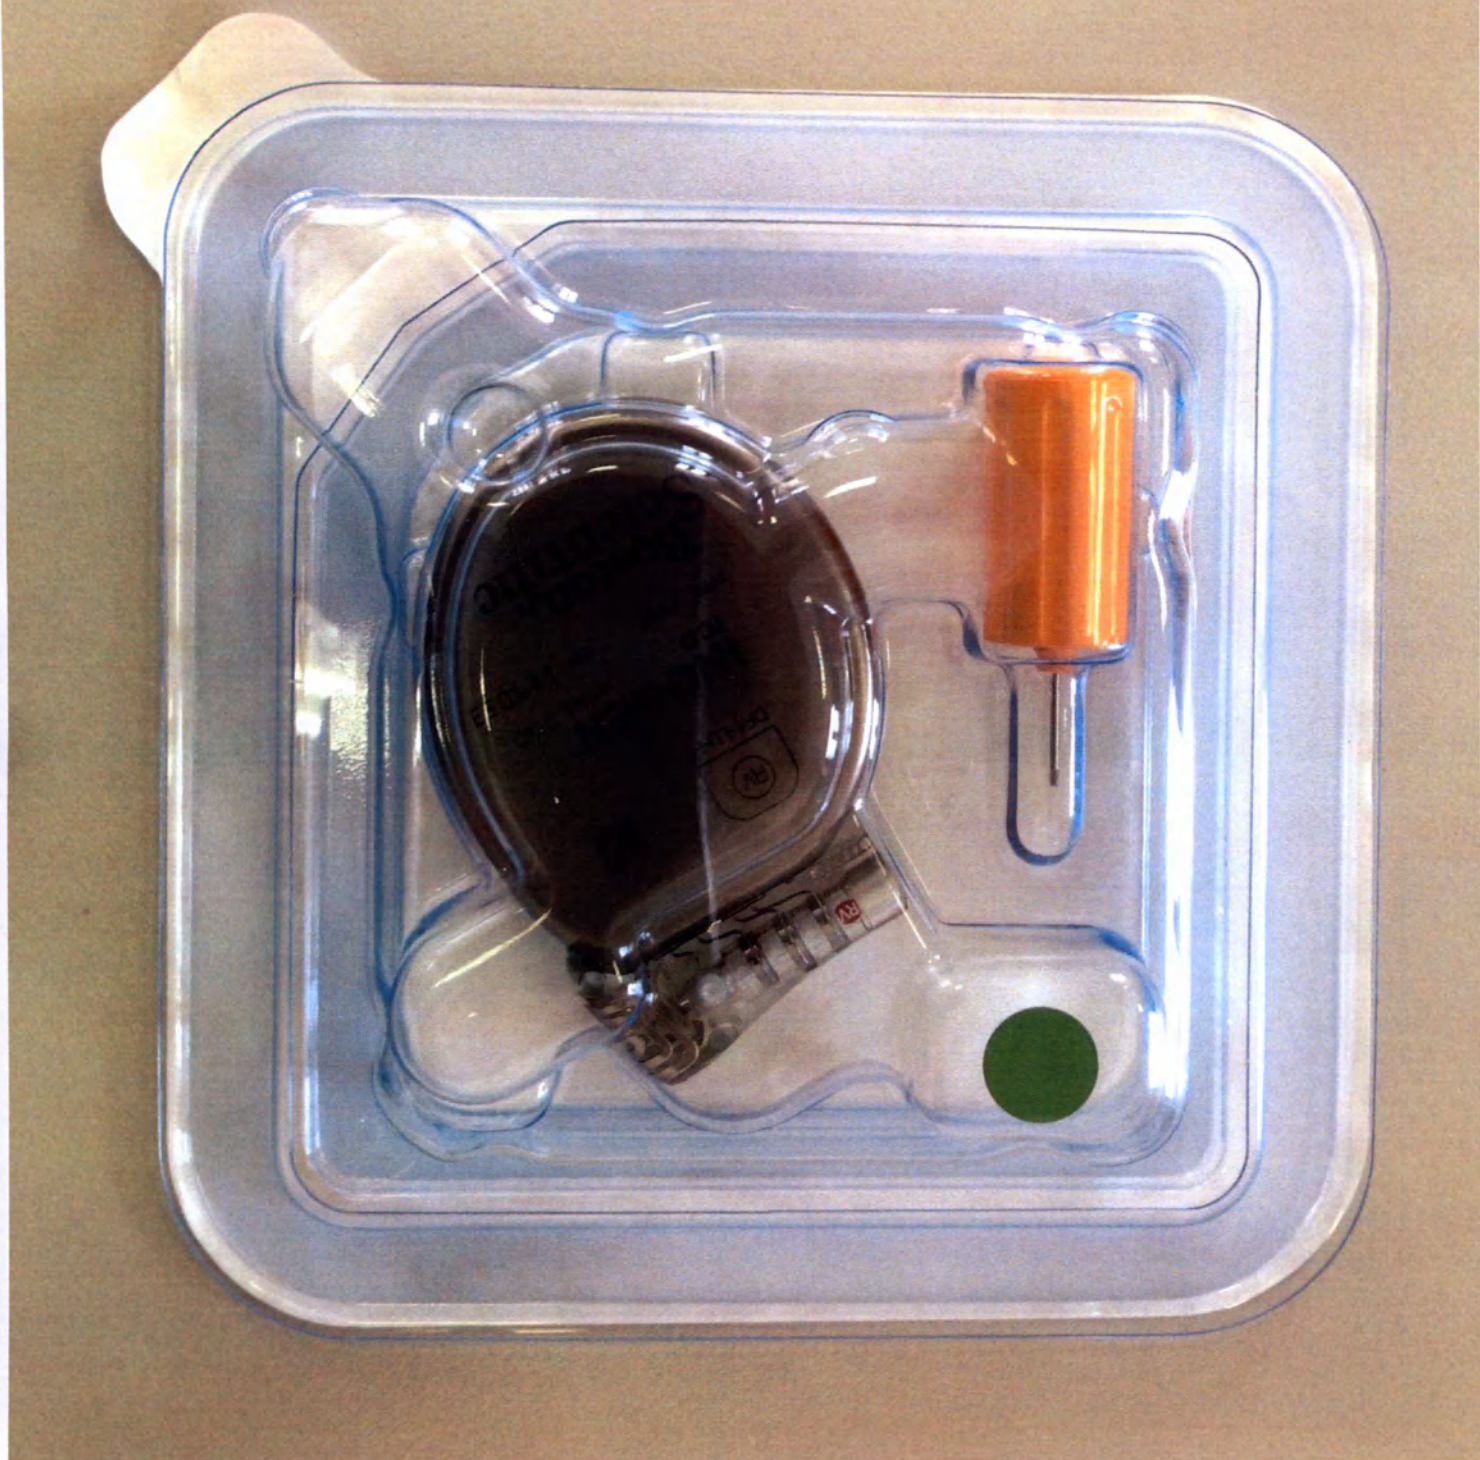


Рис.3. Кардиовертер-дефибриллятор имплантируемый двухкамерный. Внутренняя упаковка.

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 3 листа (ов)



Генеральный директор
ООО «КардиоМедикс»

Меролаев А.А.