

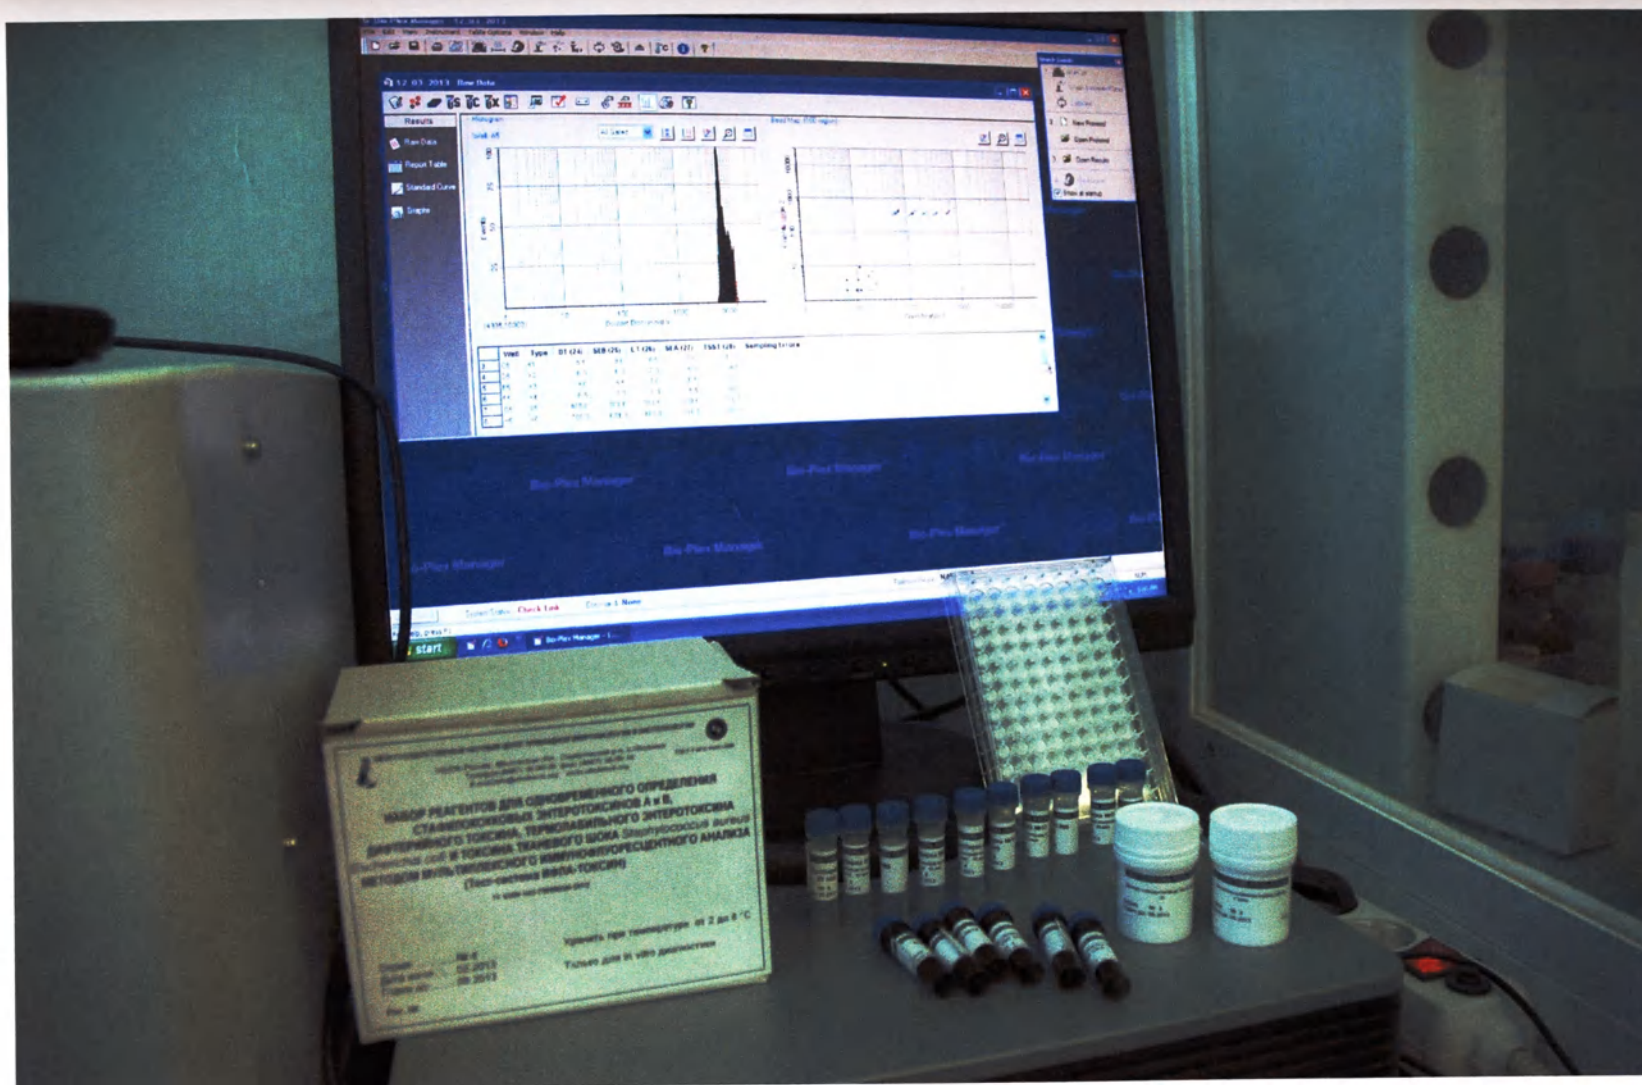


Рис. Учет результатов на проточном флуориметре Био-Плекс 200