



Специальный монитор для STA R Max®

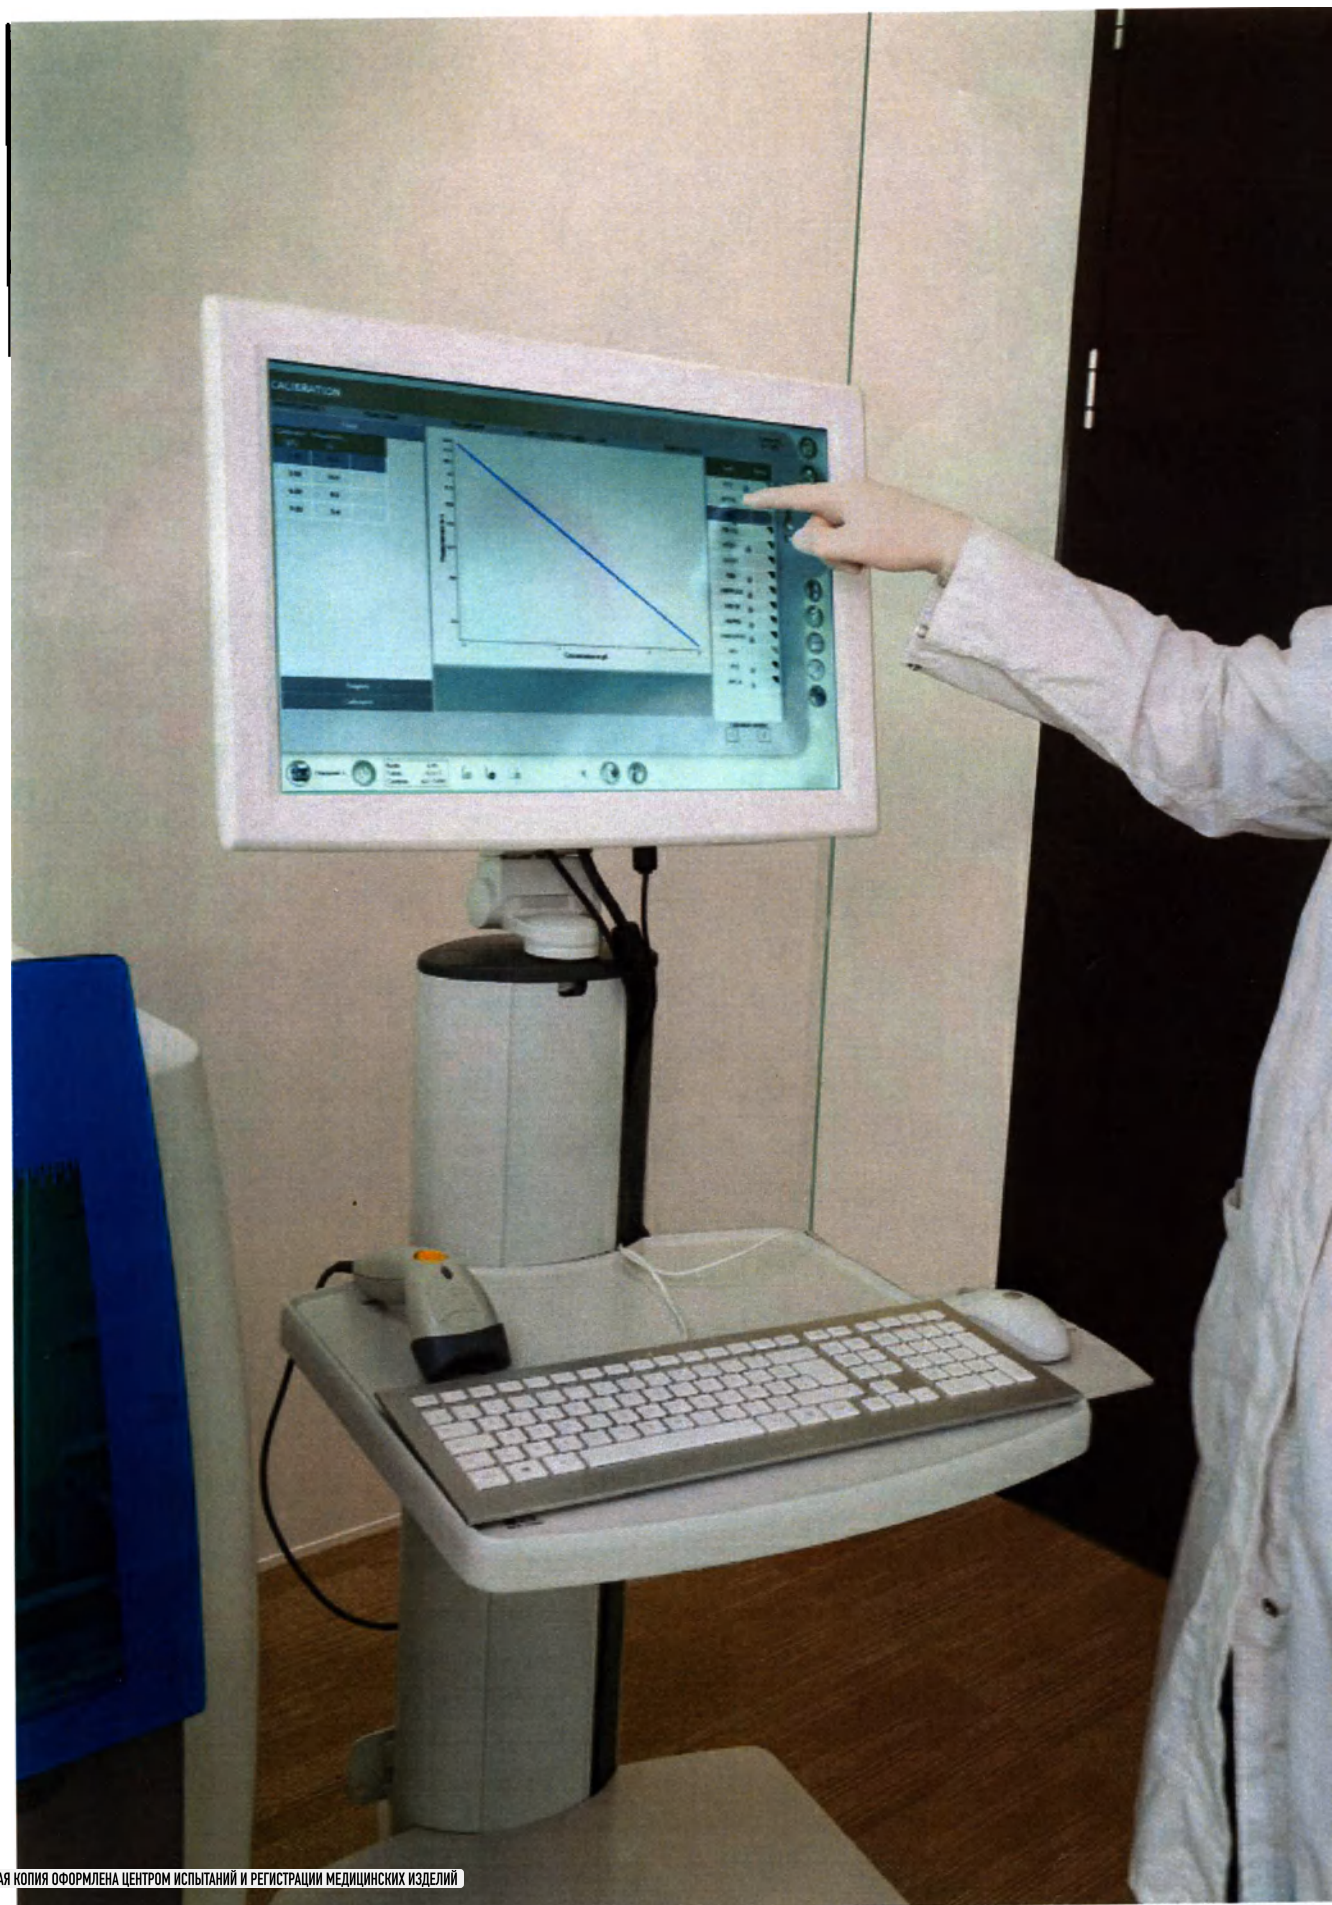

Специальная клавиатура для STA R Max®

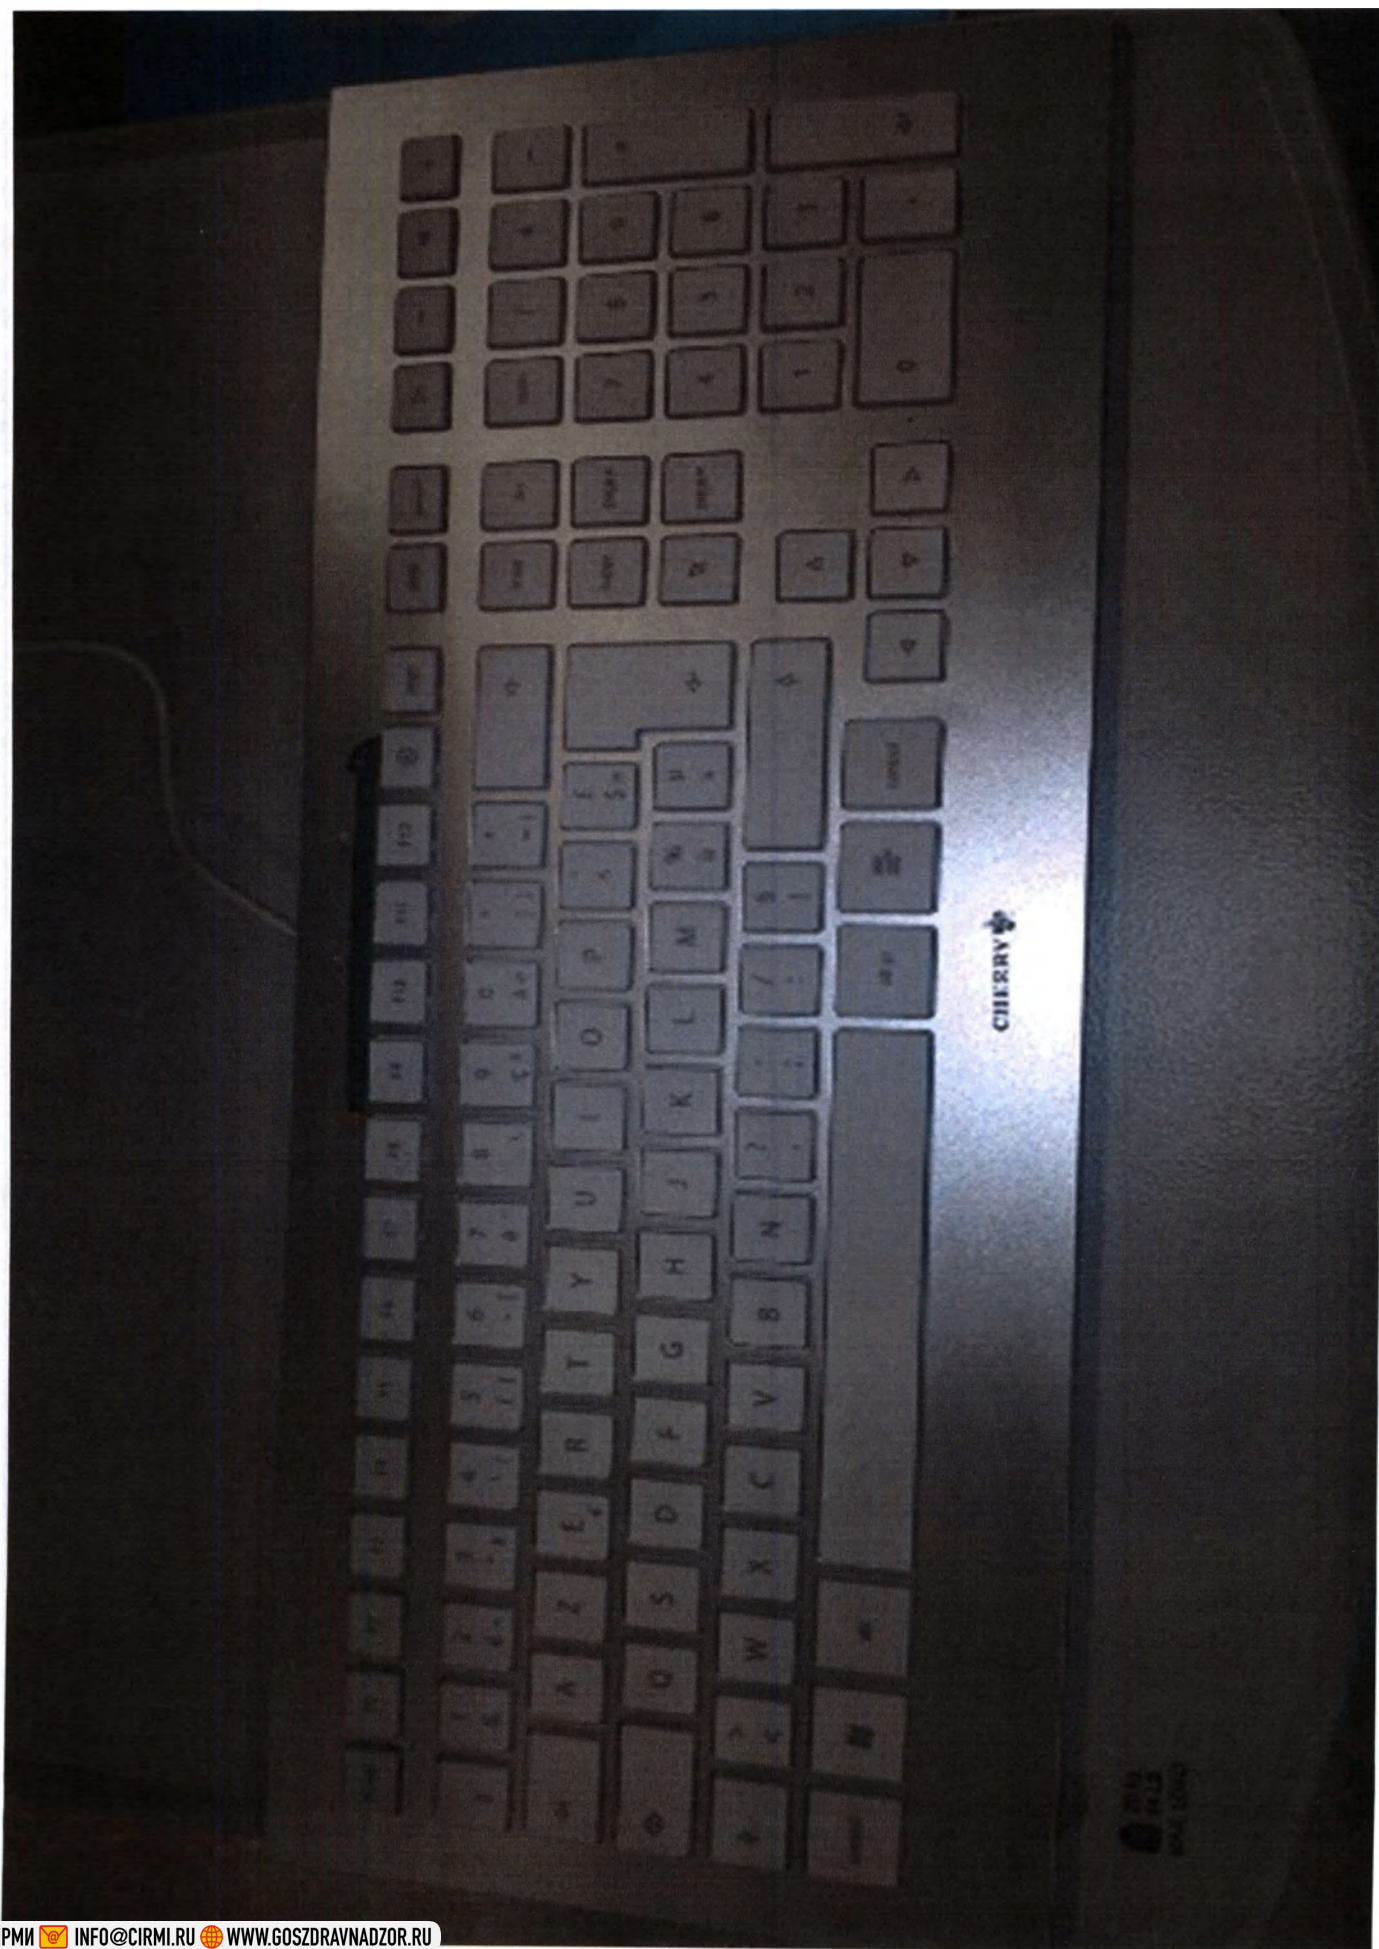

Специальное программное обеспечение для STA R Max[®]




Специальный компьютерный модуль для STA R Max®




Специальный ручной сканер штрихкодов



Специальная мышь для STA R Max[®]

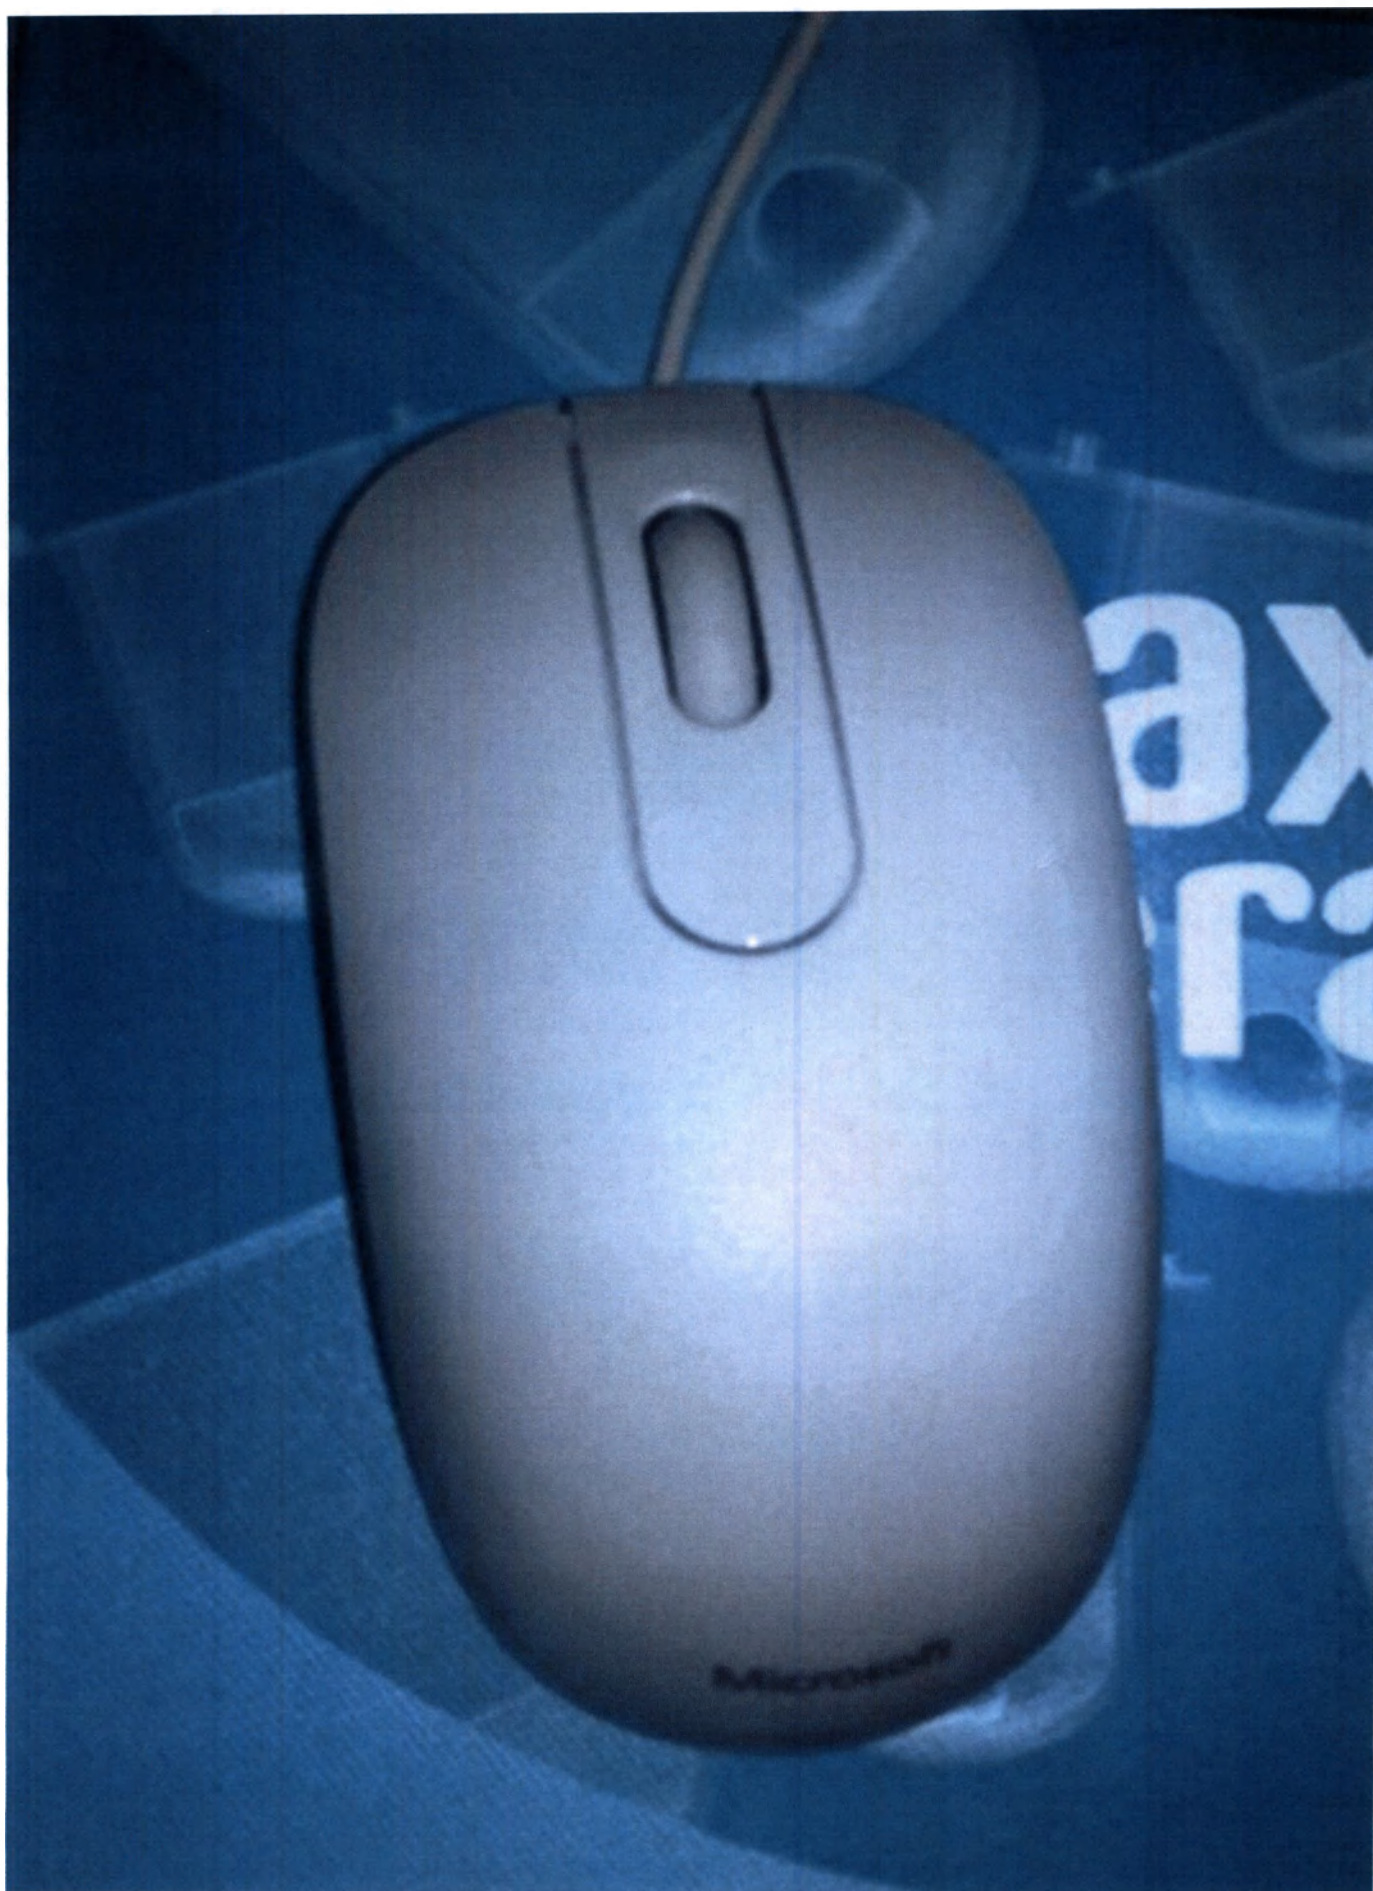

Шнуры сетевые

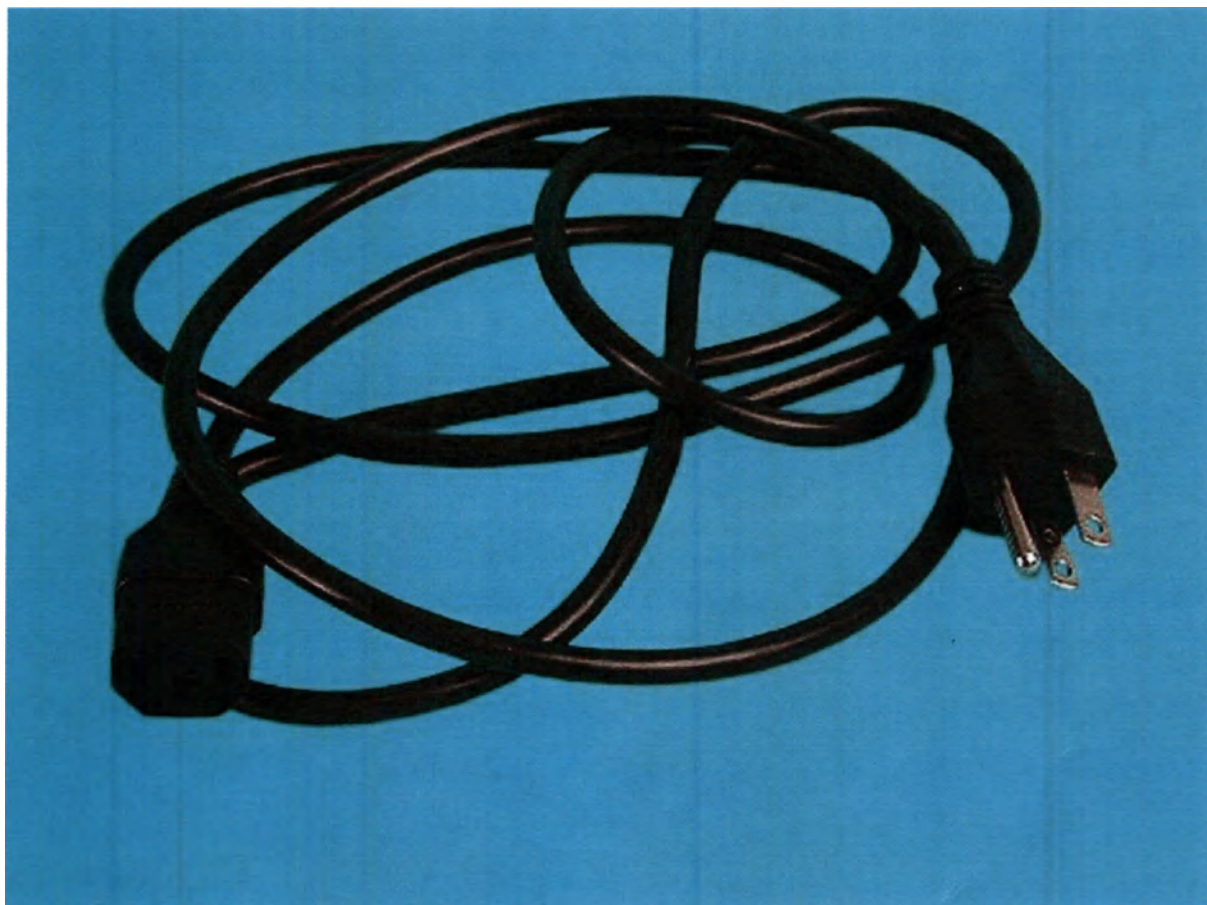


Специальный стол для STA R Max®



Индикатор крена



Индикатор сотрясения

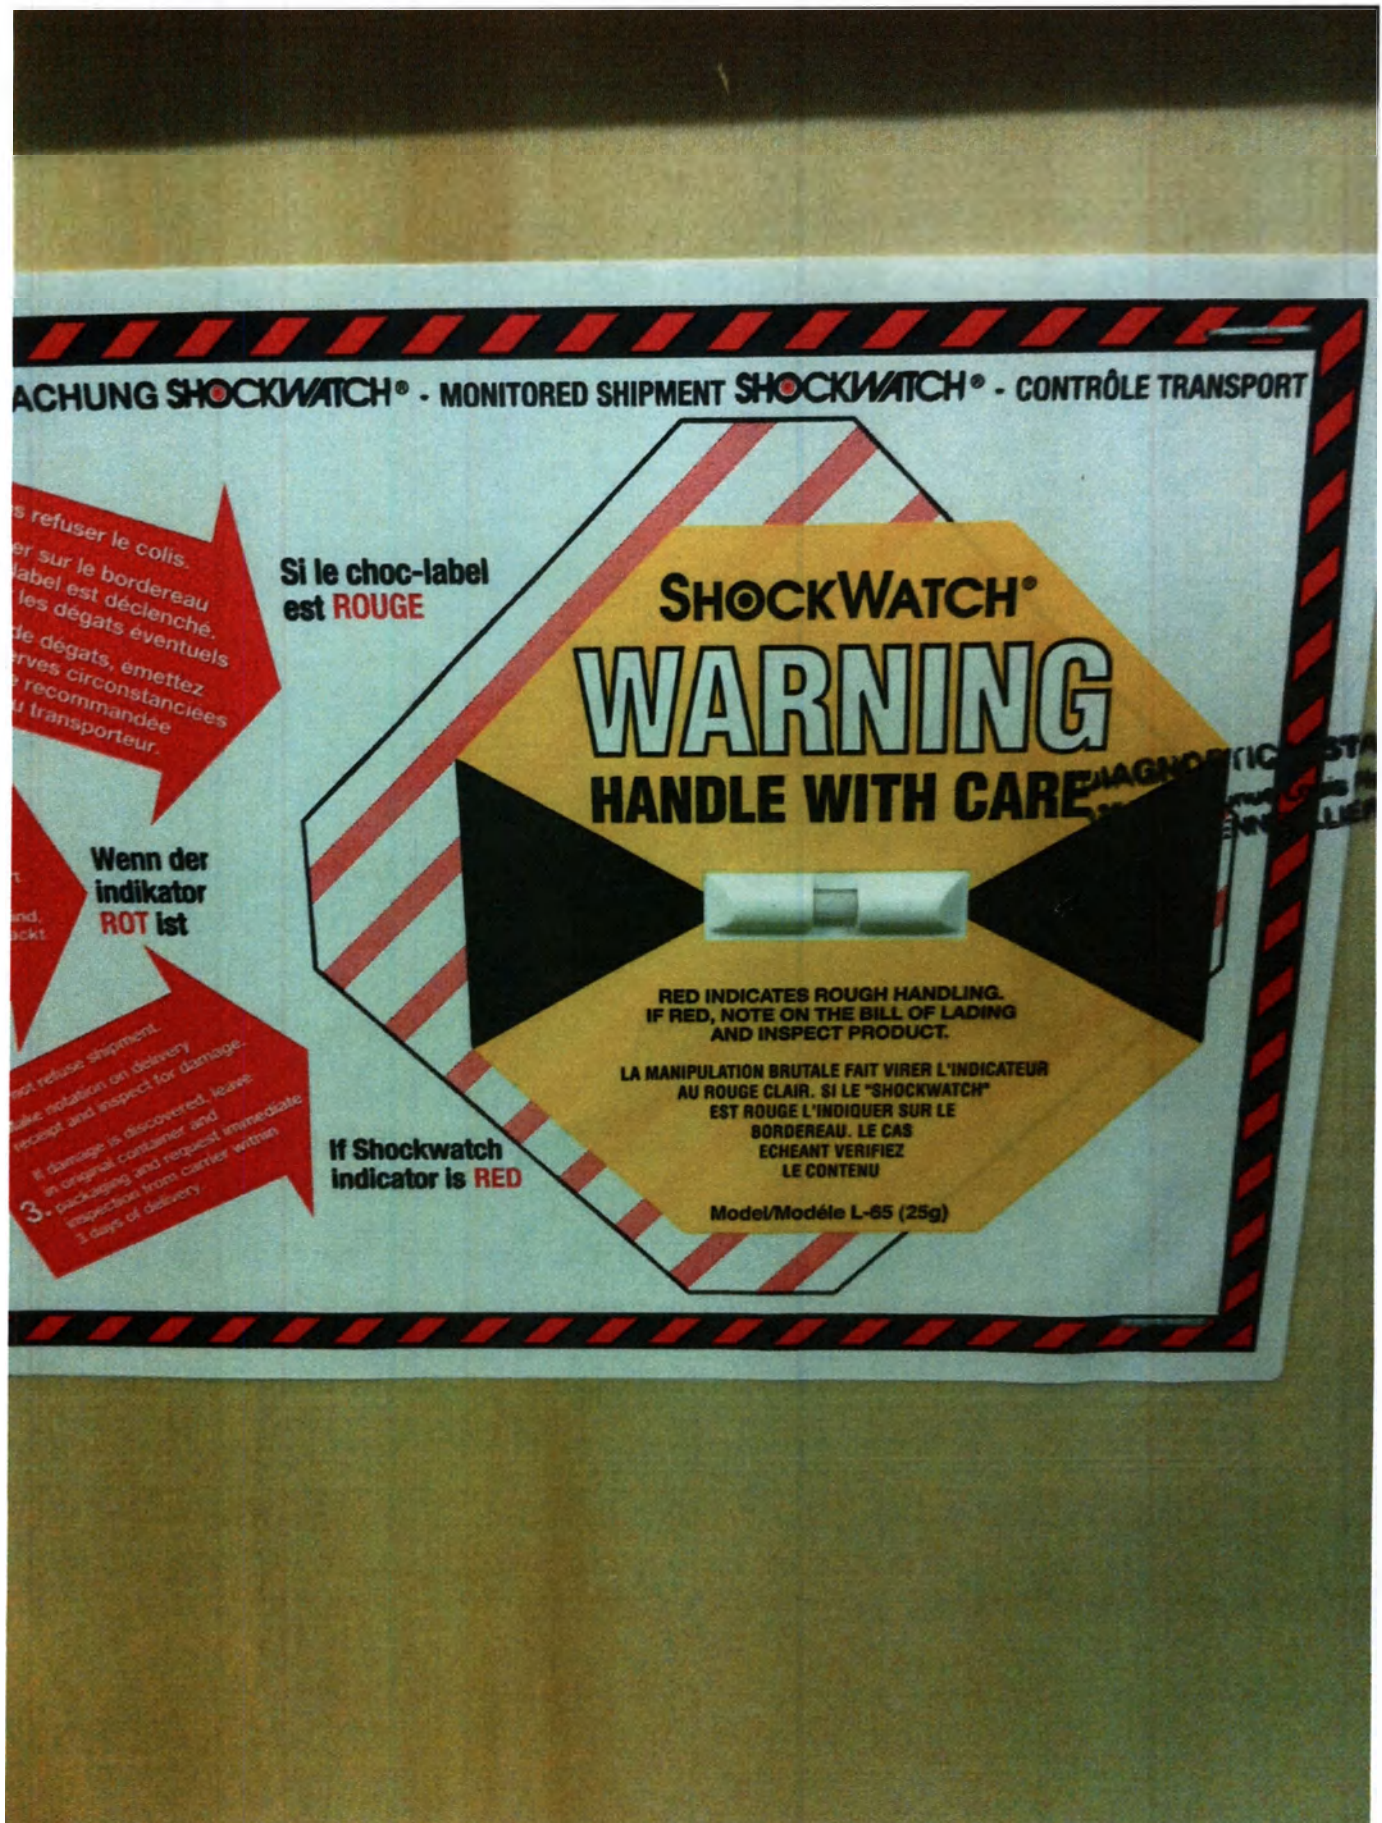


Контейнер для сбора жидких отходов



Мешок для использованных кювет



Фильтр воздушный

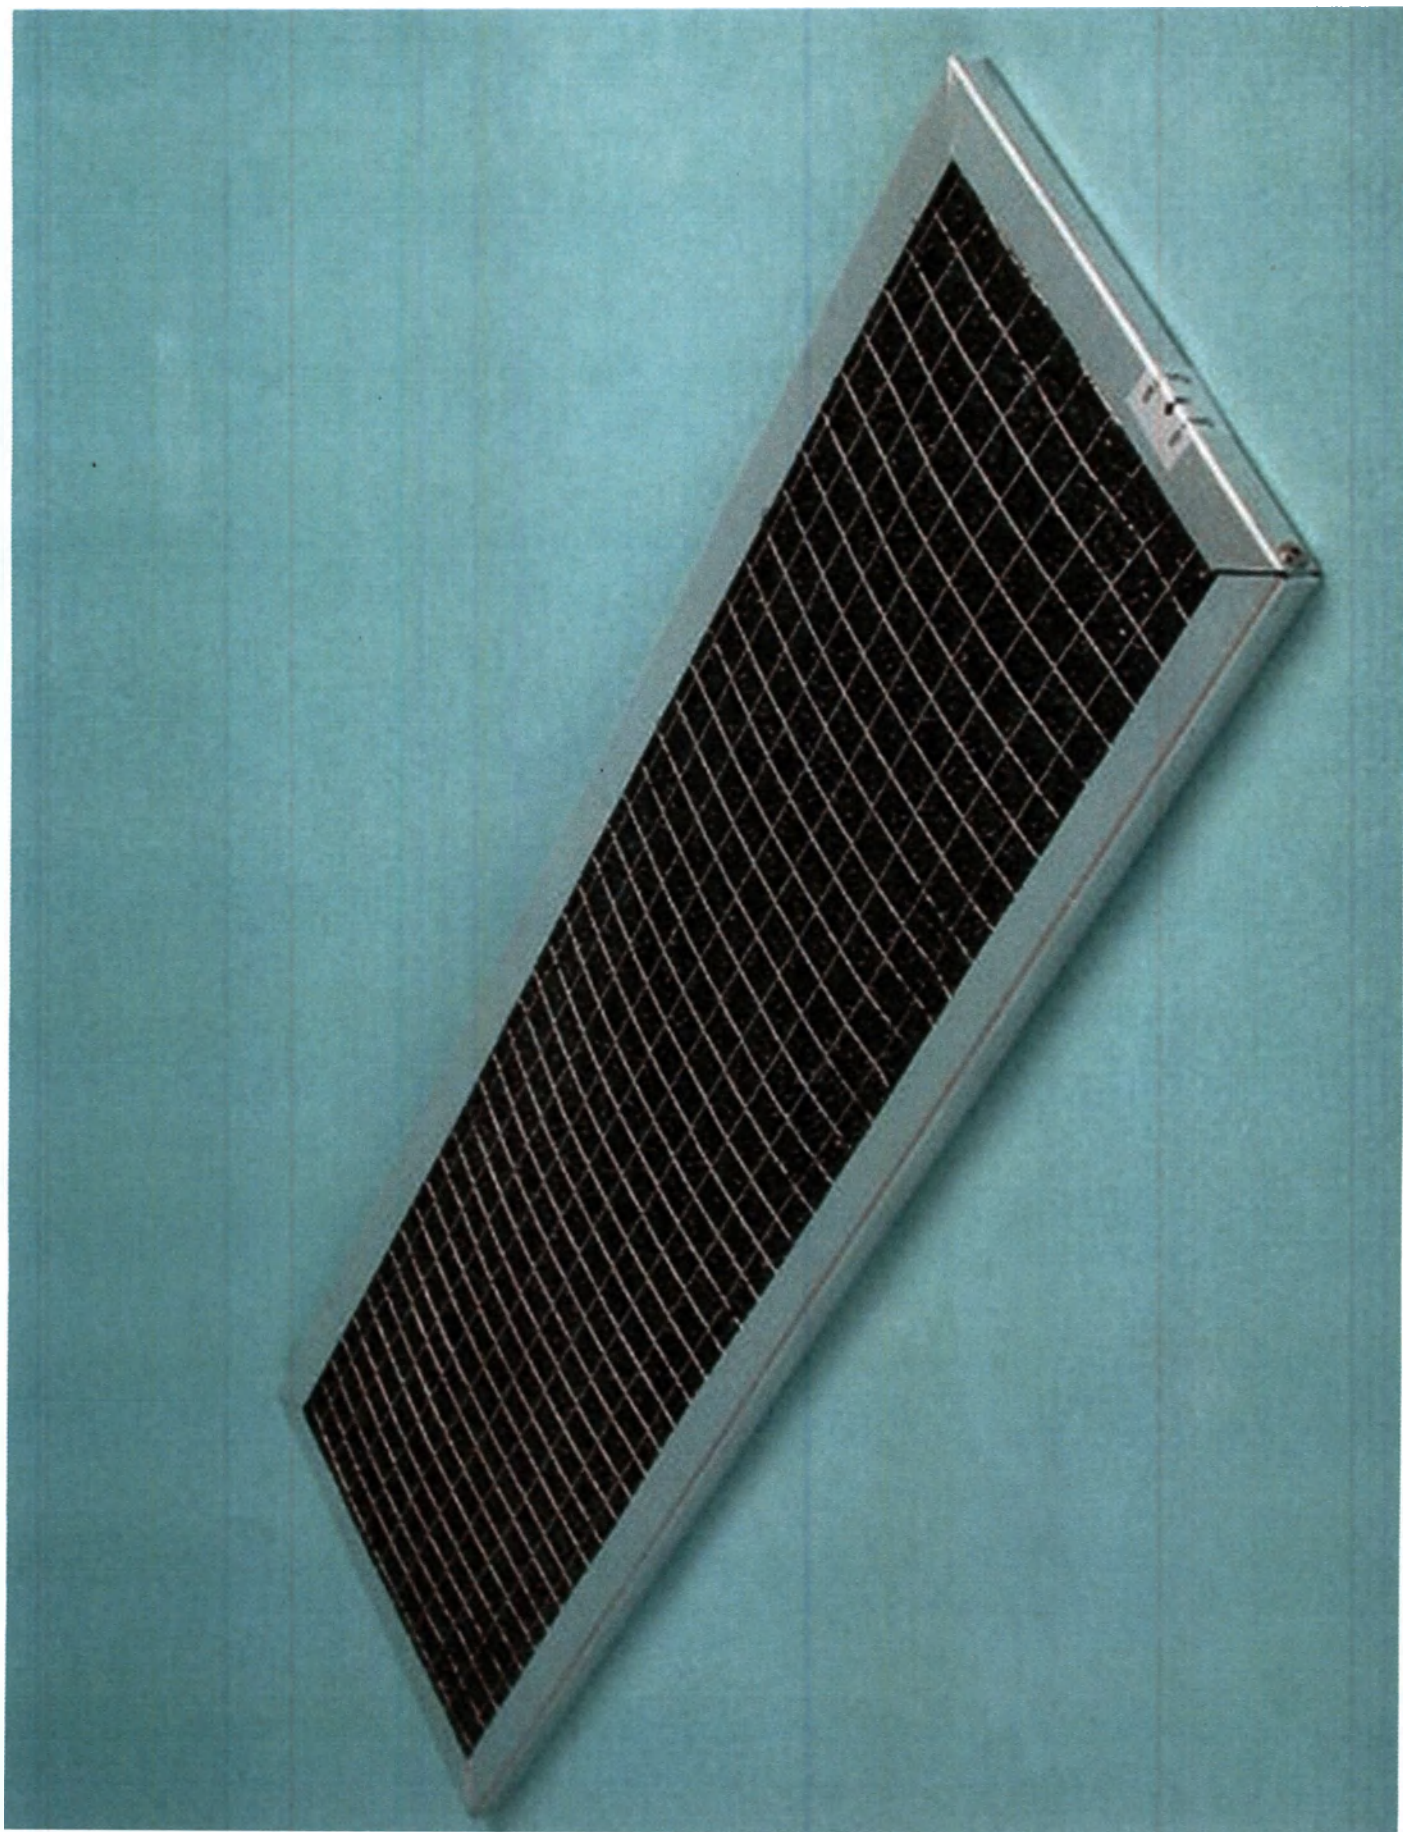


Подносы для штативов



Штативы для пробирок



Документация

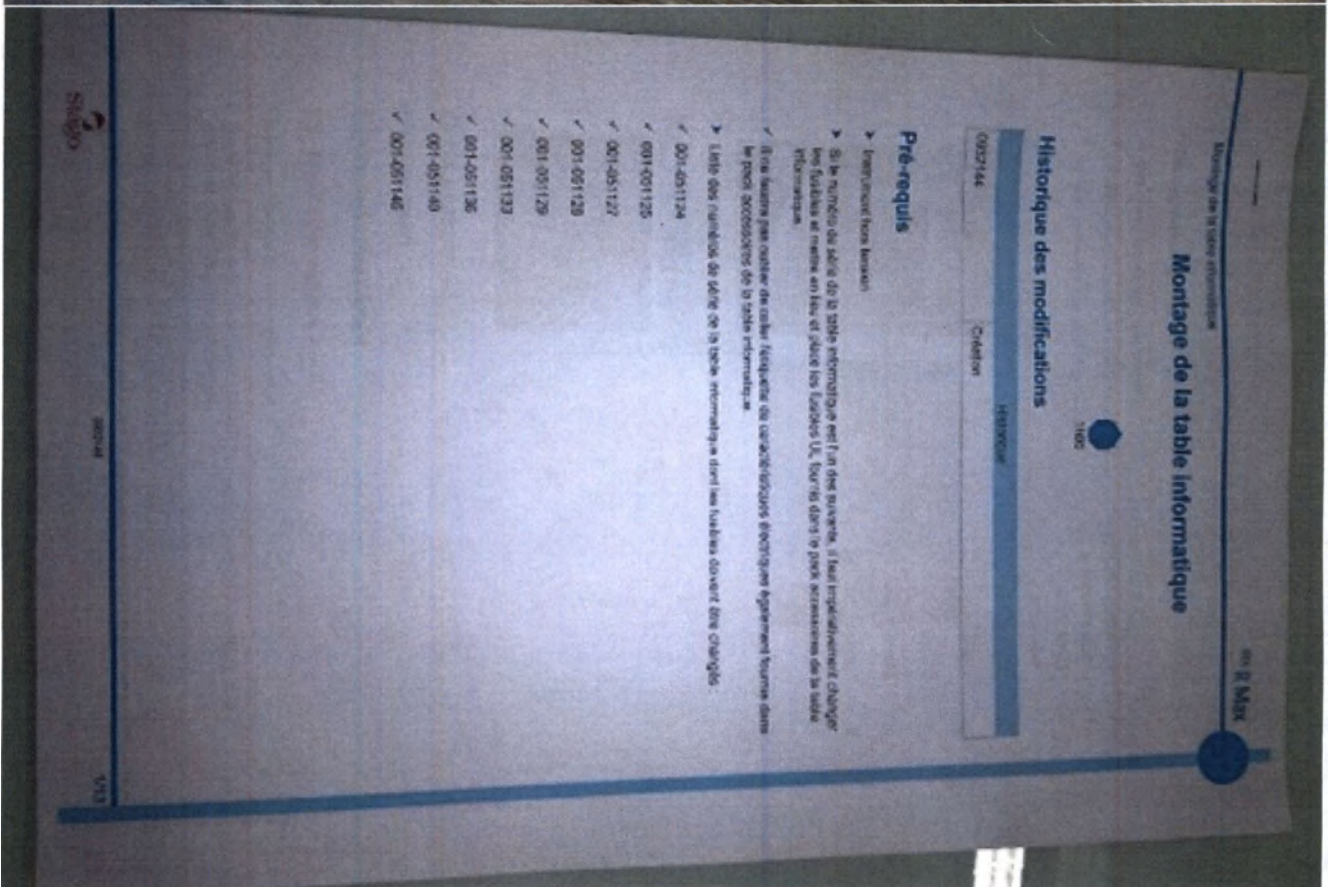


16

Чемодан с вспомогательными материалами




Устройство для удаления шариков

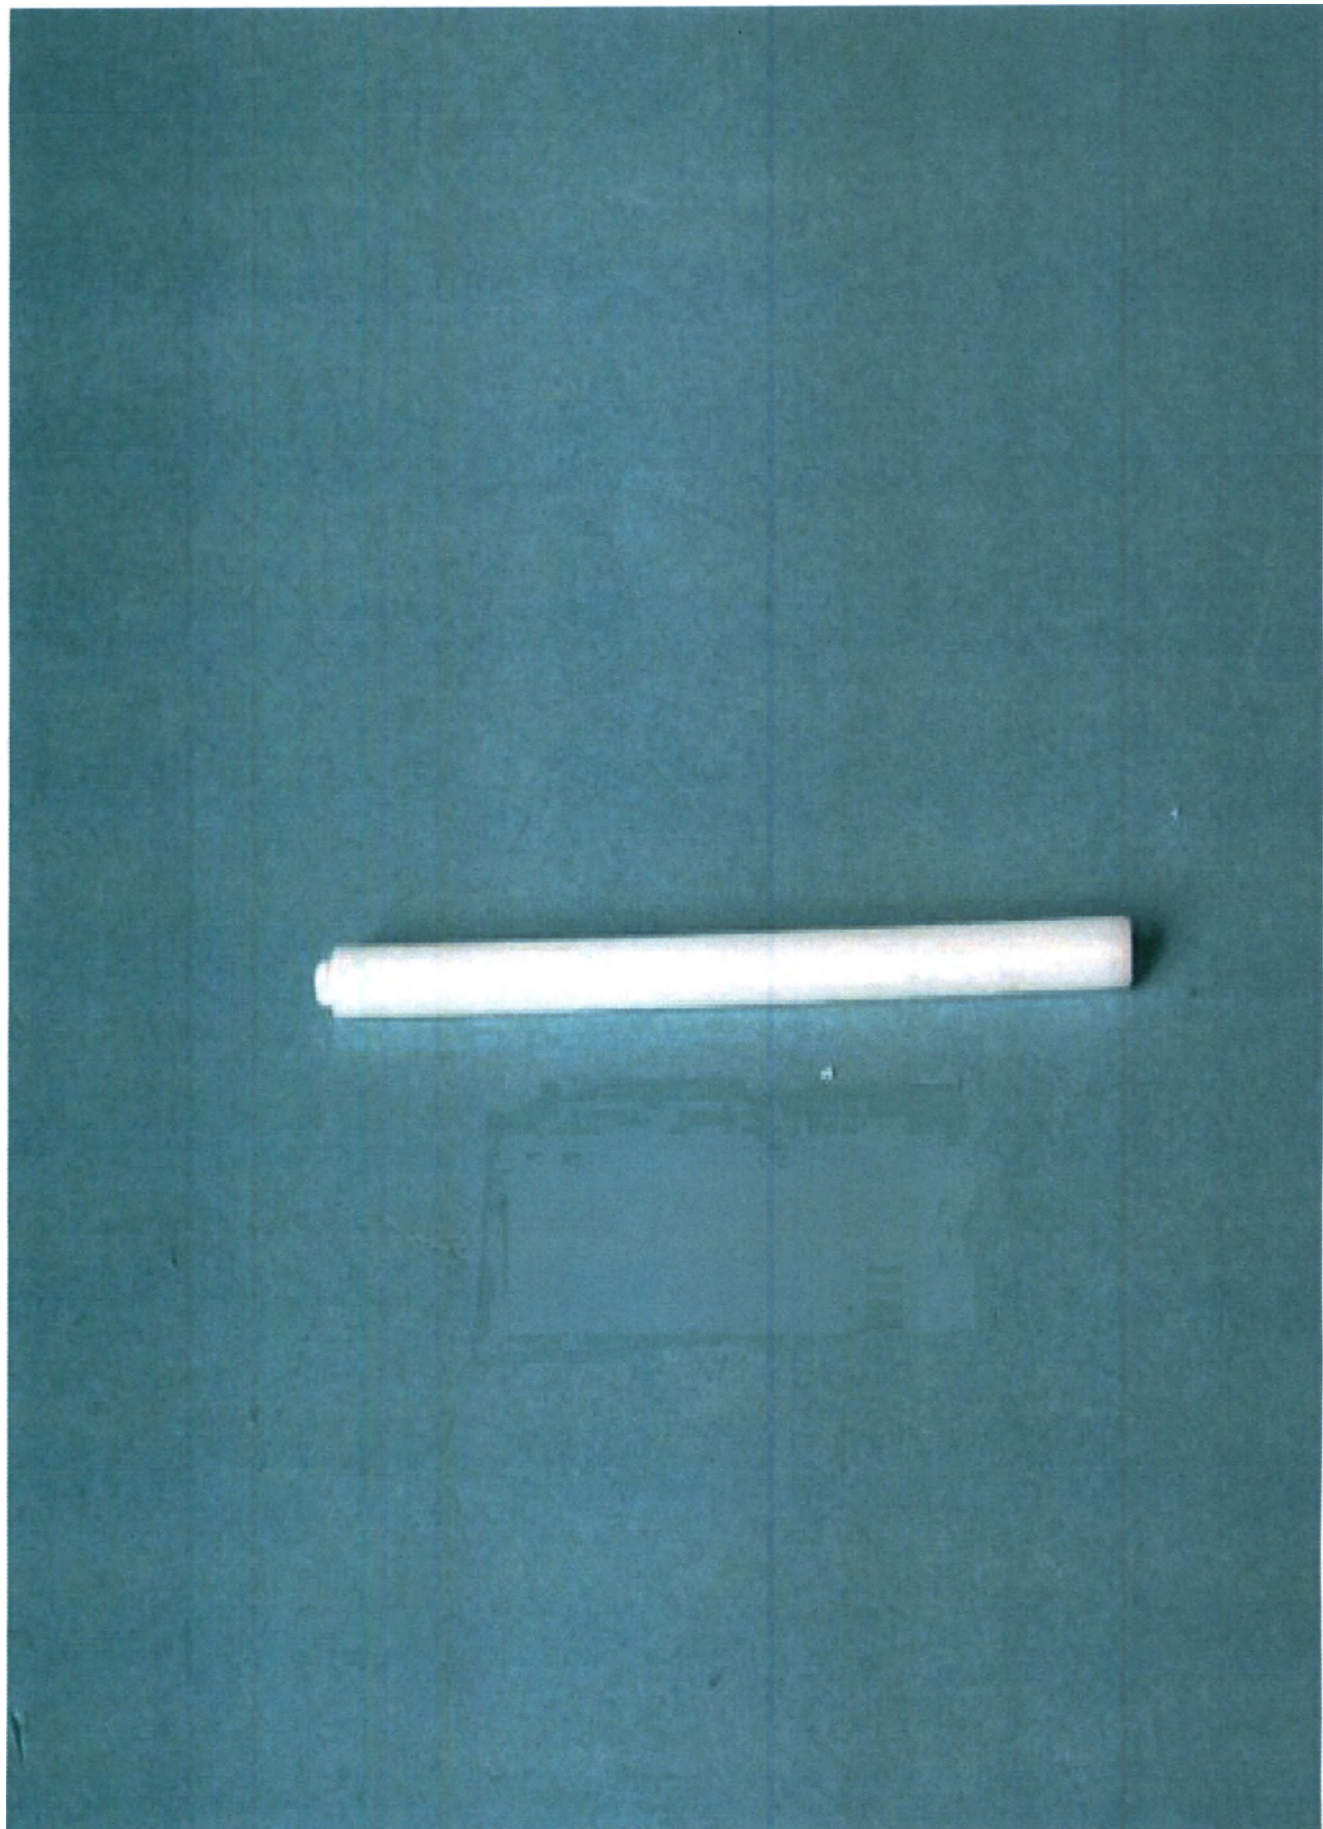


Кювета навигационная




Адаптеры для микроконтейнеров

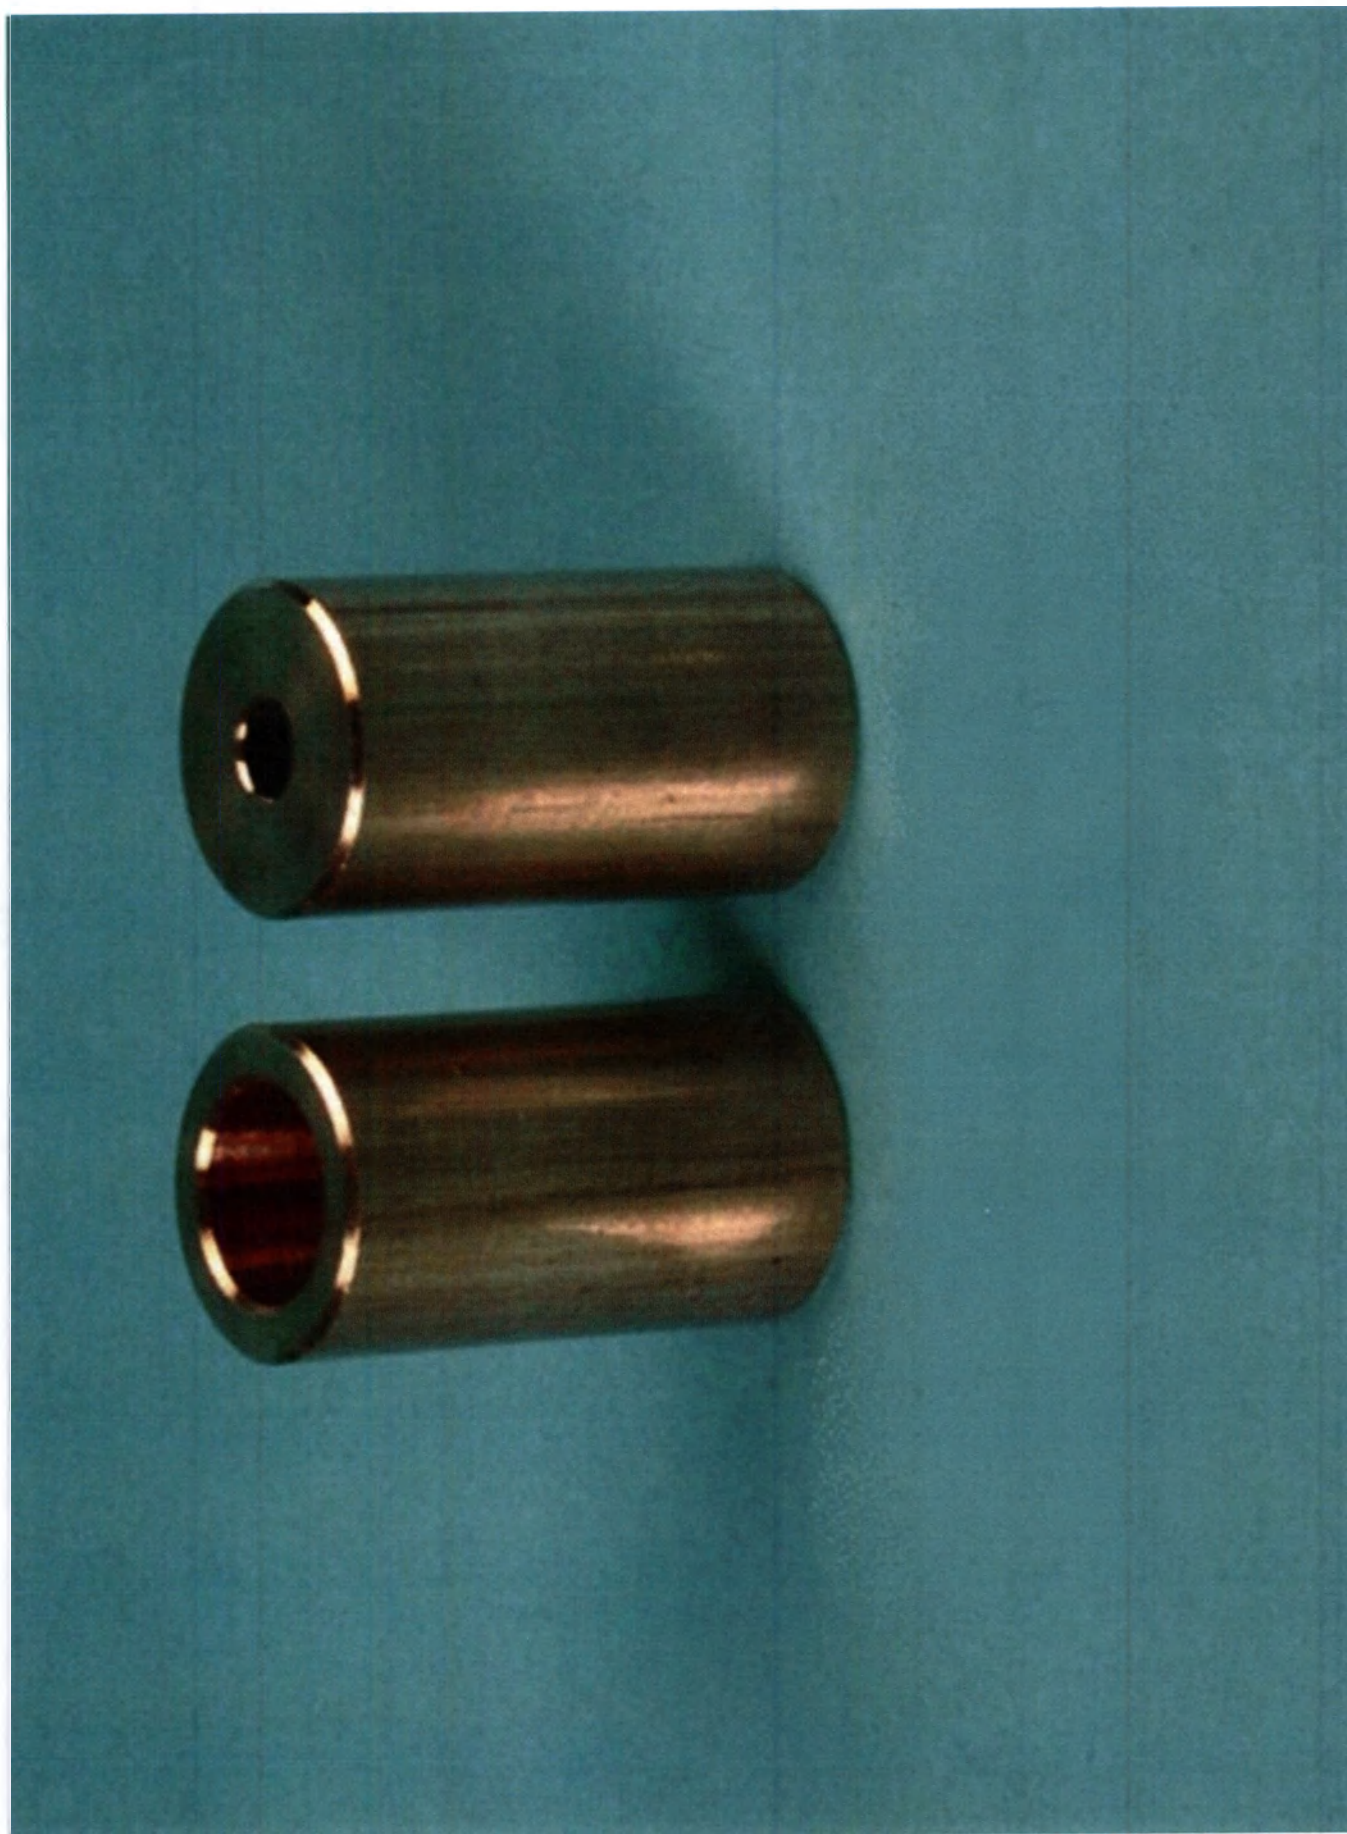


Вставки для образцов малого объема

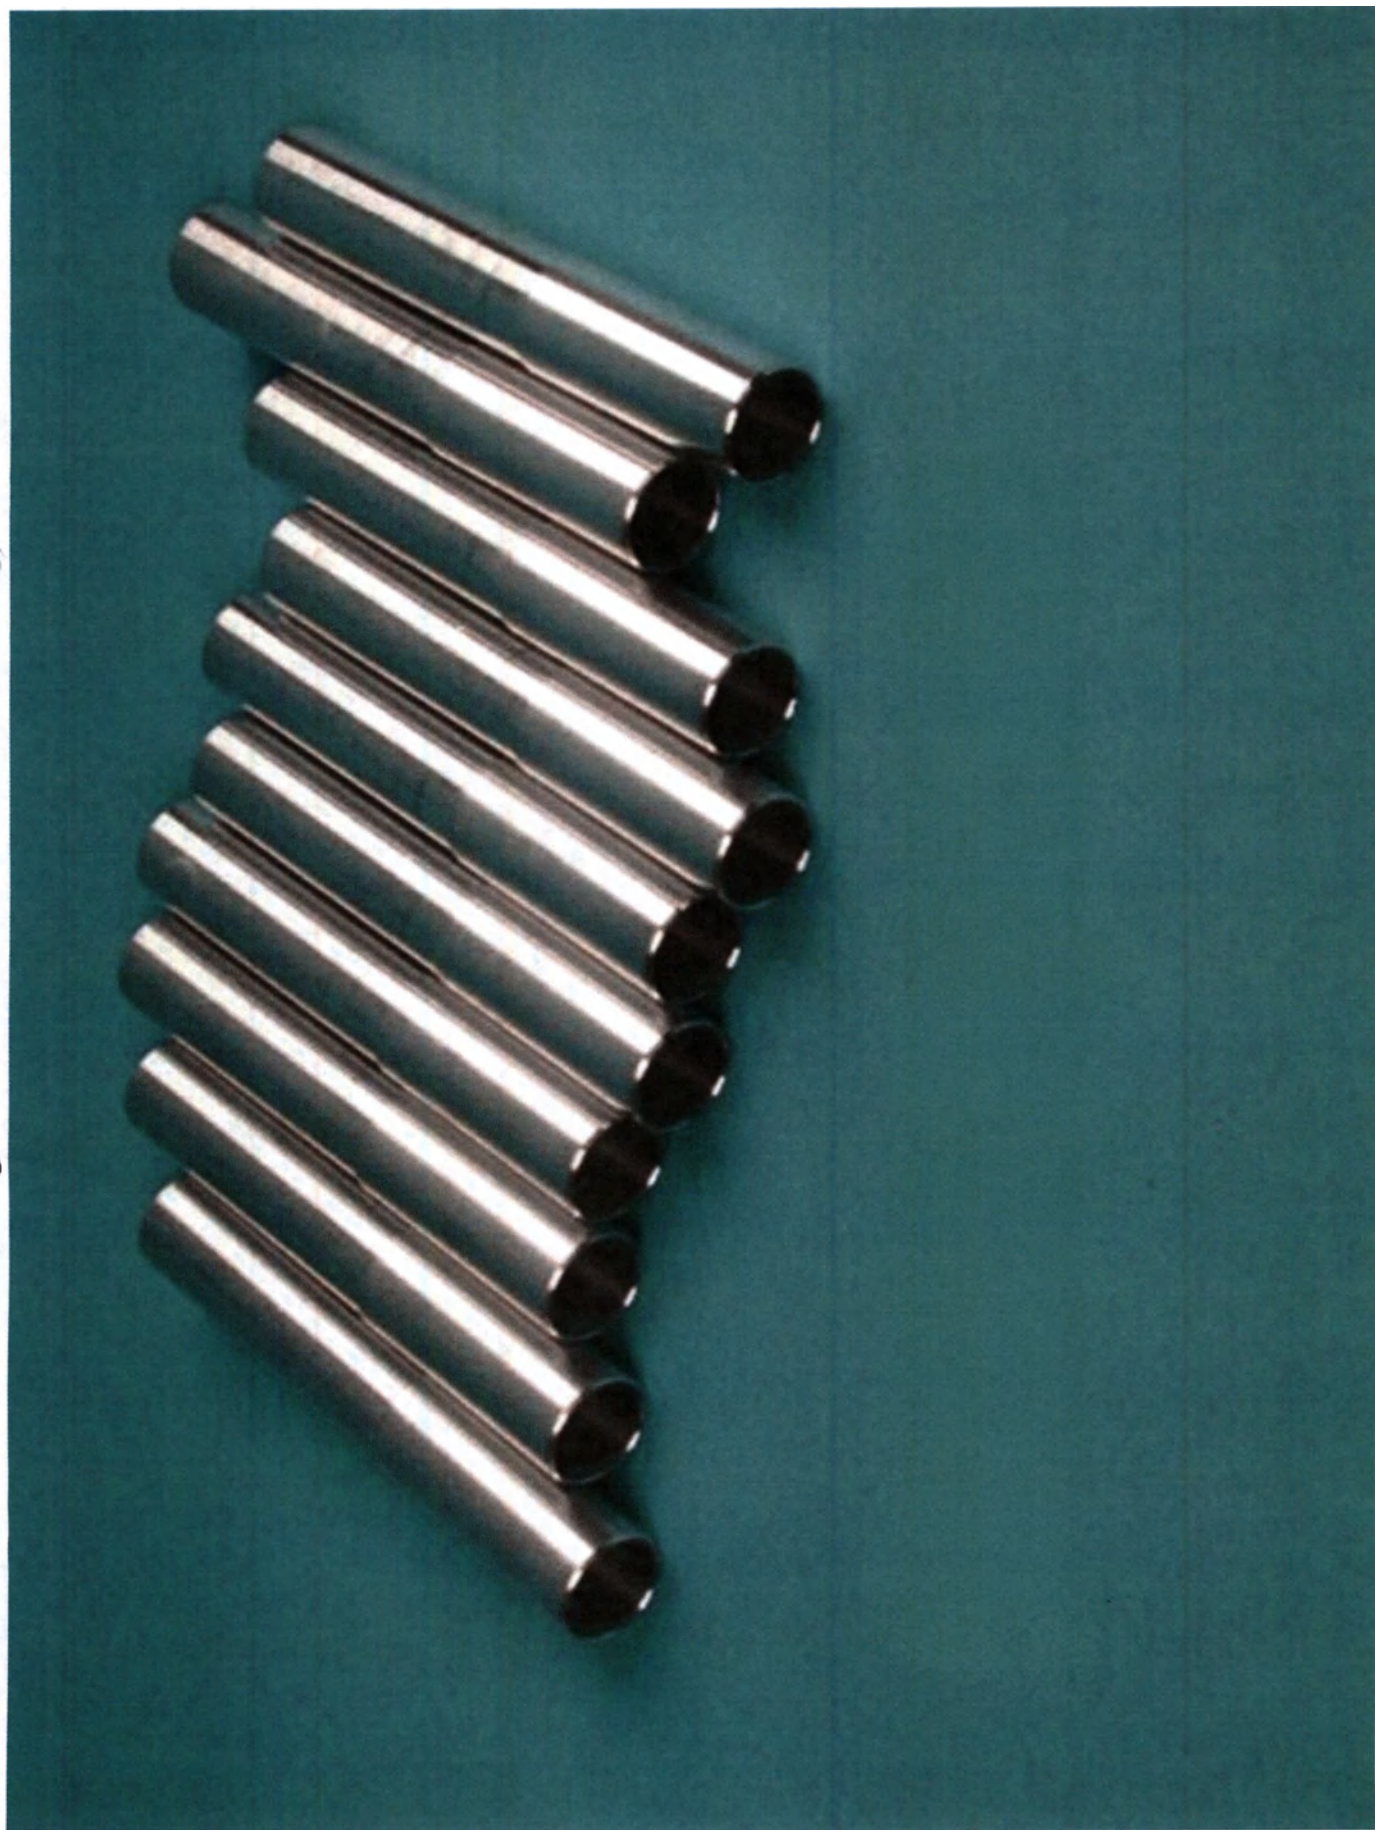


Игла для "руки" № 3

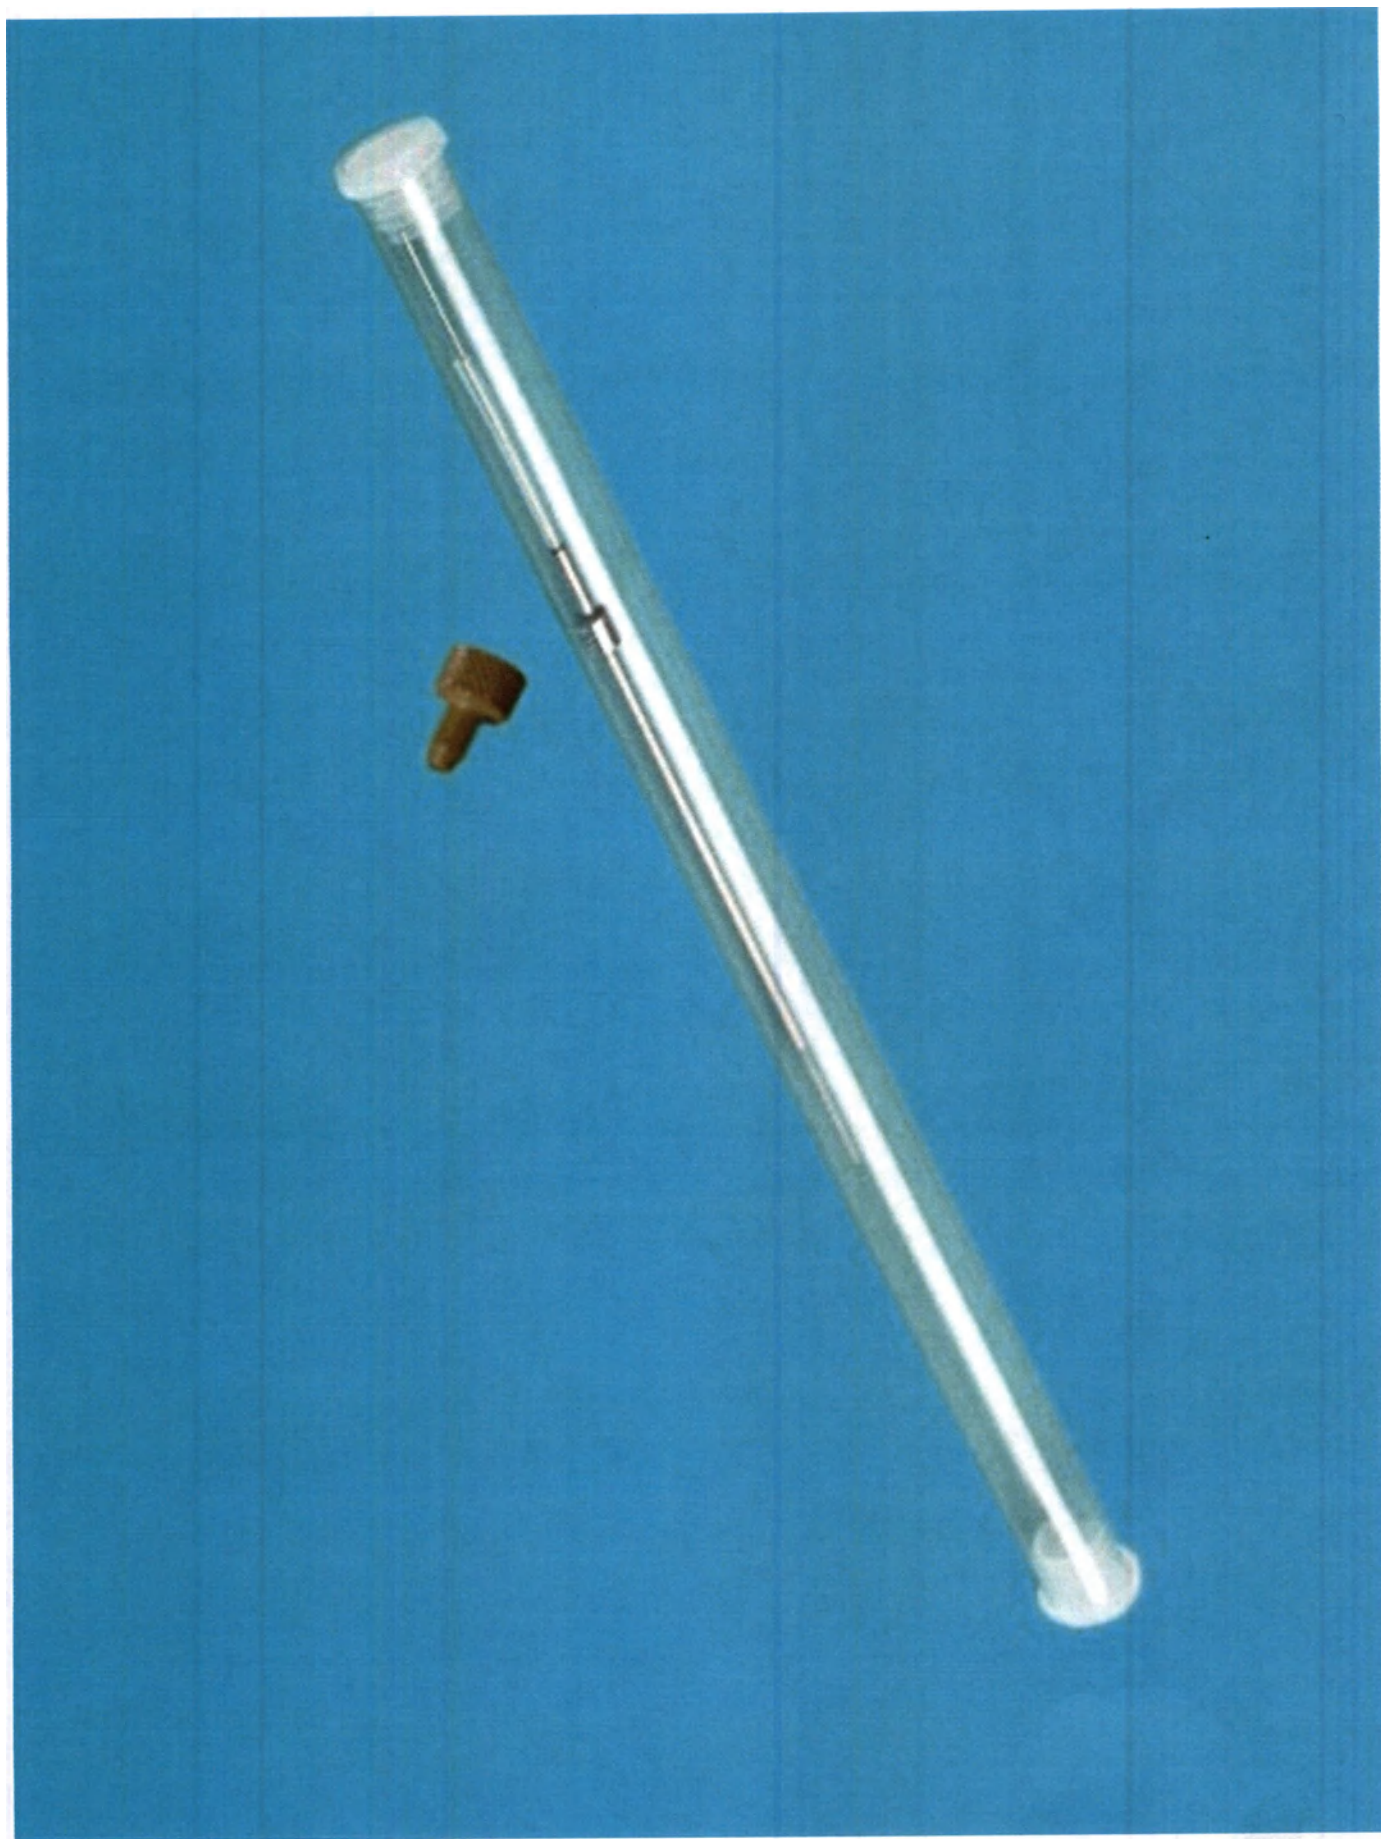


Игла для "руки" № 2

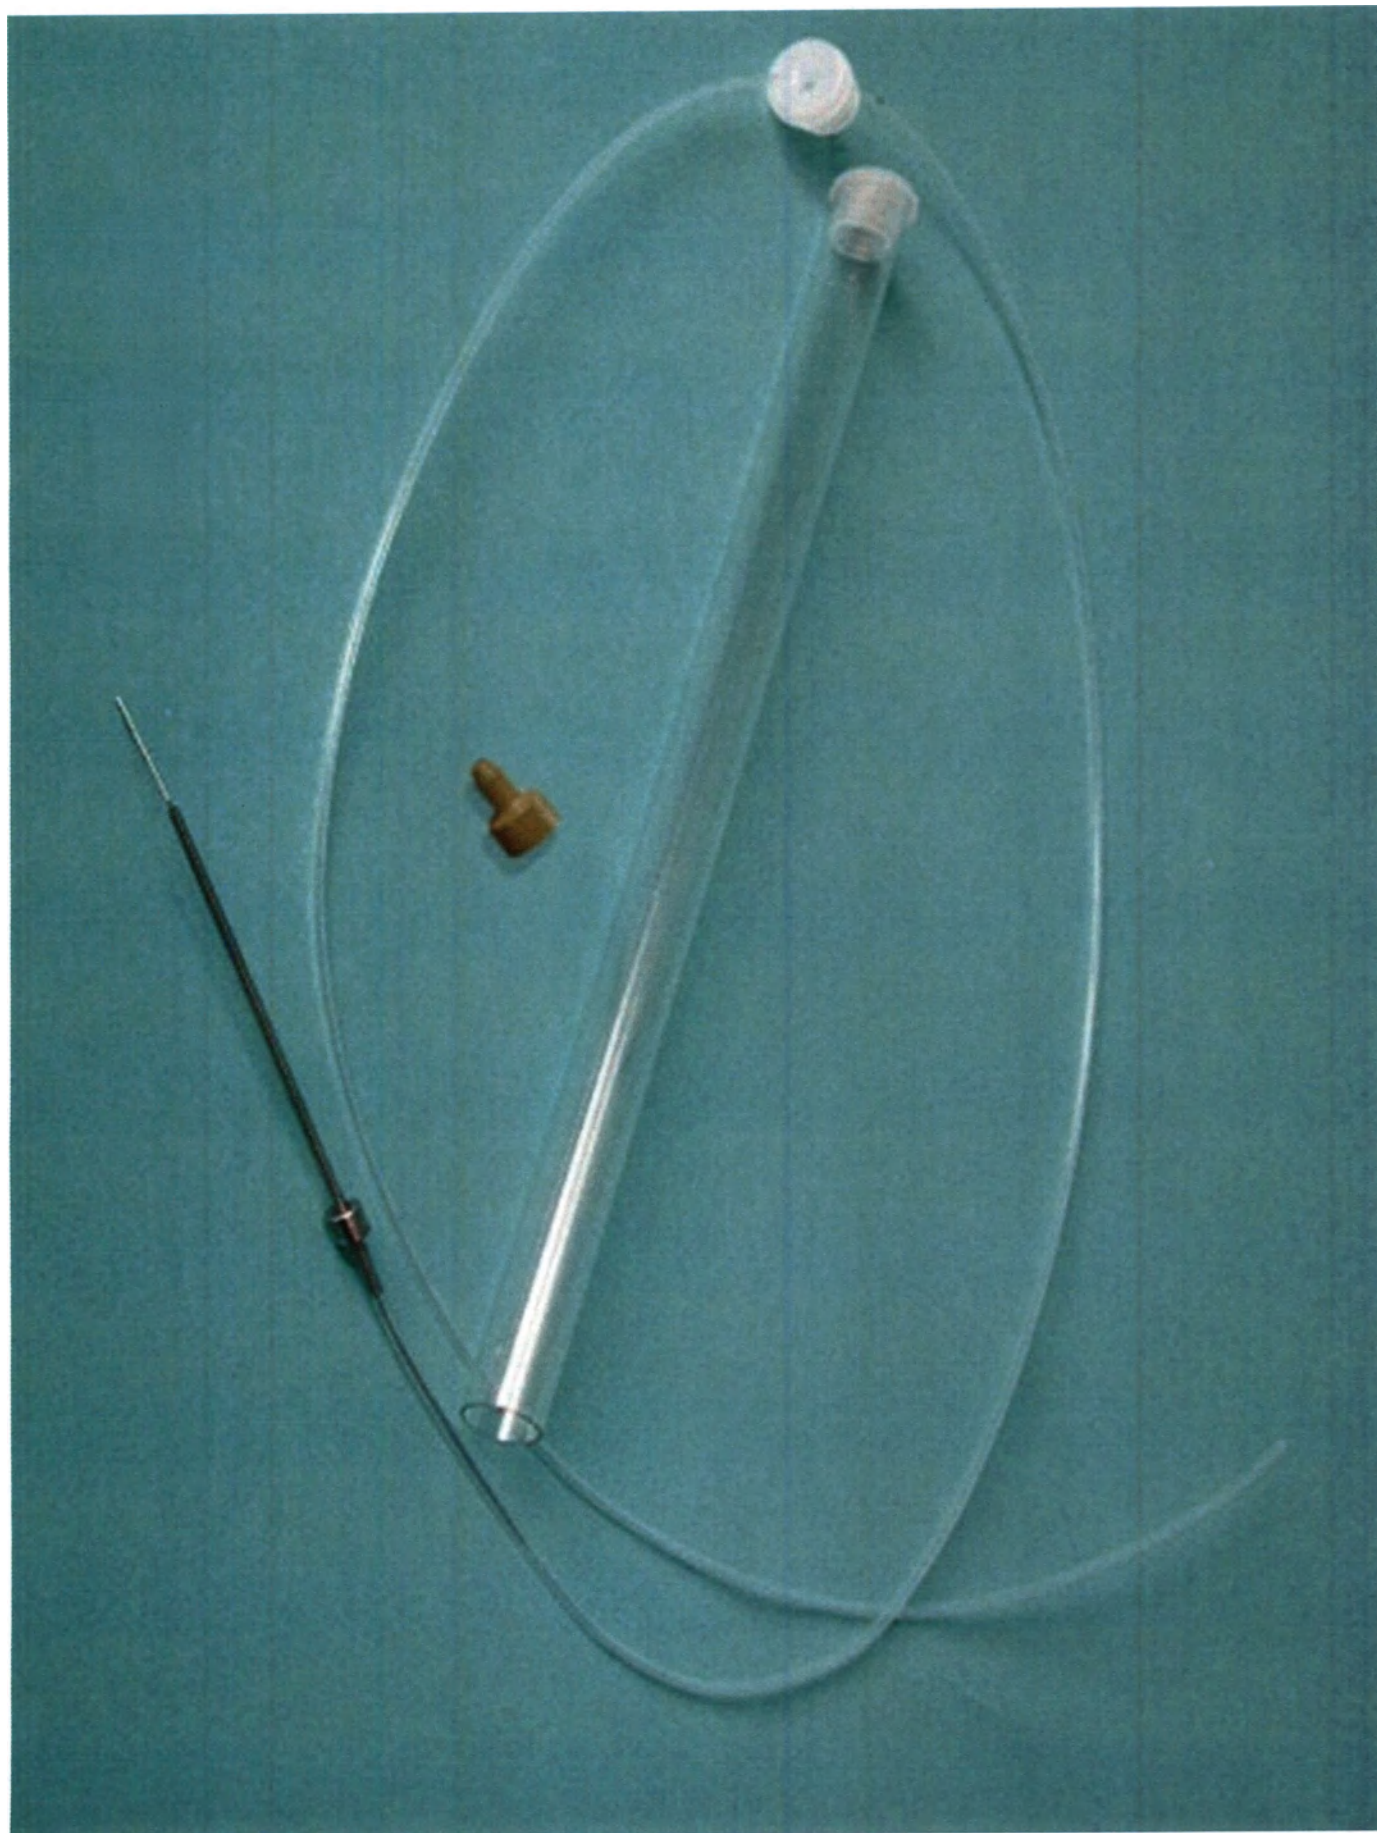


Игла для "руки" № 1

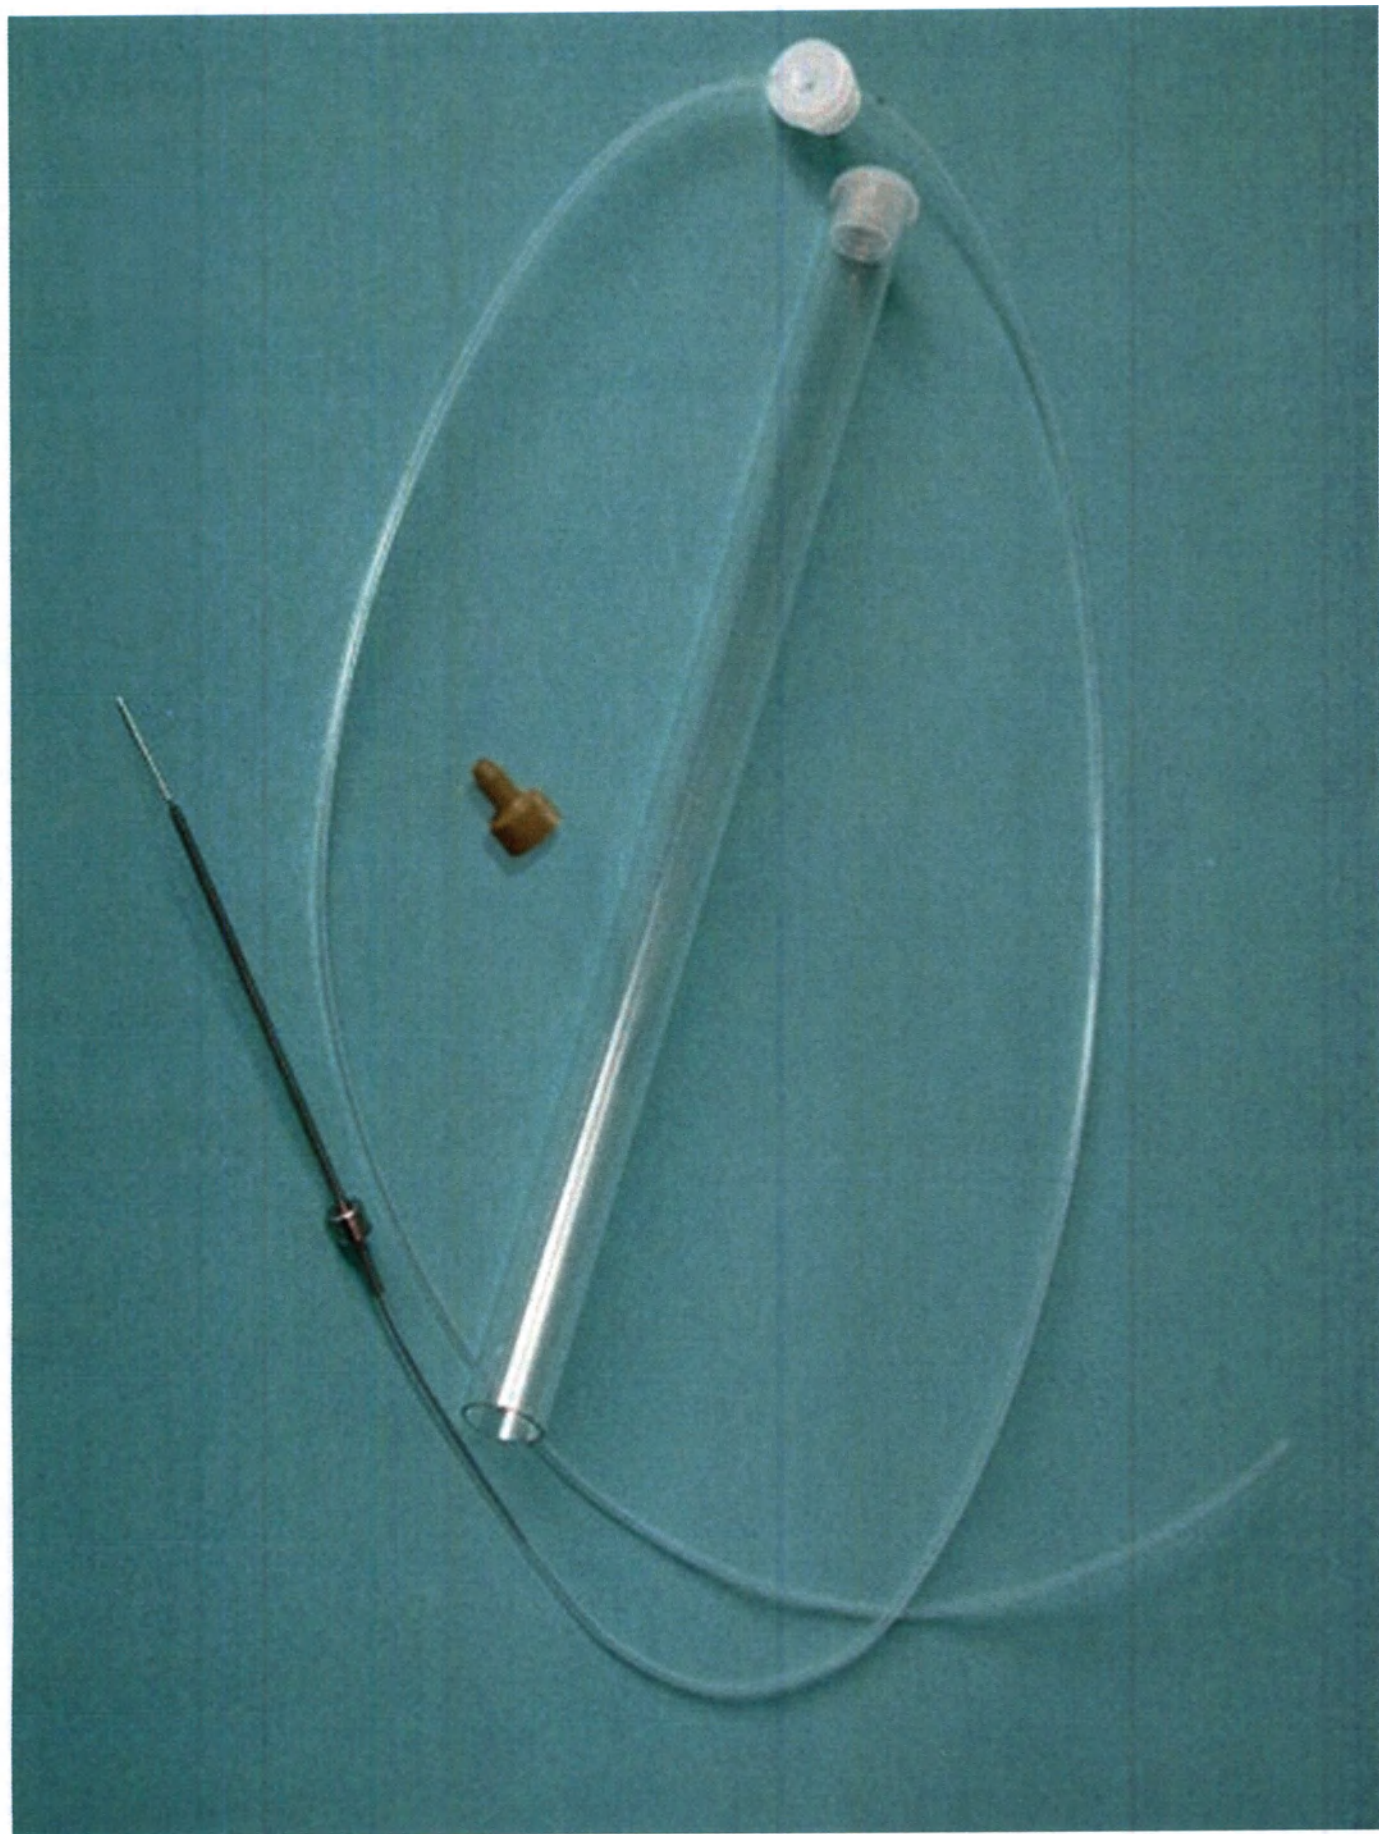

Специальные челноки

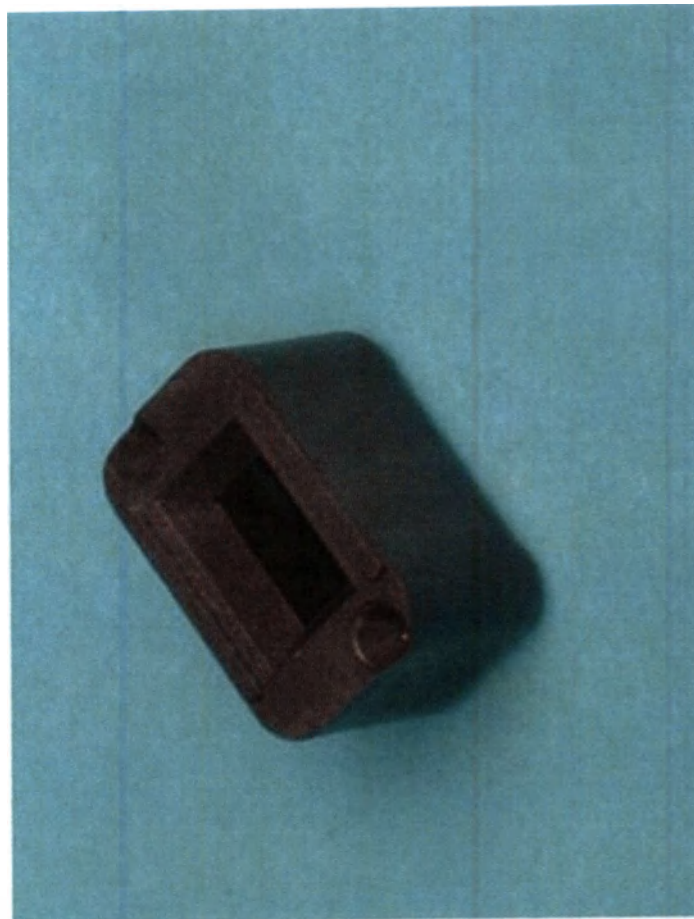

Устройство защиты от падения рэка

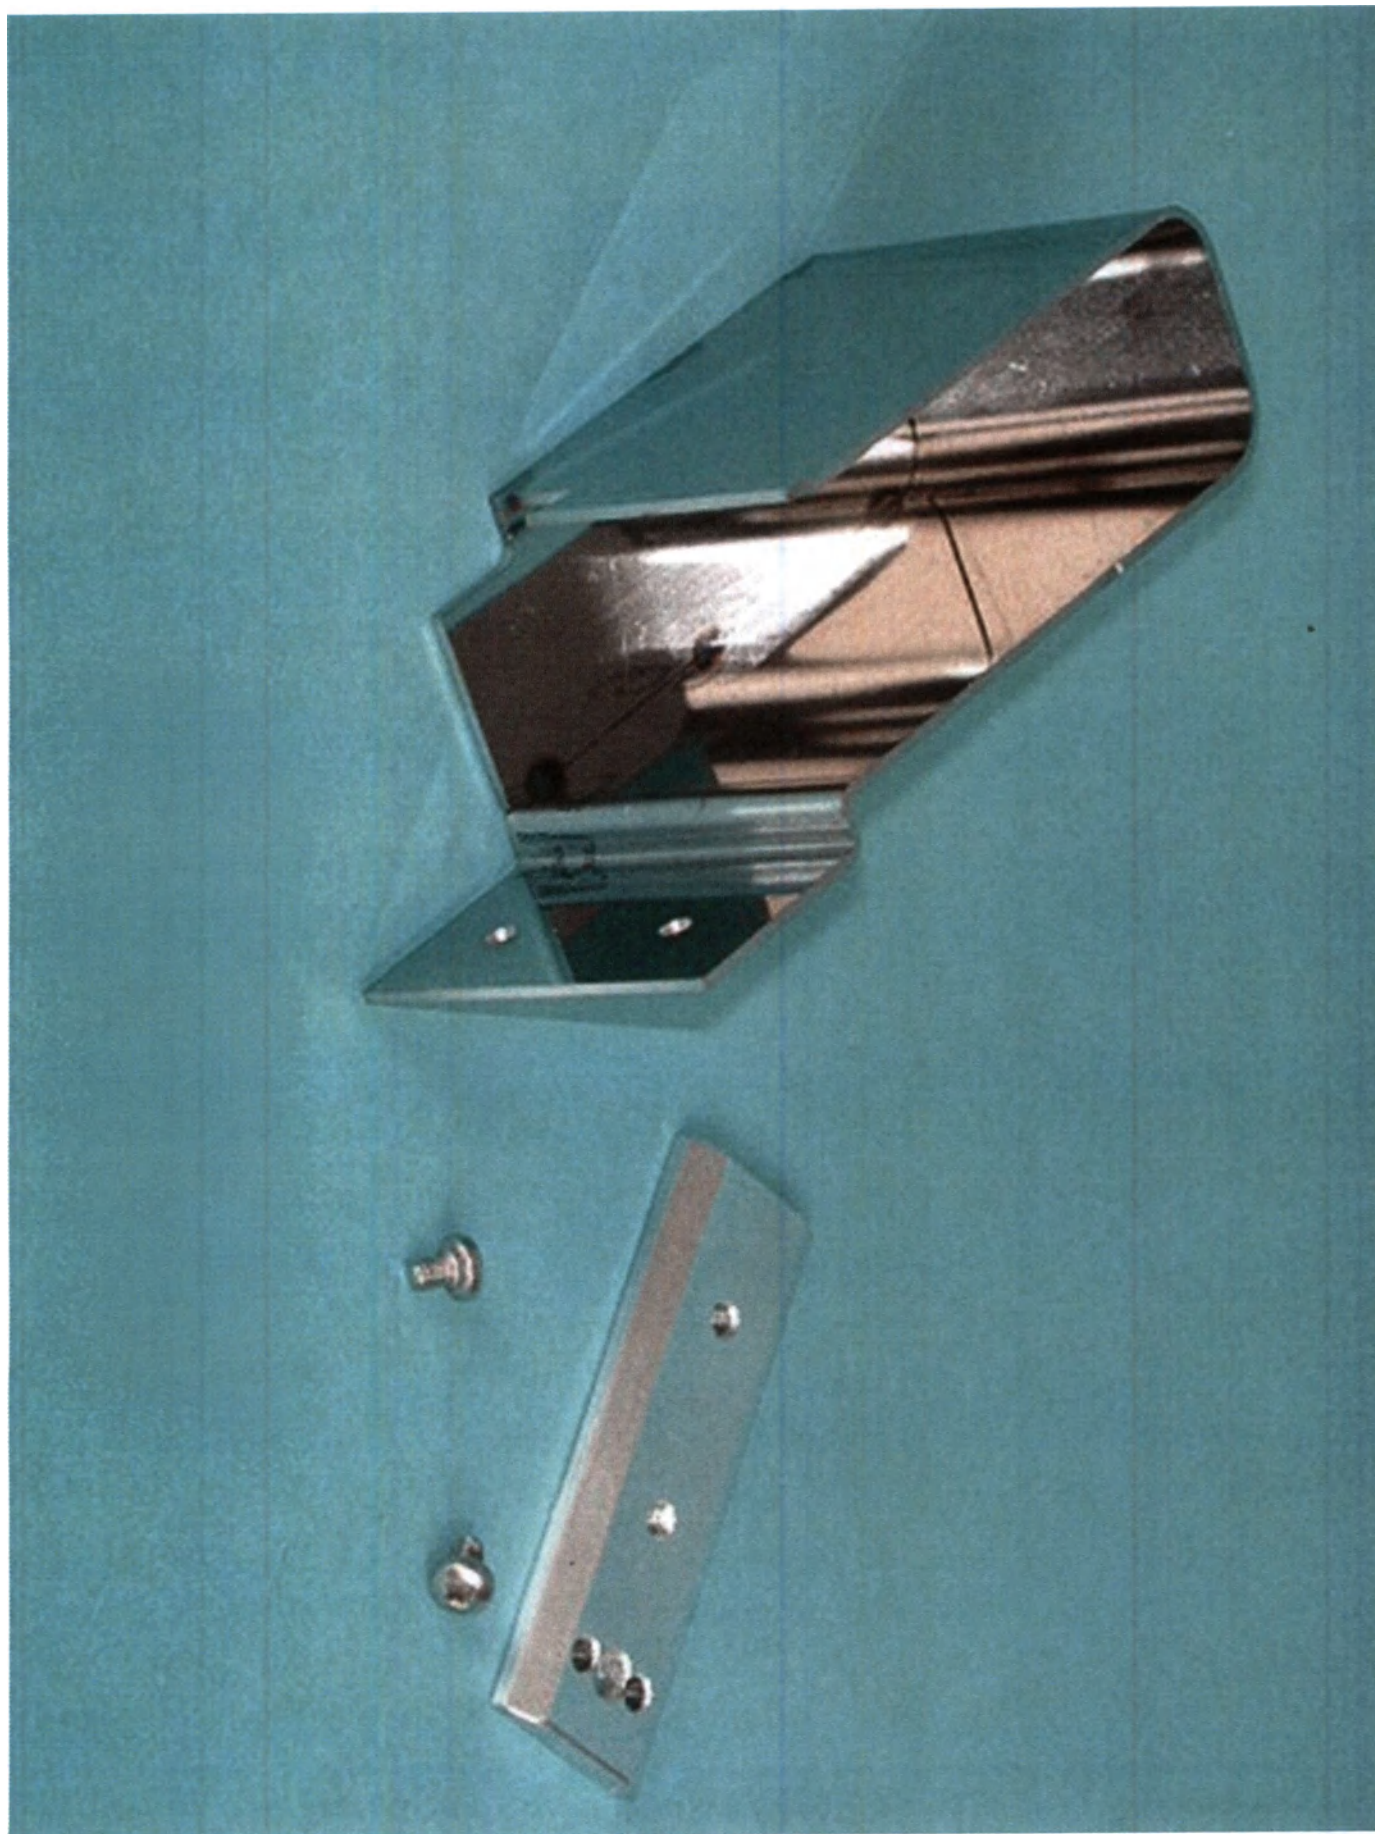


Специальные шурупы




Фильтры вакуумные




Муфта соединительная для 2мм трубок

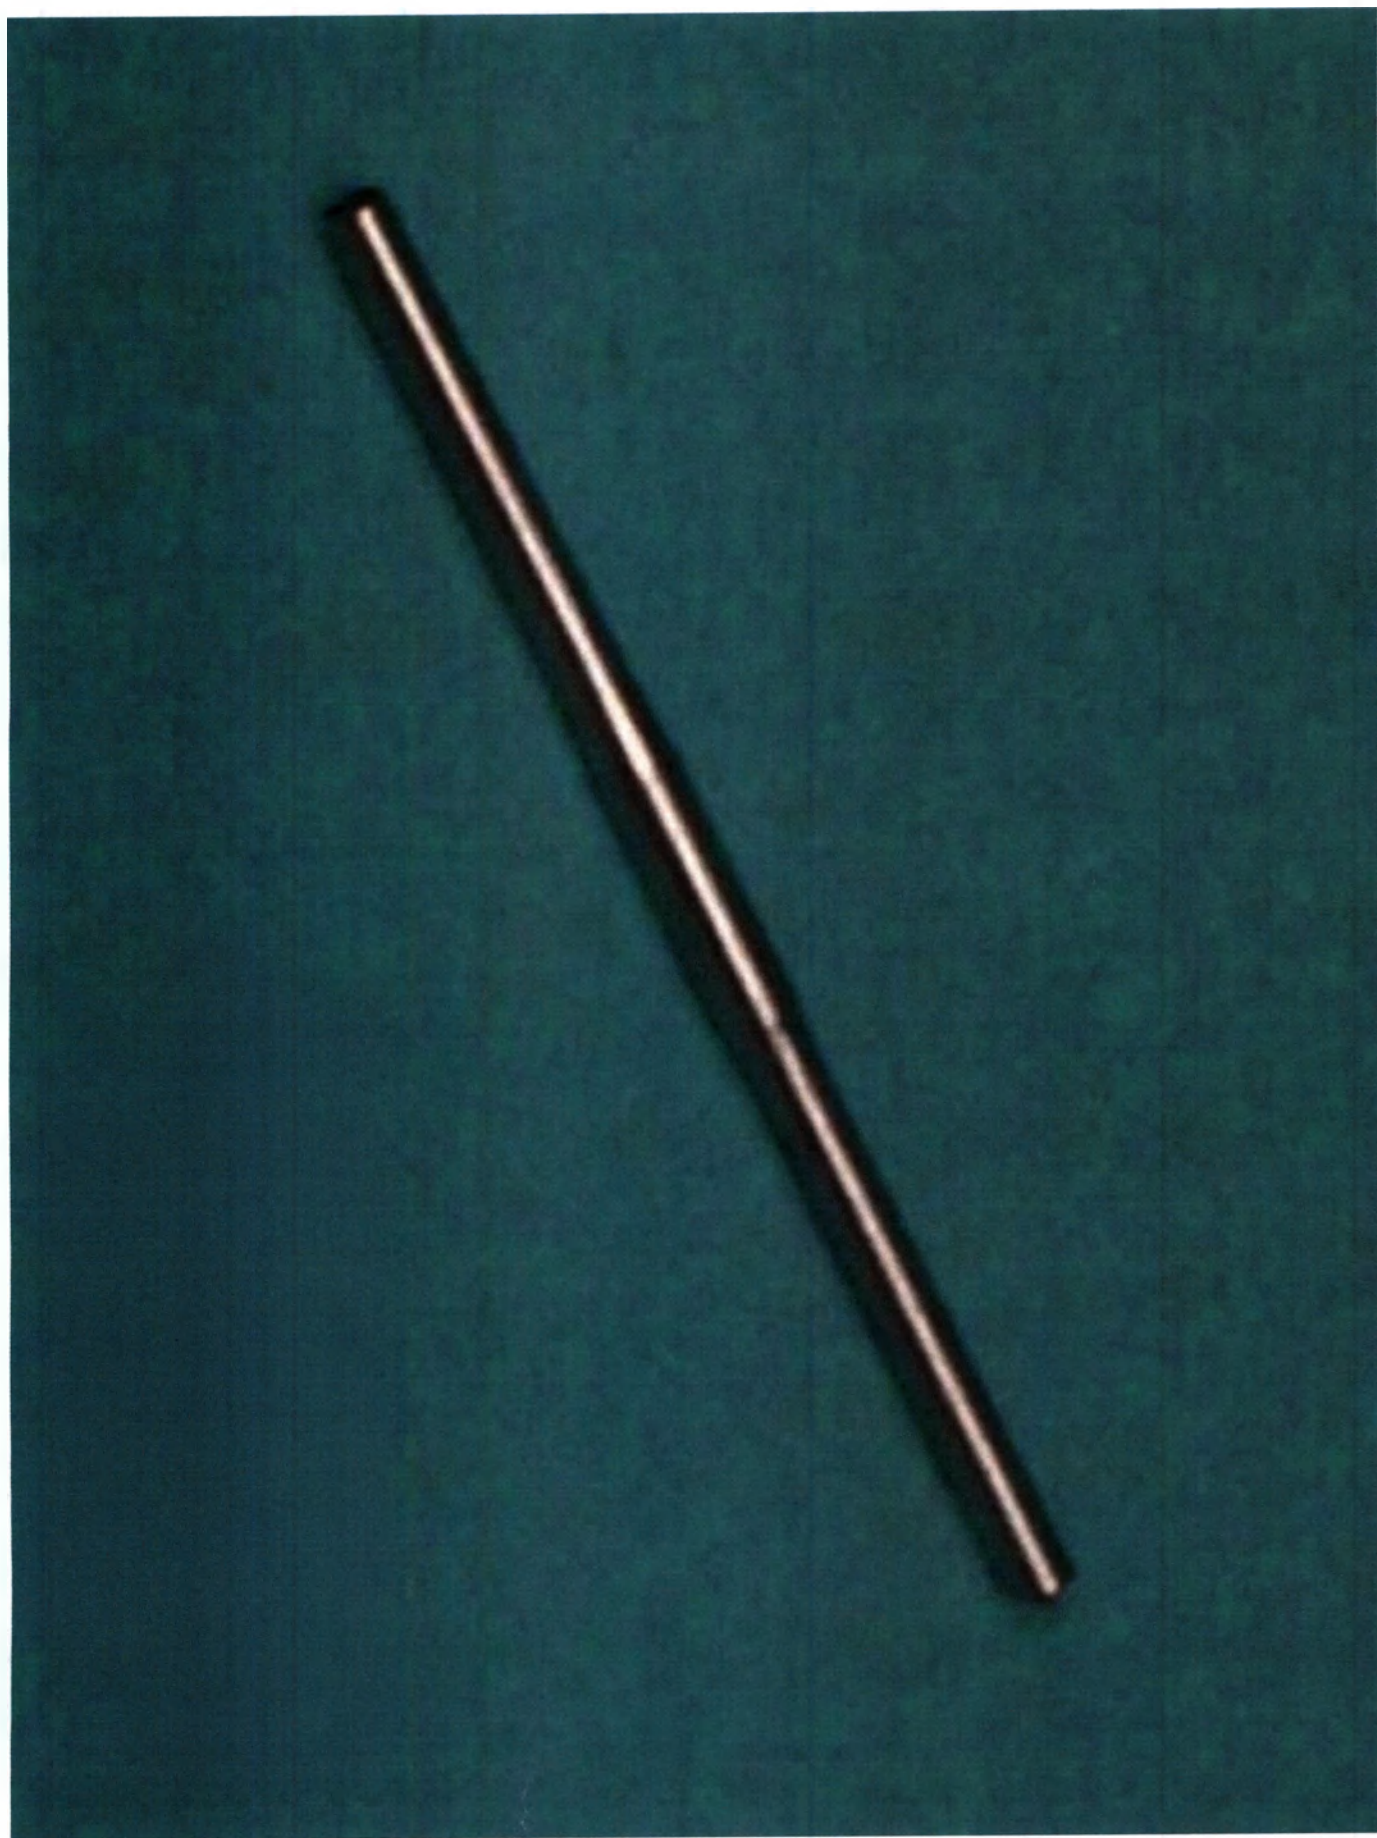

Наконечник пневматического захватывающего устройства

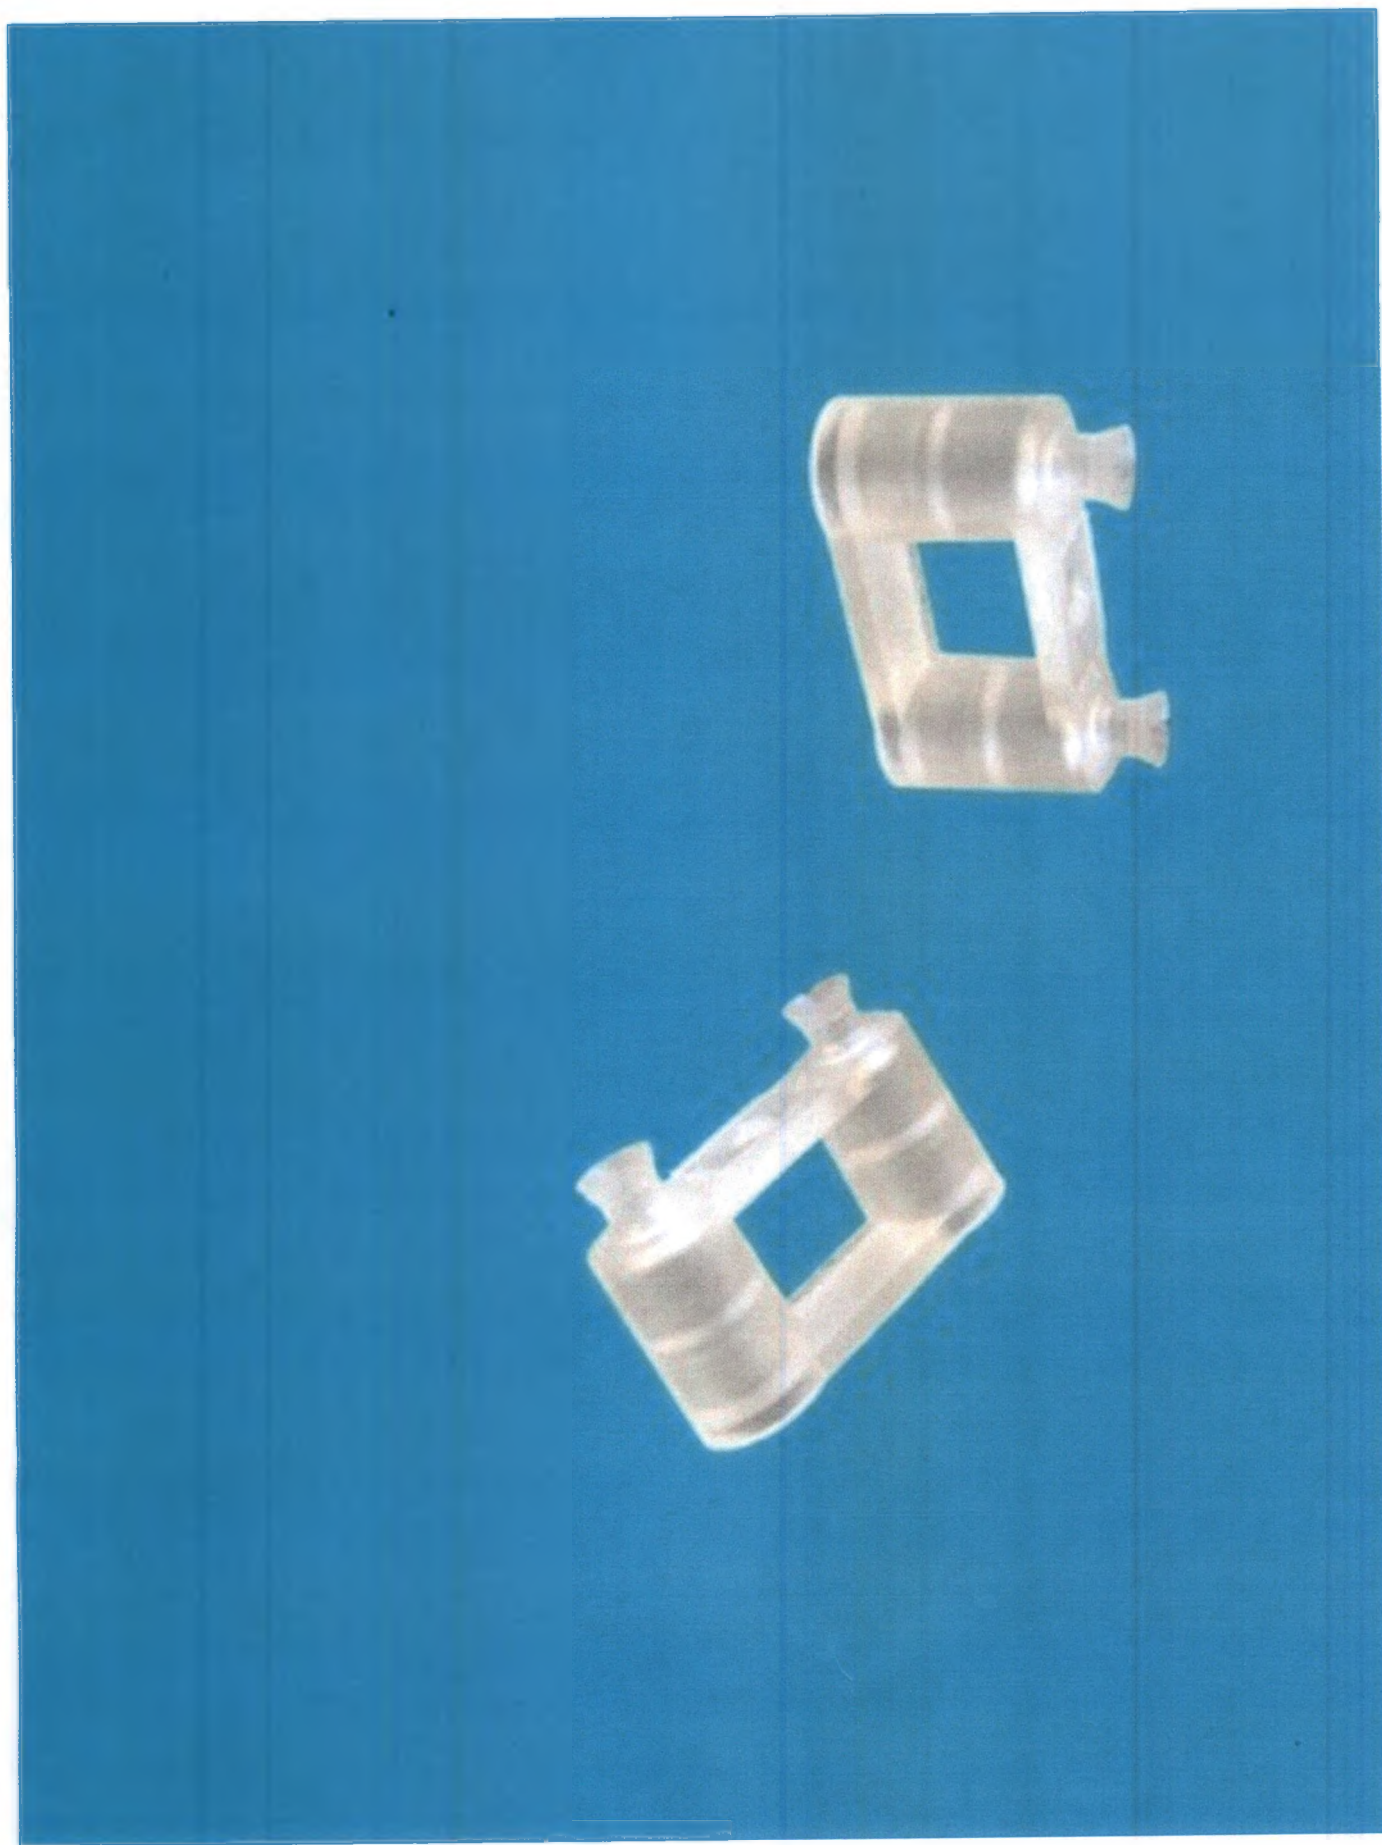


Штифт для удаления вращающего вала

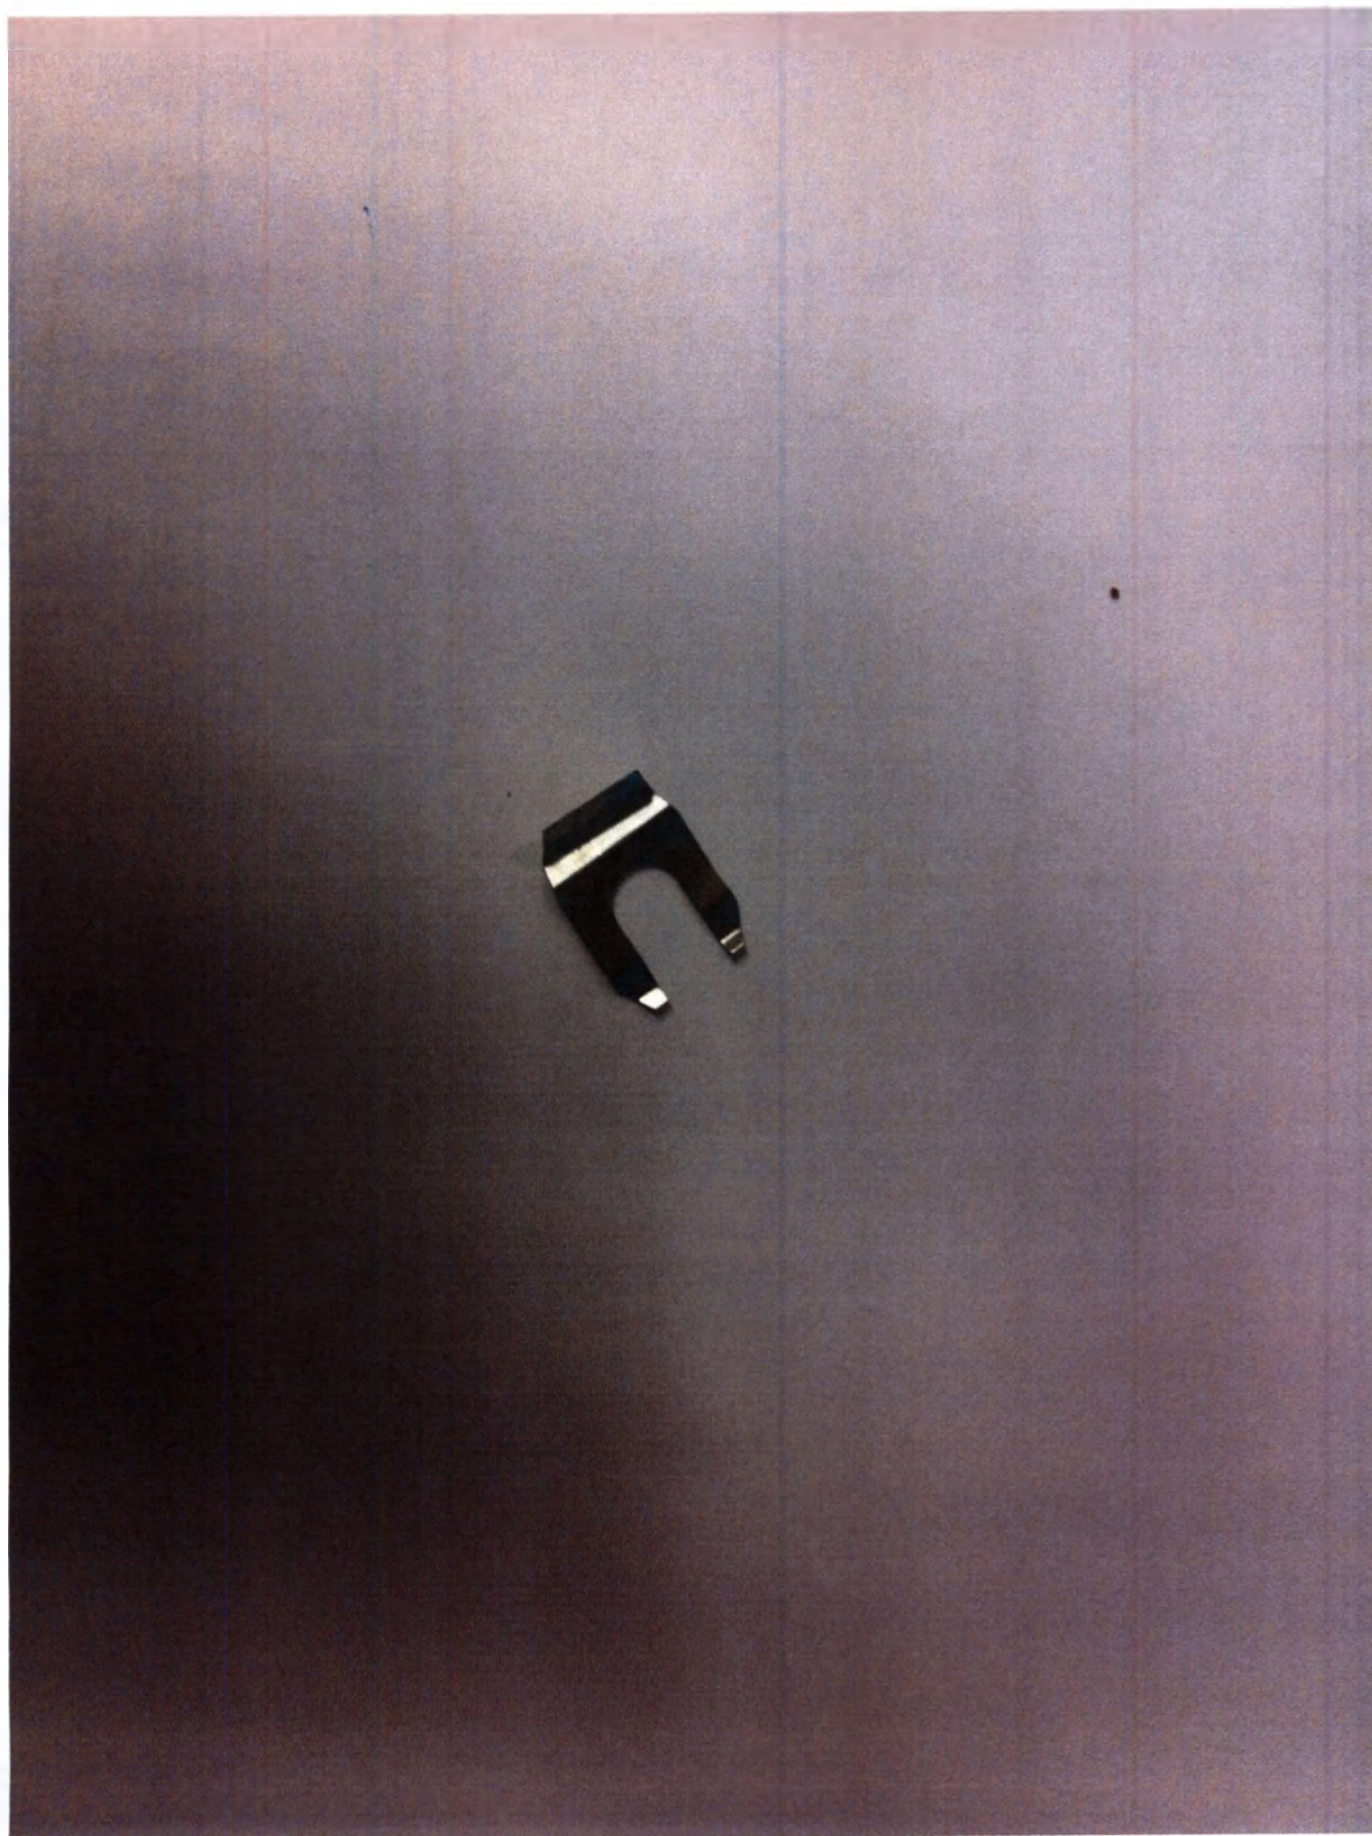


специальные лампы галогеновые, не более 5 шт.;




Наконечники поршня дозатора

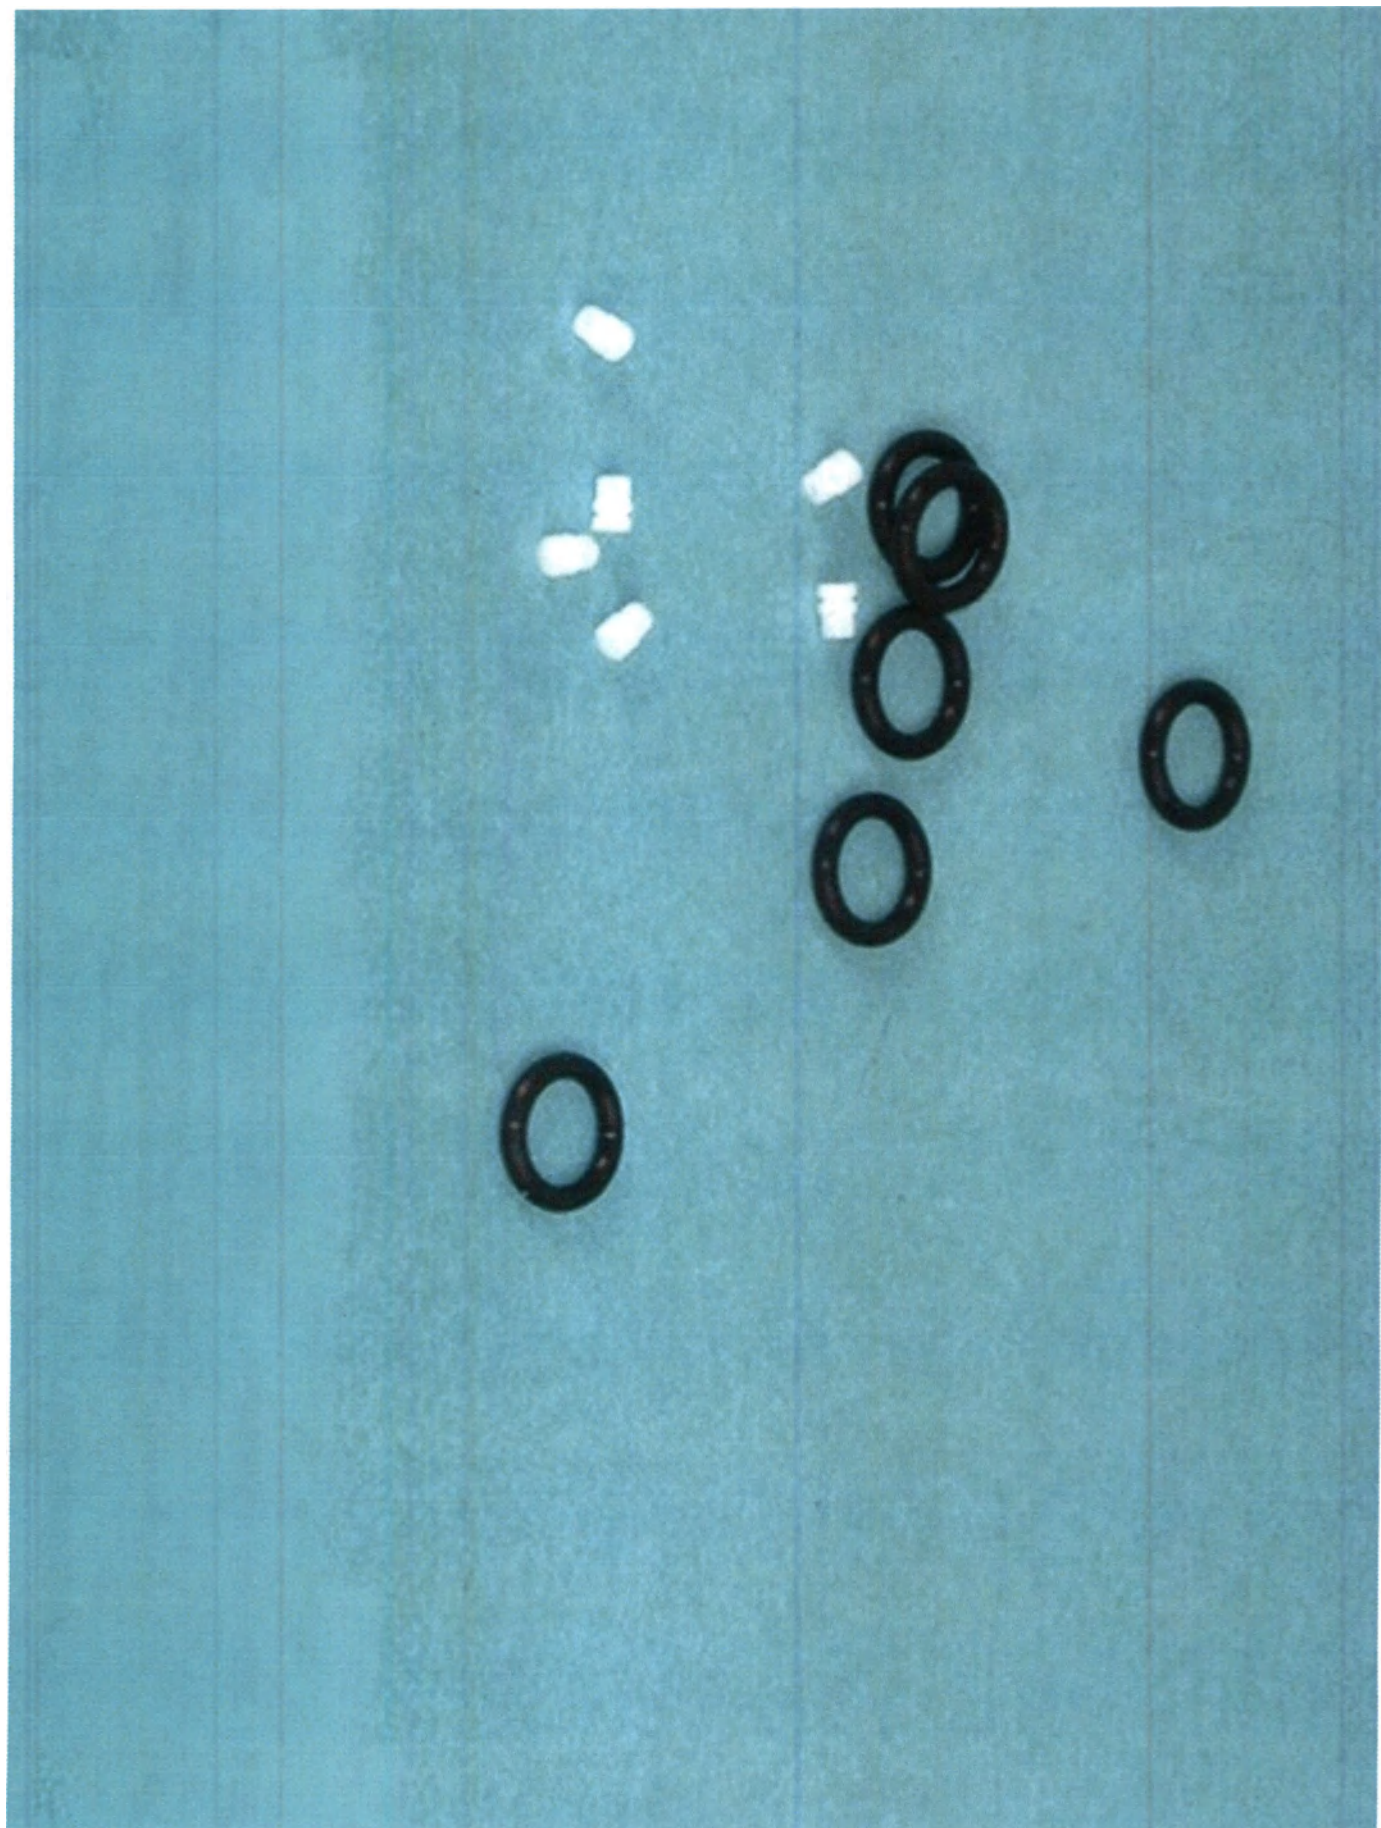

Специальные инструменты (гаечные ключи, отвертки, плоскогубцы)

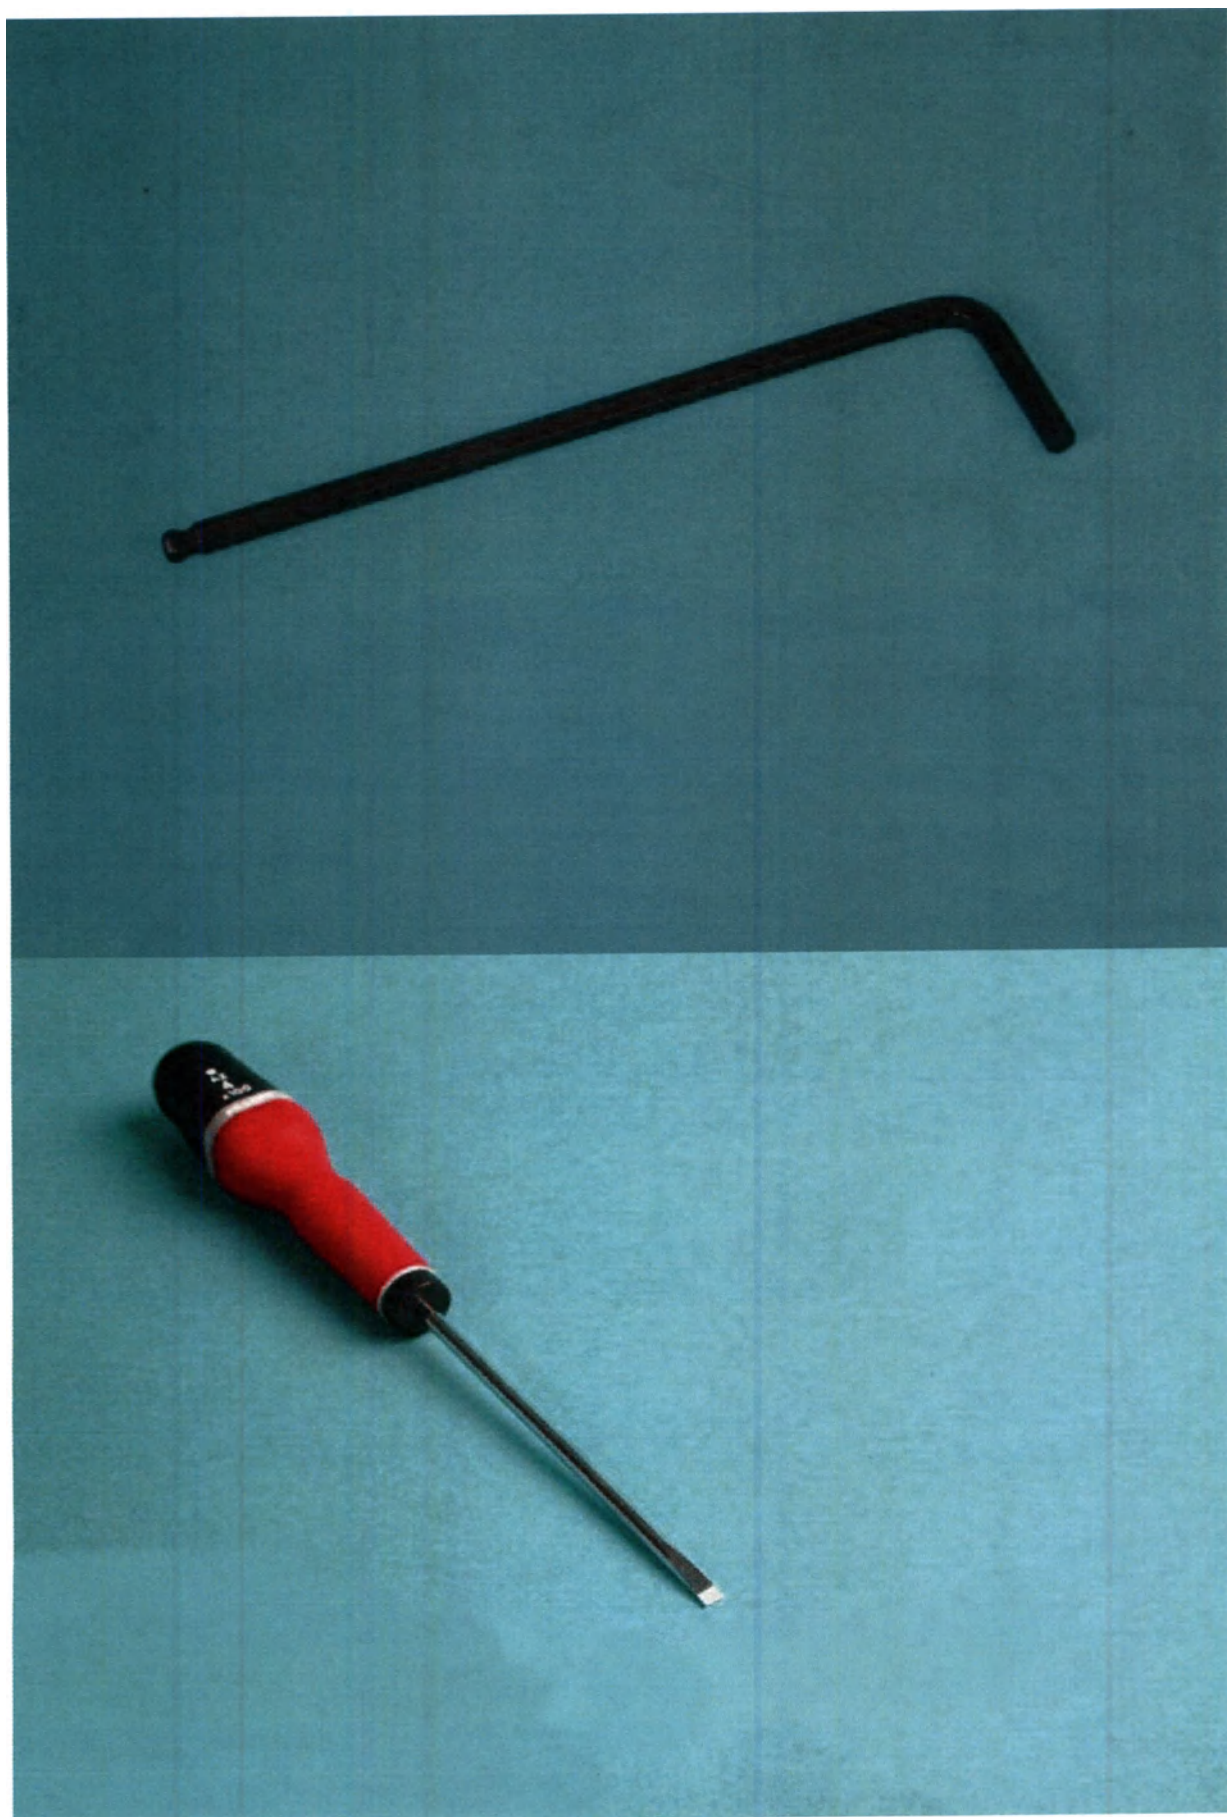


Специальные магнитные мешалки

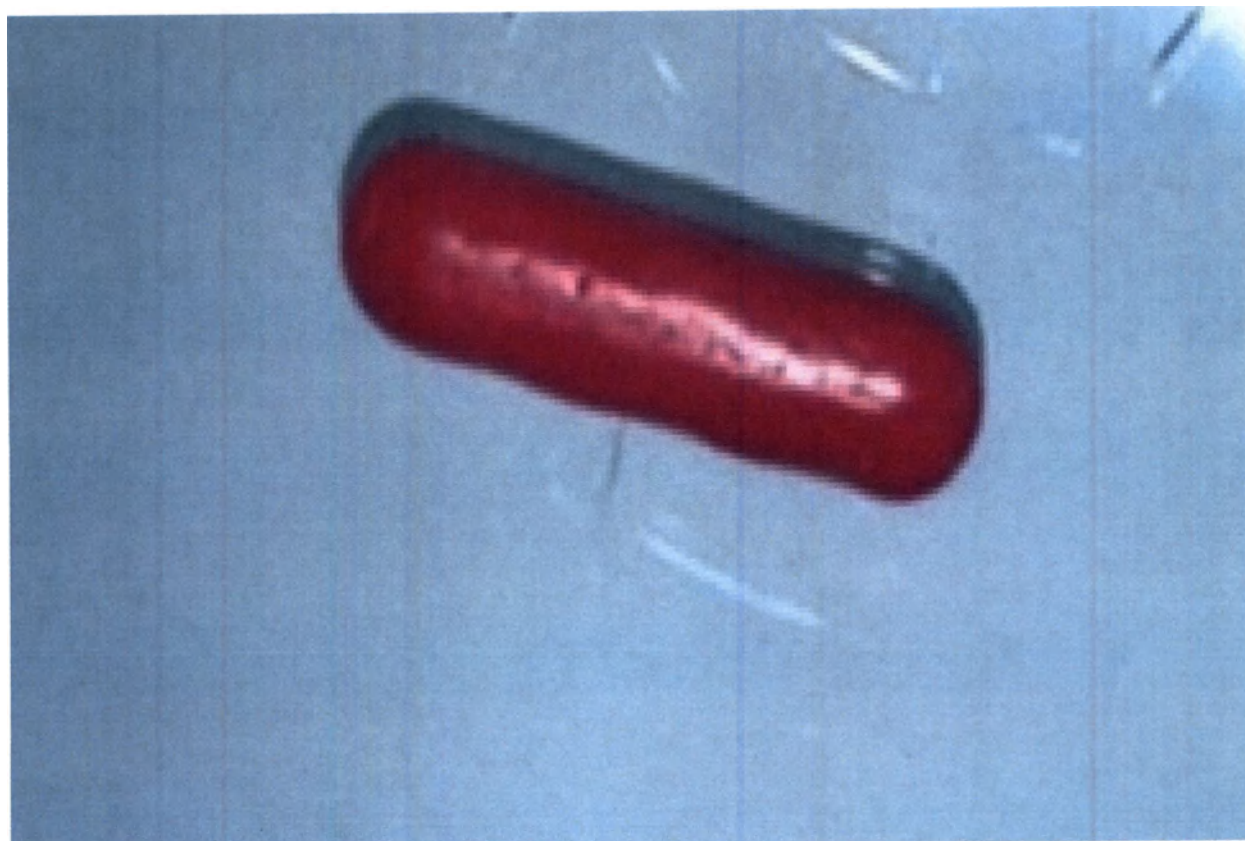

Дозаторы на 250мкл с наконечниками и уплотнительными кольцами




Фильтр войлочный

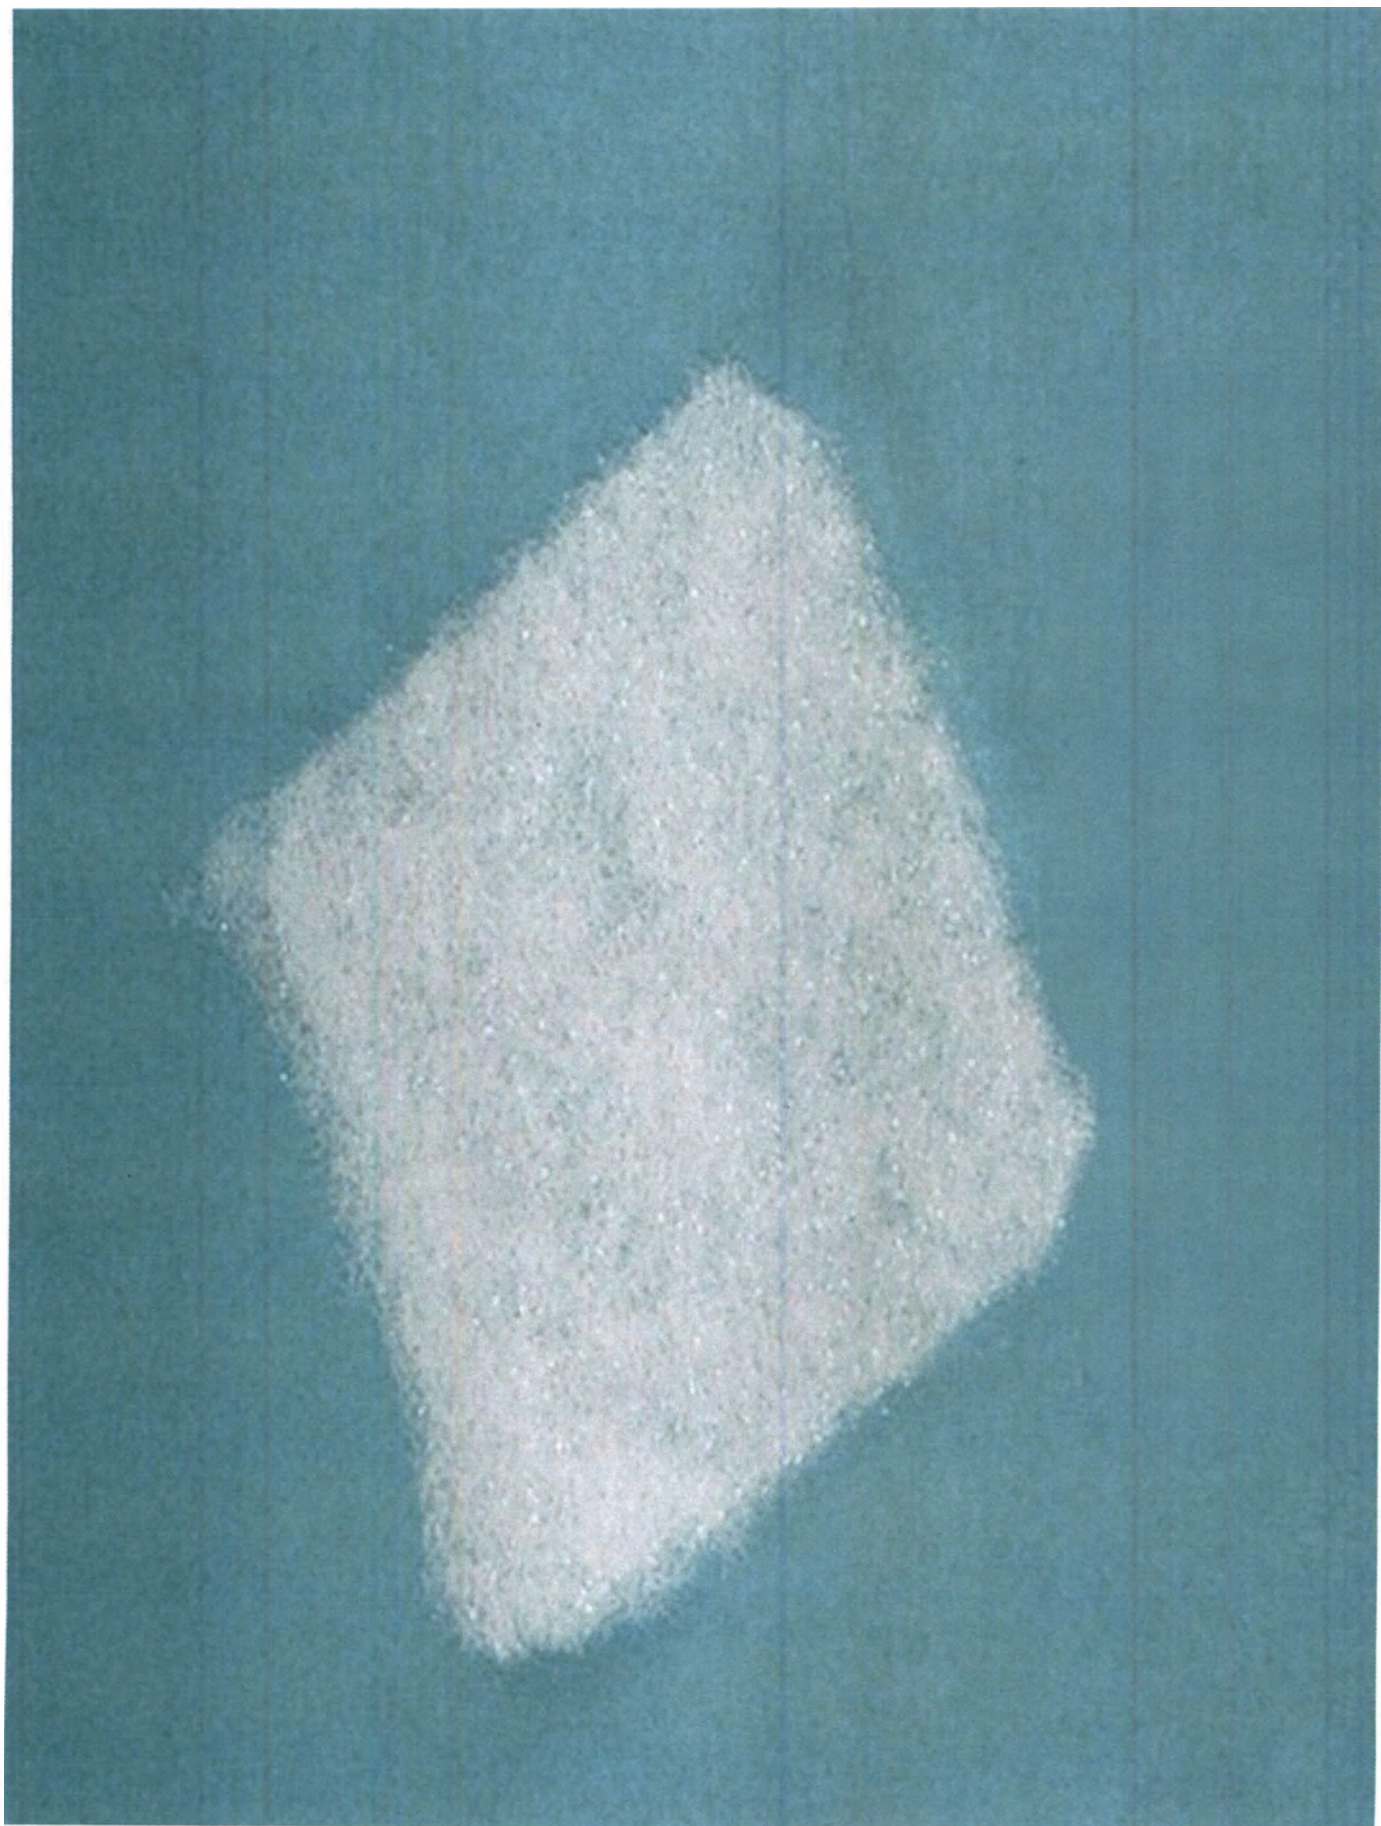


Пинцет для удаления кювет




Ручка сенсорного экрана

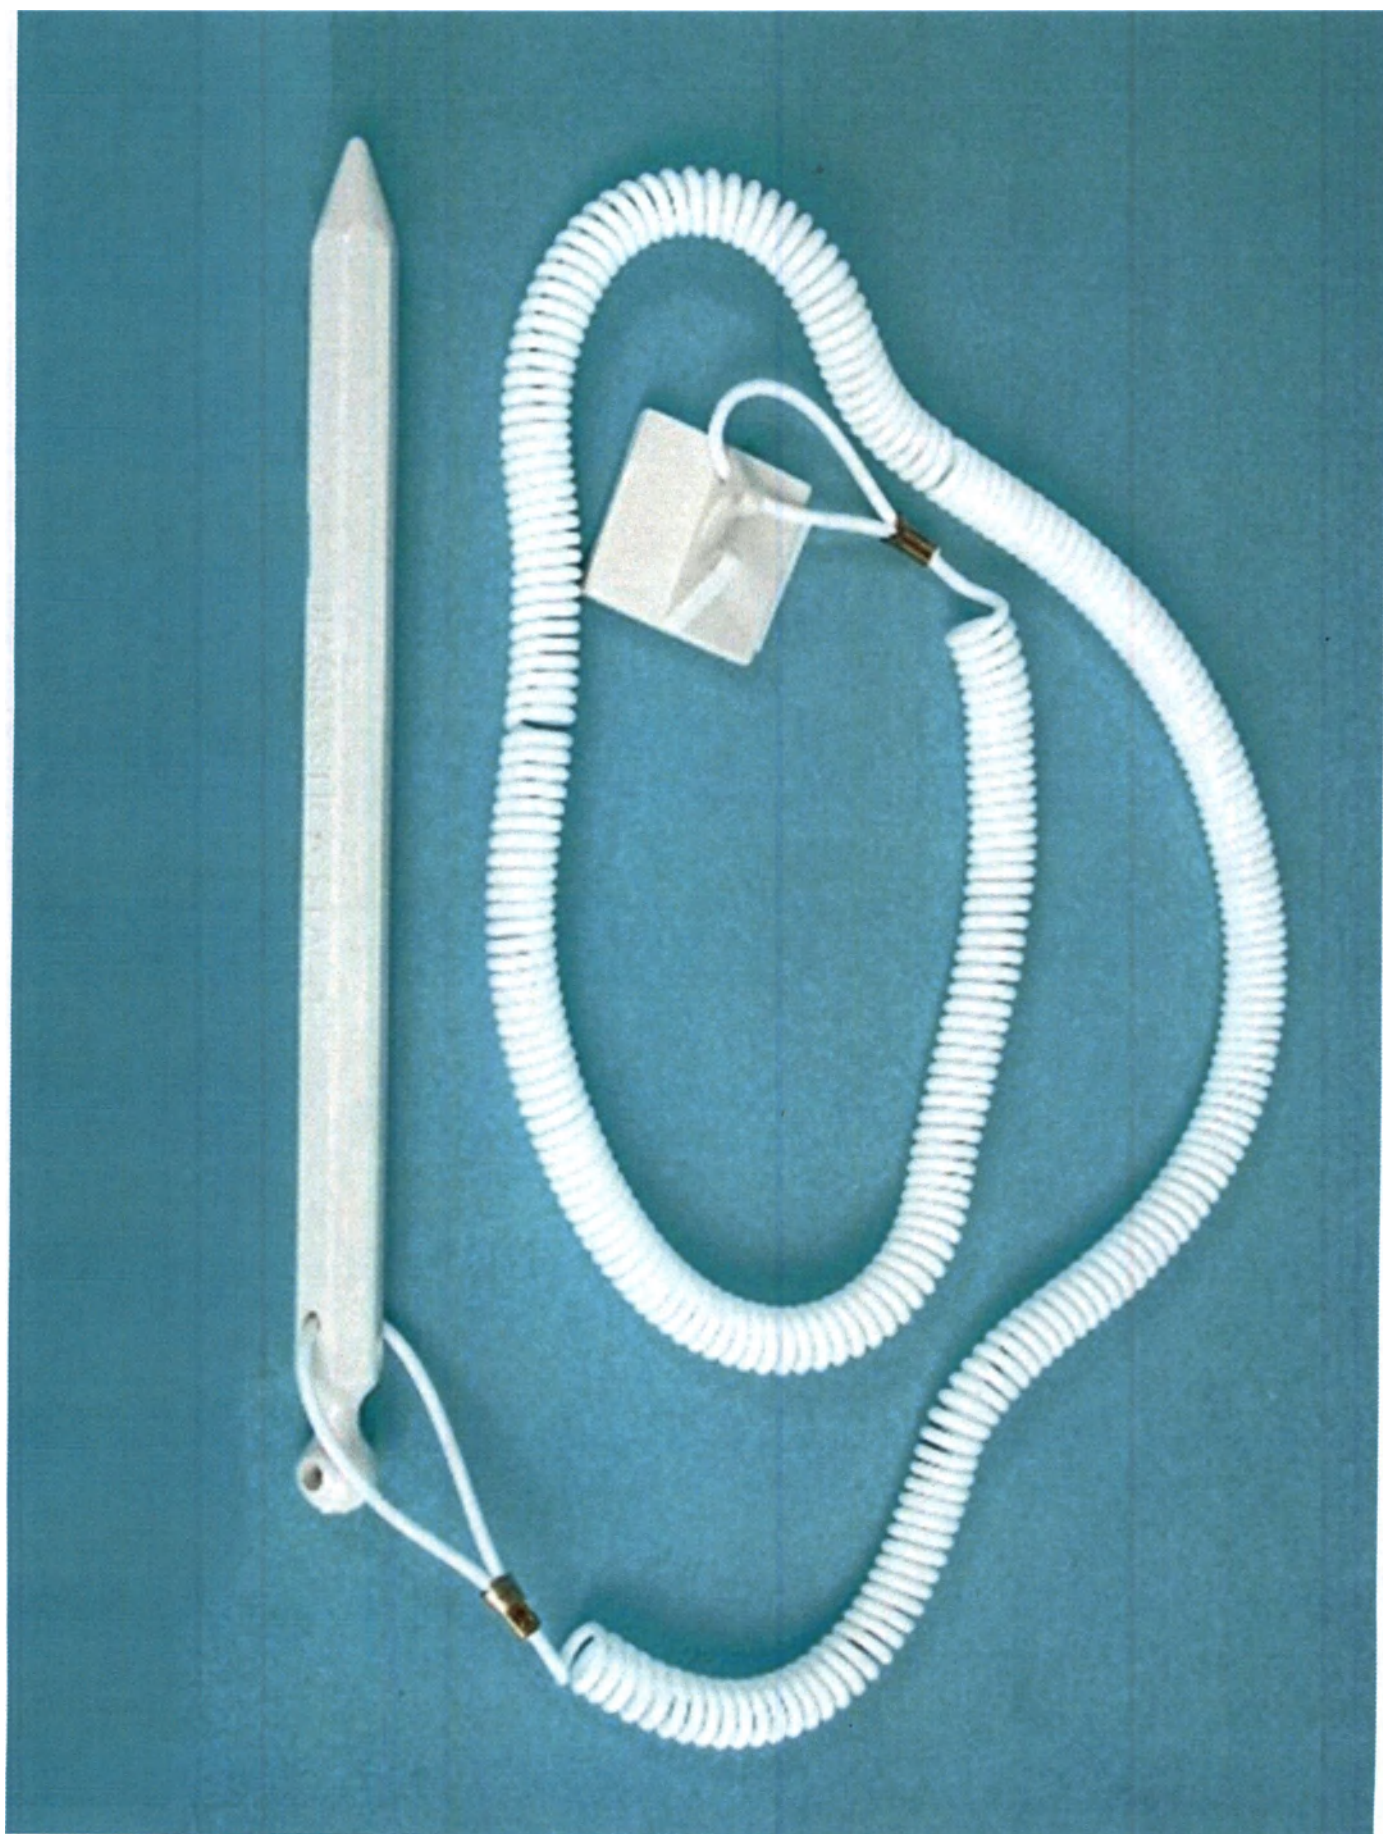

Колеса баркода для вращения пробирок

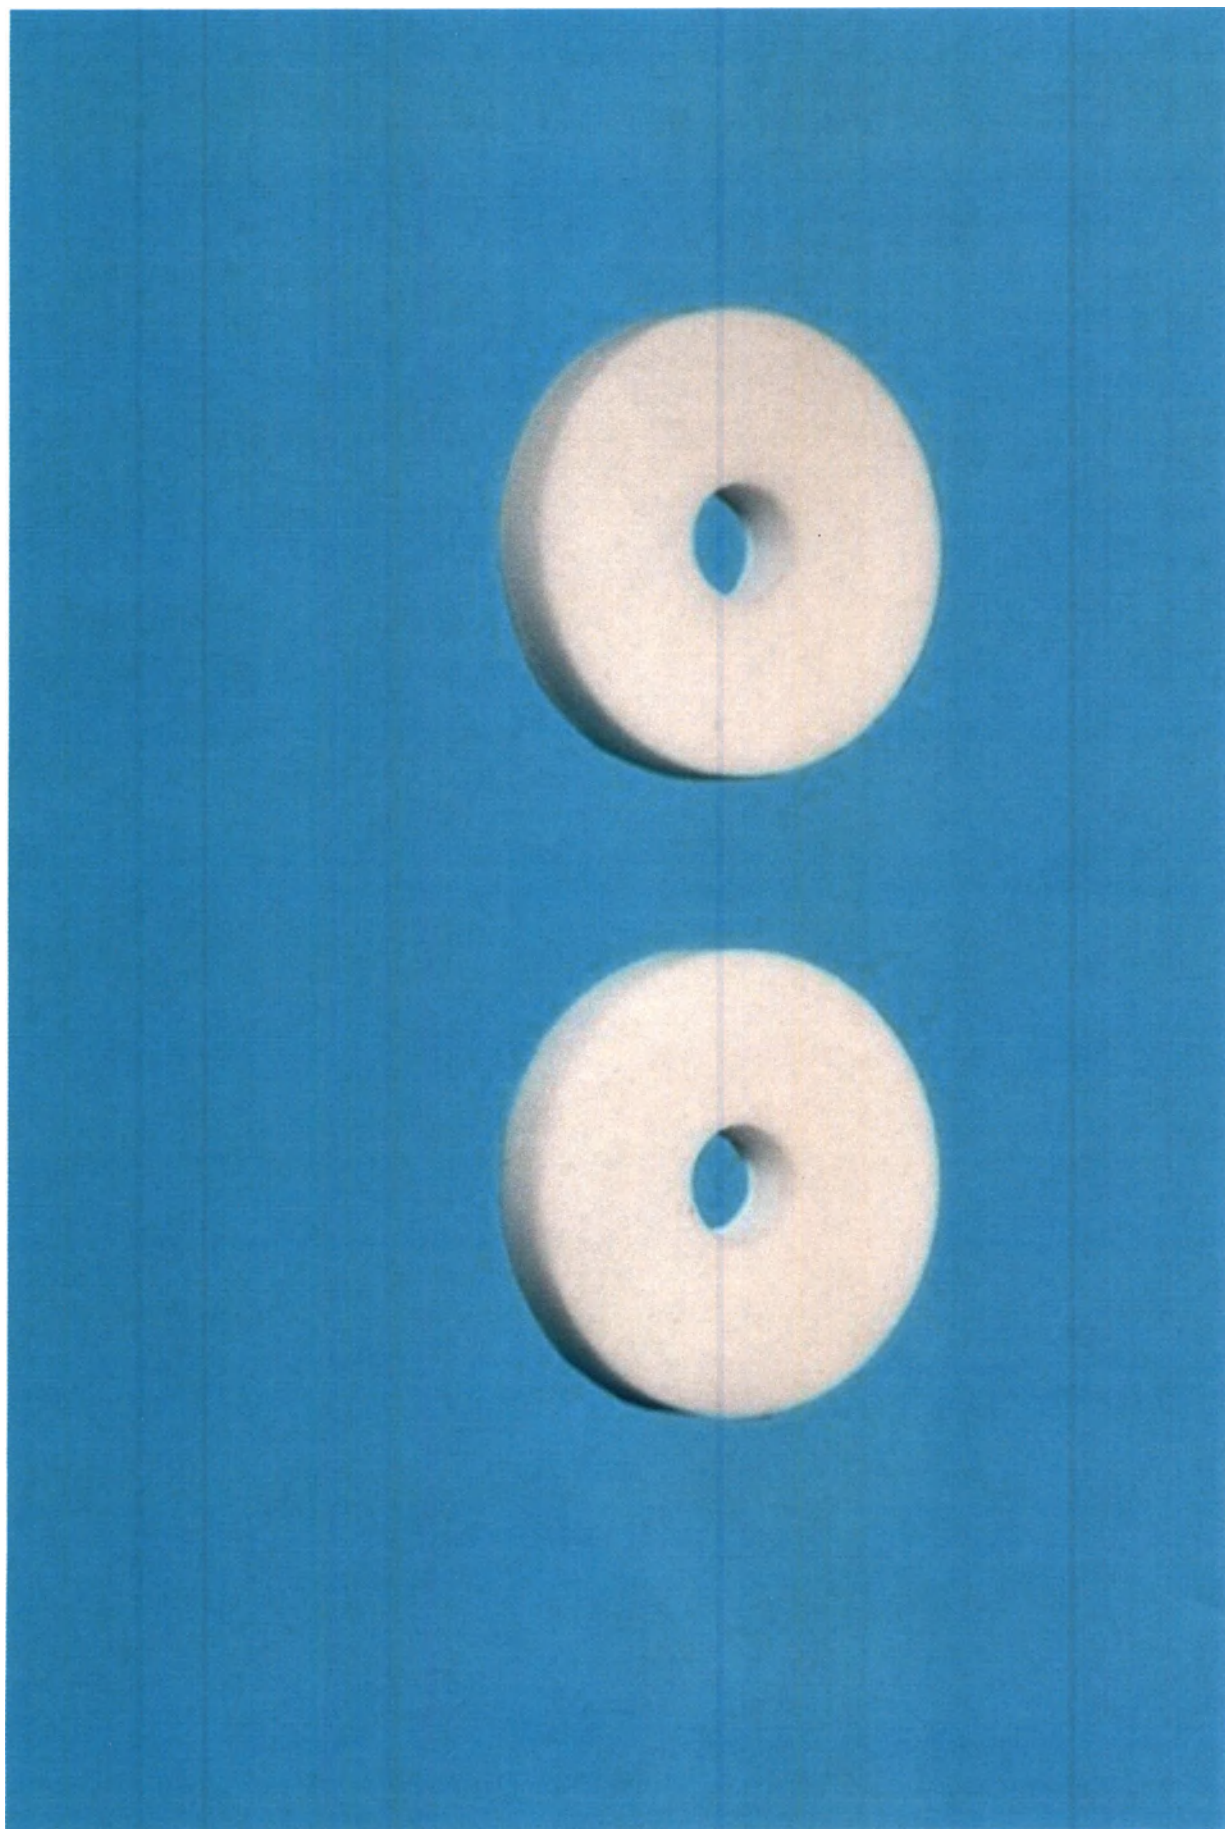

Специальные предохранители в упаковке

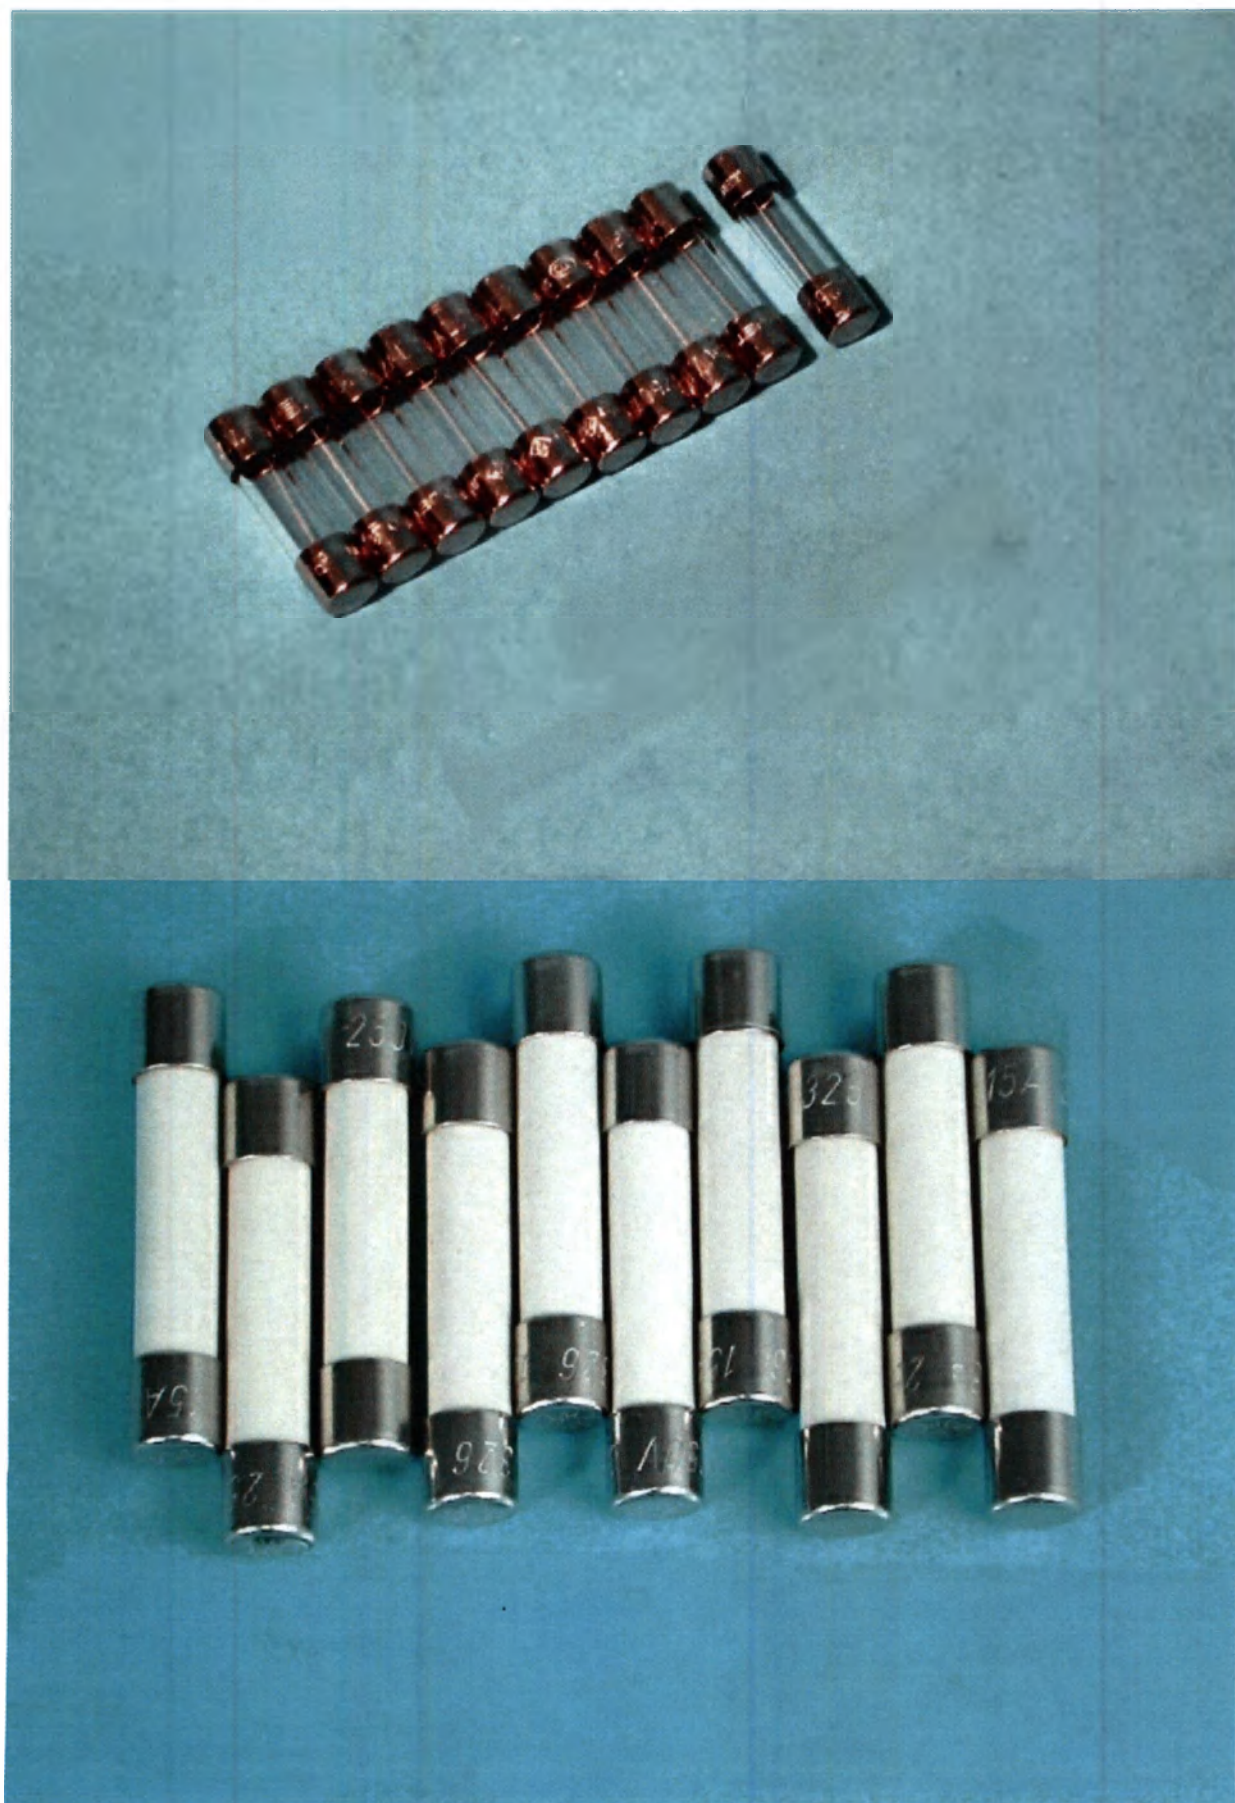

Наклейка



Документация: перечень материалов, вложенных в чемодан, описание установки защитного устройства от падения рэков.

Материалы		Инструменты	
№	Наименование	№	Наименование
1	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	1	Сверло
2	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	2	Сверло
3	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	3	Сверло
4	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	4	Сверло
5	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	5	Сверло
6	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	6	Сверло
7	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	7	Сверло
8	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	8	Сверло
9	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	9	Сверло
10	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	10	Сверло
11	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	11	Сверло
12	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	12	Сверло
13	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	13	Сверло
14	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	14	Сверло
15	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	15	Сверло
16	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	16	Сверло
17	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	17	Сверло
18	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	18	Сверло
19	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	19	Сверло
20	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	20	Сверло
21	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	21	Сверло
22	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	22	Сверло
23	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	23	Сверло
24	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	24	Сверло
25	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	25	Сверло
26	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	26	Сверло
27	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	27	Сверло
28	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	28	Сверло
29	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	29	Сверло
30	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	30	Сверло
31	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	31	Сверло
32	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	32	Сверло
33	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	33	Сверло
34	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	34	Сверло
35	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	35	Сверло
36	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	36	Сверло
37	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	37	Сверло
38	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	38	Сверло
39	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	39	Сверло
40	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	40	Сверло
41	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	41	Сверло
42	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	42	Сверло
43	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	43	Сверло
44	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	44	Сверло
45	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	45	Сверло
46	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	46	Сверло
47	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	47	Сверло
48	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	48	Сверло
49	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	49	Сверло
50	Скрепы для крепления защитного устройства к ракам	50	Сверло

Procedure to install the protection against rack falling

Procédure d'installation de la protection antichute de rack

Notice history

Historique

0931131

- Notice creation

0931131A

- Version for internal use

0931131B

- Update resulting from the rack falling upgrade

0931131C

- Addition of STA-R Max®

0931131

- Création de la notice

0931131A

- Version à usage interne

0931131B

- Mise à jour suite à évolution de la protection antichute de rack

0931131C

- Ajout de STA-R Max®

Necessary tools / Outils nécessaires

Screwdriver Pozidrive no. 1 (included in the box) / Tournevis Pozidrive n° 1 (inclus dans la mallette)

1. Procedure

1. Procédure

Mount then fix the protection against the rack falling (see mark 1 of the figure below) using the two fixing screws

Monter puis fixer la protection antichute de rack (repère 1 de la figure ci-dessous) à l'aide des deux vis de fixation

45

Специальный USB ключ



Специальный переходник RX/TX



Специальный защитный пластиковый мешок




Специальный защитный картонный короб



Специальные крышки и газовые амортизаторы для STA R Max[®]




Специальные регулировочные инструменты для пробирок

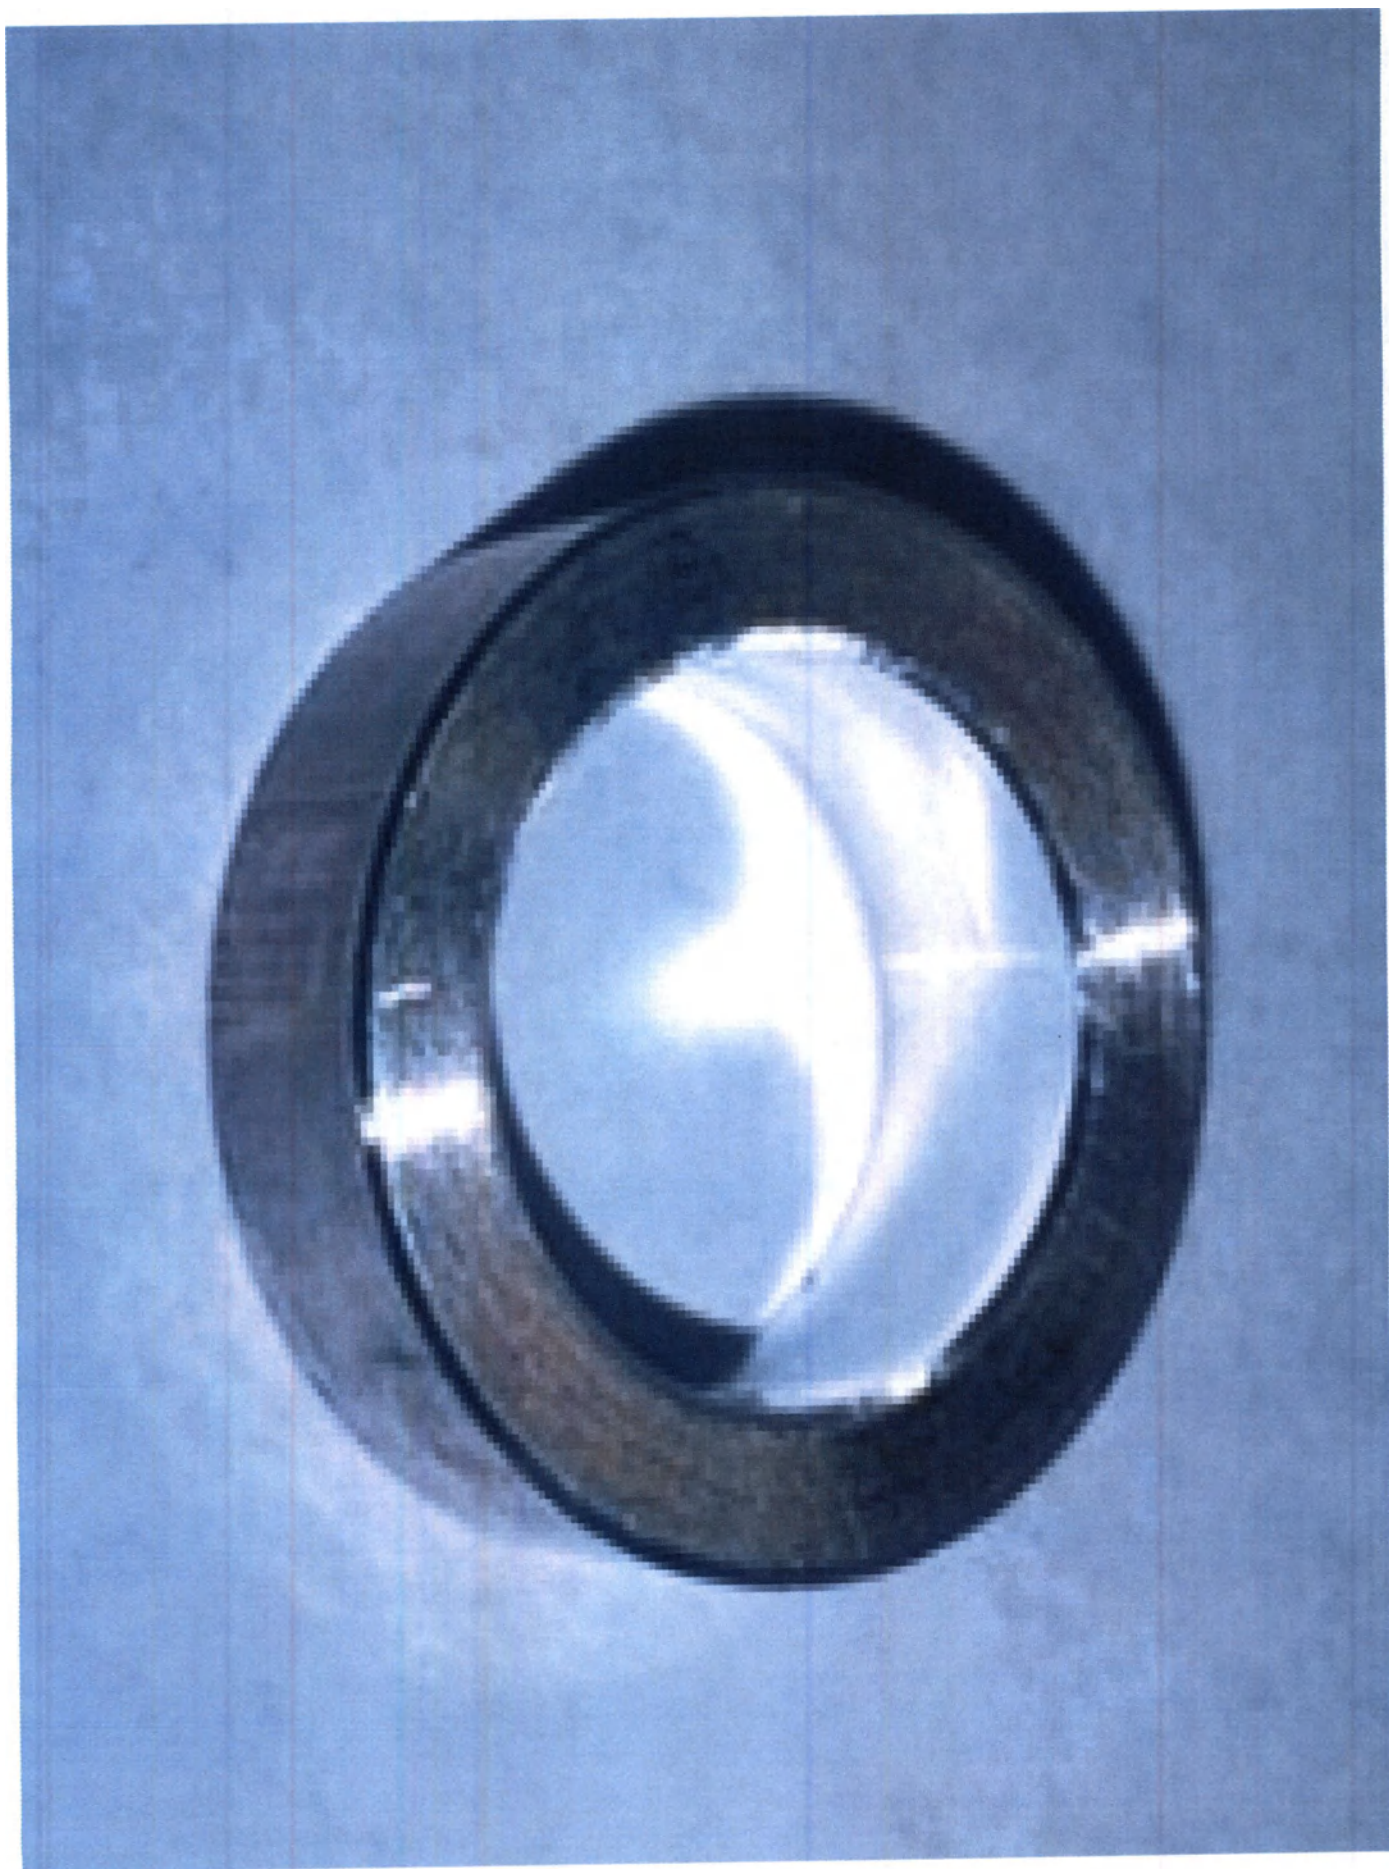


Специальные фиксаторы и соединители для проб



Специальные перчатки для оператора

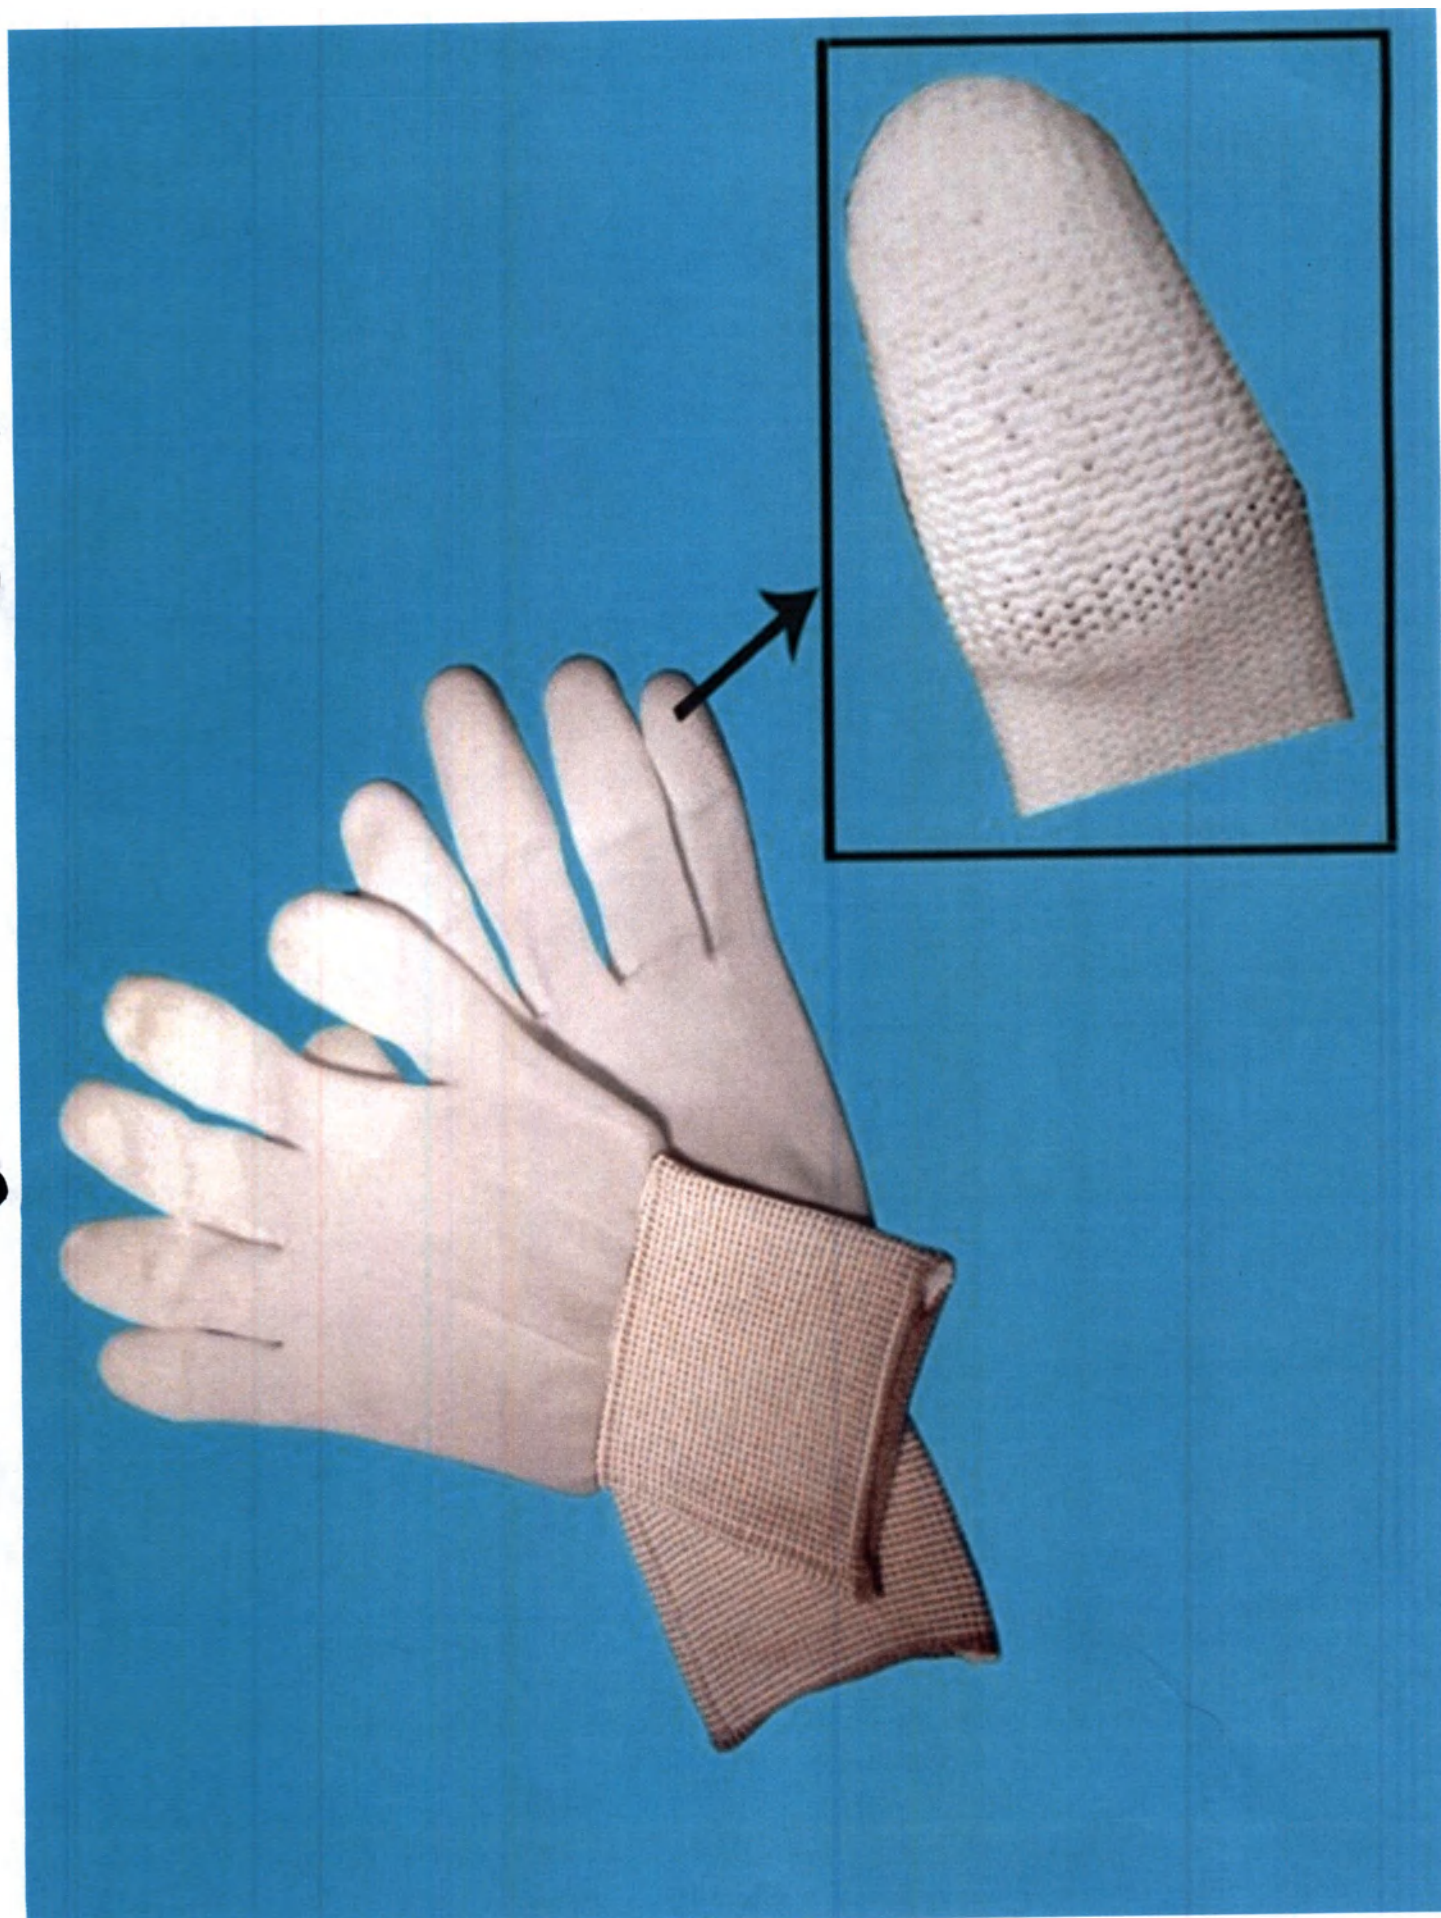

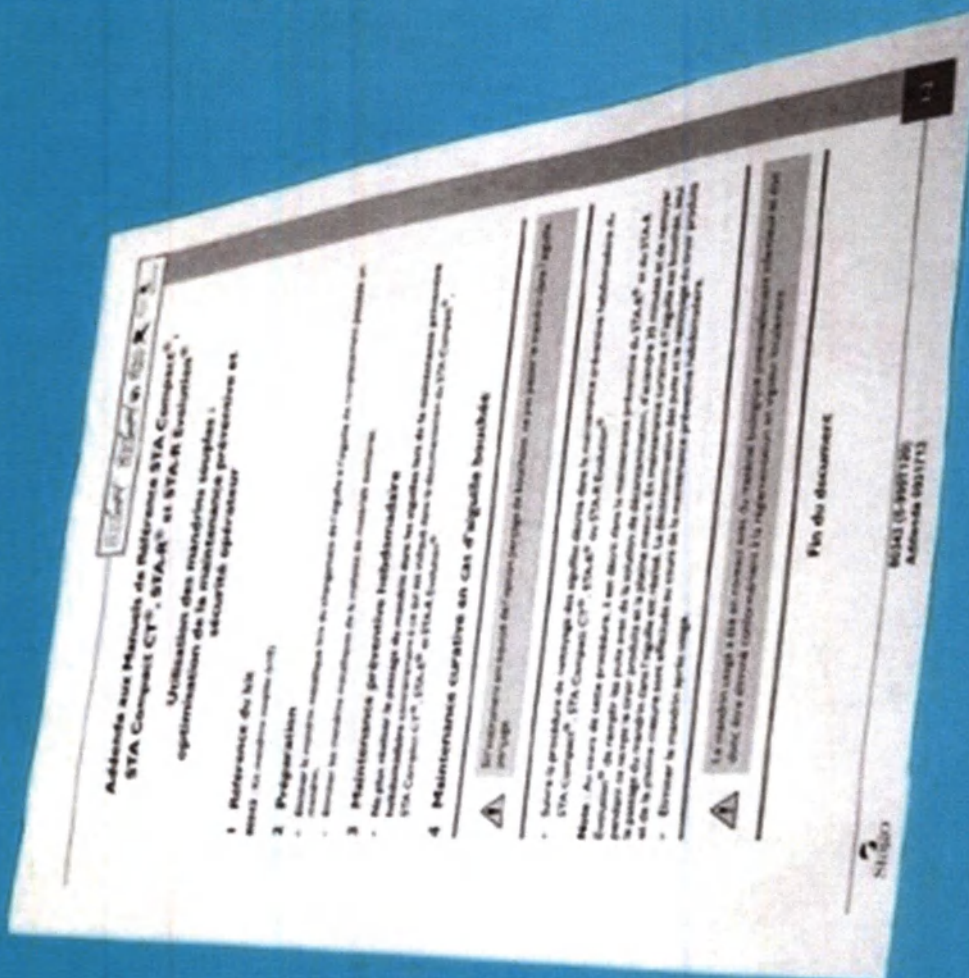

Специальное устройство для прокалывания крышек



53



Генеральный директор
Трусов А.В.