

**Фотографические изображения медицинского изделия
«Электроды с интегрированными проводами IP-SET® для диагностики
и мониторинга ЭКГ пластинчатые, одноразовые в наборах и отдельных
упаковках в вариантах исполнения»**

Электроды с интегрированными проводами IP-SET® для диагностики и мониторинга ЭКГ пластинчатые, одноразовые в наборах в вариантах исполнения:

1. Электроды рентгенопрозрачные для взрослых и детей старше 8 лет, в составе:

- 4 электрода в одном соединении – 1 шт.;

- 6 электродов в одном соединении – 1 шт.;

Электроды с интегрированными проводами IP-SET® для диагностики и мониторинга ЭКГ пластинчатые, одноразовые в наборе в варианте исполнения




Комплектация:

Электроды рентгенопрозрачные для взрослых и детей старше 8 лет, в составе:

- 4 электрода в одном соединении – 1 шт.;

- 6 электродов в одном соединении – 1 шт.;



LOT	Код партии	1420002
REF	Номер по каталогу	50602
	Дата изготовления	2014-03
	Использовать до ...	2017-03



Осторожно! Обратитесь к сопроводительной документации



Не содержит натуральный латекс



Не допускать воздействия солнечного света

RT

Рентгенопрозрачность

Возраст



Для взрослых и детей старше 8 лет




По истечении срока службы, пожалуйста, следуйте указаниям Европейской директивы по утилизации



Не использовать повторно



Беречь от влаги



Температурный диапазон



Не стерильно

Возраст



Не для новорожденных



Соответствует Европейской Директиве 93/42/EEC

Производитель: INTEGRAL PROCESS SAS,
Z.A. des Bouilles, 12 rue des Cayennes, 95700 Conflans Sainte Honorine, France




2. Электроды рентгенопрозрачные для взрослых и детей старше 8 лет, в составе:
 - 5 электродов в одном соединении – 2 шт.;

Электроды с интегрированными проводами IP-SET® для диагностики и мониторинга ЭКГ пластинчатые, одноразовые в наборе в варианте исполнения

Комплектация:
 Электроды рентгенопрозрачные для взрослых и детей старше 8 лет, в составе:
 - 5 электродов в одном соединении – 2 шт.;

INTEGRAL PROCESS

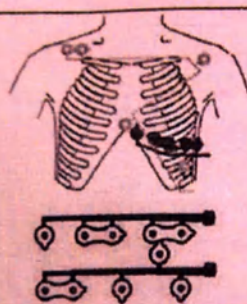

LOT	Код партии	1430008
REF	Номер по каталогу	50605
	Дата изготовления	2014-03
	Использовать до ...	2017-03

Осторожно! Обратитесь к сопроводительной документации

Не содержит натуральный латекс

Не допускать воздействия солнечного света

RT Рентгенопрозрачность

Возраст
 Для взрослых и детей старше 8 лет

По истечении срока службы, пожалуйста, следуйте указаниям Европейской директивы по утилизации

Не использовать повторно

Беречь от влаги


Температурный диапазон
5 °C – 30 °C

Не стерильно

Возраст
 Не для новорожденных

CE Соответствует Европейской Директиве 93/42/EEC

Производитель: INTEGRAL PROCESS SAS,
 Z.A. des Boutries, 12 rue des Cayennes, 78700 Conflans Sainte Honorine, France

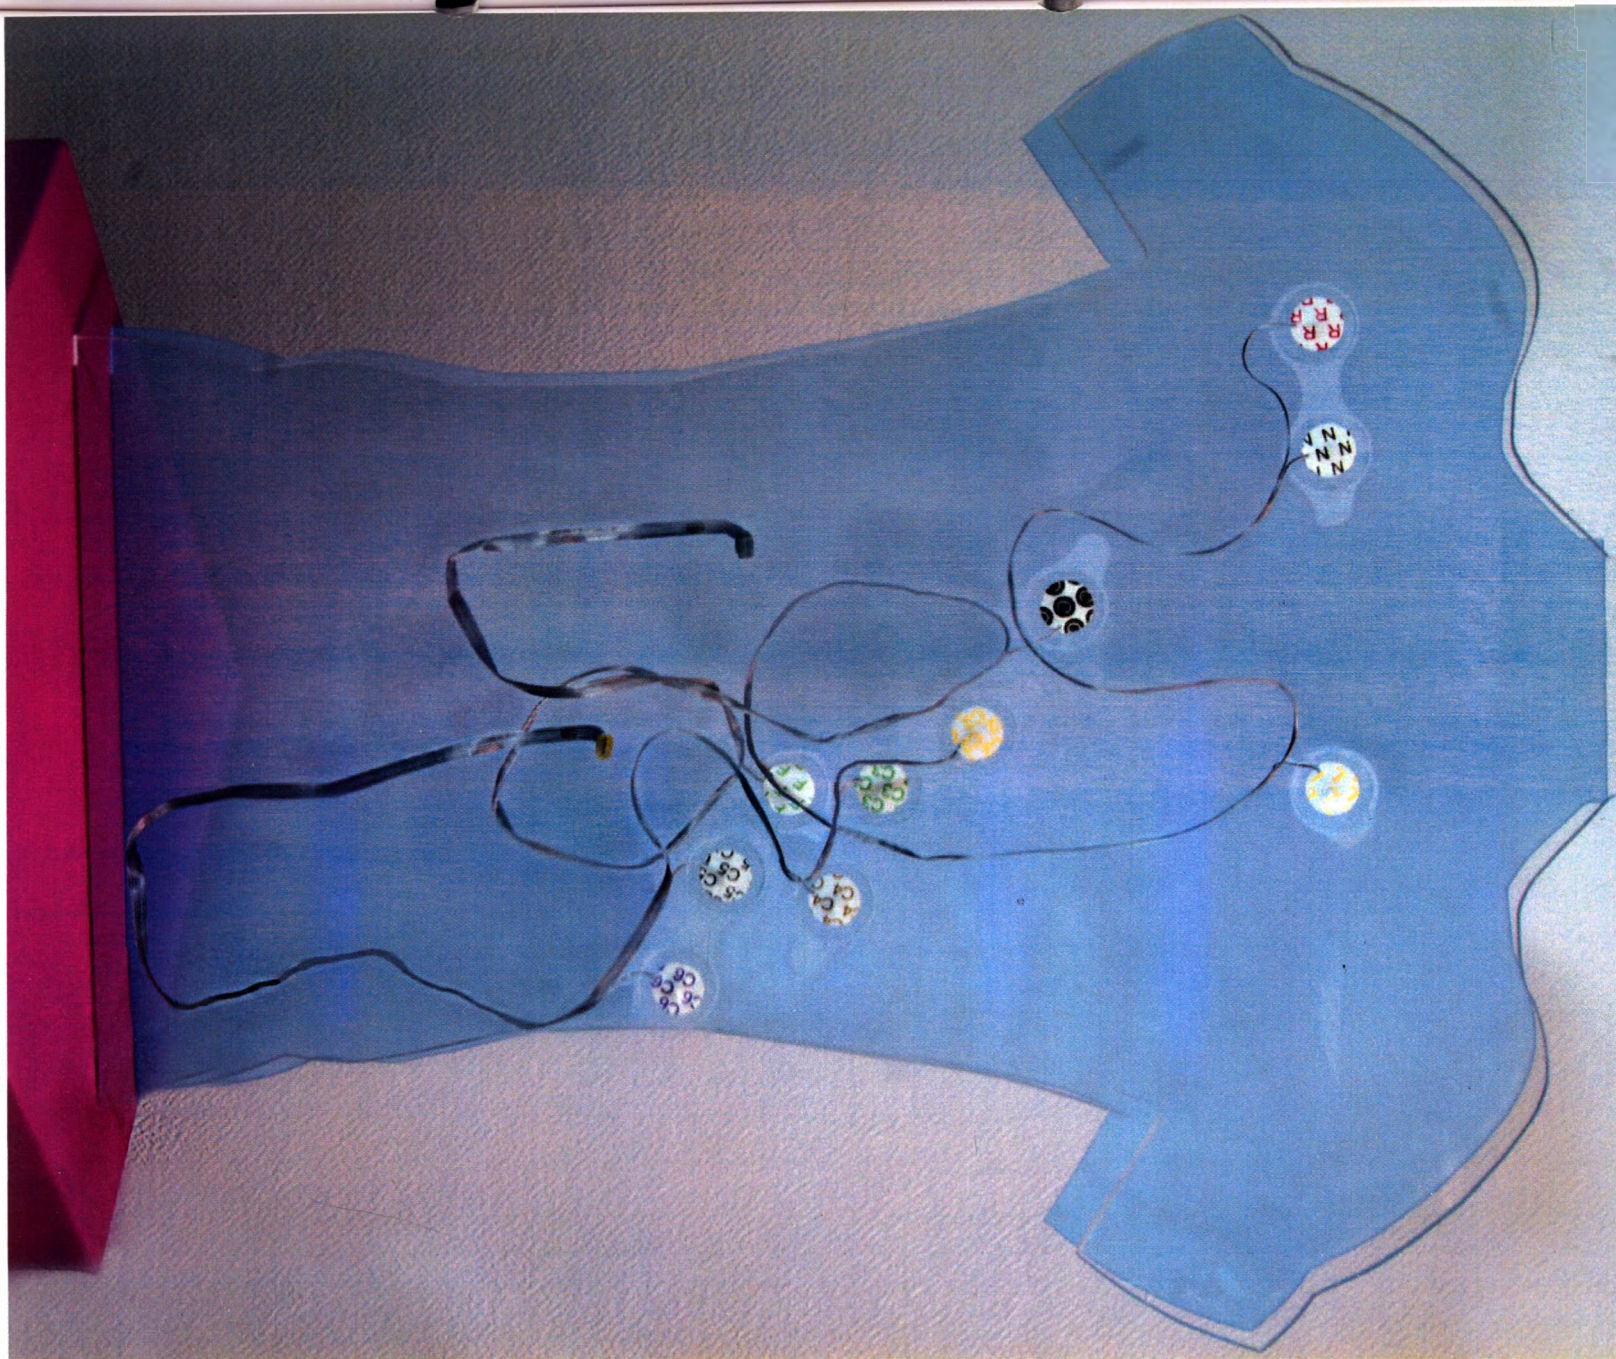

3. Электроды нерентгенопрозрачные для взрослых и детей старше 8 лет, в составе:
- 4 электрода в одном соединении – 1 шт.;
 - 6 электродов в одном соединении – 1 шт.;


Электроды с интегрированными проводами IP-SET® для диагностики и мониторинга ЭКГ пластинчатые, одноразовые в наборе в варианте исполнения



Комплектация:

Электроды нерентгенопрозрачные для взрослых и детей старше 8 лет, в составе:

- 4 электрода в одном соединении – 1 шт.;
- 6 электродов в одном соединении – 1 шт.;

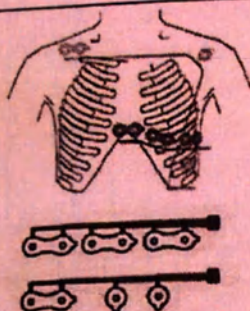

LOT	Код партии	1207003
REF	Номер по каталогу	50502
	Дата изготовления	2014-03
	Использовать до ...	2017-03



Осторожно! Обратитесь к сопроводительной документации



Не содержит натуральный латекс



Не допускать воздействия солнечного света

Возраст




Для взрослых и детей старше 8 лет



Не использовать повторно



Беречь от влаги



Температурный диапазон



Не стерильно



Возраст

Не для новорожденных




По истечении срока службы, пожалуйста, следуйте указаниям Европейской директивы по утилизации



Соответствует Европейской Директиве 93/42/EEC

Производитель: INTEGRAL PROCESS SAS,
Z.A. des Boutries, 12 rue des Cayennes, 78700 Conflans Sainte Honorine, France

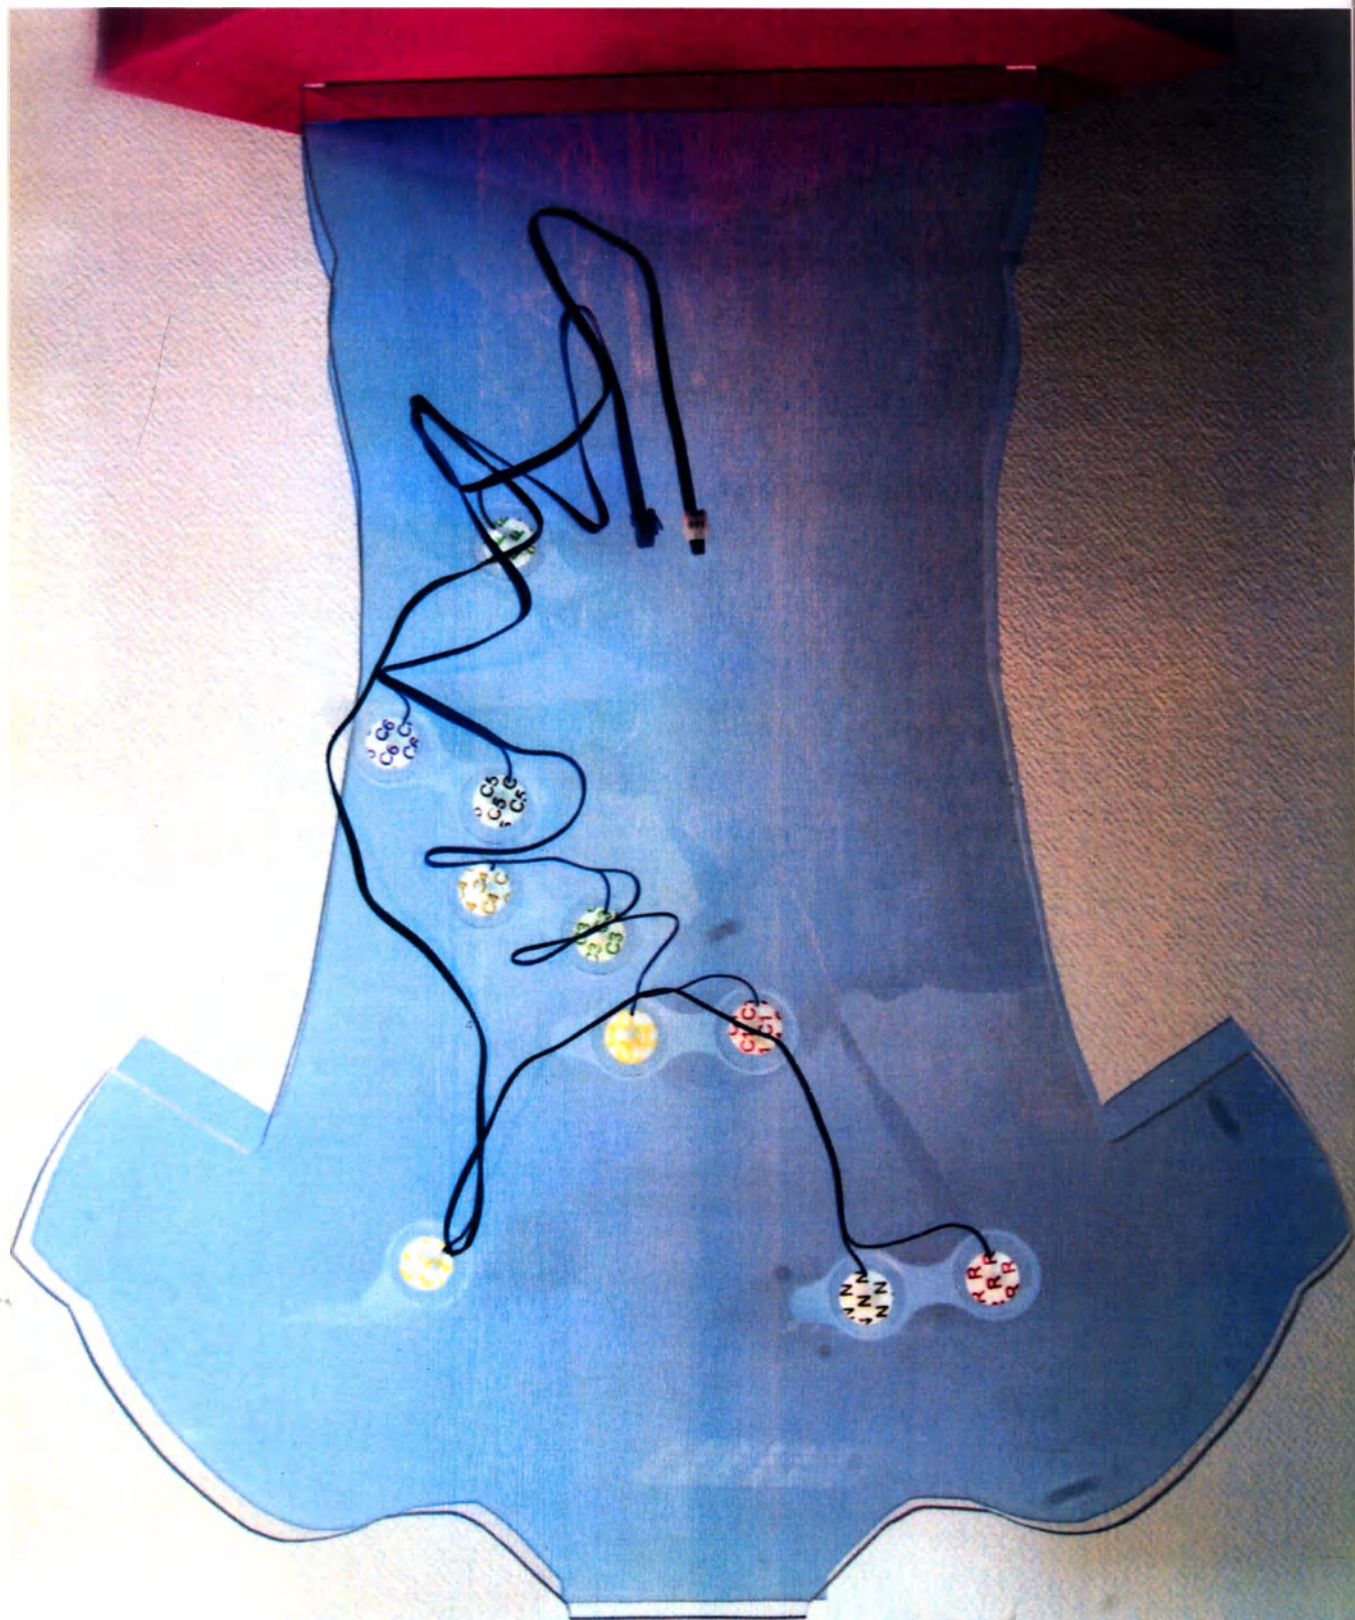

Электроды с интегрированными проводами IP-SET® для диагностики и мониторинга ЭКГ пластинчатые, одноразовые в отдельных упаковках в вариантах исполнения:


1. Электроды рентгенопрозрачные для взрослых и детей старше 8 лет по 4 электрода в одном соединении – 1 шт.;

Электроды с интегрированными проводами IP-SET® для диагностики и мониторинга ЭКГ пластинчатые, одноразовые в отдельной упаковке в варианте исполнения



Комплектация:

Электроды рентгенопрозрачные для взрослых и детей старше 8 лет по 4 электрода в одном соединении – 1 шт.;



LOT	Код партии	1423003
REF	Номер по каталогу	50600
	Дата изготовления	2014-03
	Использовать до ...	2017-03



Осторожно! Обратитесь к сопроводительной документации



Не содержит натуральный латекс



Не допускать воздействия солнечного света

RT

Рентгенопрозрачность

Возраст



Для взрослых и детей старше 8 лет




По истечении срока службы, пожалуйста, следуйте указаниям Европейской директивы по утилизации



Не использовать повторно



Беречь от влаги



Температурный диапазон



Не стерильно

Возраст




Не для новорожденных



Соответствует Европейской Директиве 93/42/EEC



Производитель: INTEGRAL PROCESS SAS,
ZA des Boutries, 12 rue des Cayennes, 78700 Conflans Sainte Honorine, France

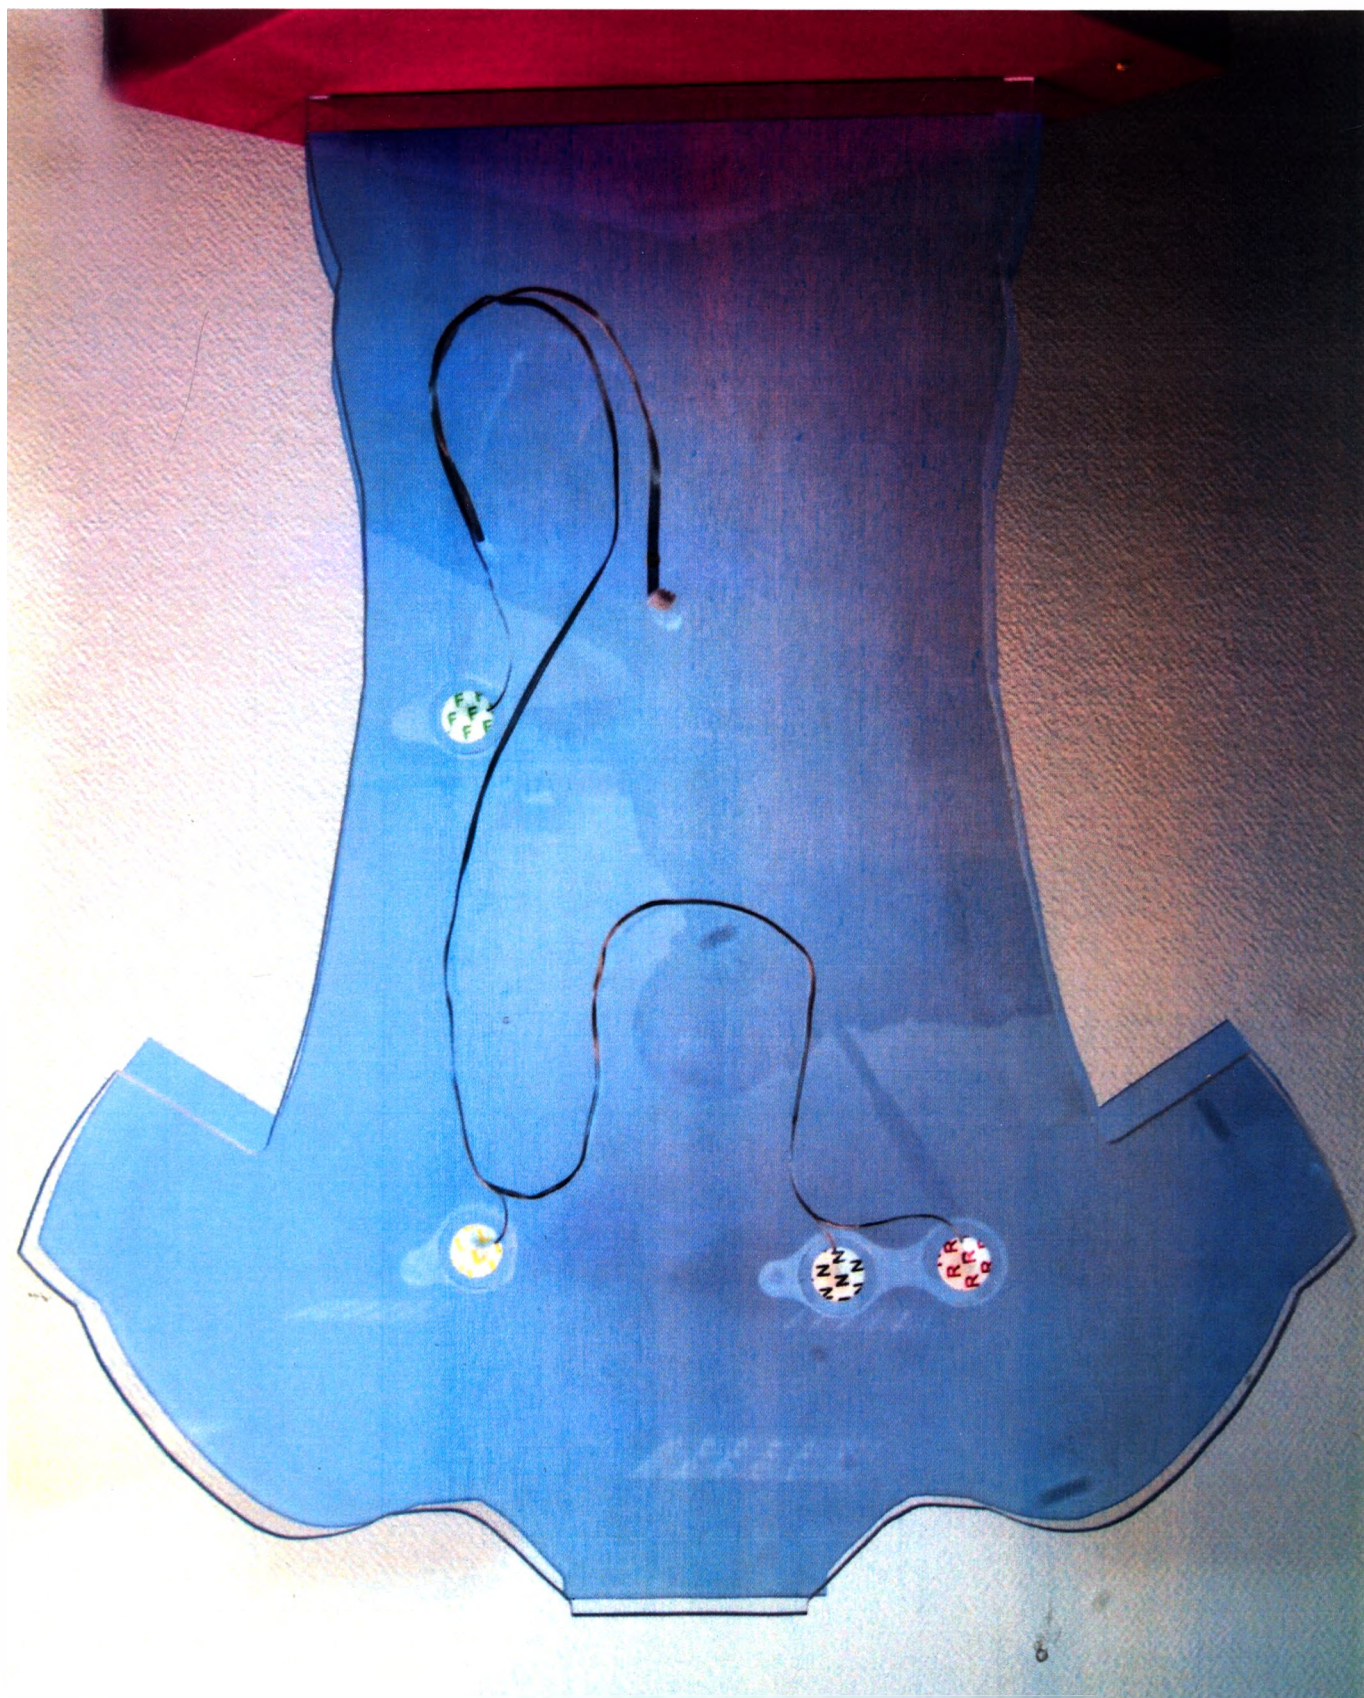


2. Электроды рентгенопрозрачные для взрослых и детей старше 8 лет по 5 электродов в одном соединении – 1 шт.;

Электроды с интегрированными проводами IP-SET® для диагностики и мониторинга ЭКГ пластинчатые, одноразовые в отдельной упаковке в варианте исполнения



Комплектация:

Электроды рентгенопрозрачные для взрослых и детей старше 8 лет по 5 электродов в одном соединении – 1 шт.;



LOT	Код партии	1435001
REF	Номер по каталогу	50601
	Дата изготовления	2014-03
	Использовать до ...	2017-03



Осторожно! Обратитесь к сопроводительной документации



Не содержит натуральный латекс



Не допускать воздействия солнечного света

RT

Рентгенопрозрачность

Возраст



Для взрослых и детей старше 8 лет




По истечении срока службы, пожалуйста, следуйте указаниям Европейской директивы по утилизации



Не использовать повторно



Беречь от влаги



Температурный диапазон



Не стерильно

Возраст




Не для новорожденных



Соответствует Европейской Директиве 93/42/EEC

Производитель: INTEGRAL PROCESS SAS,
Z.A. des Boutries, 12 rue des Cayennes, 78700 Conflans Sainte Honorine, France

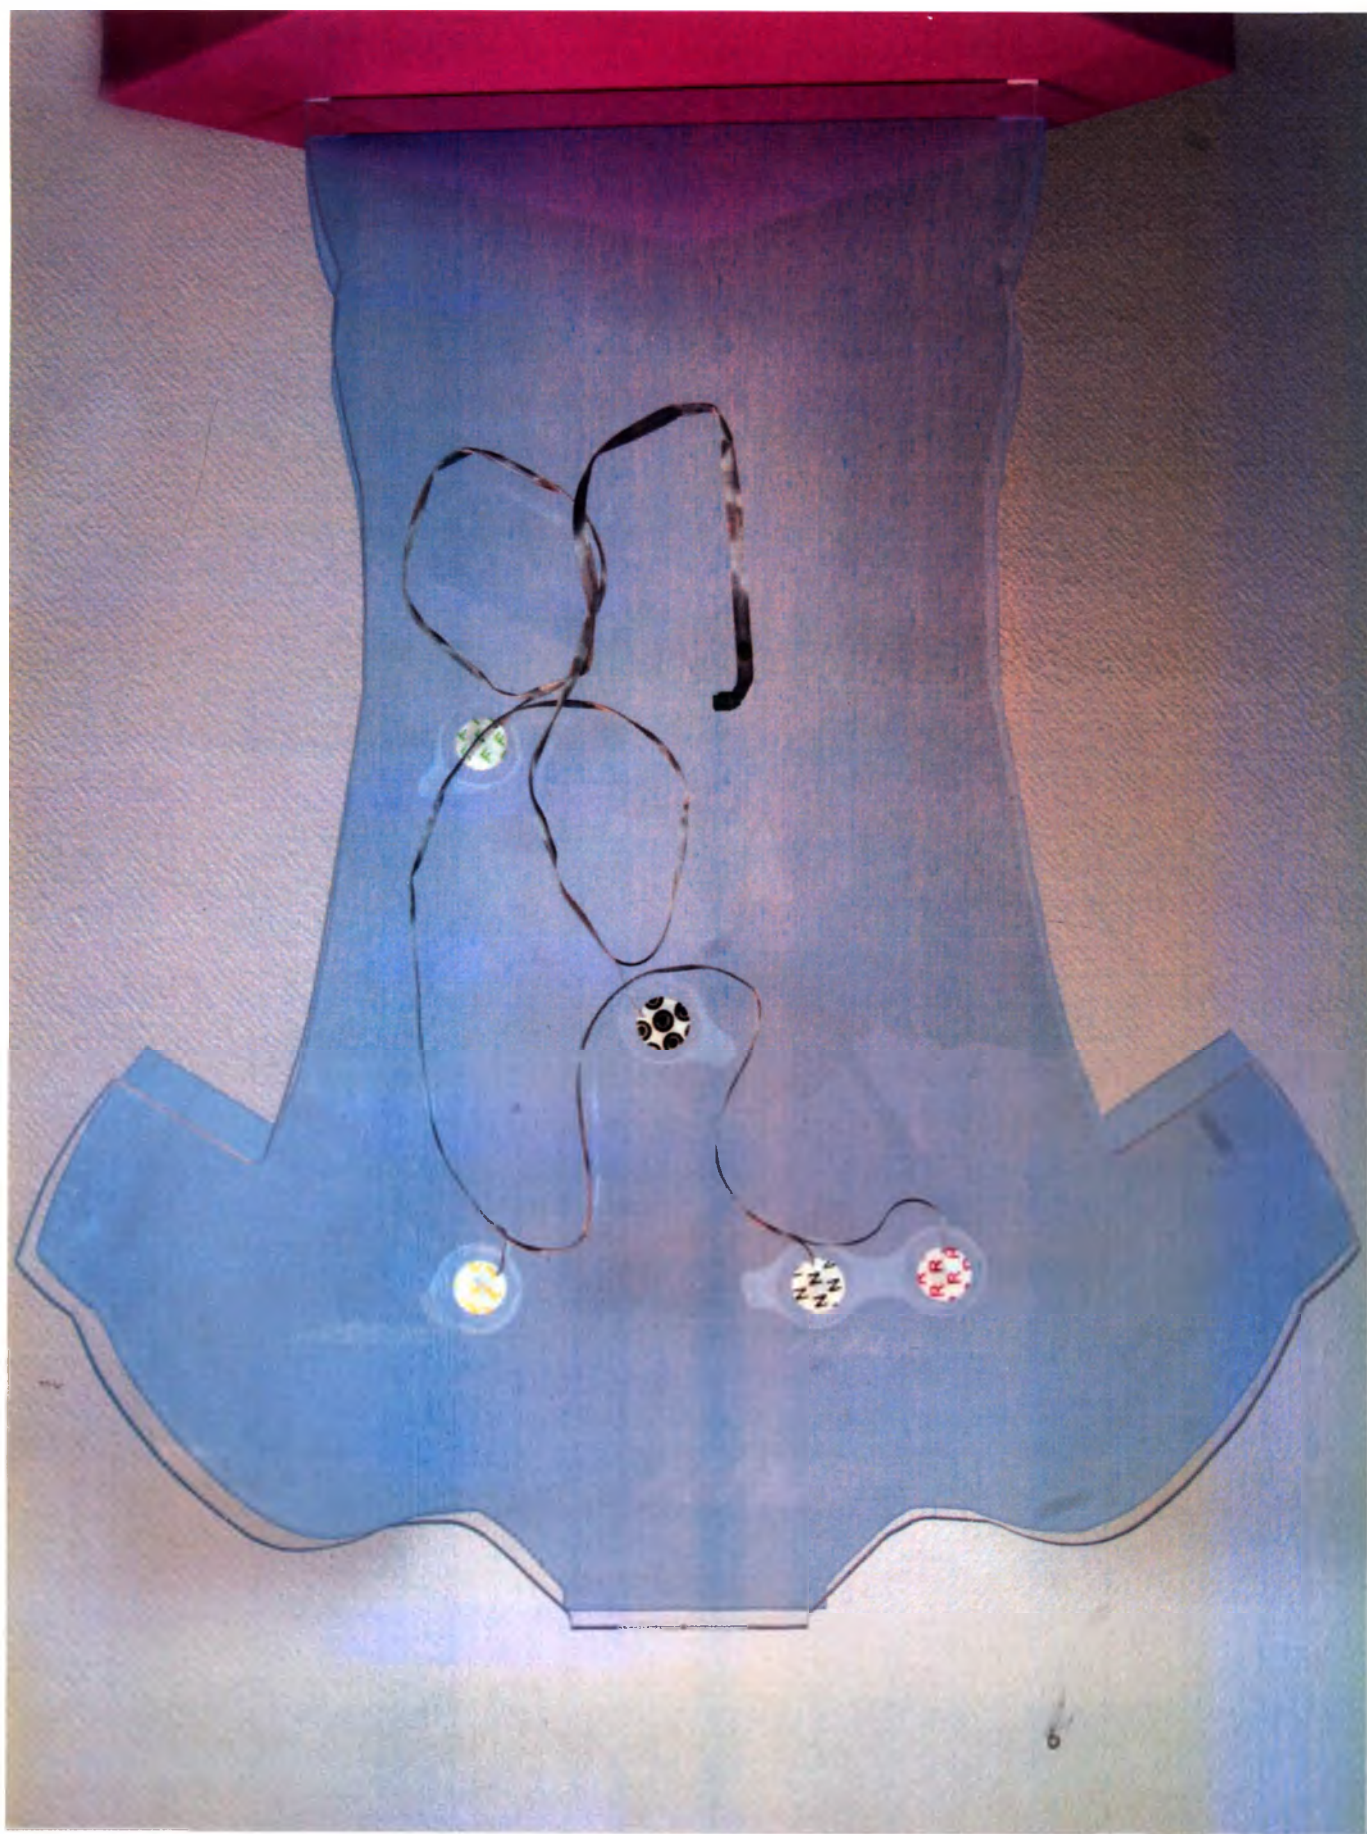


Электроды с интегрированными проводами IP-SET® для диагностики и мониторинга ЭКГ пластинчатые, одноразовые в отдельной упаковке в варианте исполнения



Комплектация:

Электроды рентгенопрозрачные для взрослых и детей старше 8 лет по 5 электродов в одном соединении — 1 шт.;



LOT	Код партии	1439002
REF	Номер по каталогу	50604
	Дата изготовления	2014-03
	Использовать до ...	2017-03



Осторожно! Обратитесь к сопроводительной документации



Не содержит натуральный латекс



Не допускать воздействия солнечного света

RT

Рентгенопрозрачность

Возраст



Для взрослых и детей старше 8 лет



По истечении срока службы, пожалуйста, следуйте указаниям Европейской директивы по утилизации



Не использовать повторно



Беречь от влаги



Температурный диапазон



Не стерильно

Возраст




Не для новорожденных



Соответствует Европейской Директиве 93/42/EEC

Производитель: INTEGRAL PROCESS SAS,
Z.A. des Boutilles, 12 rue des Cayennes, 78700 Conflans Sainte Honorine, France

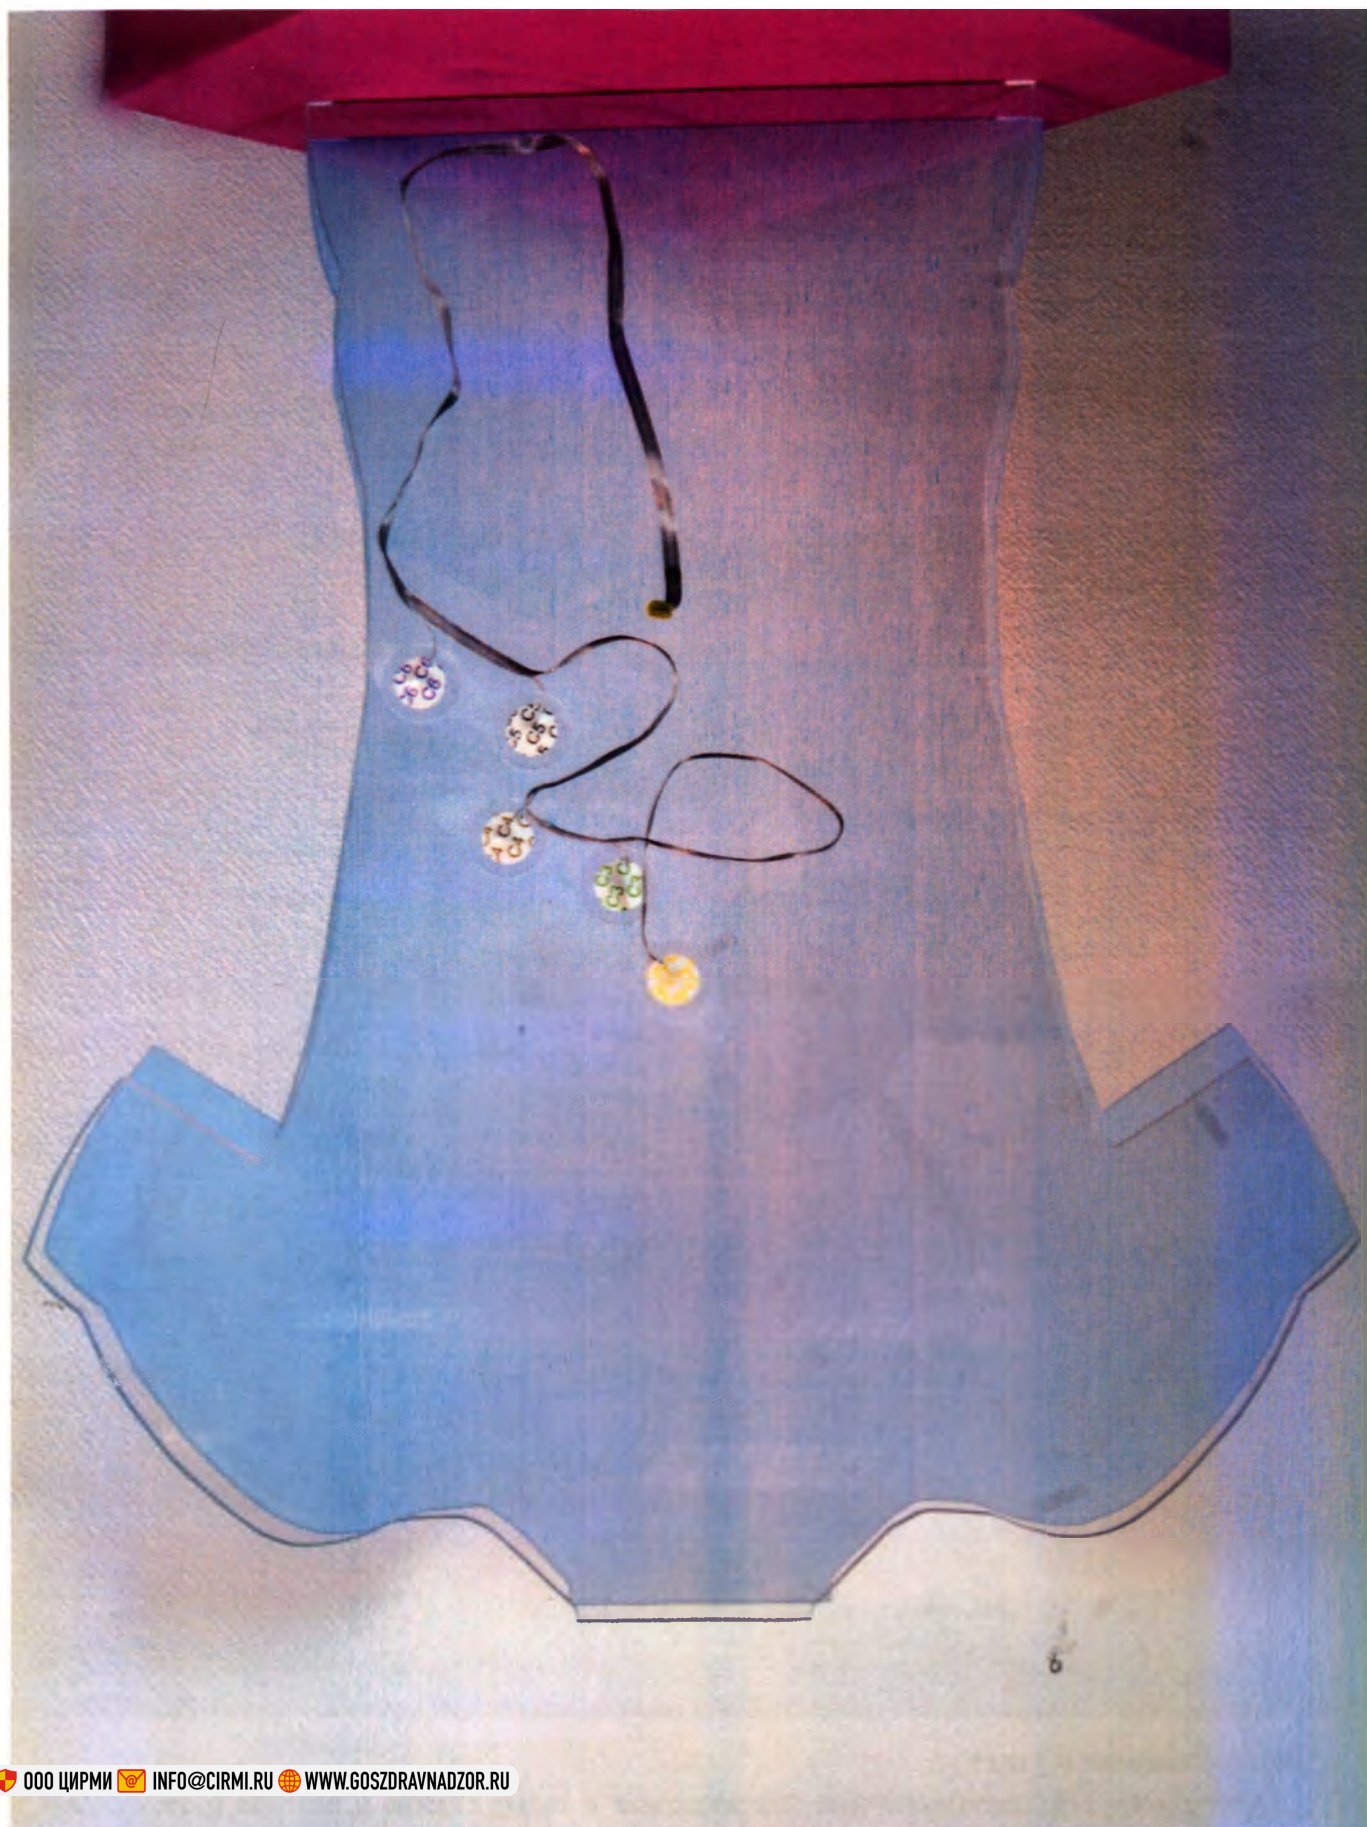


3. Электроды рентгенопрозрачные для взрослых и детей старше 8 лет по 6 электродов в одном соединении – 1 шт.;

Электроды с интегрированными проводами IP-SET® для диагностики и мониторинга ЭКГ пластинчатые, одноразовые в отдельной упаковке в варианте исполнения



Комплектация:

Электроды рентгенопрозрачные для взрослых и детей старше 8 лет по 6 электродов в одном соединении – 1 шт.;



LOT	Код партии	1411002
REF	Номер по каталогу	50603
	Дата изготовления	2014-03
	Использовать до ...	2017-03



Осторожно! Обратитесь к сопроводительной документации



Не содержит натуральный латекс



Не допускать воздействия солнечного света

RT

Рентгенопрозрачность

Возраст



Для взрослых и детей старше 8 лет




По истечении срока службы, пожалуйста, следуйте указаниям Европейской директивы по утилизации



Не использовать повторно



Беречь от влаги



Температурный диапазон



Не стерильно

Возраст




Не для новорожденных



Соответствует Европейской Директиве 93/42/EEC



Производитель: INTEGRAL PROCESS SAS,
Z.A. des Boutries, 12 rue des Cayennes, 78700 Conflans Sainte Honorine, France

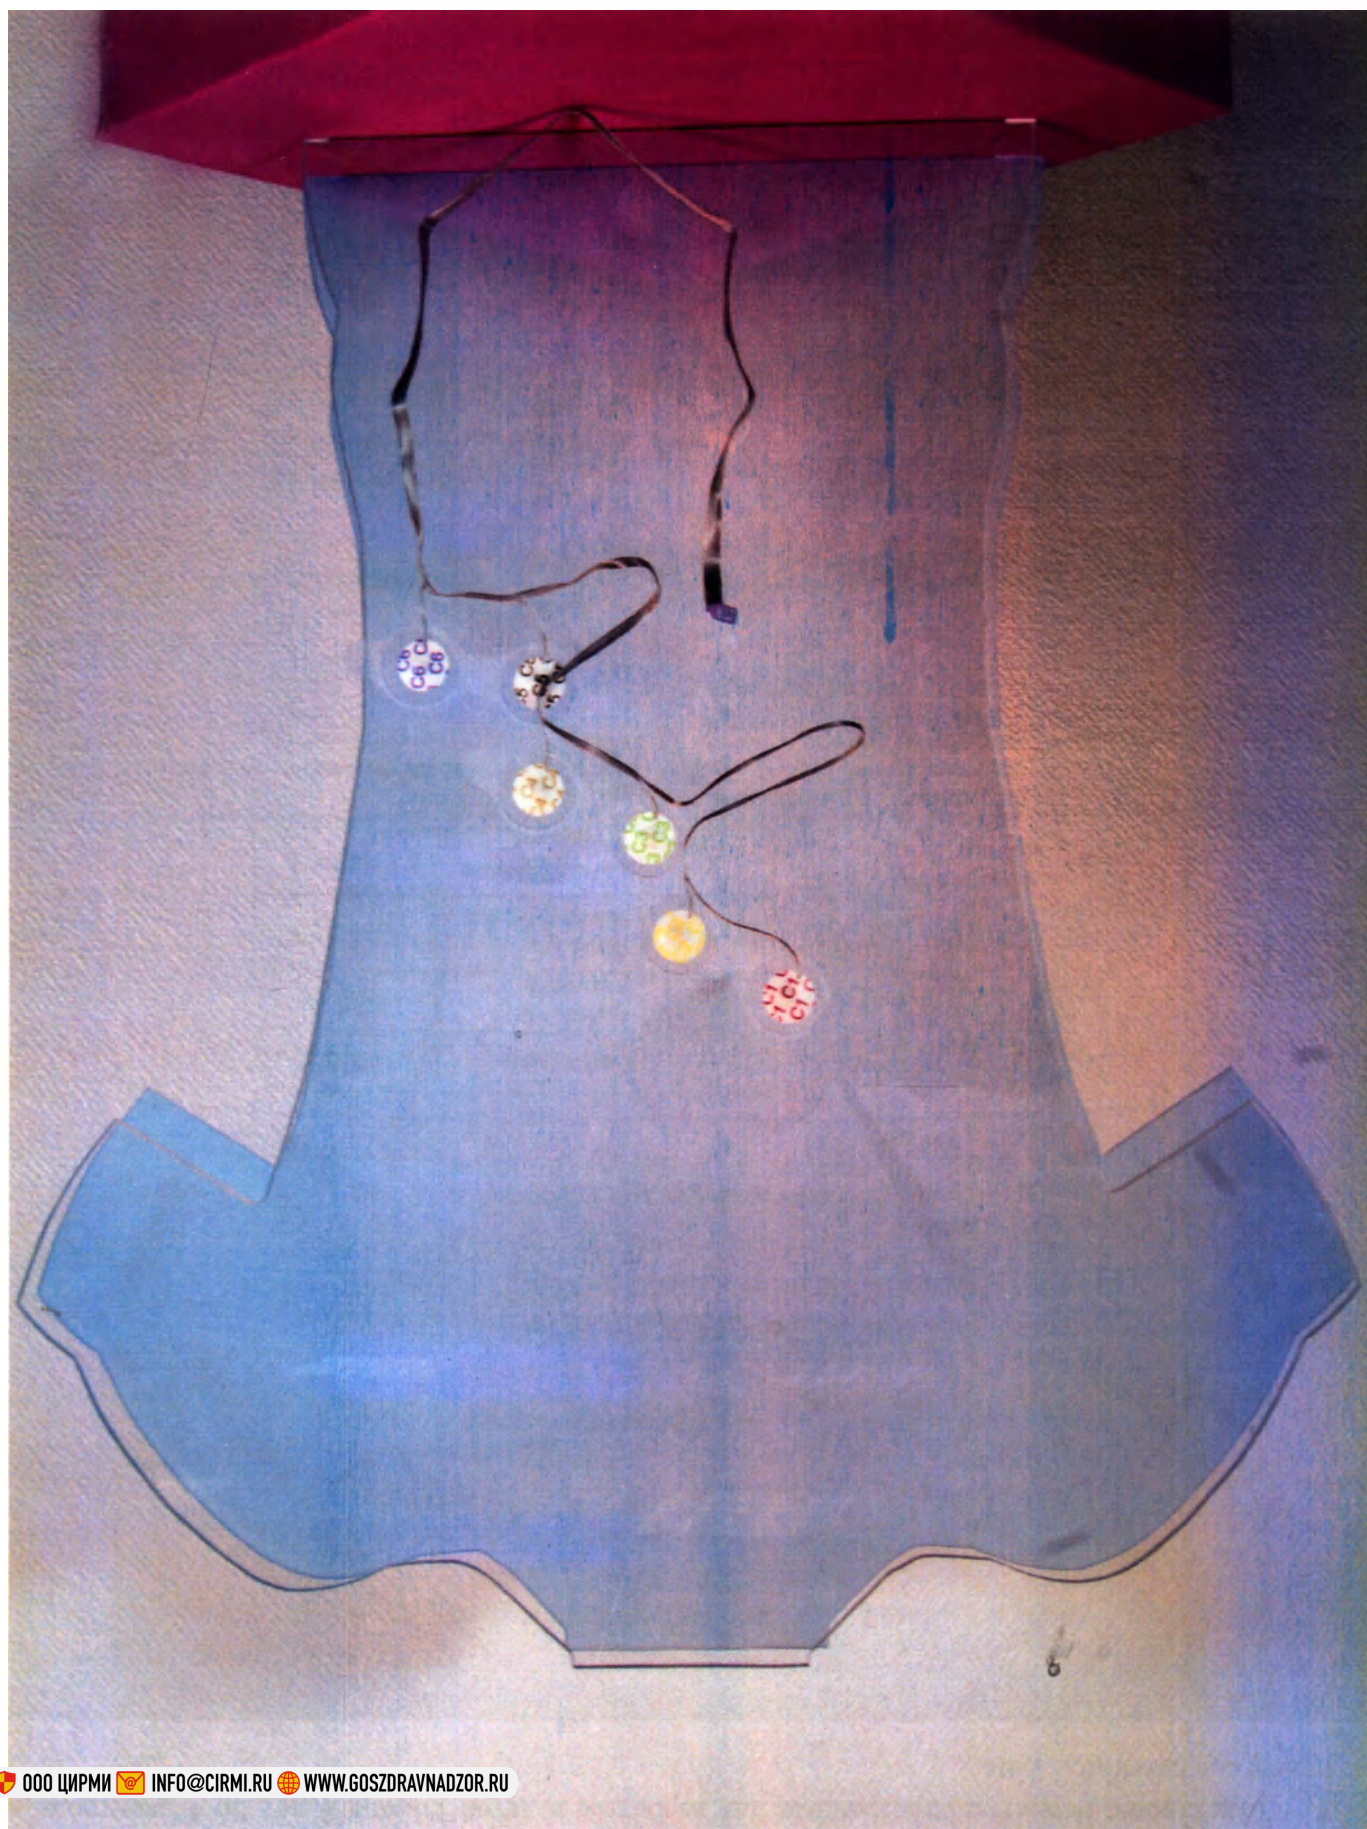


4. Электроды нерентгенопрозрачные для взрослых и детей старше 8 лет по 4 электрода в одном соединении – 1 шт.;

Электроды с интегрированными проводами IP-SET® для диагностики и мониторинга ЭКГ пластинчатые, одноразовые в отдельной упаковке в варианте исполнения



Комплектация:

Электроды нерентгенопрозрачные для взрослых и детей старше 8 лет по 4 электрода в одном соединении – 1 шт.;



LOT	Код партии	1403003
REF	Номер по каталогу	50500
	Дата изготовления	2014-03
	Использовать до ...	2017-03



Осторожно! Обратитесь к сопроводительной документации



Не содержит натуральный латекс



Не допускать воздействия солнечного света

Возраст




Для взрослых и детей старше 8 лет



Не использовать повторно



Беречь от влаги



Температурный диапазон



Не стерильно

Возраст



Не для новорожденных




По истечении срока службы, пожалуйста, следуйте указаниям Европейской директивы по утилизации



Соответствует Европейской Директиве 93/42/EEC



Производитель: INTEGRAL PROCESS SAS,
Z.A. des Boudries, 12 rue des Cayennes, 78700 Conflans Sainte Honorine, France

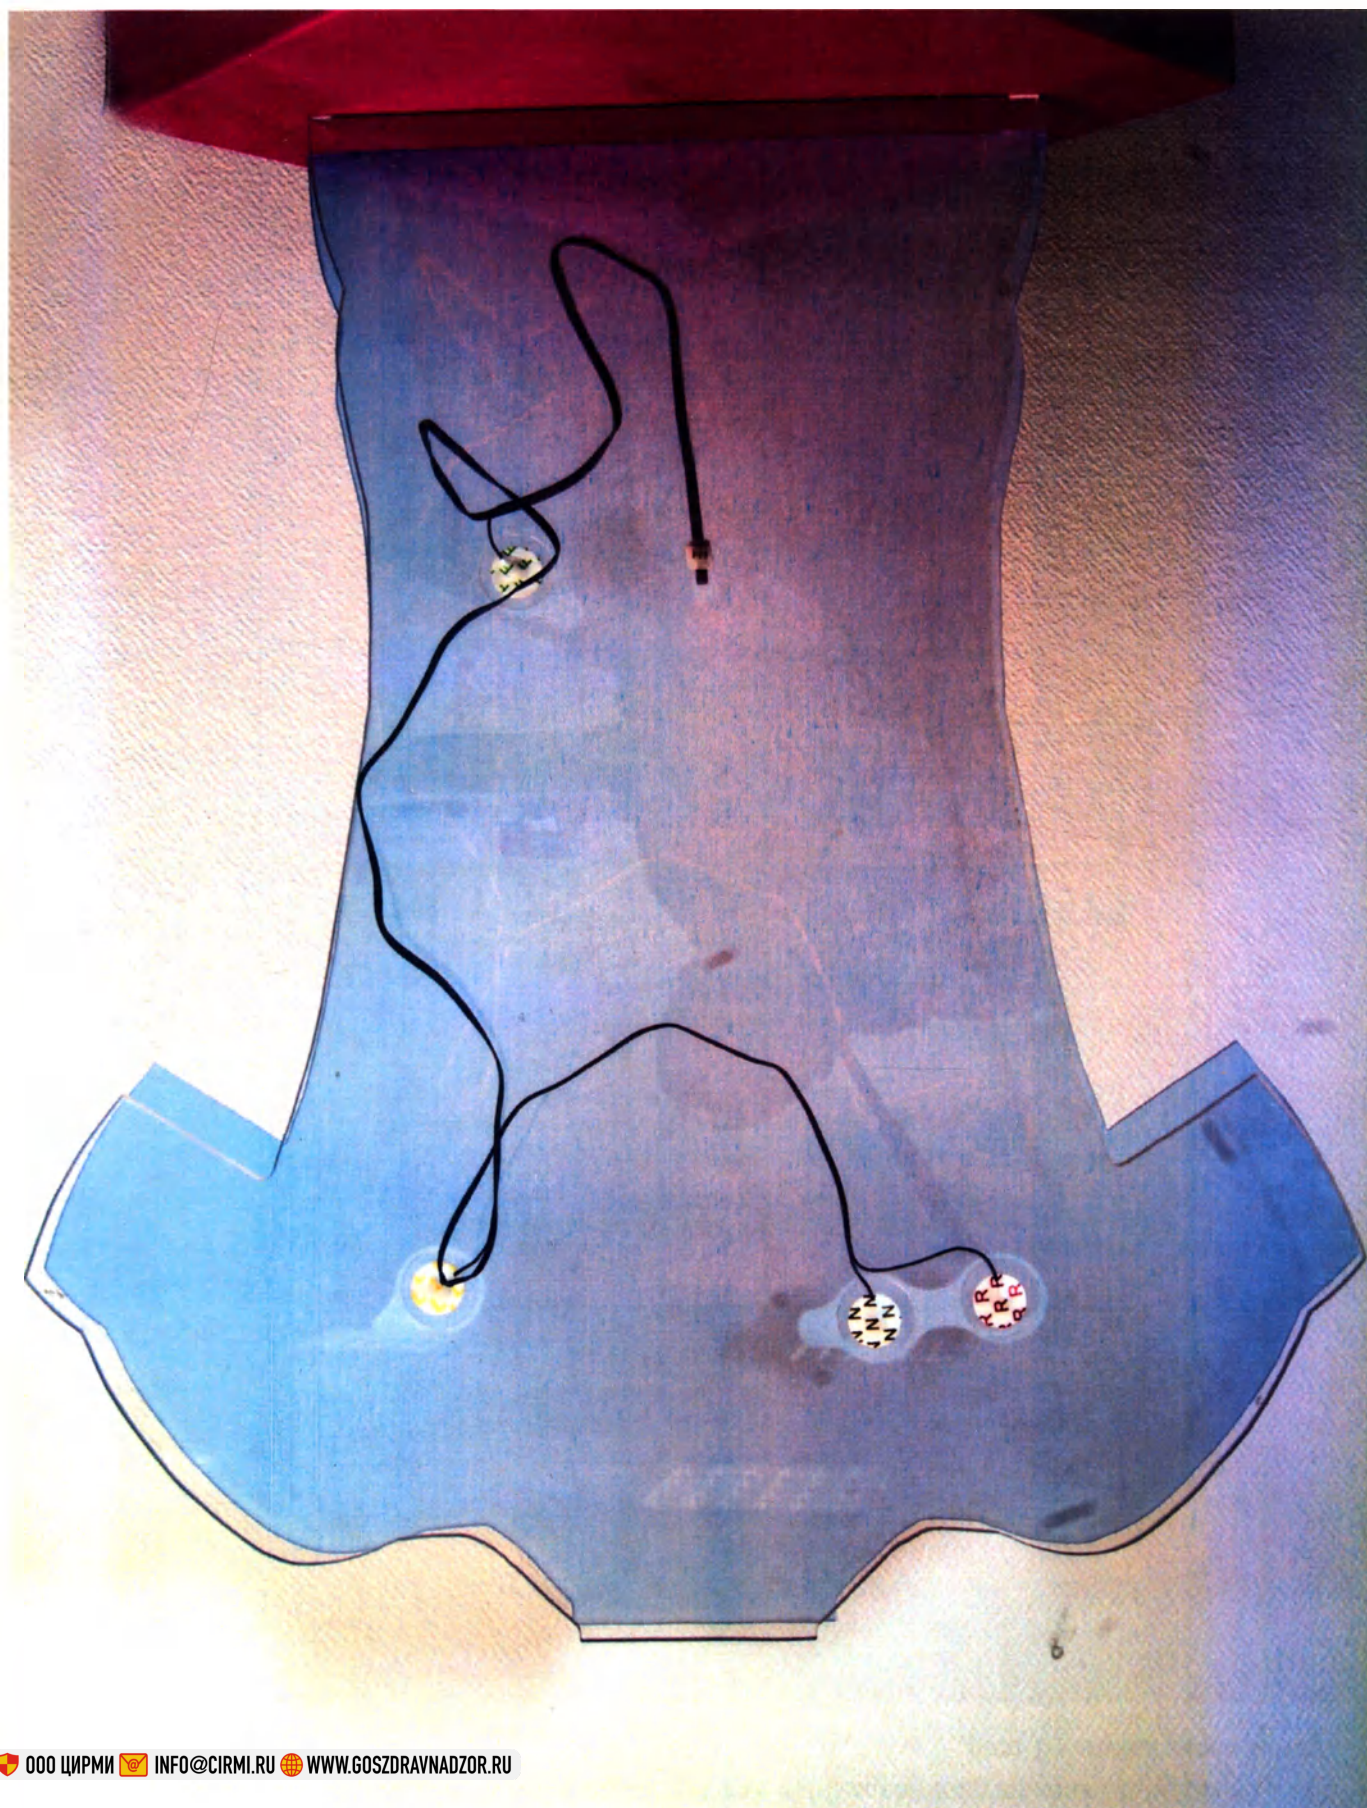


5. Электроды нерентгенопрозрачные для взрослых и детей старше 8 лет по 6 электродов в одном соединении – 1 шт.;

Электроды с интегрированными проводами IP-SET® для диагностики и мониторинга ЭКГ пластинчатые, одноразовые в отдельной упаковке в варианте исполнения



Комплектация:

Электроды нерентгенопрозрачные для взрослых и детей старше 8 лет по 6 электродов в одном соединении – 1 шт.;



LOT	Код партии	1420001
REF	Номер по каталогу	50507
	Дата изготовления	2014-03
	Использовать до ...	2017-03



Осторожно! Обратитесь к сопроводительной документации



Не содержит натуральный латекс



Не допускать воздействия солнечного света

Возраст



Для взрослых и детей старше 8 лет




По истечении срока службы, пожалуйста, следуйте указаниям Европейской директивы по утилизации



Не использовать повторно



Беречь от влаги



Температурный диапазон



Не стерильно

Возраст




Не для новорожденных



Соответствует Европейской Директиве 93/42/EEC



Производитель: INTEGRAL PROCESS SAS,
Z.A. des Boutries, 12 rue des Cayennes, 78700 Conflans Sainte Honore, France

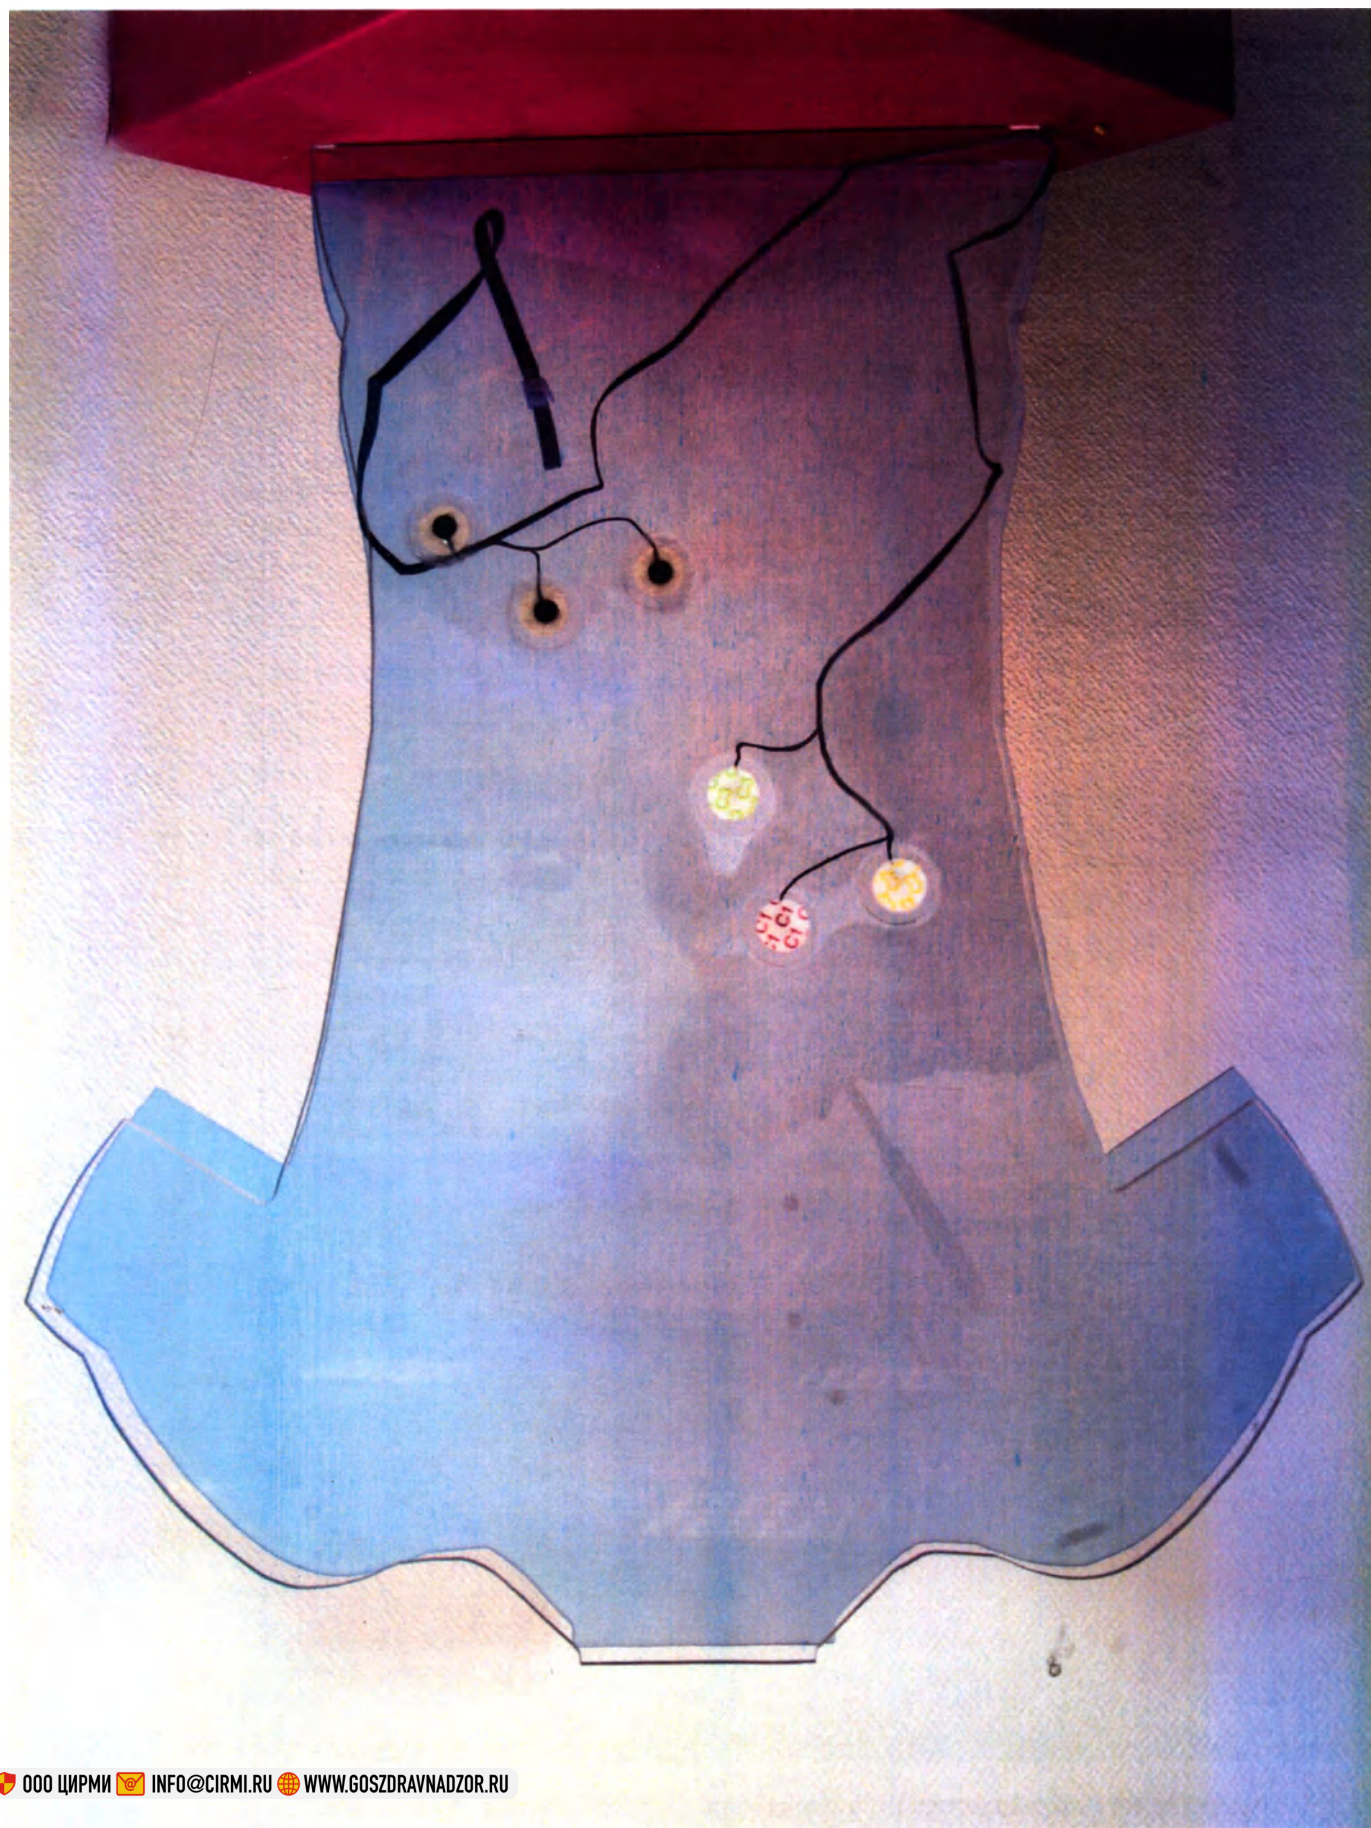

Электроды с интегрированными проводами IP-SET® для диагностики и мониторинга ЭКГ пластинчатые, одноразовые в отдельной упаковке в варианте исполнения

Комплектация:
Электроды неонатальные по 3 электрода в одном соединении – 1 шт.





LOT	Код партии	1504002
REF	Номер по каталогу	50401
	Дата изготовления	2014-03
	Использовать до ...	2017-03

 Осторожно! Обратитесь к сопроводительной документации

 Не содержит натуральный латекс


 Не допускать воздействия солнечного света

Возраст
 Для новорожденных

 По истечении срока службы, пожалуйста, следуйте указаниям Европейской директивы по утилизации

 Не использовать повторно


 Беречь от влаги

 Температурный диапазон 5 °C - 30 °C

 Не стерильно

 Соответствует Европейской Директиве 93/42/EEC

Производитель: INTEGRAL PROCESS SAS,
ZA des Boutries, 12 rue des Cayennes, 78700 Conflans Sainte Honorine, France

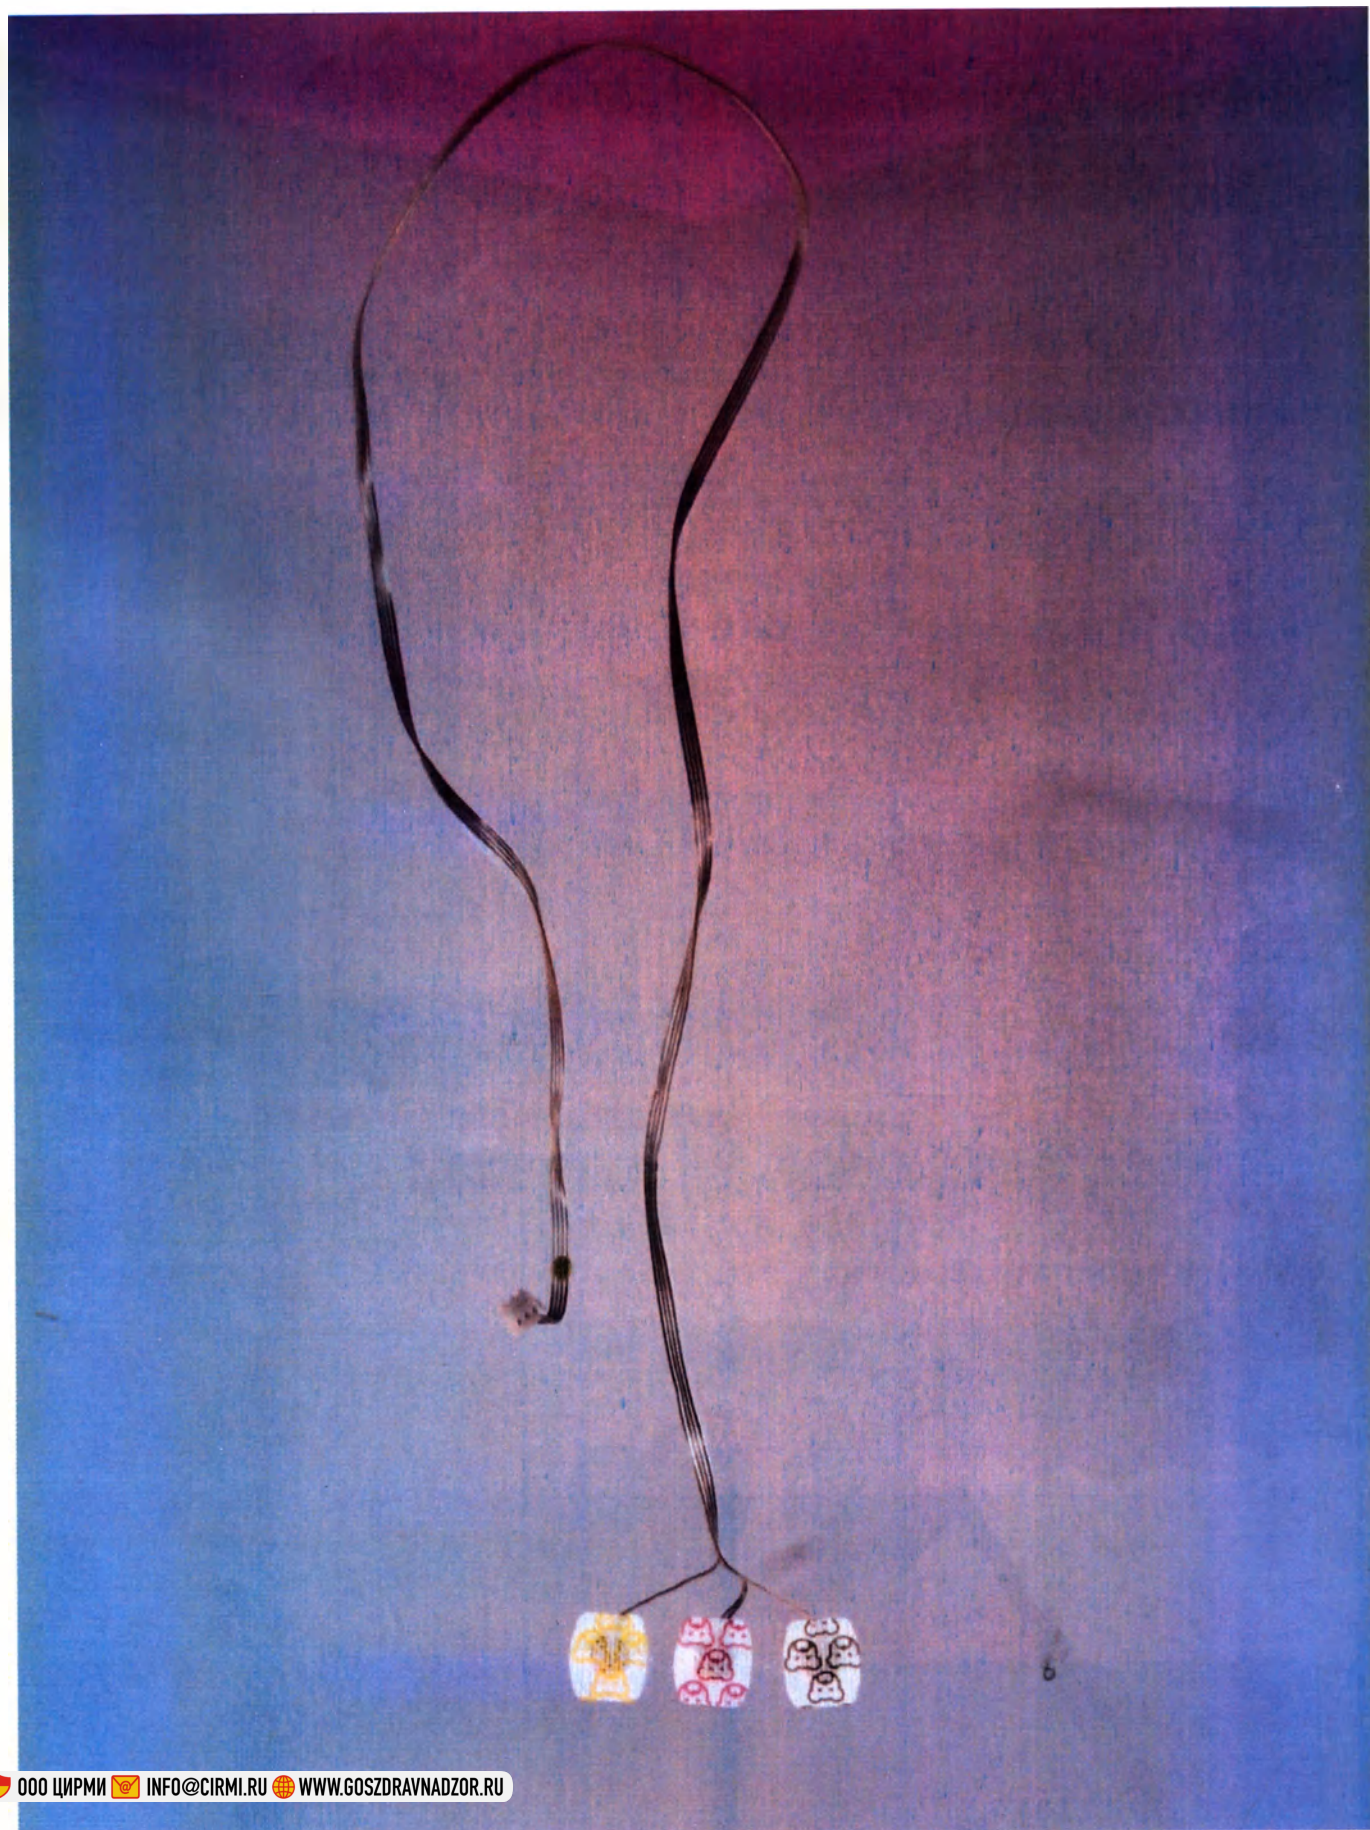

В документе пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью

21 (двадцать один) листа(ов)

Генеральный директор
ООО «Аполло Диагностические Системы»
А.Н. Островский

