


Фотографическое изображение

**Материал стоматологический реставрационный светоотверждаемый
Spectrum,**

производства «DENTSPLY DeTrey GmbH»/ ДЕНТСПЛАЙ Ди Трей ГмбХ

Материал стоматологический Spectrum в шприце 4 г - 1 шт в упаковке; оттенок: A1

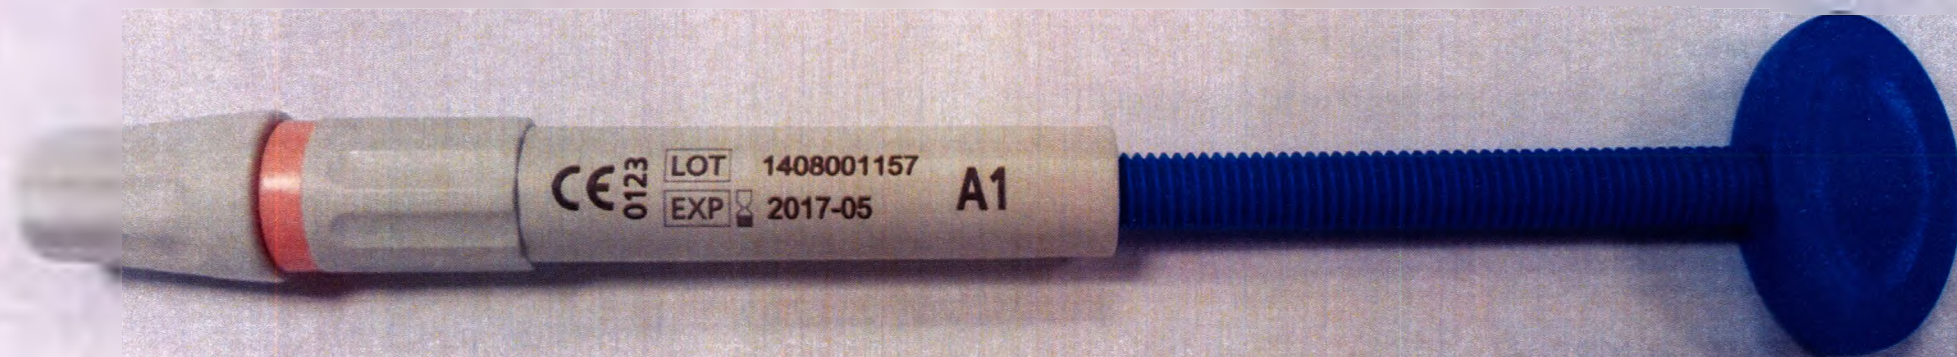


Материал стоматологический Spectrum в шприце 4 г - 1 шт в упаковке; оттенок: A2








Материал стоматологический Spectrum в шприце 4 г - 1 шт в упаковке; оттенок: A4

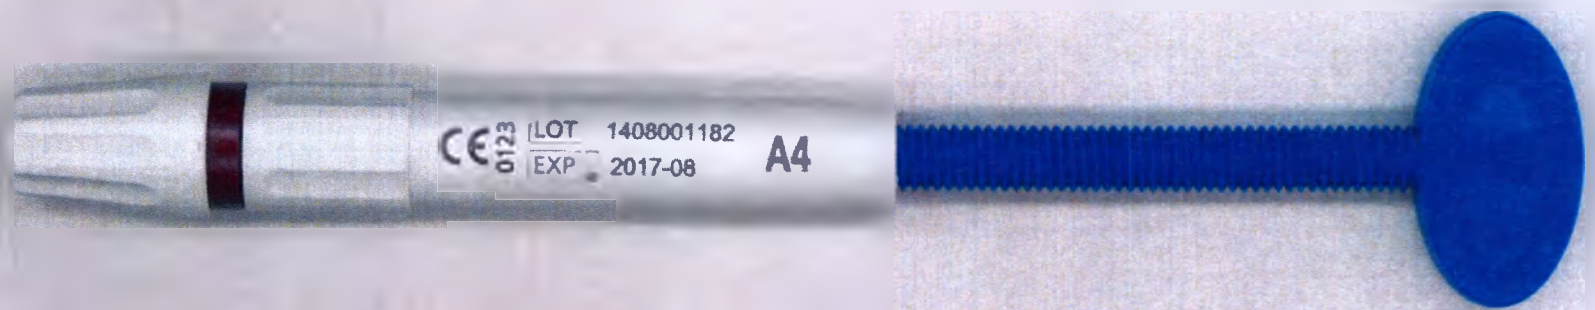

Материал стоматологический Spectrum в шприце 4 г - 1 шт в упаковке; оттенок: B1




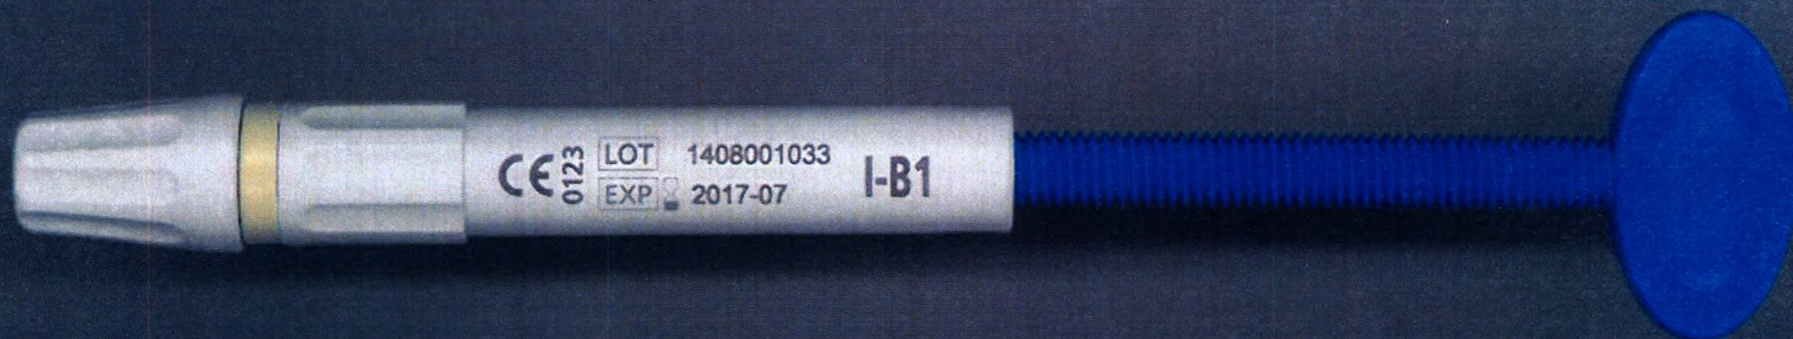


Материал стоматологический Spectrum в шприце 4 г - 1 шт в упаковке; оттенок: B2



Материал стоматологический Spectrum в шприце 4 г - 1 шт в упаковке; оттенок: B3

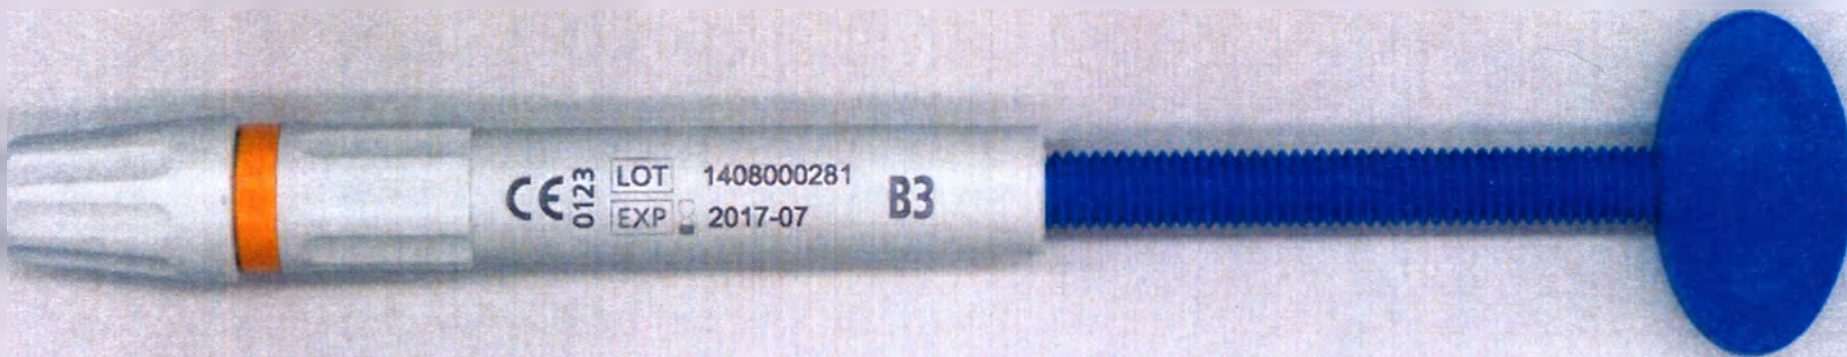


Материал стоматологический Spectrum в шприце 4 г - 1 шт в упаковке; оттенок: C2

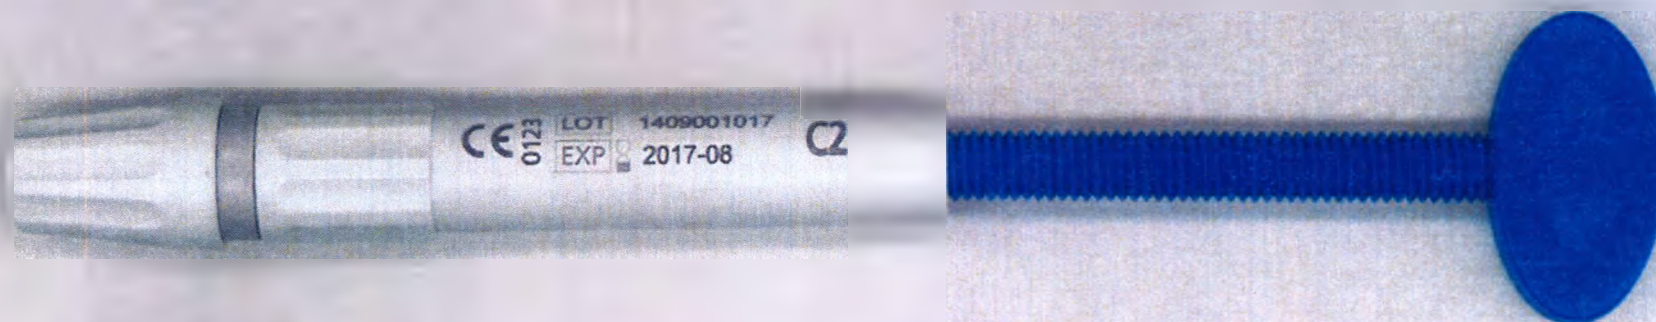


Материал стоматологический Spectrum в шприце 4 г - 1 шт в упаковке; оттенок: C3



Материал стоматологический Spectrum в шприце 4 г - 1 шт в упаковке; оттенок: 0-A2

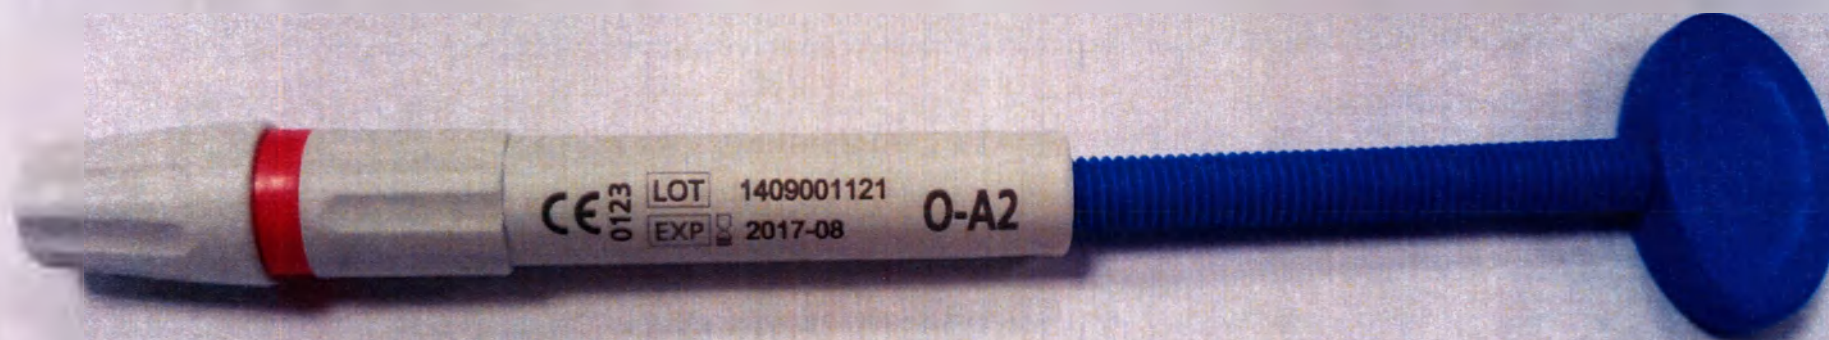

Материал стоматологический Spectrum в шприце 4 г - 1 шт в упаковке; оттенок: О-А3.5

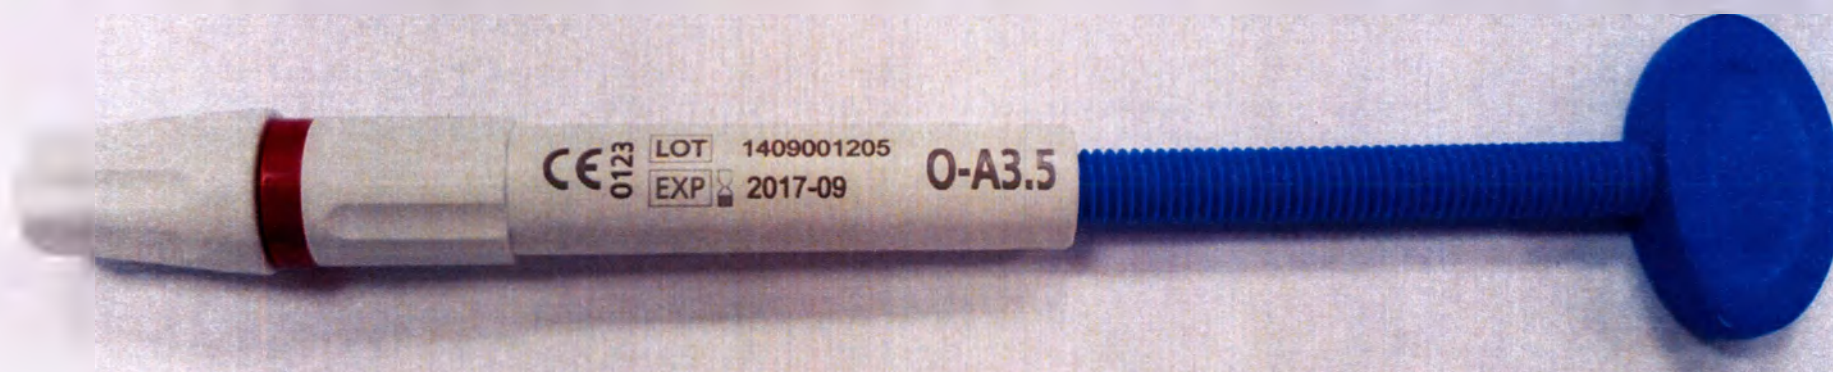

Генеральный Директор ООО «Дентсплай РУ»

К.Г. Левин

Сшито 14 листа(ов)

Генеральный Директор


ООО «Дентсплай РУ»

Лев.ч К.Г. Лев.ч К.Г.




Дополнение к фотографическому изображению
Материал стоматологический реставрационный светоотверждаемый
Spectrum,
производства «DENTSPLY DeTrey GmbH»/ ДЕНТСПЛАЙ Ди Трей ГмбХ

Материал стоматологический Spectrum в шприце 4 г - 1 шт в упаковке; оттенок: A1 (передняя сторона)

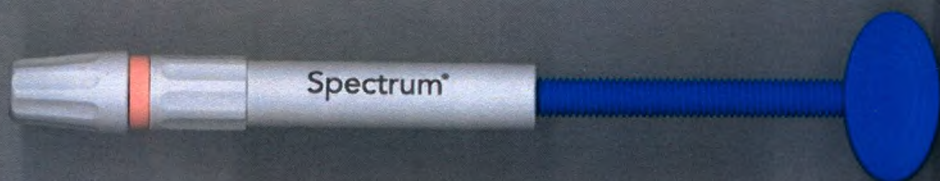


Материал стоматологический Spectrum в шприце 4 г - 1 шт в упаковке; оттенок: A1 (задняя сторона)

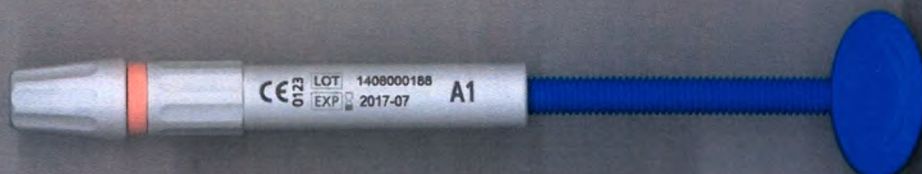

Материал стоматологический Spectrum в шприце 4 г - 1 шт в упаковке; оттенок: A2 (передняя сторона)



Материал стоматологический Spectrum в шприце 4 г - 1 шт в упаковке; оттенок: А2 (задняя сторона)

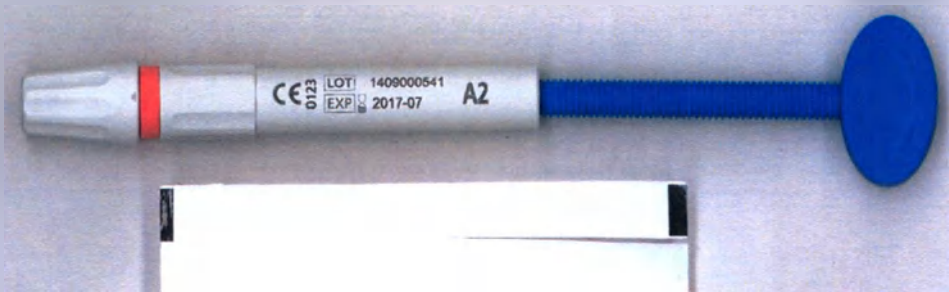

A2

Spectrum®

ReOrder 60805282



+D010806052821%



+3331707311409001195%+

LOT 1409001195 EXP 2017-07

Shade: A2

K101985-02

Spectrum® is a radiopaque resin-based dental restorative material



Caution, consult instructions for use



Storage temperature
2 °C / 36 °F
28 °C / 82 °F



Keep away from sunlight

Shade	 mW/cm²	 s	 s
A1; A2; A3; A3.5; B1; B1.5; B2; C2; C3	≥ 500	20	3
O-A2; O-A3.5; A4; B3		20	2



www.dentsply.ru/RU
See webpage for instructions for use

Материал стоматологический Spectrum в шприце 4 г - 1 шт в упаковке; оттенок: А3 (передняя сторона)



Материал стоматологический Spectrum в шприце 4 г - 1 шт в упаковке; оттенок: А3 (задняя сторона)



A3

Spectrum®

ReOrder: 60605283

D0106060528310

+33317053114090011960~

[Lot] 1409001196 EXP 2017-05

Shade A3

P

KT01985-02

!

Caution, consult
Instructions for use

2 °C

36 °F

28 °C

82 °F

Storage temperature

☀

Keep away
from sunlight

Shade	mW/cm² sec mm	
A1; A2; A3; A3.5; B1; B1.5; B2; C2; C3	≥ 500	20 3
○ A2; ○ A3.5; A4, B3		20 2

www.danly.ru


See webpage for
Instructions for use

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Материал стоматологический Spectrum в шприце 4 г - 1 шт в упаковке; оттенок: А3.5 (передняя сторона)




Материал стоматологический Spectrum в шприце 4 г - 1 шт в упаковке; оттенок: А3.5 (задняя сторона)

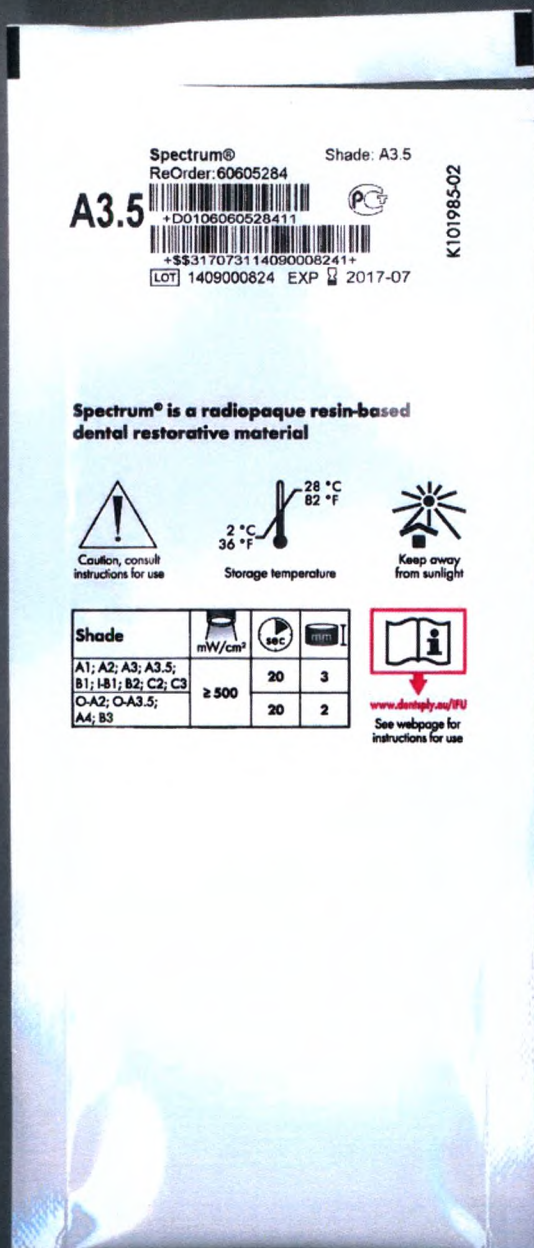

Материал стоматологический Spectrum в шприце 4 г - 1 шт в упаковке; оттенок: А4 (передняя сторона)




Материал стоматологический Spectrum в шприце 4 г - 1 шт в упаковке; оттенок: А4 (задняя сторона)

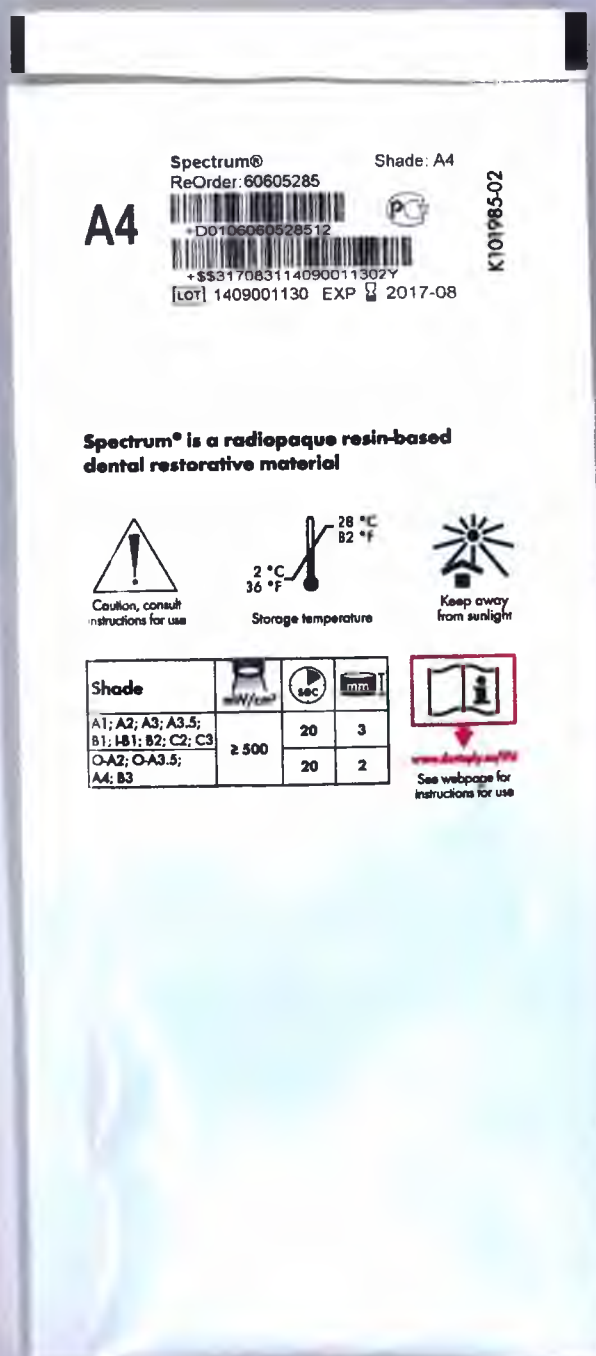

Материал стоматологический Spectrum в шприце 4 г - 1 шт в упаковке; оттенок: B1 (передняя сторона)



Материал стоматологический Spectrum в шприце 4 г - 1 шт в упаковке; оттенок: B1 (задняя сторона)

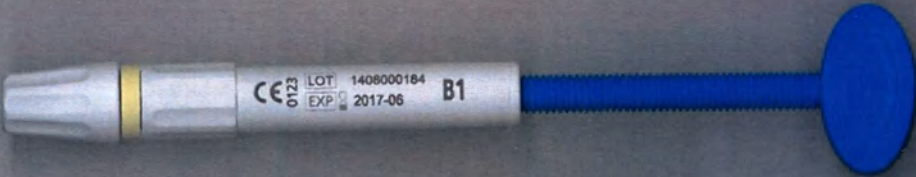

B1

Spectrum®
ReOrder: 60605286
+D0106060528613
+SS317063014090001523Z
LOT 1409000152 EXP 2017-06

Shade: B1
PC
K101985-02

Spectrum® is a radiopaque resin-based dental restorative material



Shade	mW/cm²	SEC	MIN
A1; A2; A3; A3.5; B1; B1.5; B2; C2; C3	20	20	3
O-A2; O-A3.5; A4; B3	20	20	2





www.dentsply.com/ru
See webpage for instructions for use

Материал стоматологический Spectrum в шприце 4 г - 1 шт в упаковке; оттенок: I-B1 (передняя сторона)




Материал стоматологический Spectrum в шприце 4 г - 1 шт в упаковке; оттенок: I-B1 (задняя сторона)

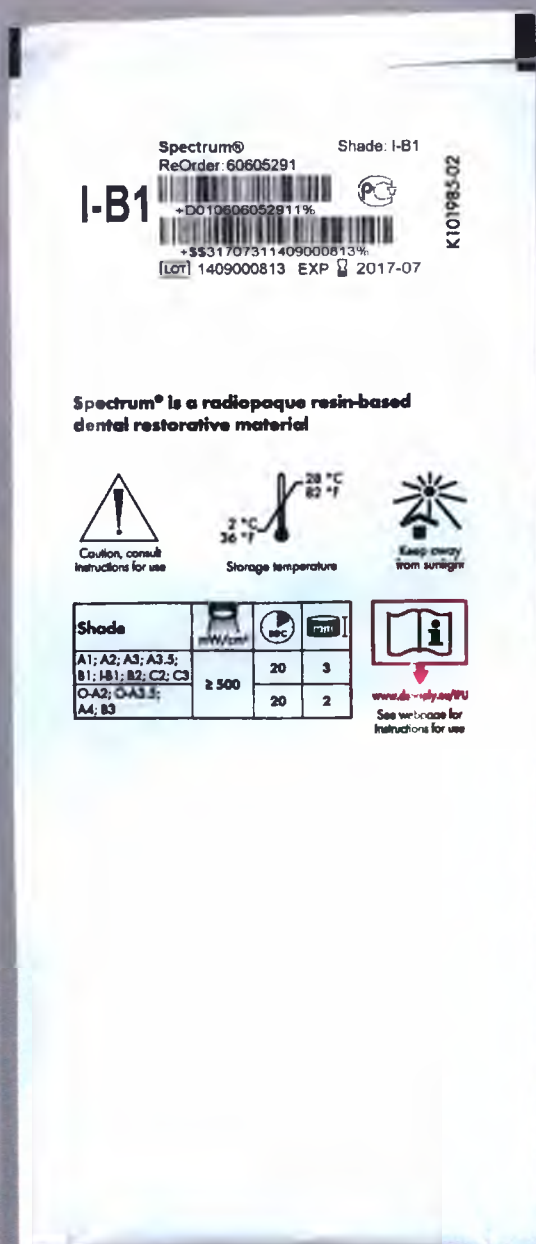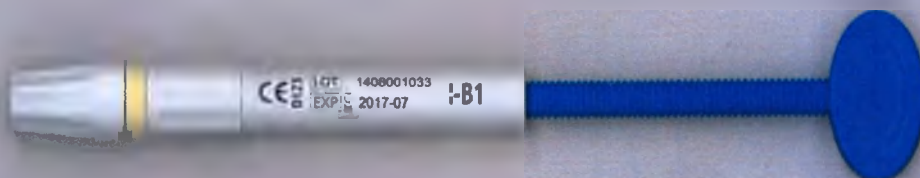

Материал стоматологический Spectrum в шприце 4 г - 1 шт в упаковке; оттенок: B2 (передняя сторона)




Материал стоматологический Spectrum в шприце 4 г - 1 шт в упаковке; оттенок: B2 (задняя сторона)

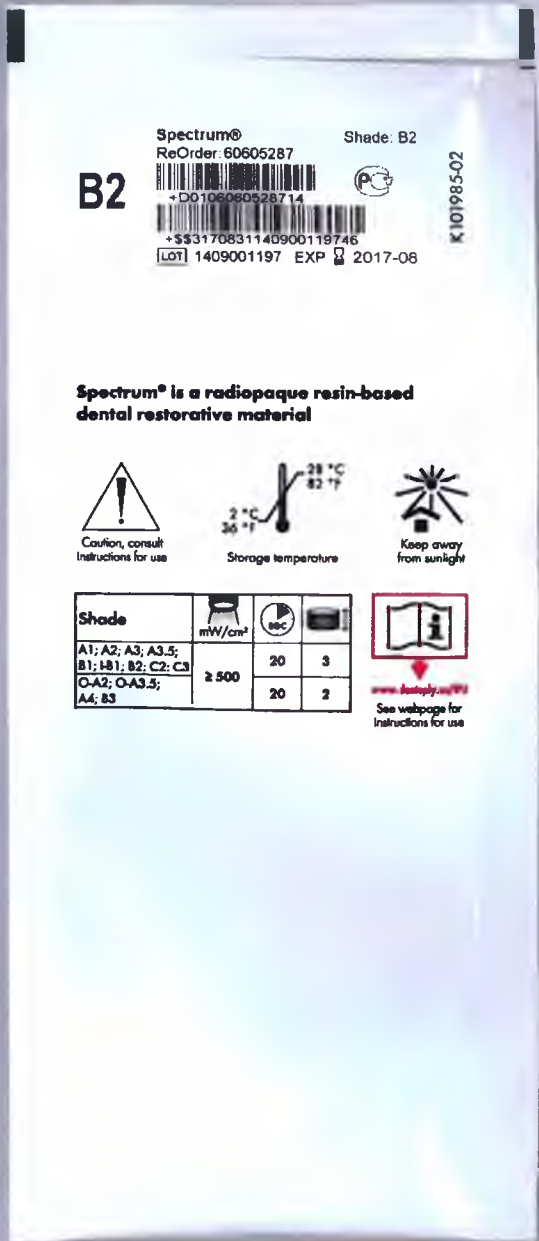

Материал стоматологический Spectrum в шприце 4 г - 1 шт в упаковке; оттенок: В3 (передняя сторона)



Материал стоматологический Spectrum в шприце 4 г - 1 шт в упаковке; оттенок: B3 (задняя сторона)

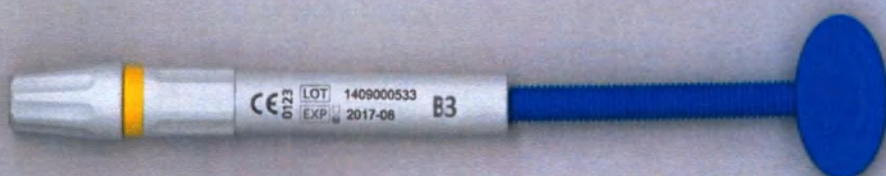

Материал стоматологический Spectrum в шприце 4 г - 1 шт в упаковке; оттенок: C2 (передняя сторона)



Материал стоматологический Spectrum в шприце 4 г - 1 шт в упаковке; оттенок: C2 (задняя сторона)



Материал стоматологический Spectrum в шприце 4 г - 1 шт в упаковке; оттенок: С3 (передняя сторона)



Spectrum®

**Universal microhybrid
composite restorative**

Composite micro-hybride de restauration universel
Универсальный микрогибридный композитный
реставрационный материал

Uniwersalny mikrohybrydowy materiał
kompozytowy do wypełnień

Universal mikro hibrid kompozit restoratif materyal
مادة كمپوزايت ميكرو هيبريد متعددة الاستخدام لترميم الأسنان
適用型複合樹脂



Syringe Export Refill Package (1 x 4 g)



Manufactured by
DENTSPLY DeTasy GmbH
78467 Konstanz
GERMANY
www.dentsply.eu

Made in Germany

For dental use only

Материал стоматологический Spectrum в шприце 4 г - 1 шт в упаковке; оттенок: C3 (задняя сторона)



C3

Spectrum®
ReOrder: 60605290

Shade C3

+D010606052901+

+5531708311409001199+2

LOT 1409001199 EXP 2017-08

K101983-02

!

Caution, consult instructions for use

2 °C
36 °F

28 °C
82 °F

Storage temperature

☀

Keep away from sunlight

Shade	mW/cm²	mm
A1; A2; A3; A3.5; B1; B1.5; B2; C2; C3	≥ 500	20 3
O-A2; O-A3.5; A4; B3		20 2


See webpage for instructions for use

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Материал стоматологический Spectrum в шприце 4 г - 1 шт в упаковке; оттенок: O-A2 (передняя сторона)



Материал стоматологический Spectrum в шприце 4 г - 1 шт в упаковке; оттенок: O-A2 (задняя сторона)

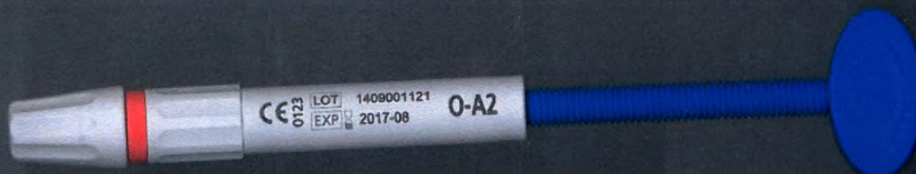

Материал стоматологический Spectrum в шприце 4 г - 1 шт в упаковке; оттенок: О-А3.5 (передняя сторона)



Материал стоматологический Spectrum в шприце 4 г - 1 шт в упаковке; оттенок: O-A3.5 (задняя сторона)



Генеральный Директор ООО «Дентсплай РУ»

К.Г. Левин

Сшито 27 листа(ов)

Генеральный Директор

ООО «Дентсплай РУ»

Левин Н.Г.

Dentsply RU LLC

