



УТВЕРЖДАЮ

**Генеральный директор
ООО «Медента»
Терехов В.В.**

« 05 » октября 2021г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МАКЕТА МАРКИРОВКИ И УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Наконечник стоматологический турбинный TWINPOWER TURBINE 4H PAR-4HX-0 с принадлежностями.

Производства J. MORITA MFG. CORP.,
адрес: 680 Higashihama Minami-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8533, Япония.



TWINPOWER TURBINE 4H
Type : PAR-4HX-O

LABEL CODE:
H619-81201-500/
H619SPAREML5/
H619T003031



SN H619T003031


 2021-06-24
H619SPAREML5 GS1-128
1818200




(01:04548213040058 (21) H619T003031




2) Фотография макета маркировки и упаковки медицинского изделия (вид сбоку).

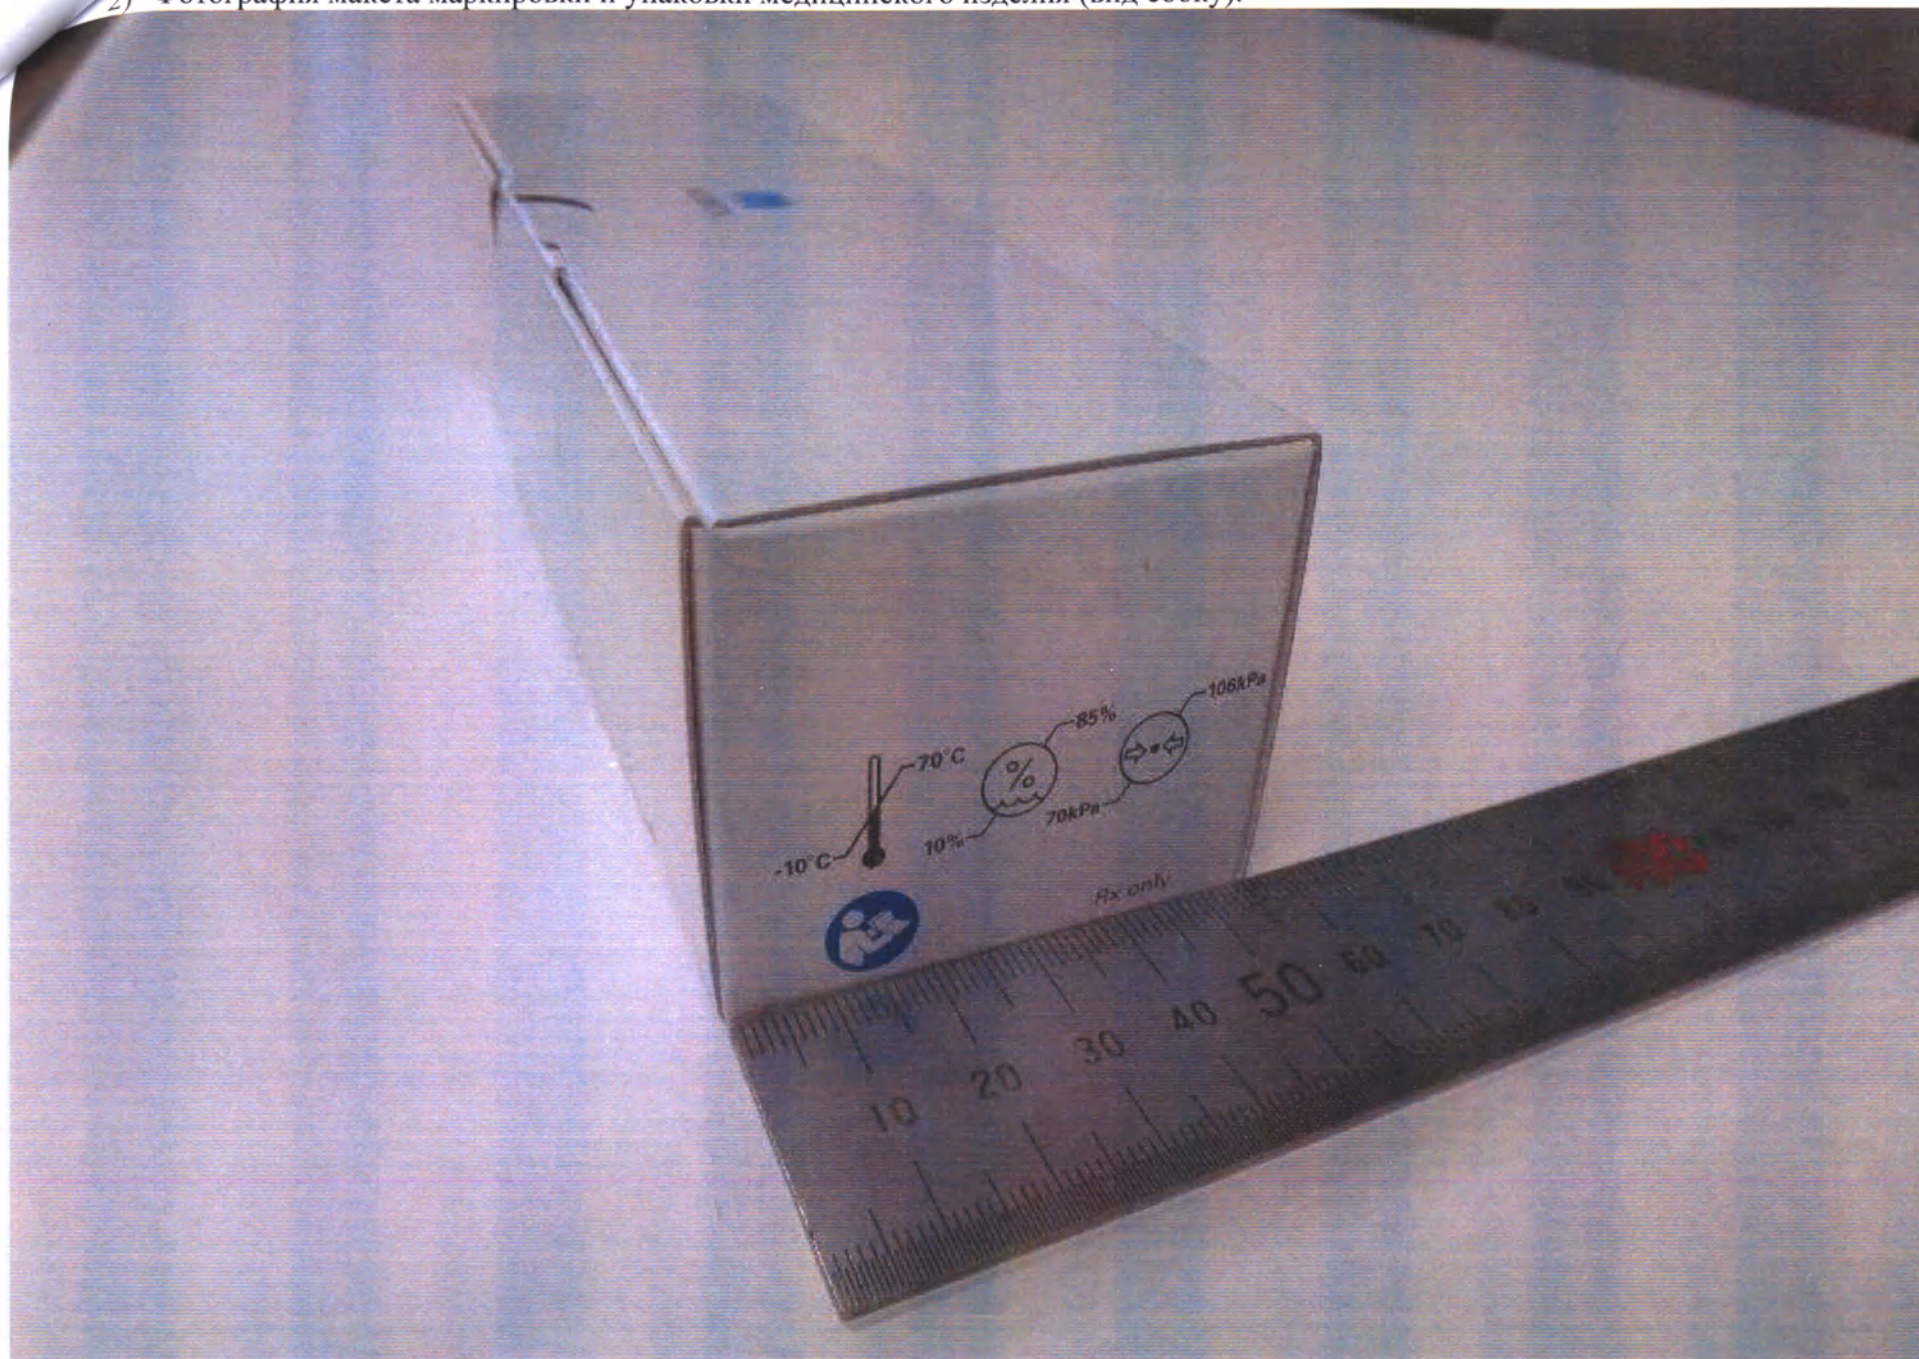

3) Фотография макета маркировки и упаковки медицинского изделия (вид снизу).

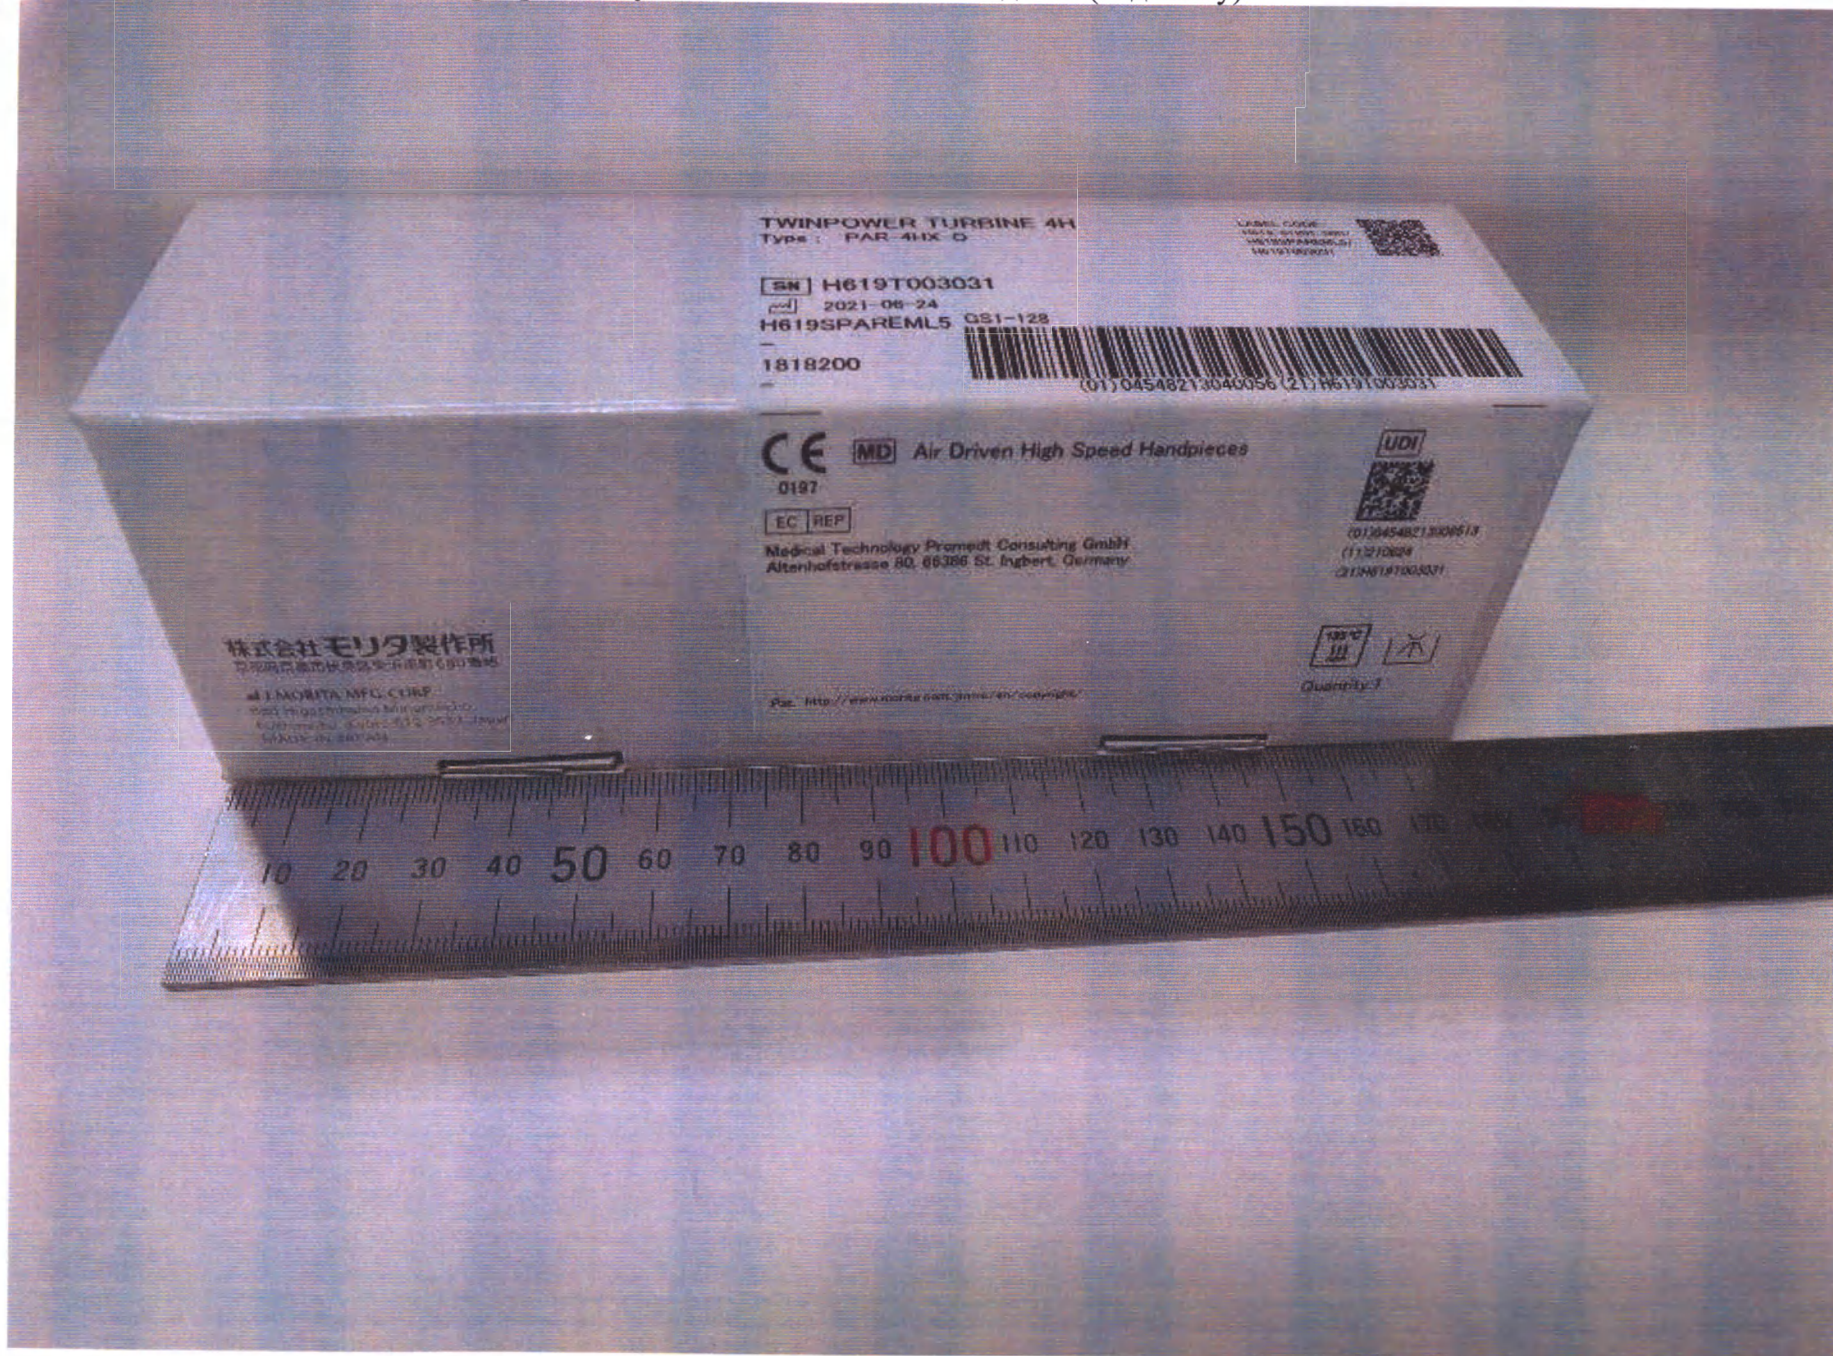

4) Фотография макета маркировки и упаковки медицинского изделия (вид сверху).

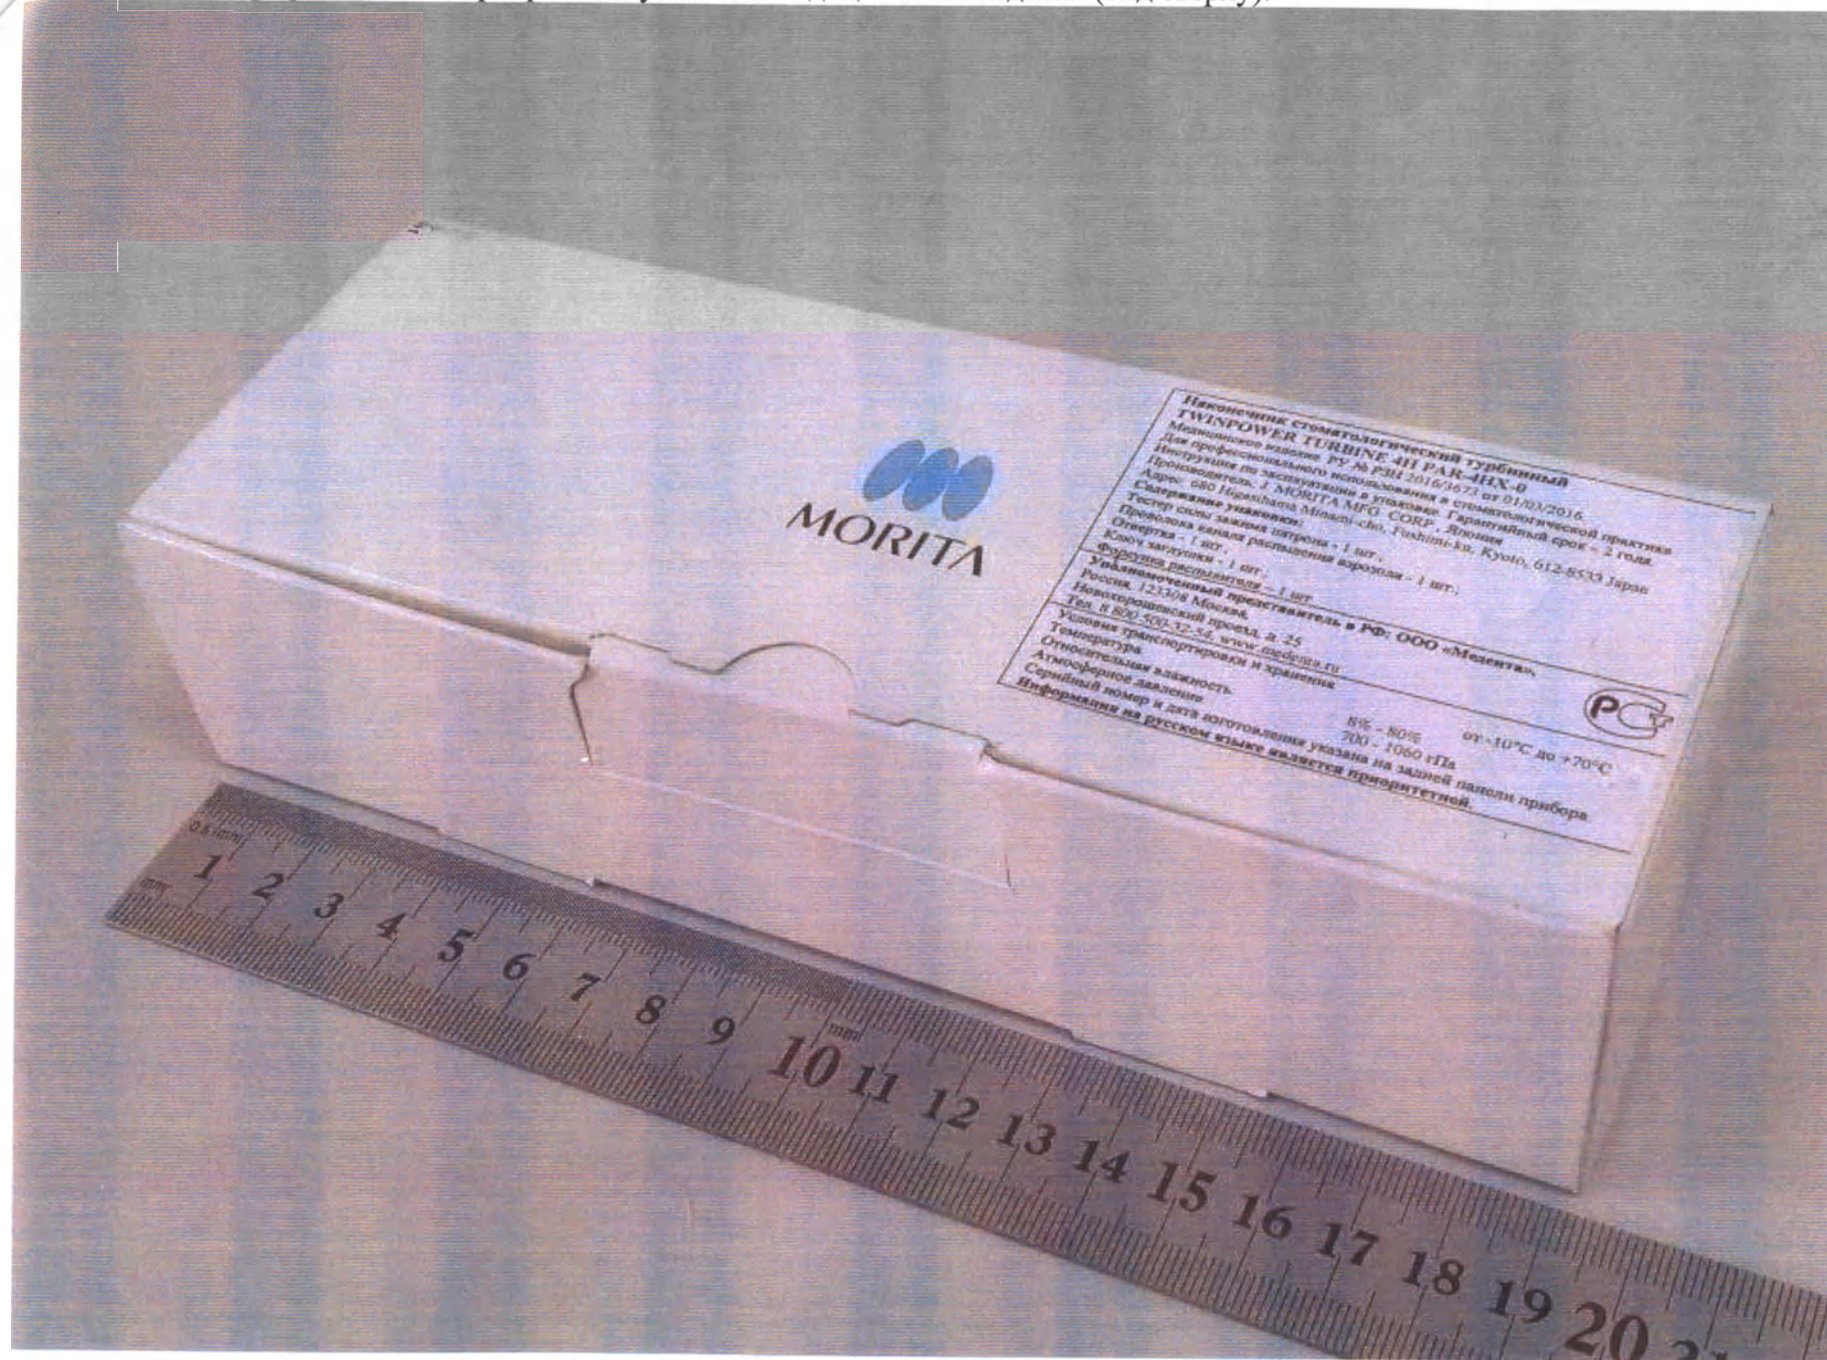

**Наконечник стоматологический турбинный
TWINPOWER TURBINE 4H PAR-4HX-0**

Медицинское изделие. РУ № РЗН 2016/3673 от 01/03/2016.
Для профессионального использования в стоматологической практике.

Инструкция по эксплуатации в упаковке. Гарантийный срок – 2 года.
Производитель: J. MORITA MFG CORP., Япония

Адрес: 680 Higashihama Minami-cho, Fushimi-ku, Kyoto, 612-8533 Japan

Содержание упаковки:

Тестер силы зажима патрона - 1 шт.;

Проволока канала распыления аэрозоля - 1 шт.;

Отвертка - 1 шт.;

Ключ заглушки - 1 шт.;

Форсунка распылителя - 1 шт.

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Медента»,

Россия, 123308 Москва,

Новохорошевский проезд, д. 25

Тел. 8 800 500-32-54, www.medenta.ru

Условия транспортировки и хранения:

Температура.

Относительная влажность:

Атмосферное давление:


8% - 80%

700 - 1060 гПа


от -10°C до +70°C

Серийный номер и дата изготовления указана на задней панели прибора.

Информация на русском языке является приоритетной.



6) Фотография содержимого упаковки медицинского изделия.

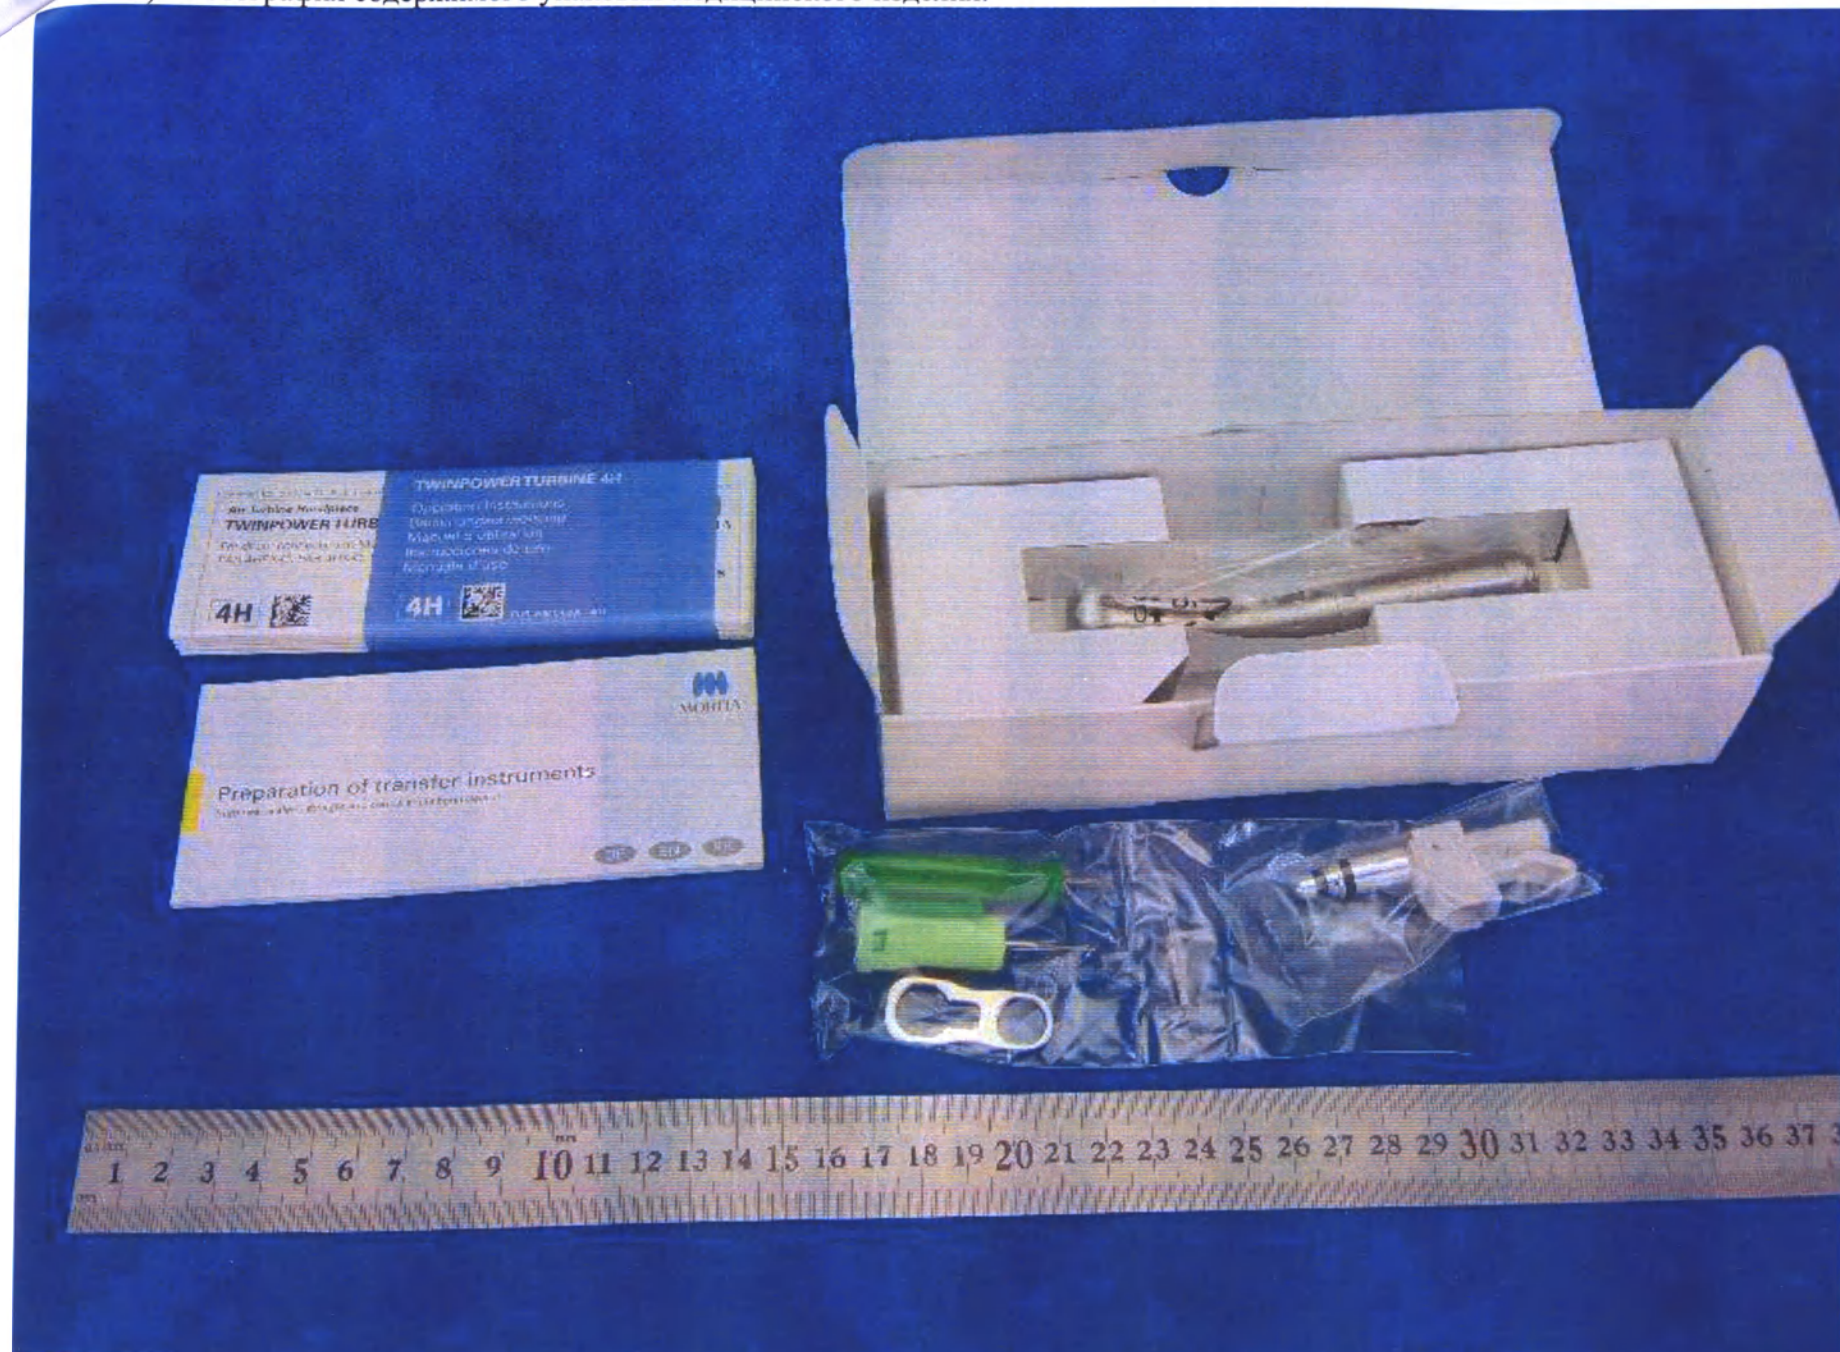

Пронумеровано, прошнуровано

и скреплено печатью

7 (силь) листов

Ген. Директор ООО «Медента»

В. В. Терехов

