



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:


**Катетер баллонный дилатационный Sterling для
ангиопластики, варианты исполнения**

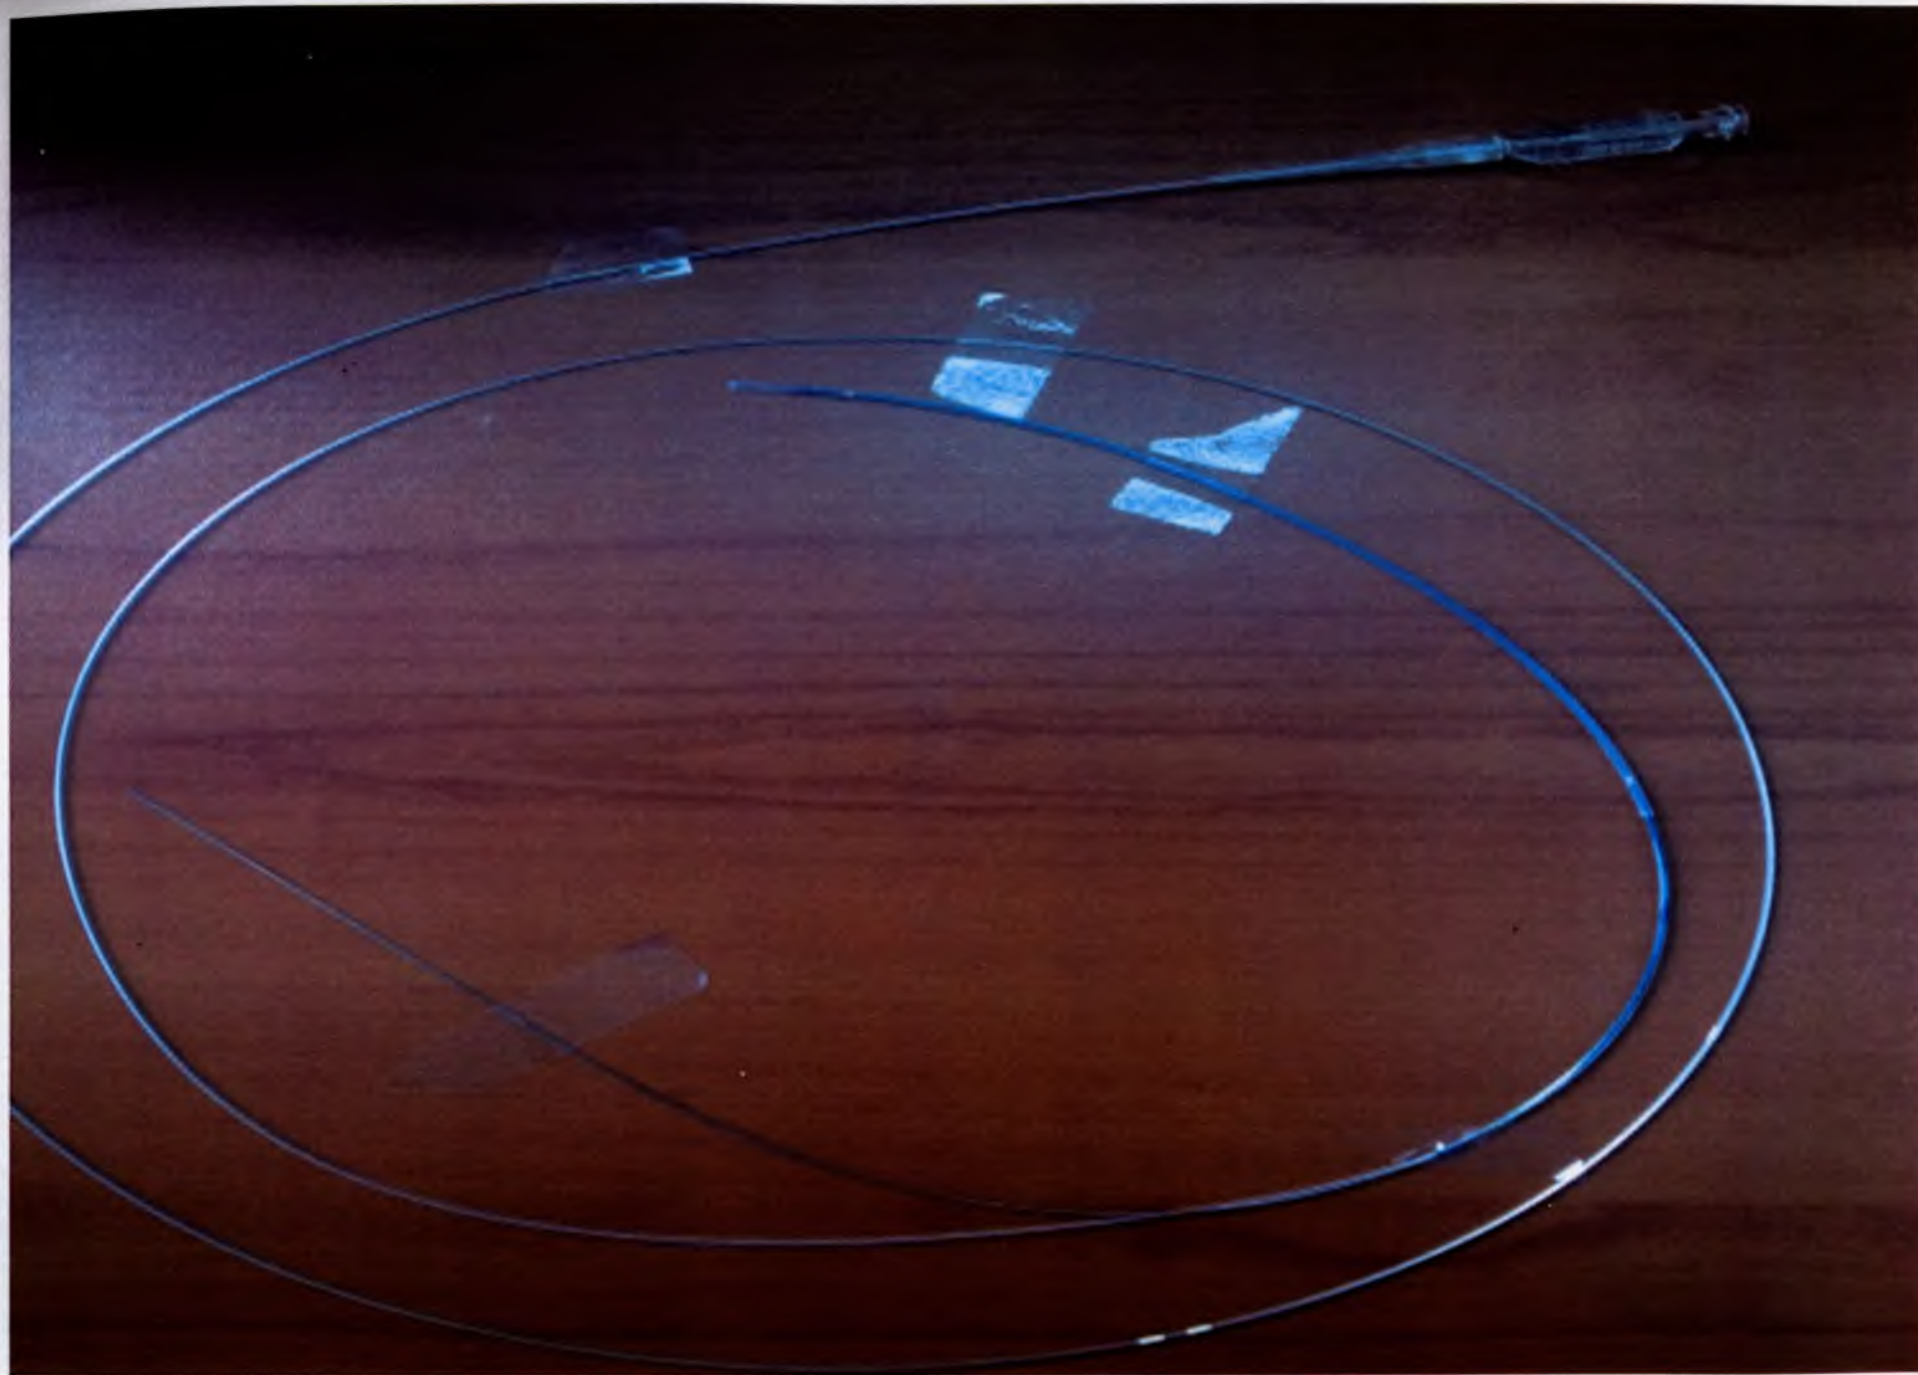


Катетер баллонный дилатационный Sterling Monorail, диаметр баллона от 3 мм до 8 мм, длина катетера 80 см, 135 см (общий вид)

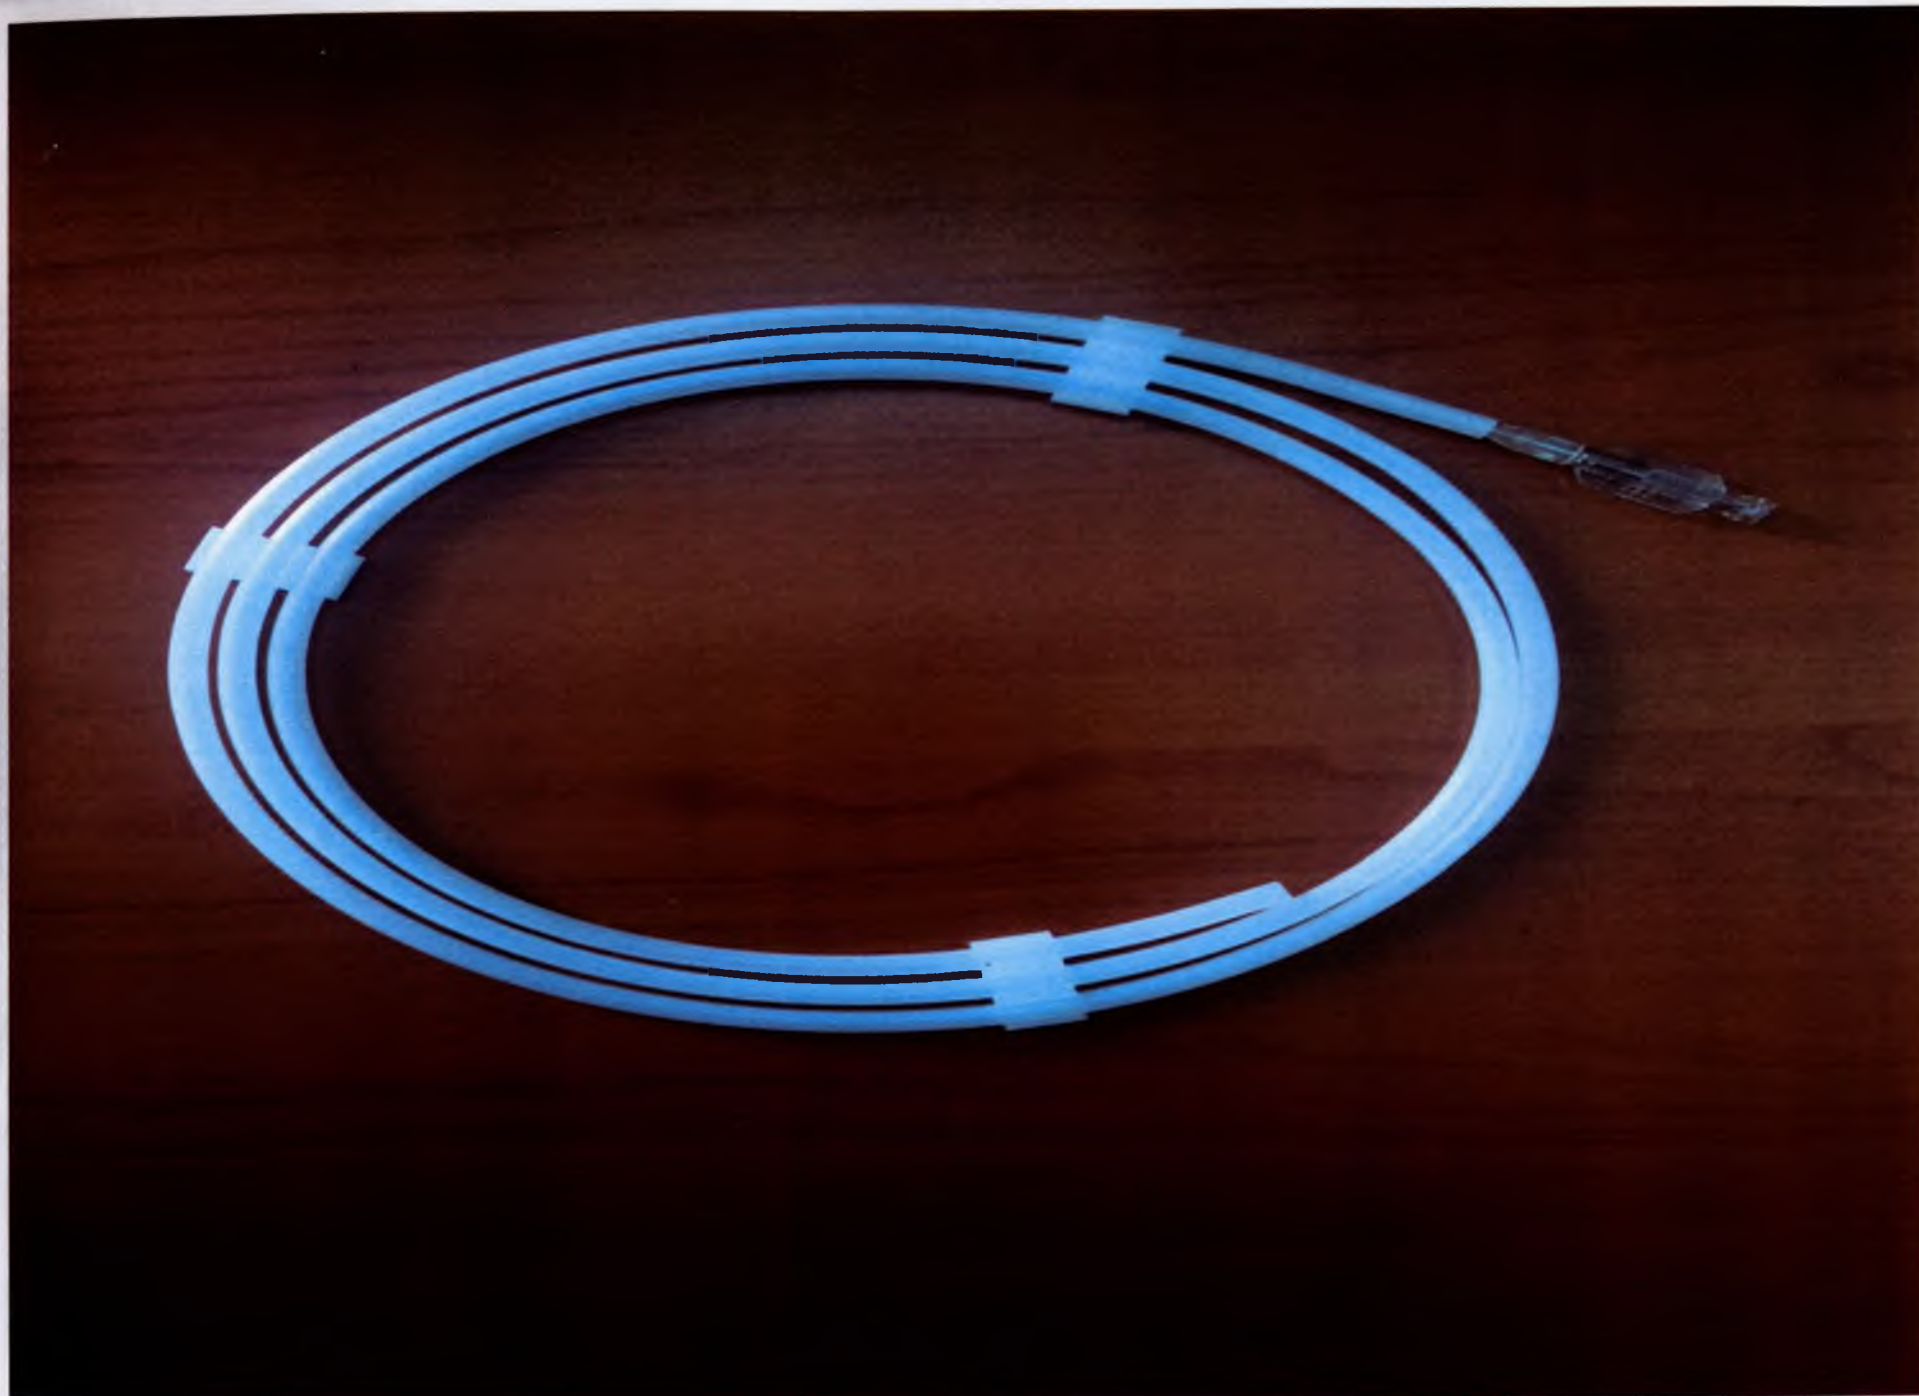


Катетер баллонный дилатационный Sterling Monorail, диаметр баллона от 3 мм до 8 мм, длина катетера 80 см, 135 см: катетер в защитной трубке

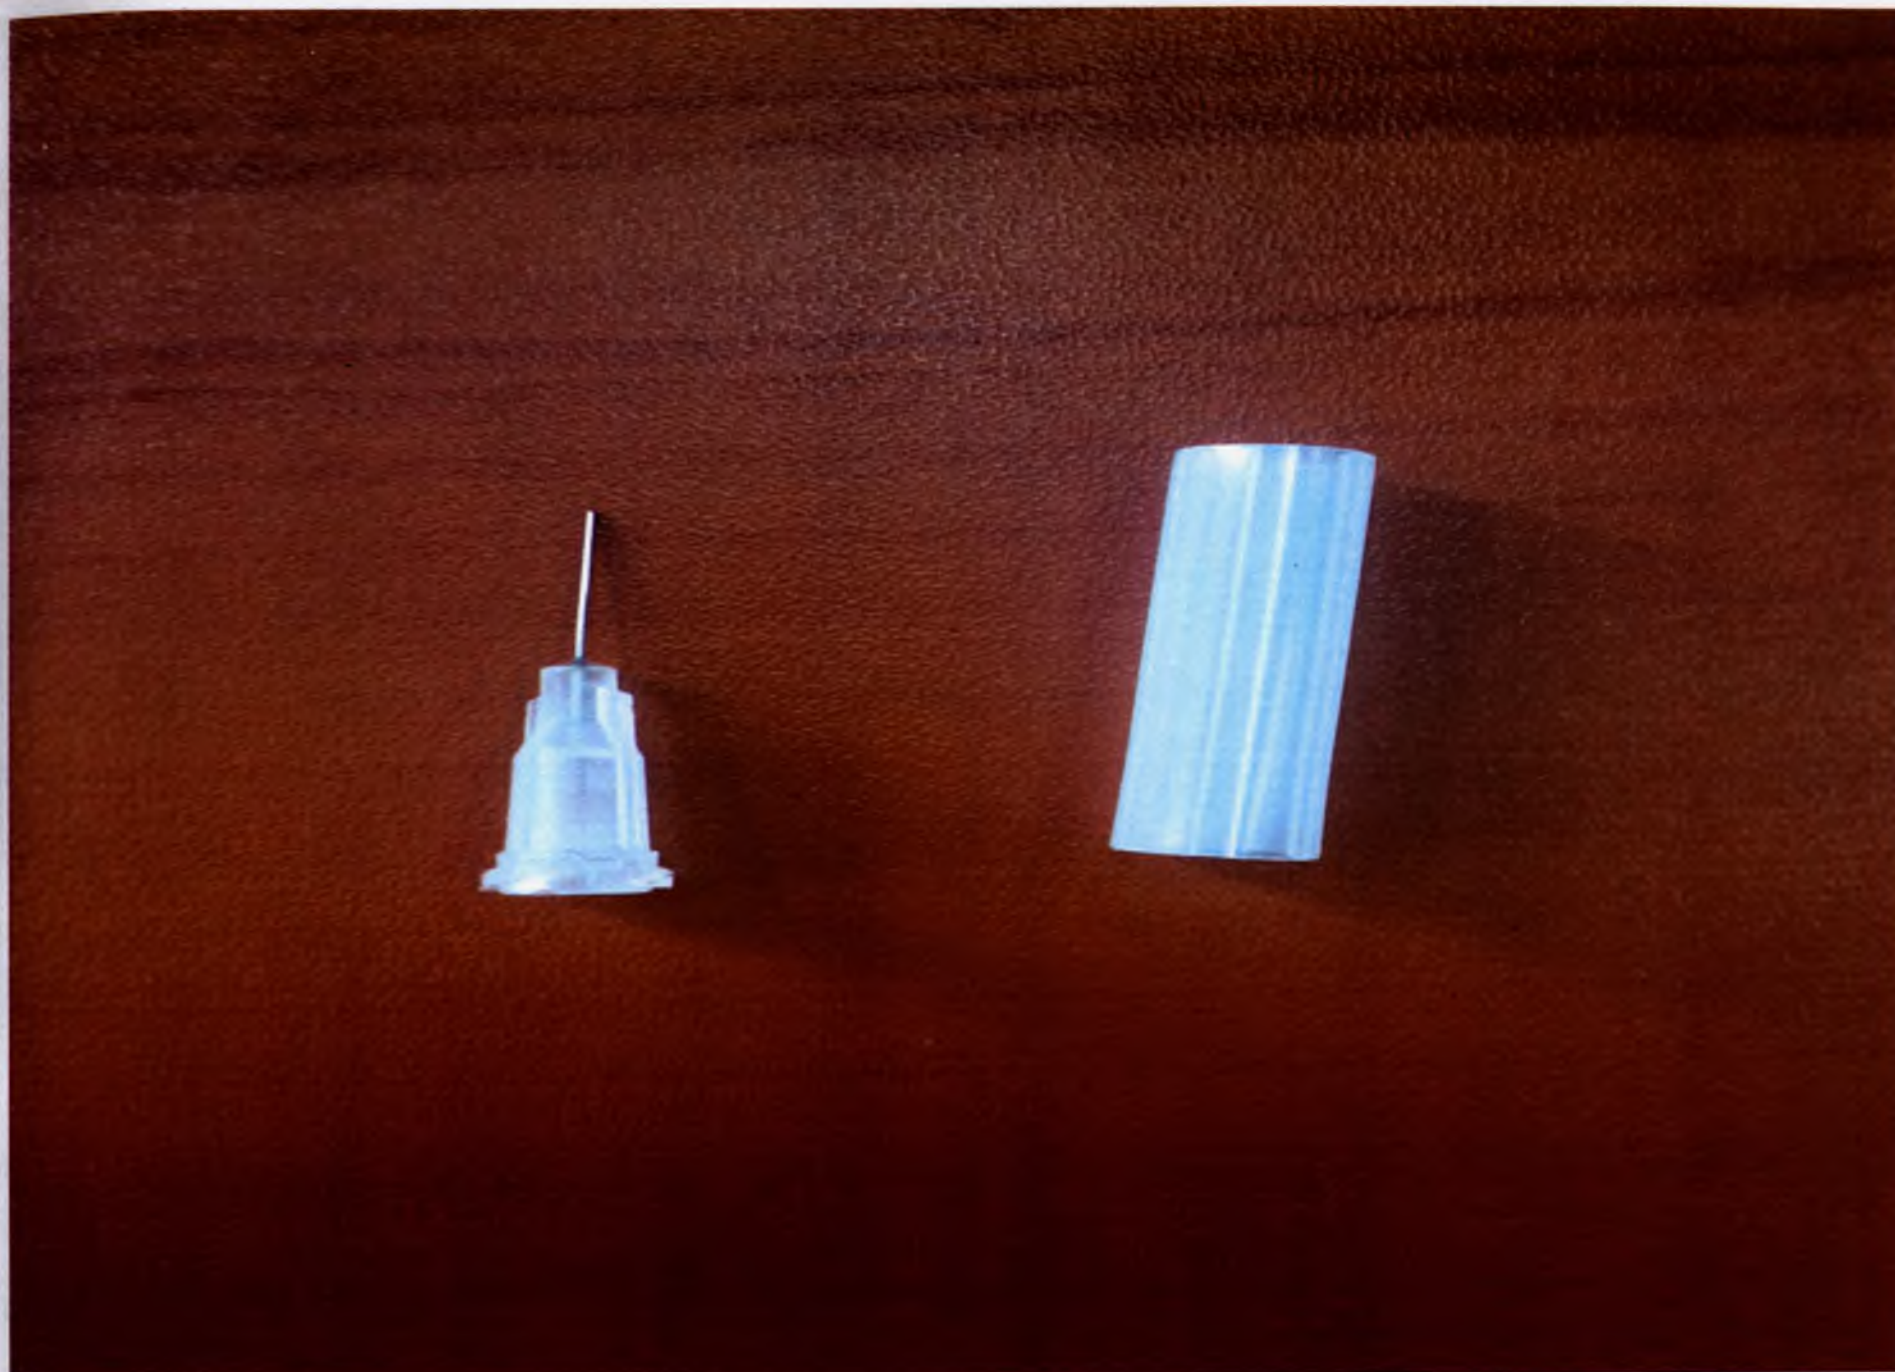

Катетер баллонный дилатационный Sterling Monorail, диаметр баллона от 3 мм до 8 мм, длина катетера 80 см, 135 см: игла для промывки

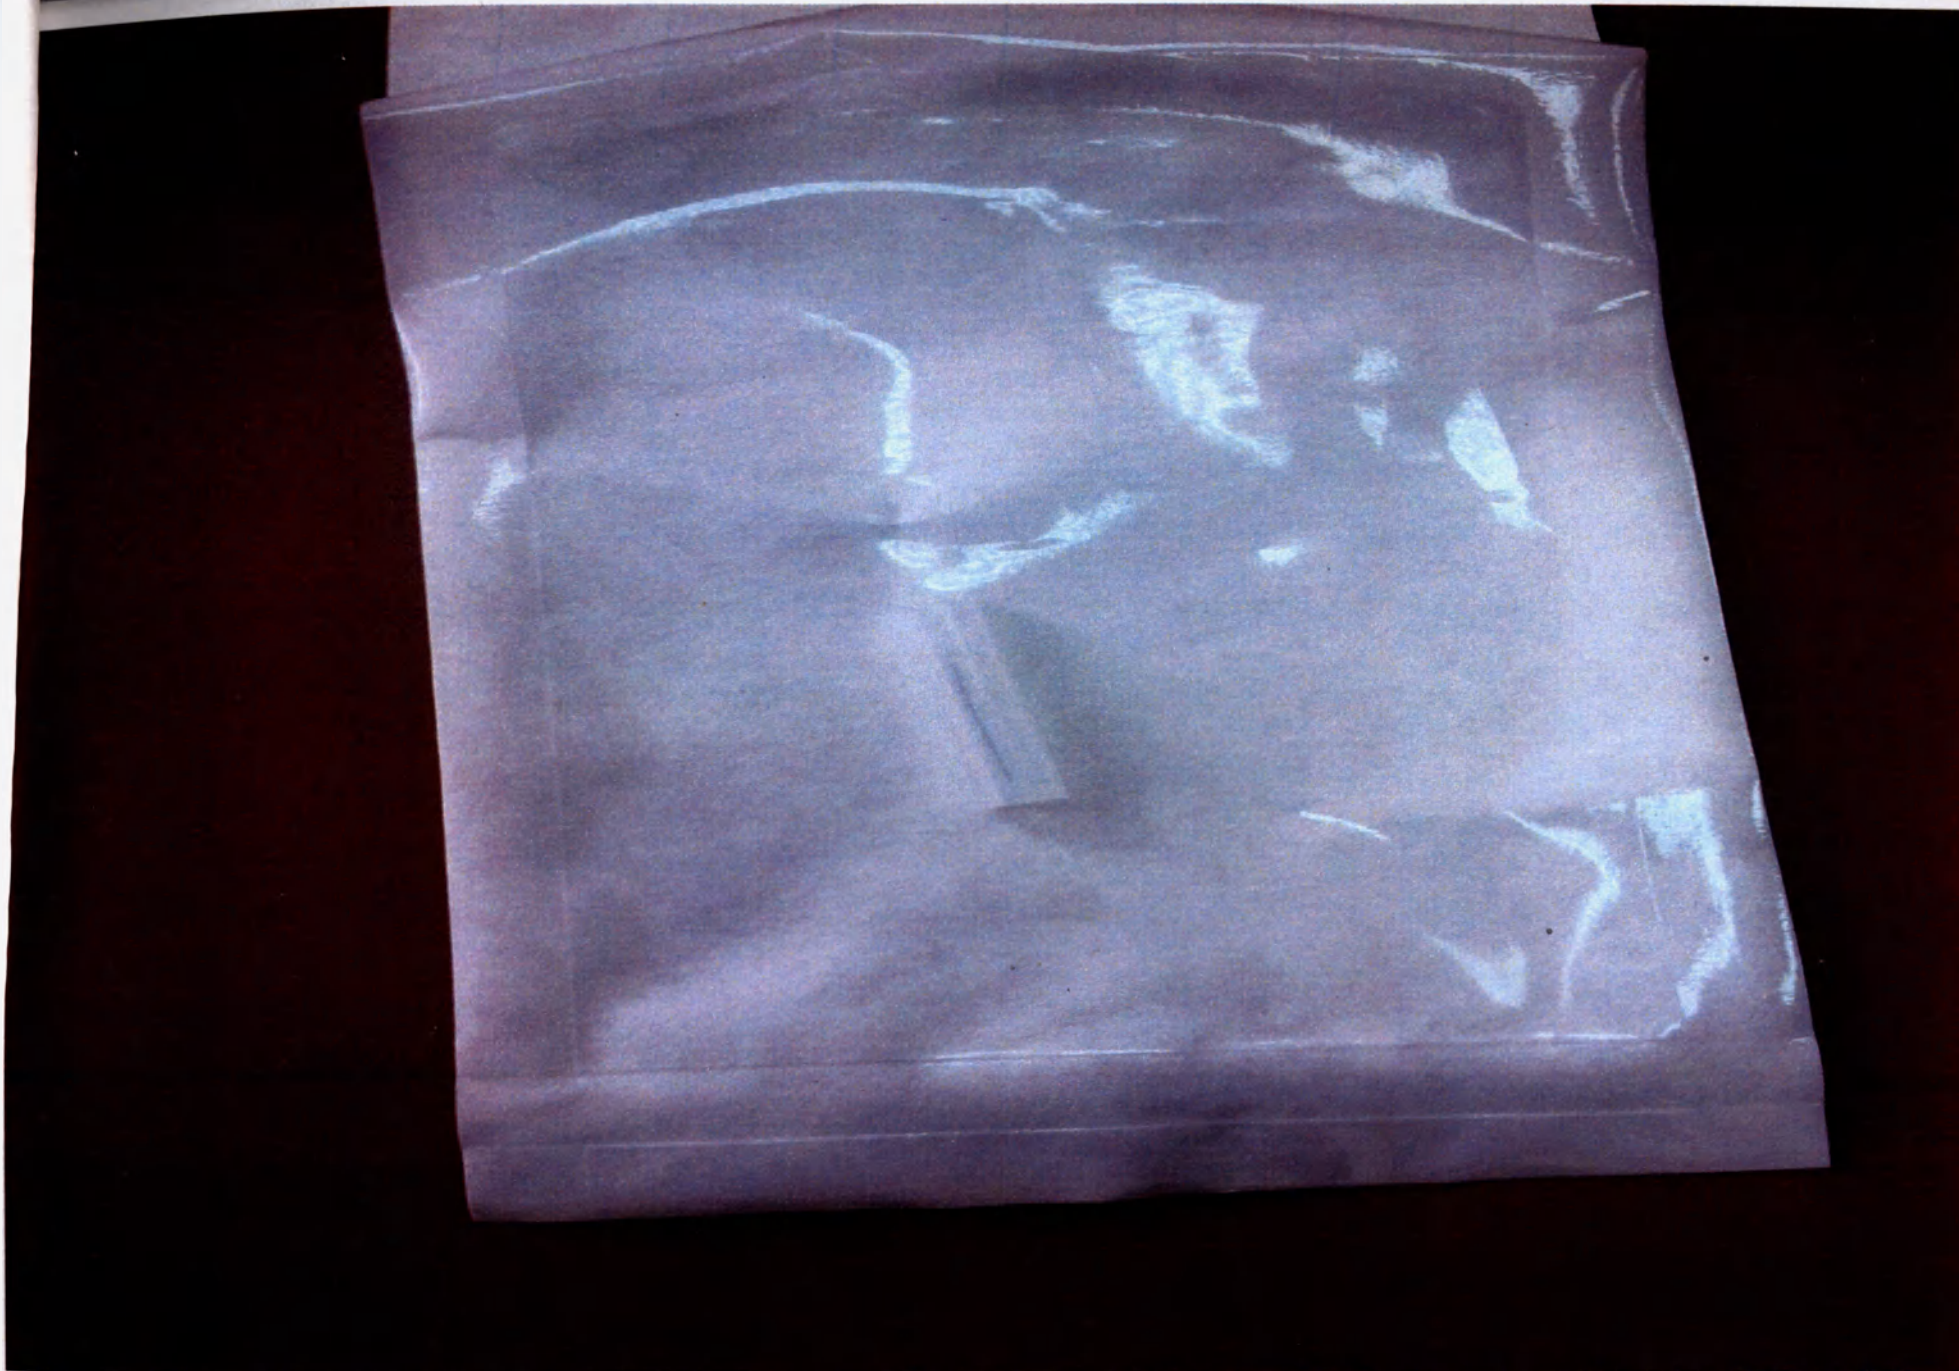

Катетер баллонный дилатационный Sterling Monorail, диаметр баллона от 3 мм до 8 мм, длина катетера 80 см, 135 см: карман для аксессуаров

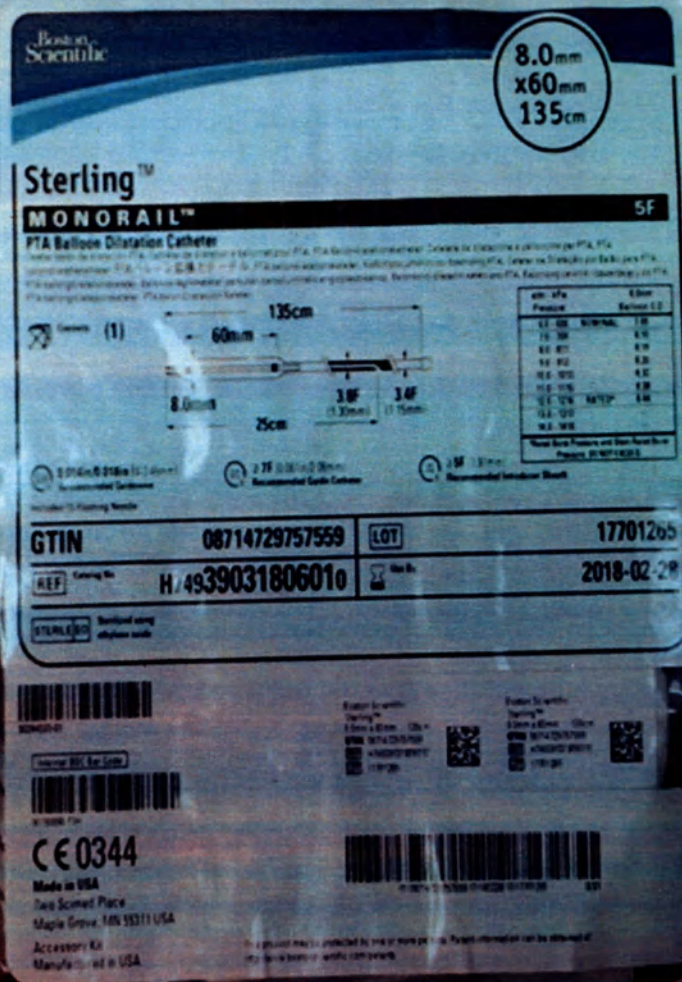

Катетер баллонный дилатационный Sterling Monorail, диаметр баллона 8 мм, длина катетера 135 см в запечатываемом пакете: маркировка 1-ой стороны

Boston
Scientific

EC REP EU Authorized
Representative
Boston Scientific International S.A.
15 Avenue des Champs-Élysées
75008 PARIS
N° de déclaration: 00000000000000000000

Rx ONLY

Consult Instructions
for use.

Do not use if package
is damaged.

For single use only.
Do not reuse.

Do Not
Resterilize



Катетер баллонный дилатационный Sterling Monorail, диаметр баллона 8 мм, длина катетера 135 см в запечатываемом пакете:
маркировка 2-ой стороны

Boston
Scientific


Sterling™
MONORAIL™

5F

PTA Balloon Dilatation Catheter

Cathéter à ballonnet de dilatation PTA, Cathéter de dilatation à ballonnet pour PTA, PTA Balloon Dilatation Catheter, Cathéter de
dilatación con balón para PTA, PTA Balloon Dilatation Catheter, PTA/Balloon Dilatation Catheter, Cathéter de
dilatación con balón para PTA, Cathéter de Dilatación con Balón para PTA, PTA
balloon dilatation catheter, Balloon dilatation catheter, Balloon dilatation catheter, Balloon dilatation catheter
pour PTA, Balloon dilatation catheter pour PTA, PTA balloon dilatation catheter, PTA Balloon Dilatation Catheter

Contents (1)



mm - kPa	mmHg	mmHg
13.0 - 14.0	190 - 200	190
15.0 - 16.0	225 - 240	225
17.0 - 18.0	255 - 270	255
19.0 - 20.0	285 - 300	285
21.0 - 22.0	315 - 330	315
23.0 - 24.0	345 - 360	345
25.0 - 26.0	375 - 390	375
27.0 - 28.0	405 - 420	405
29.0 - 30.0	435 - 450	435
31.0 - 32.0	465 - 480	465
33.0 - 34.0	495 - 510	495
35.0 - 36.0	525 - 540	525
37.0 - 38.0	555 - 570	555
39.0 - 40.0	585 - 600	585
41.0 - 42.0	615 - 630	615
43.0 - 44.0	645 - 660	645
45.0 - 46.0	675 - 690	675
47.0 - 48.0	705 - 720	705
49.0 - 50.0	735 - 750	735
51.0 - 52.0	765 - 780	765
53.0 - 54.0	795 - 810	795
55.0 - 56.0	825 - 840	825
57.0 - 58.0	855 - 870	855
59.0 - 60.0	885 - 900	885
61.0 - 62.0	915 - 930	915
63.0 - 64.0	945 - 960	945
65.0 - 66.0	975 - 990	975
67.0 - 68.0	1005 - 1020	1005
69.0 - 70.0	1035 - 1050	1035
71.0 - 72.0	1065 - 1080	1065
73.0 - 74.0	1095 - 1110	1095
75.0 - 76.0	1125 - 1140	1125
77.0 - 78.0	1155 - 1170	1155
79.0 - 80.0	1185 - 1200	1185
81.0 - 82.0	1215 - 1230	1215
83.0 - 84.0	1245 - 1260	1245
85.0 - 86.0	1275 - 1290	1275
87.0 - 88.0	1305 - 1320	1305
89.0 - 90.0	1335 - 1350	1335
91.0 - 92.0	1365 - 1380	1365
93.0 - 94.0	1395 - 1410	1395
95.0 - 96.0	1425 - 1440	1425
97.0 - 98.0	1455 - 1470	1455
99.0 - 100.0	1485 - 1500	1485

0.014in (0.35mm) Recommended Guide Catheter

2.7F (0.7mm) Recommended Guide Catheter


2.5F (0.6mm) Recommended Introducer Sheath

Includes (1) Flushing Needle

GTIN	00714729757559	LOT	17701265
REF	Catalog No. H74039031806010	Exp. By	2018-02-28

018

Катетер баллонный дилатационный Sterling Monorail, диаметр баллона 8 мм, длина катетера 135 см: маркировка 1-ой стороны упаковки

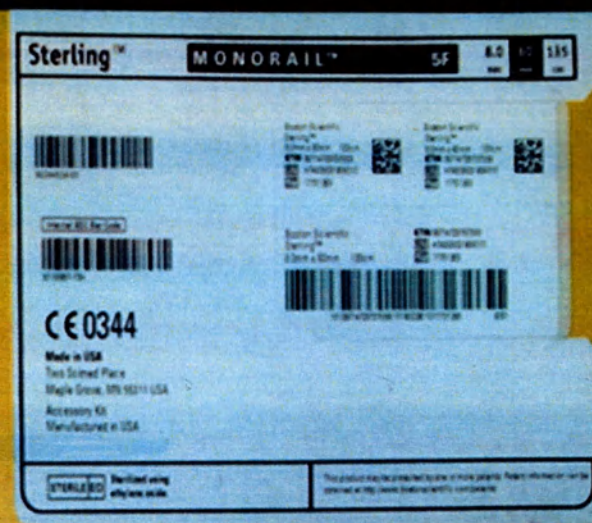

018

Boston
Scientific



STERILIZED

STERILIZED using ethylene oxide

This product has been produced to one or more specific patient information can be obtained at <http://www.boston-scientific.com/patient>

R ONLY

STERILIZED

STERILIZED using ethylene oxide

This product has been produced to one or more specific patient information can be obtained at <http://www.boston-scientific.com/patient>

STERILIZED

STERILIZED using ethylene oxide

This product has been produced to one or more specific patient information can be obtained at <http://www.boston-scientific.com/patient>

STERILIZED

STERILIZED using ethylene oxide

This product has been produced to one or more specific patient information can be obtained at <http://www.boston-scientific.com/patient>


STERILIZED

STERILIZED using ethylene oxide


This product has been produced to one or more specific patient information can be obtained at <http://www.boston-scientific.com/patient>

Катетер баллонный дилатационный Sterling Monorail, диаметр баллона 8 мм, длина катетера 135 см: маркировка 2-ой стороны

упаковки

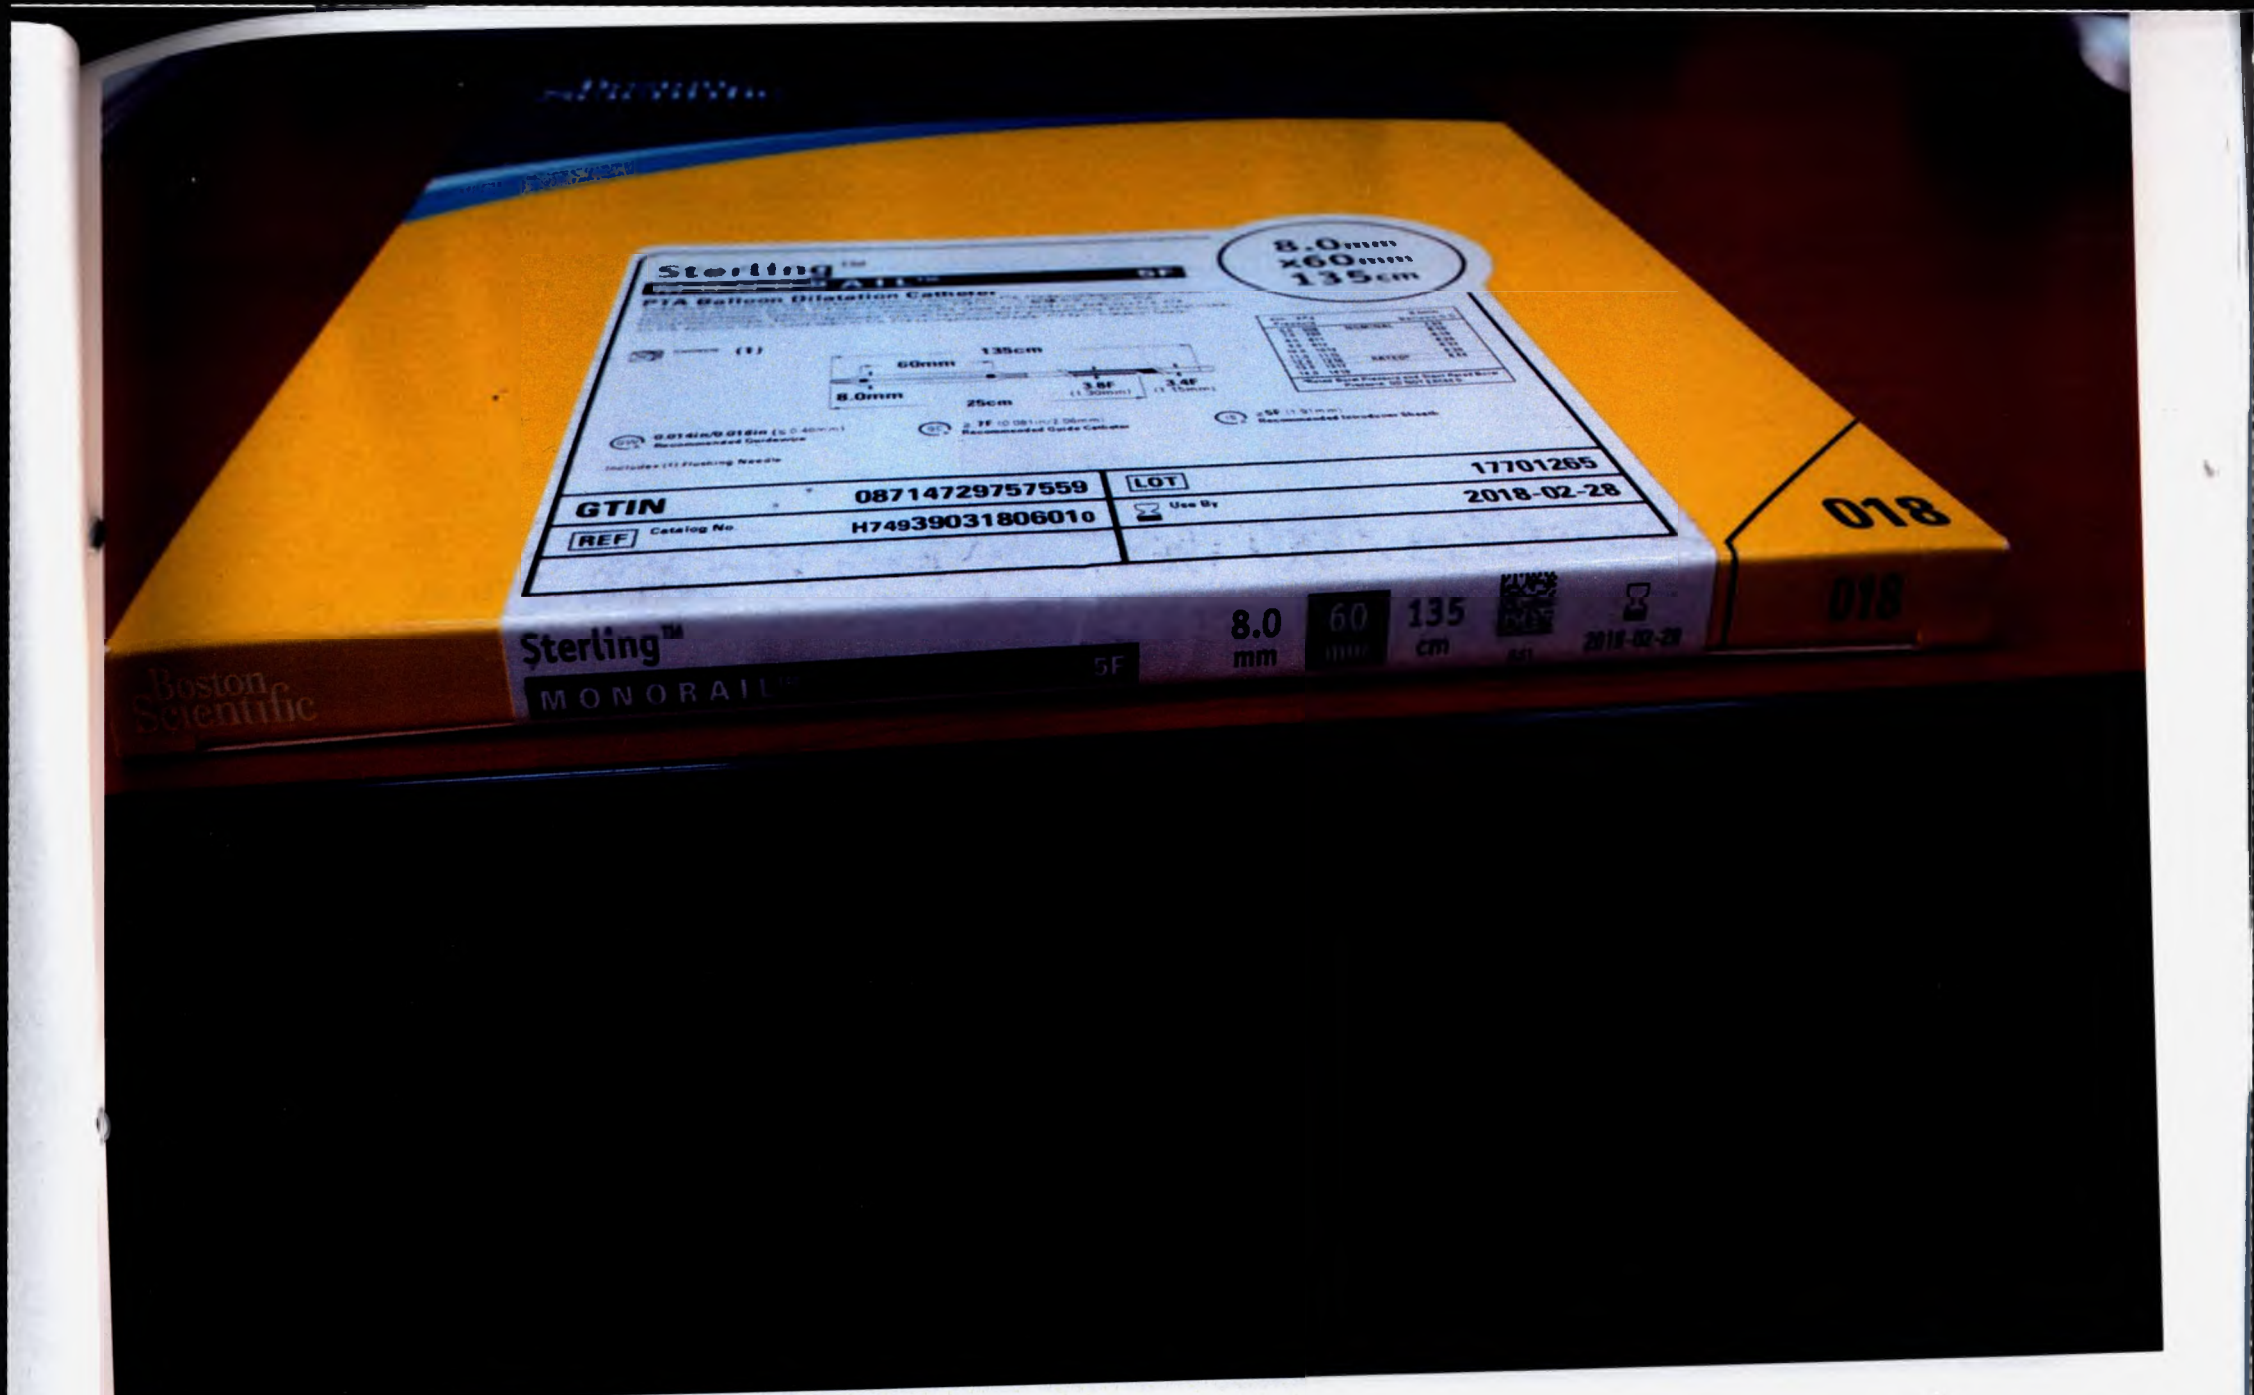


Катетер баллонный дилатационный Sterling Monorail, диаметр баллона 8 мм, длина катетера 135 см: маркировка боковой стороны упаковки

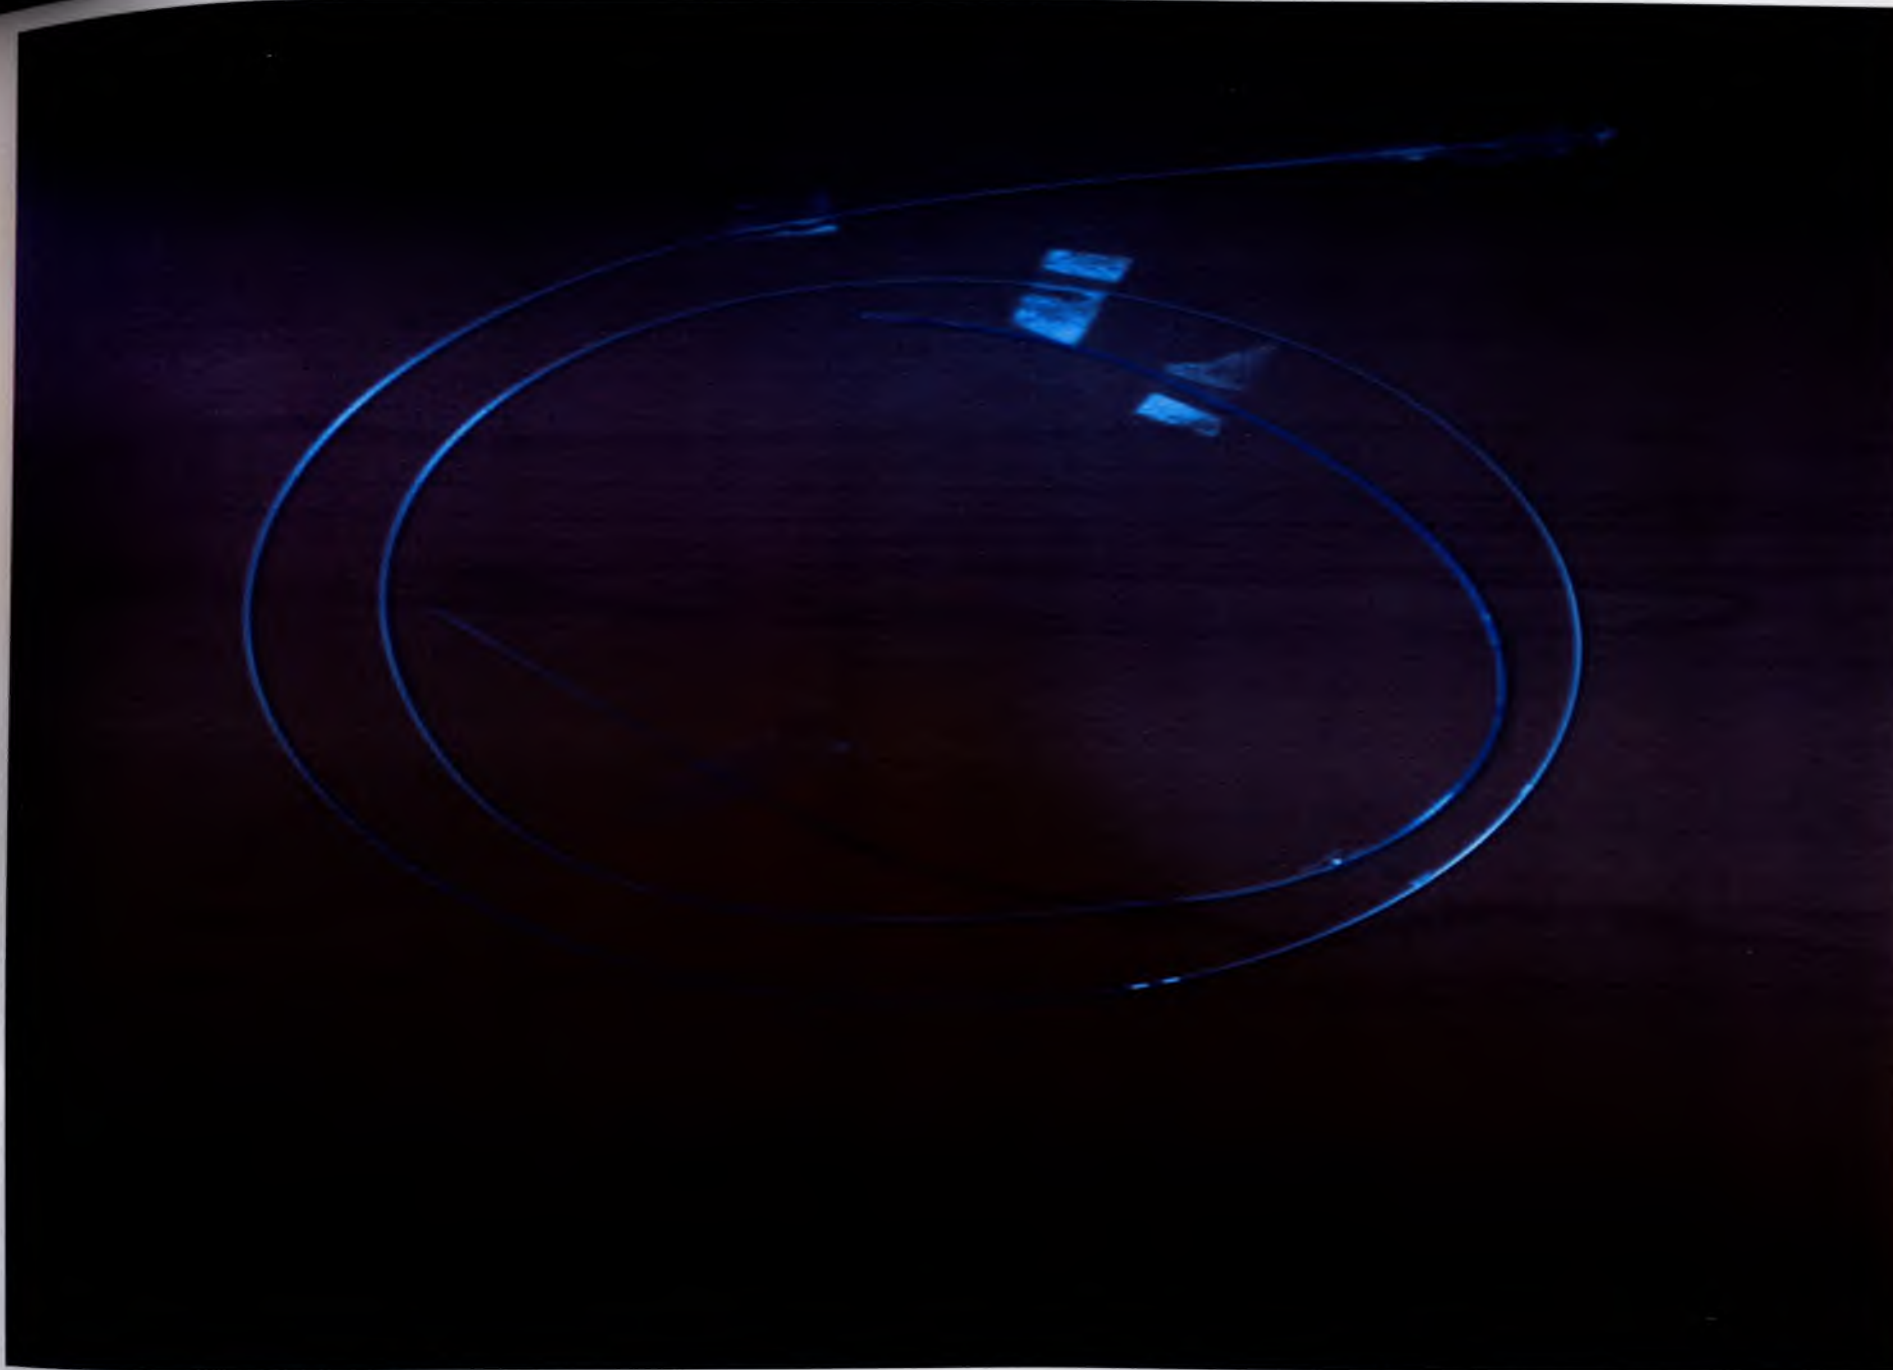


Катетер баллонный дилатационный Sterling SL Monorail, диаметр баллона от 2 мм до 4 мм, длина катетера 90 см, 150 см (общий вид)



Катетер баллонный дилатационный Sterling SL Monorail, диаметр баллона от 2 мм до 4 мм, длина катетера 90 см, 150 см: катетер в защитной трубке

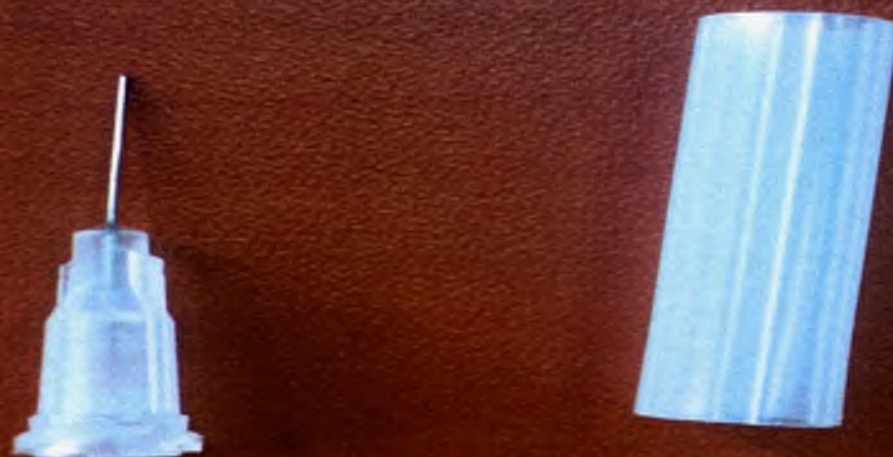

Катетер баллонный дилатационный Sterling SL Monorail, диаметр баллона от 2 мм до 4 мм, длина катетера 90 см, 150 см: игла для промывки

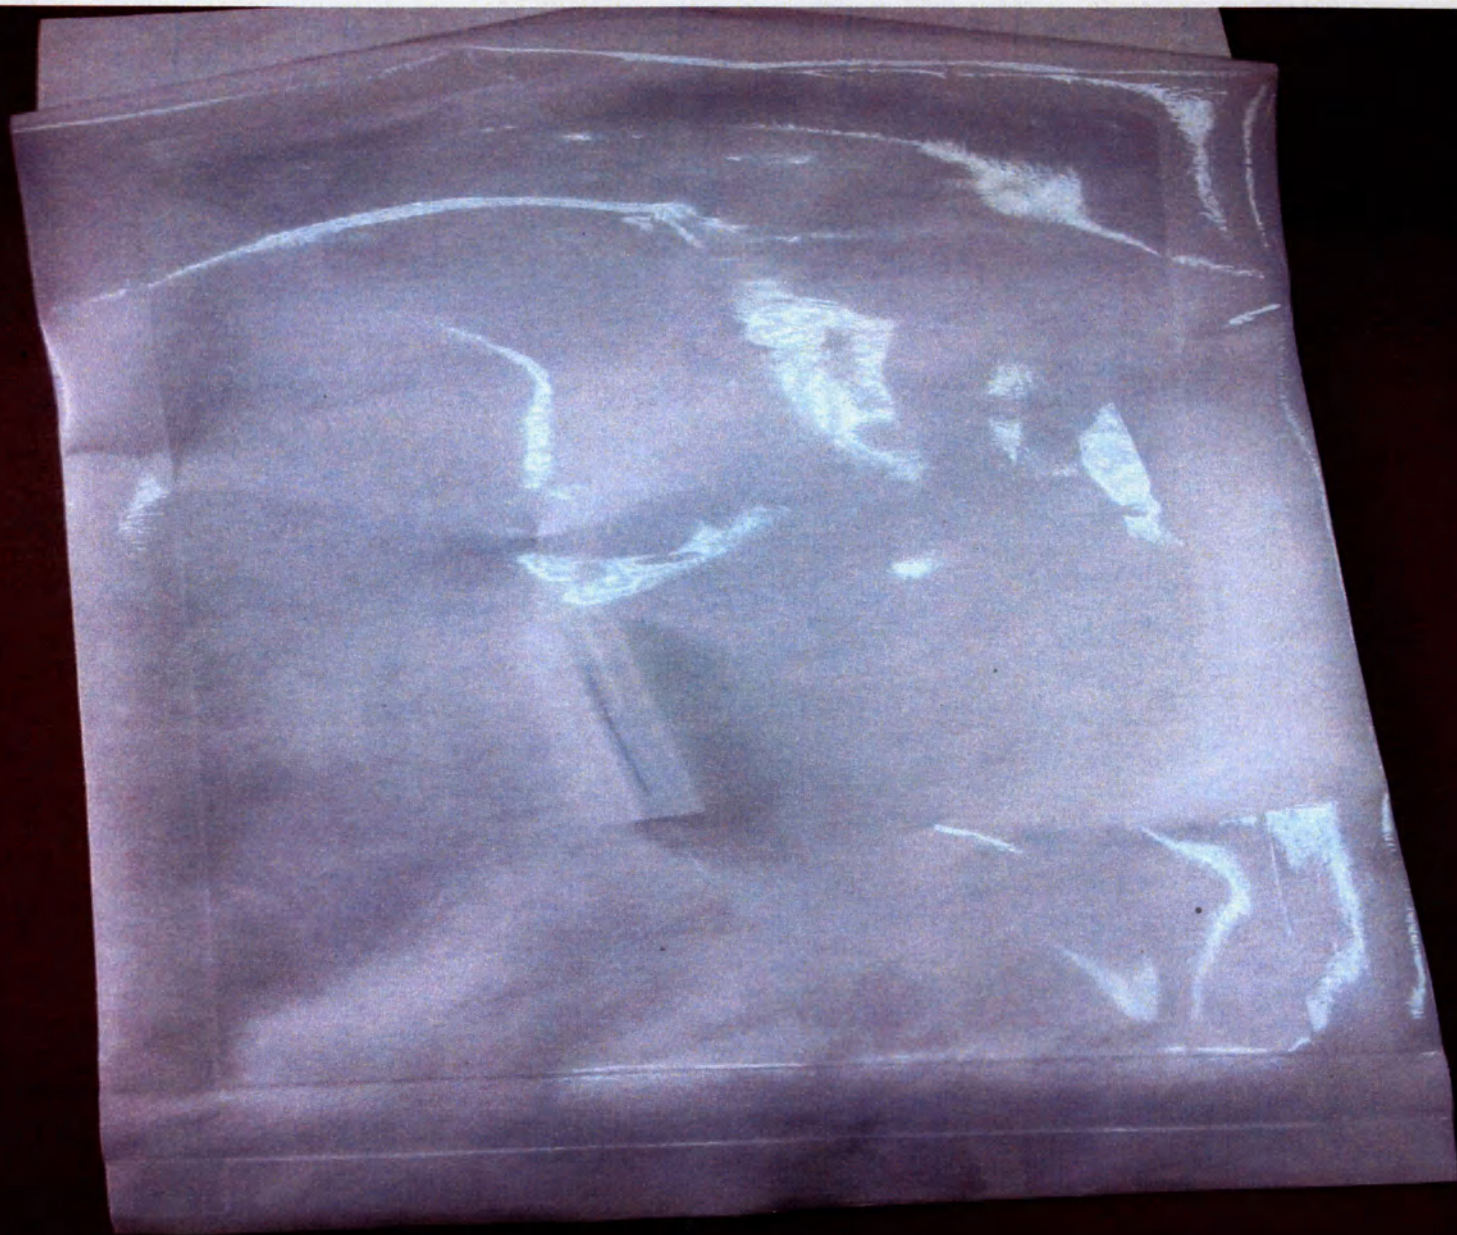

Катетер баллонный дилатационный Sterling SL Monorail, диаметр баллона от 2 мм до 4 мм, длина катетера 90 см, 150 см: карман для аксессуаров



**Катетер баллонный дилатационный Sterling SL Monorail, диаметр баллона 4 мм, длина катетера 150 см в запечатываемом пакете:
маркировка 2-ой стороны**

Катетер баллонный дилатационный Sterling SL Monorail, диаметр баллона 4 мм, длина катетера 150 см: маркировка 1-ой стороны



018

Boston
Scientific



U.S. & Canada
Authorized
Representative

Boston Scientific Corporation
Boston, MA 02115
U.S.A.

Rx ONLY

For single use only.
Do not reuse.

2. To Kit
3. To Kit

4. To Kit

5. To Kit

6. To Kit

7. To Kit

8. To Kit


9. To Kit

10. To Kit

Катетер баллонный дилатационный Sterling SL Monorail, диаметр баллона 4 мм, длина катетера 150 см: маркировка 2-ой стороны упаковки

Sterling™ SL
MONORAIL™
PTA Balloon Dilatation Catheter

Contents: (1)



0.016mm/0.016in (ISO 25mm) Recommended Guidewire
 Includes (1) Flushing Needle

2.5F ID 0.91mm (1.35mm) Recommended Guide Catheter
 2.5F (1.5mm) Recommended Intersheath Sheath

GTIN	08714729782773	LOT	17858109
REF Catalog No.	H74939147401510	Use By	2017-04-30

Sterling™ SL

MONORAIL™


4.0

150

150

018

Катетер баллонный дилатационный Sterling SL Monorail, диаметр баллона 4 мм, длина катетера 150 см: маркировка боковой стороны упаковки

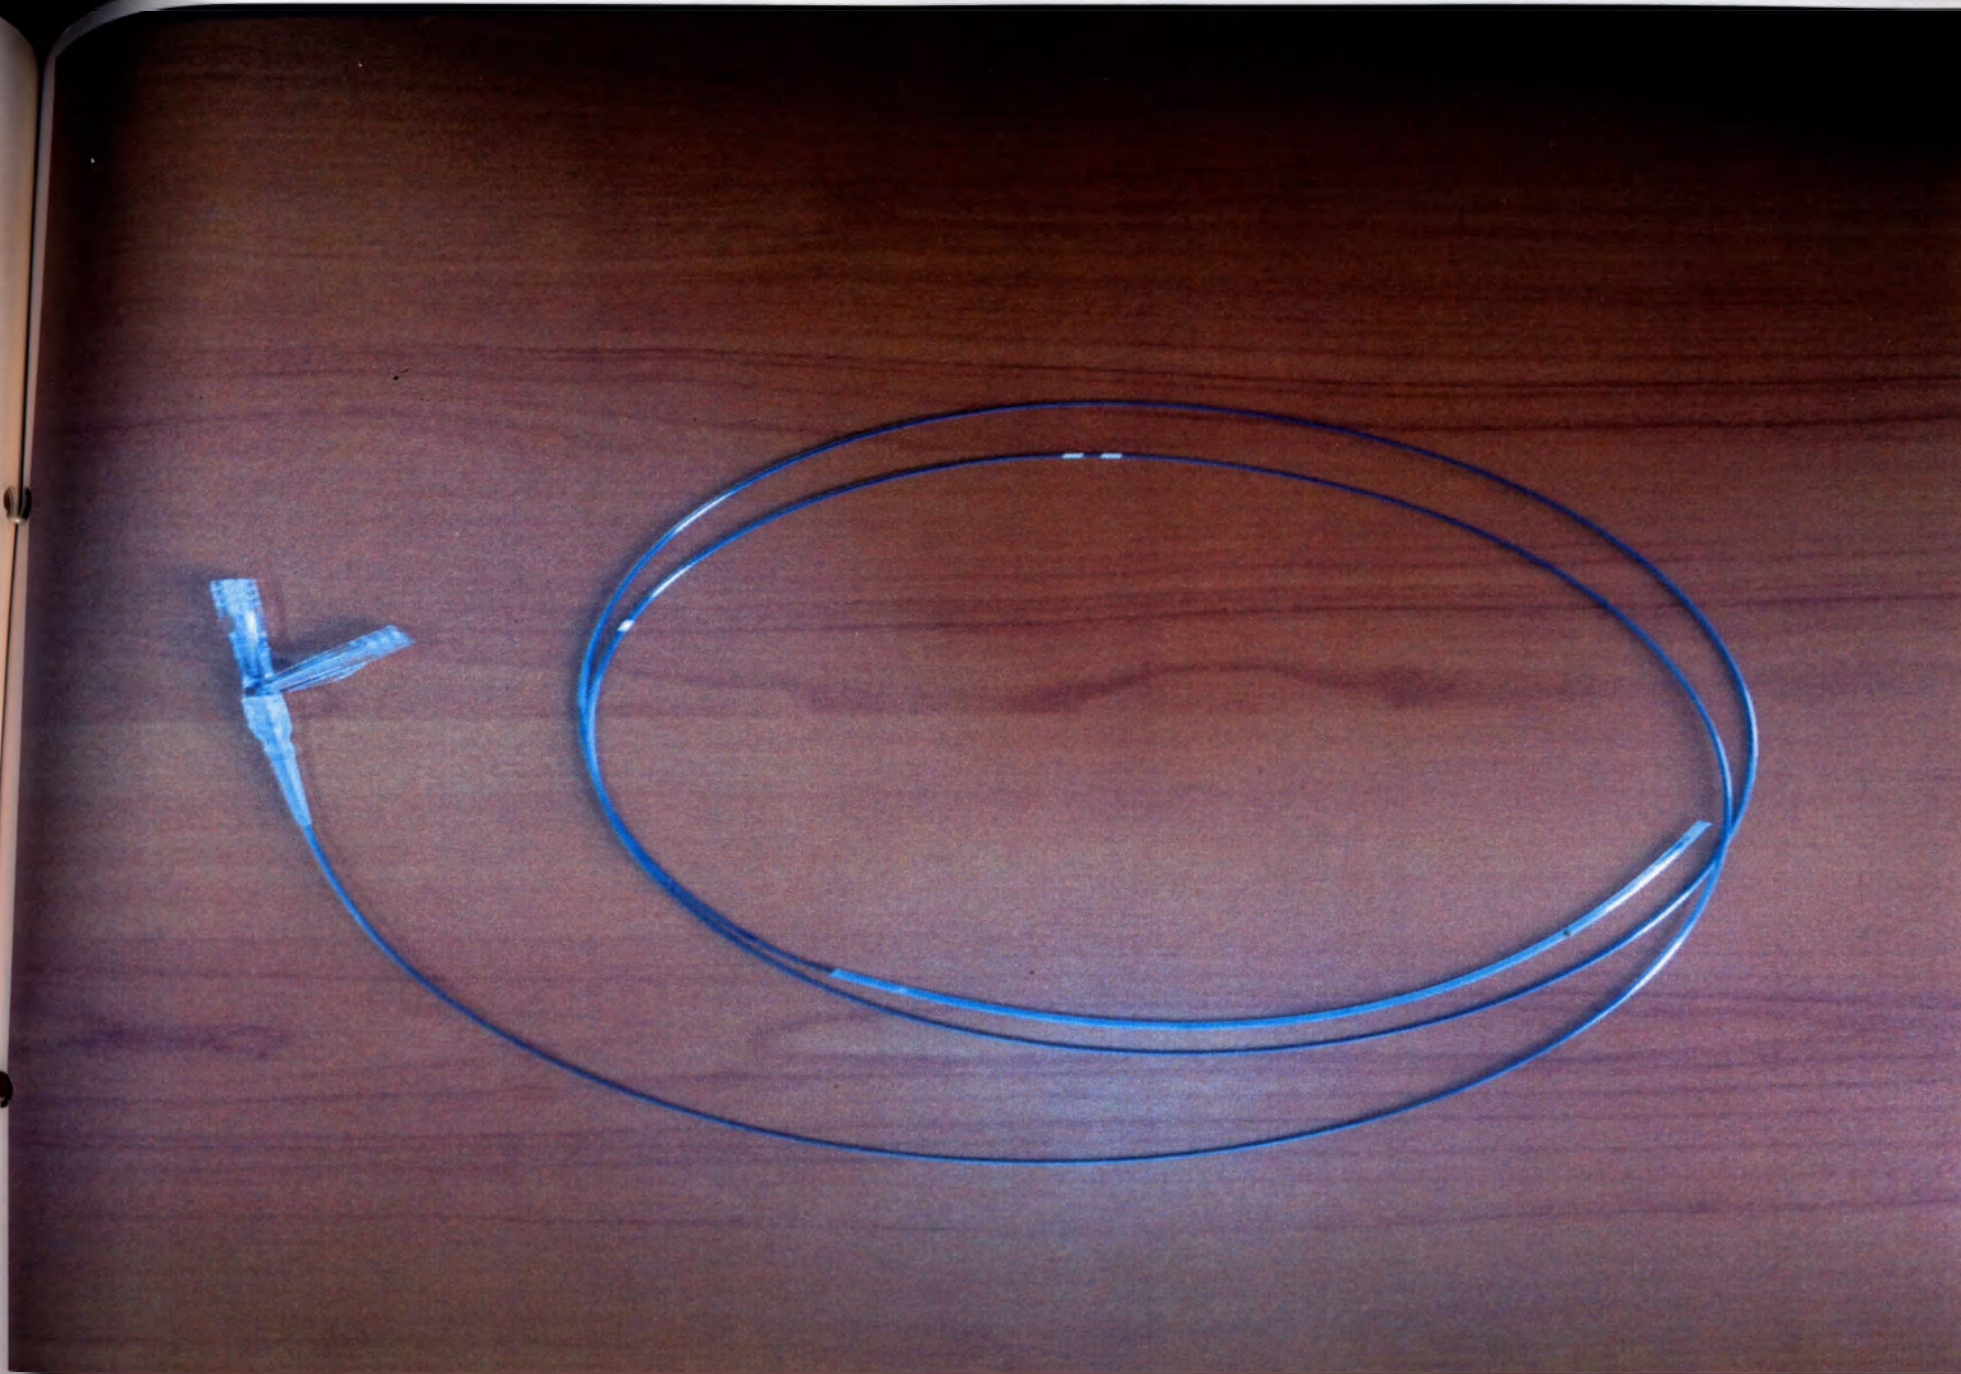

Катетер баллонный дилатационный Sterling Over-The-Wire, диаметр баллона от 1,5 мм до 10 мм, длина катетера 40 см, 80 см, 90 см, 135 см, 150 см (общий вид)



Катетер баллонный дилатационный Sterling Over-The-Wire, диаметр баллона от 1,5 мм до 10 мм, длина катетера 40 см, 80 см, 90 см, 135 см, 150 см: катетер в защитной трубке

Boston
Scientific

ISO 9001 ISO 13485
US Authorized
Representative
Boston Scientific International, S.A.
St. Julien des Champs, France
Tel: 01 47 00 00 00
www.boston-scientific.com

Rx ONLY

Consult instructions
for use.

Do not use if package
is damaged.

For single use only.
Do not reuse.

Do Not
Reinstantiate




Катетер баллонный дилатационный Sterling Over-The-Wire, диаметр баллона 10 мм, длина катетера 135 см в запечатываемом пакете:
маркировка 2-ой стороны

Sterling™

10.0mm
x80mm
135cm

PTA Balloon Dilatation Catheter

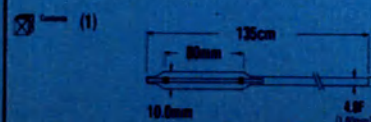[illegible]

© 2014年版权归属 (S. 4000)
Recommended Technology

© 2007 Blackwell Publishing
Reprinted with permission


(15) 2-~~8~~⁹ (2.10mm)

GTIN 00714729123484

LOT 17469409

2017-11-30

 **ООО ЦИПМИ**  **INFO@CIRMI.RU**  **WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU**

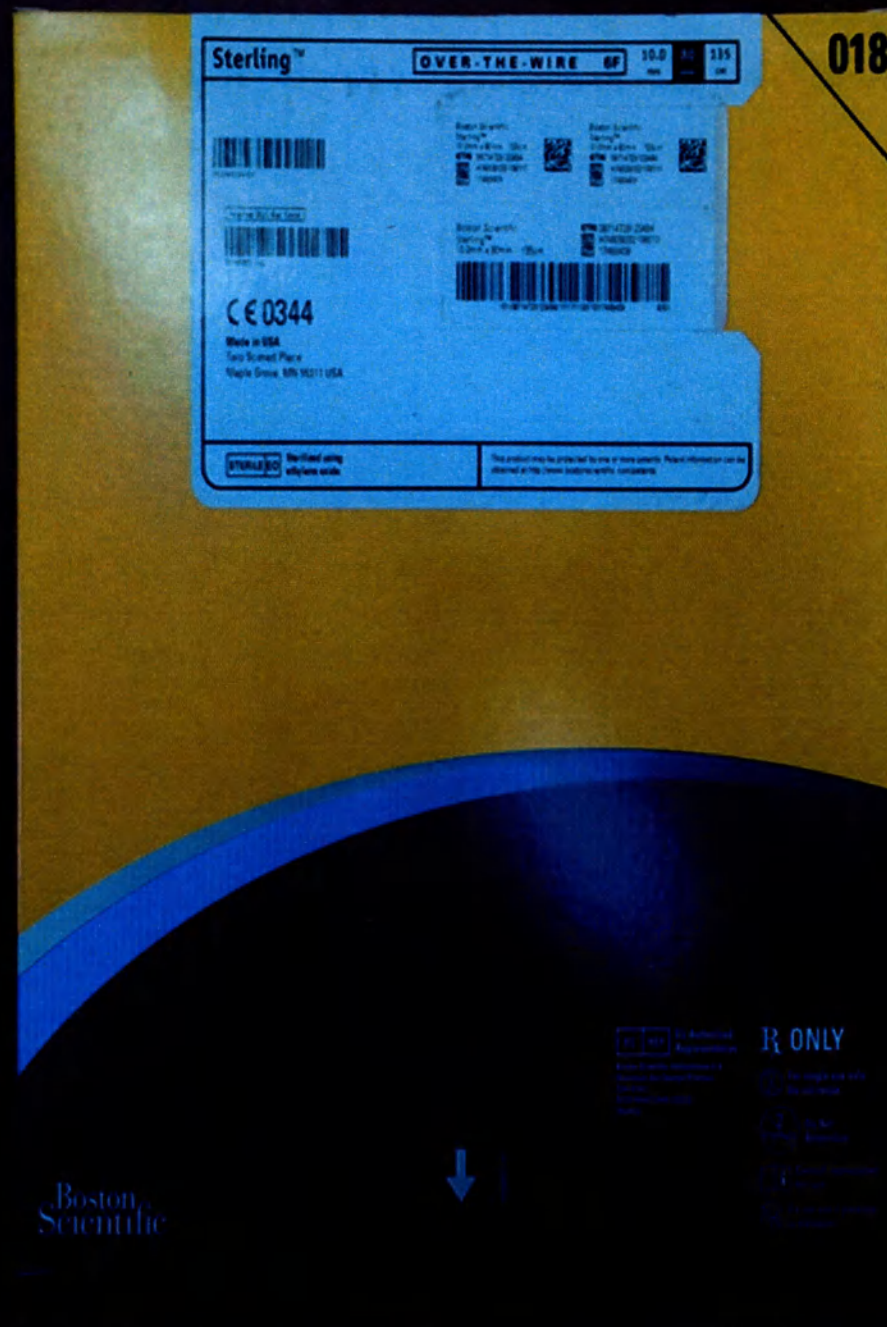

Катетер баллонный дилатационный Sterling Over-The-Wire, диаметр баллона 10 мм, длина катетера 135 см: маркировка 2-ой стороны упаковки

Sterling
OVER-THE-WIRE
PIA Balloon Dilatation Catheter

10.0mm
 x80mm
 135cm


Diagram showing catheter dimensions: 10.0mm diameter, 80mm balloon length, 135cm total length, and 4.8F (1.60mm) outer diameter.

0.016in/0.016in (5.0/5.0mm) Recommended Guidewire
 2.8F (0.091in/2.31mm) Recommended Guide Catheter
 2.8F (2.16mm) Recommended Intersheath Sheath

GTIN	08714729123484	LOT	17469409
REF Catalog No	H74939032108010	Use By	2017-11-30

018


Катетер баллонный дилатационный Sterling Over-The-Wire, диаметр баллона 10 мм, длина катетера 135 см: маркировка боковой стороны упаковки

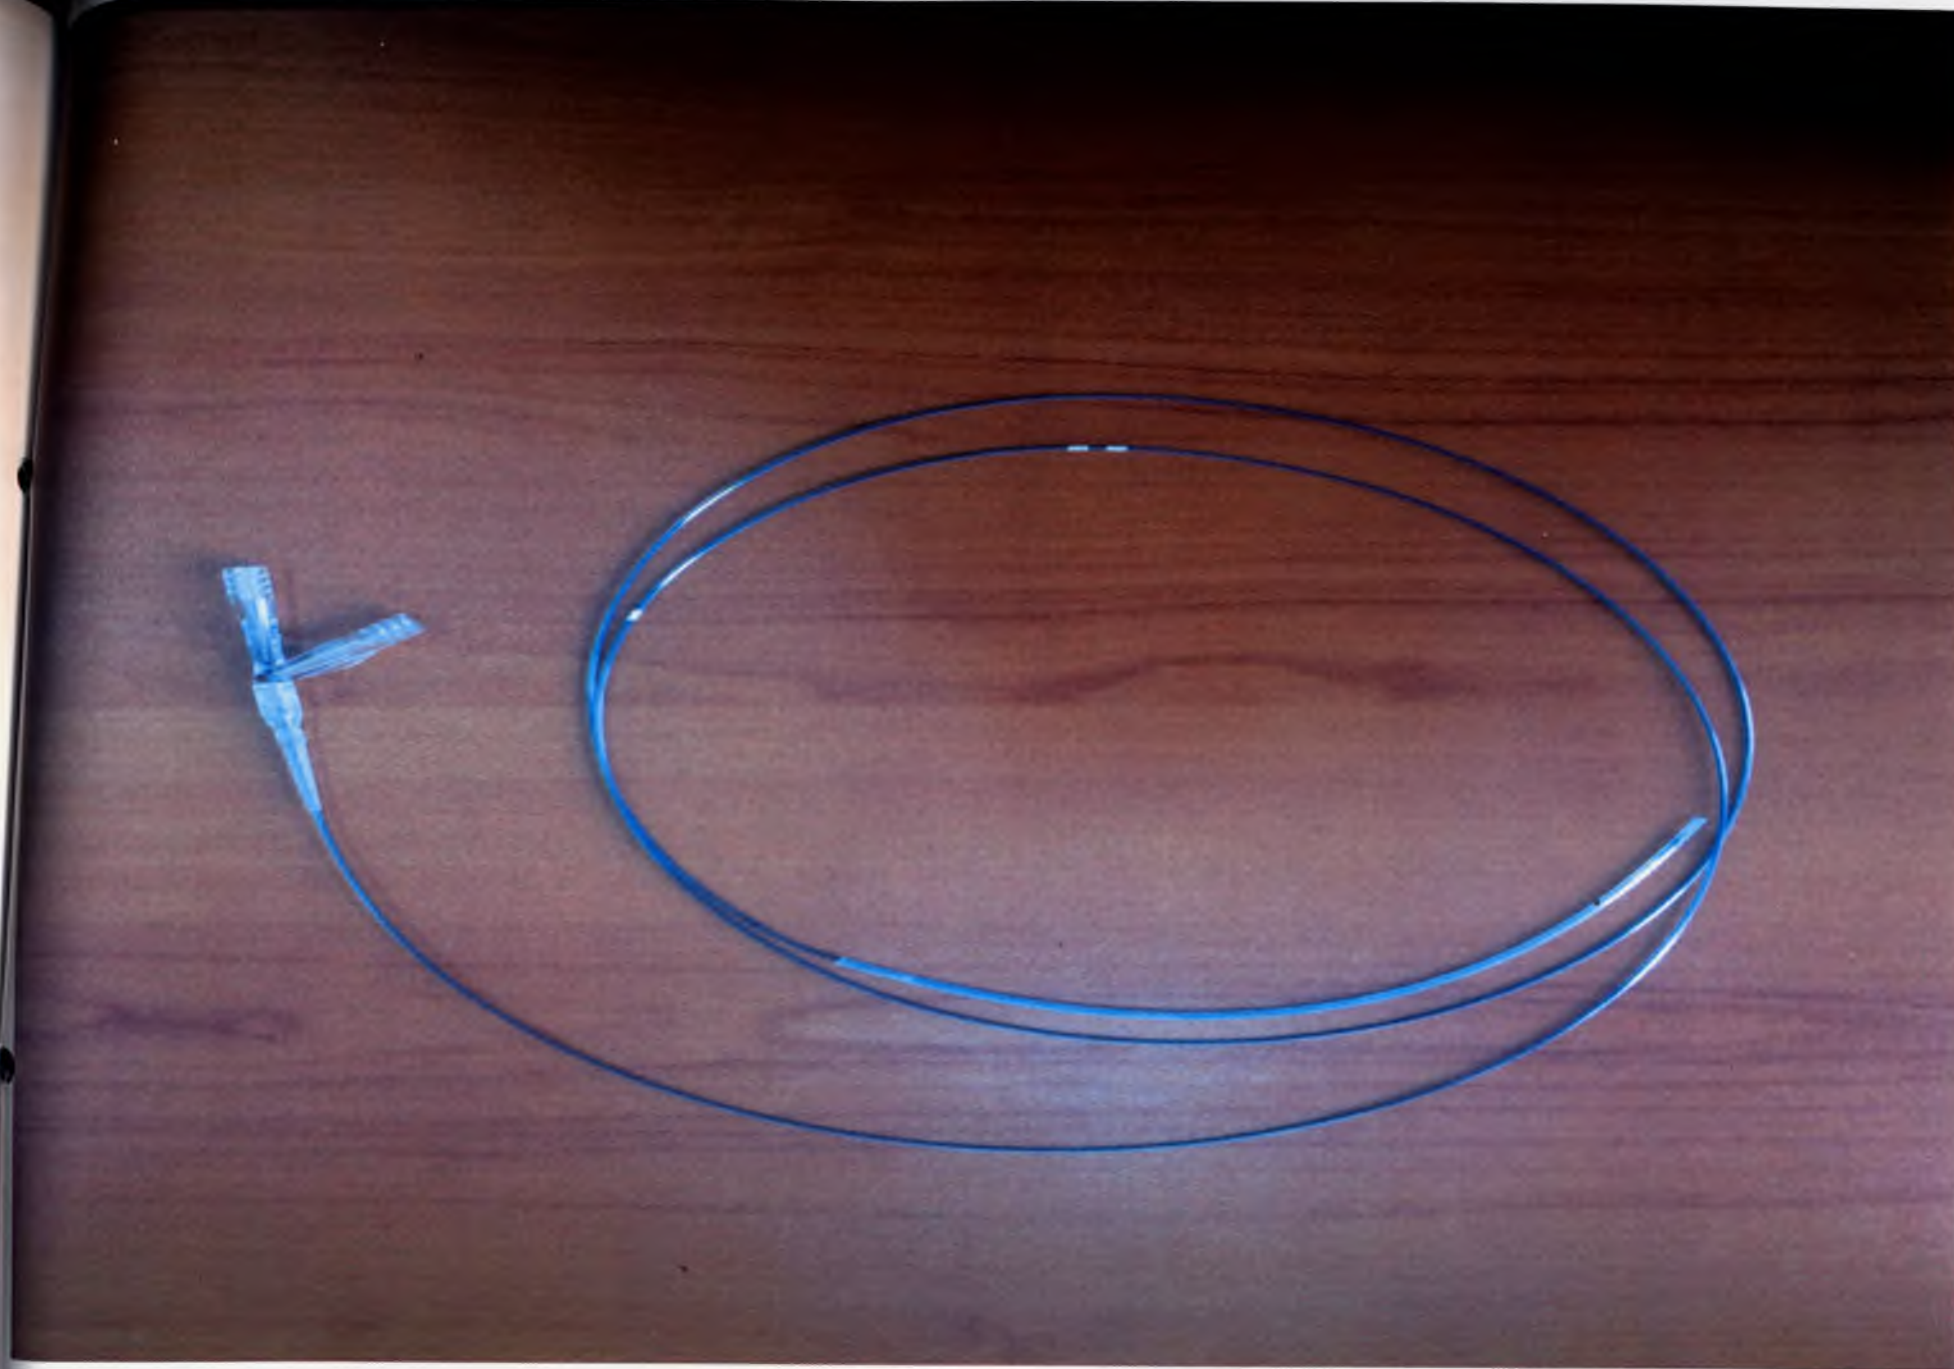

Катетер баллонный дилатационный Sterling SL Over-The-Wire, диаметр баллона от 2 мм до 4 мм, длина катетера 90 см, 150 см (общий вид)



Катетер баллонный дилатационный Sterling SL Over-The-Wire, диаметр баллона от 2 мм до 4 мм, длина катетера 90 см, 150 см: катетер в защитной трубке

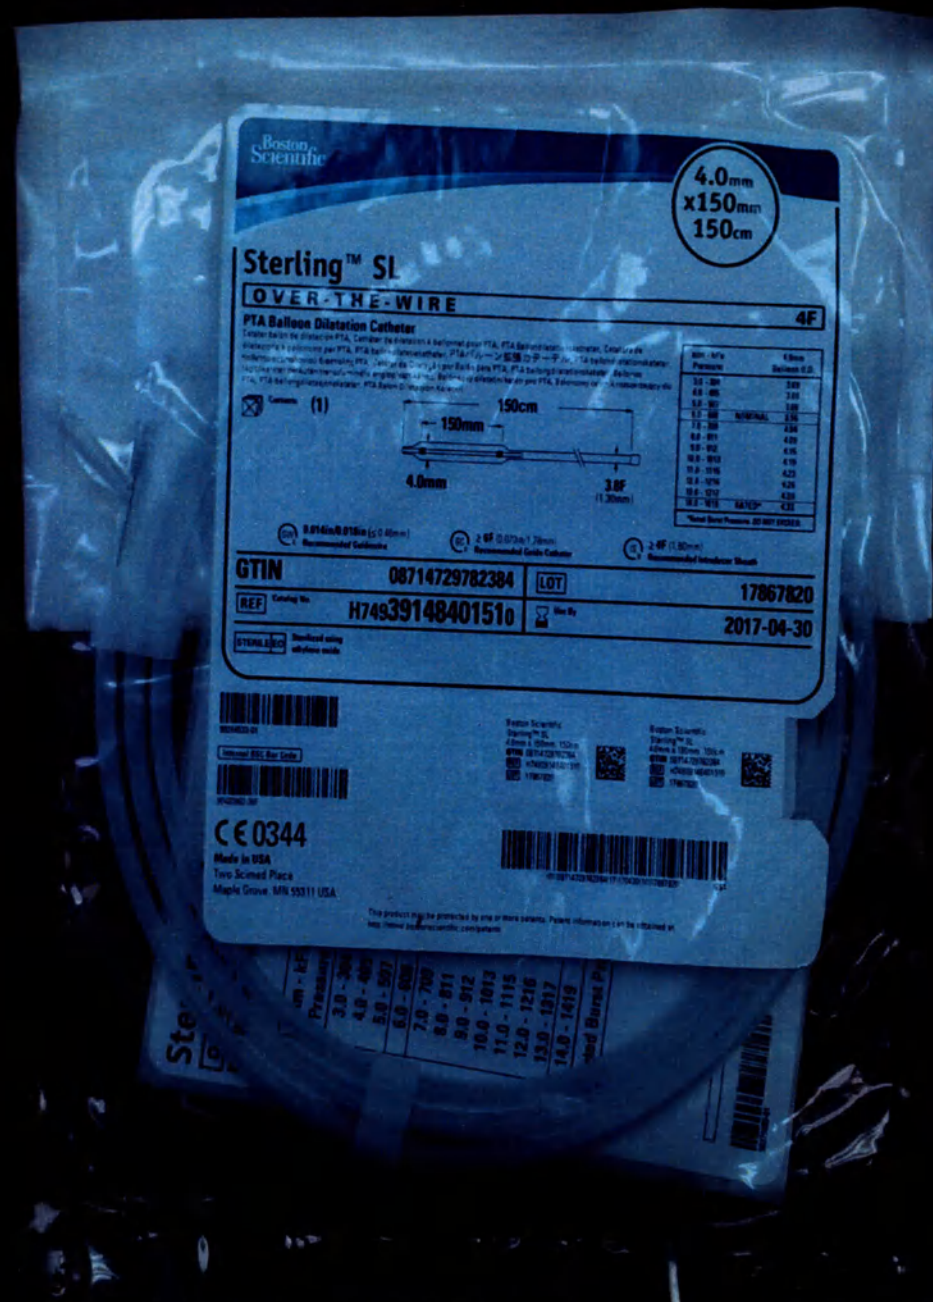

Катетер баллонный дилатационный Sterling SL Over-The-Wire, диаметр баллона 4 мм, длина катетера 150 см в запечатываемом пакете: маркировка 1-ой стороны

Boston
Scientific

EC REP
Boston Scientific International S.A.
15 Avenue des Champs Elysees
75008 PARIS
STERILIZATION CODE
P00000

Rx ONLY

Consult Instructions
for use.

Do not use if package
is damaged.


For single use only.
Do not reuse.

Do Not
Autoclave



Катетер баллонный дилатационный Sterling SL Over-The-Wire, диаметр баллона 4 мм, длина катетера 150 см в запечатываемом пакете:
маркировка 2-ой стороны

 **ООО ЦПМИ**  **INFO@CIRMI.RU**  **WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU**

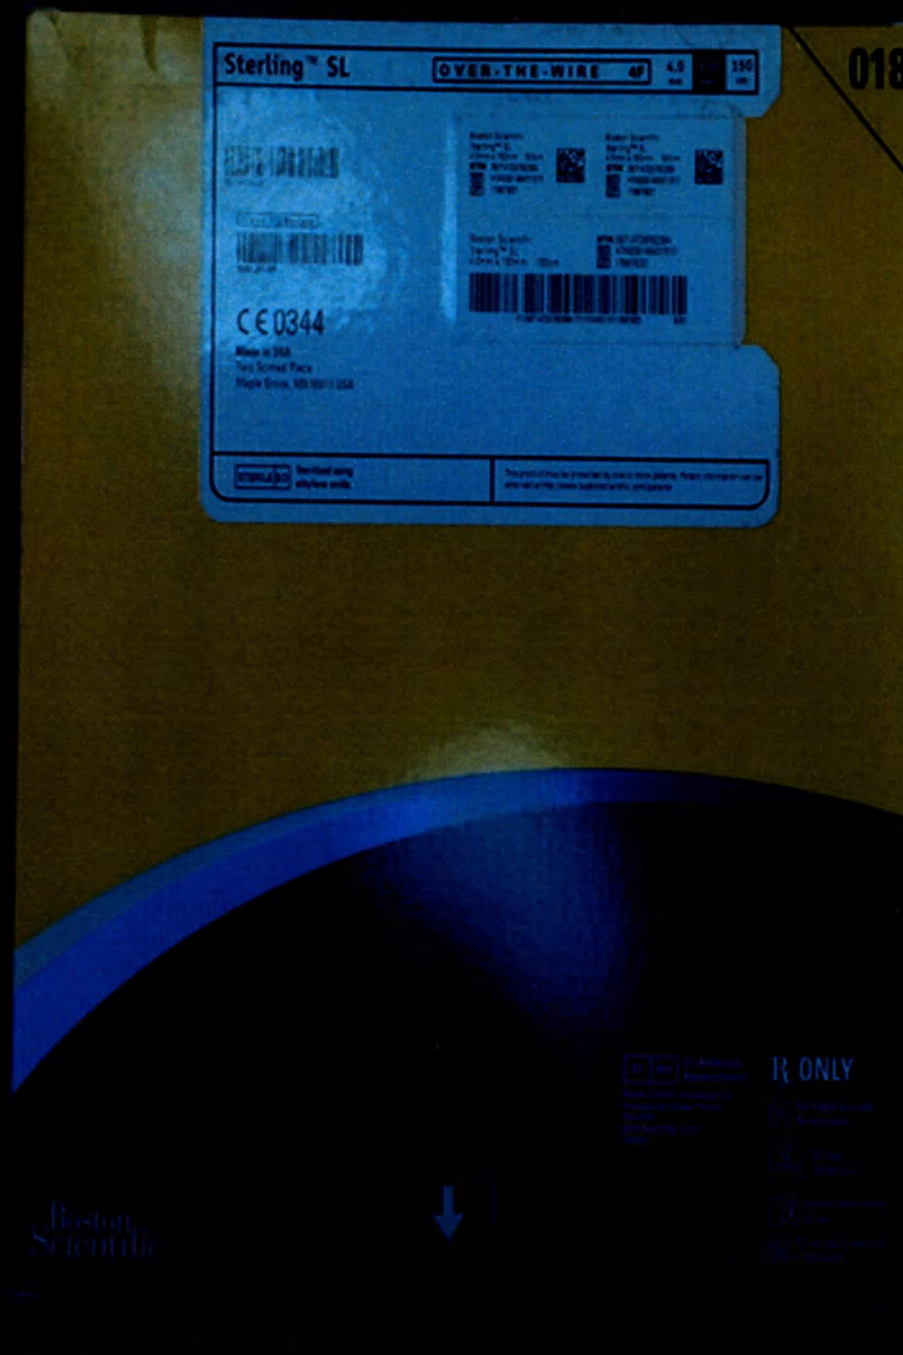

Катетер баллонный дилатационный Sterling SL Over-The-Wire, диаметр баллона 4 мм, длина катетера 150 см: маркировка 2-ой стороны

SterlingTM SL
OVER-THE-WIRE
PTA Balloon Dilatation Catheter

4F

4.0mm
x150mm
150cm

(1)

150cm
150mm
4.0mm
3.8F
(1.50mm)

0.014in/0.018in (≤0.46mm)
Recommended Guidewire

≥ 5F (0.070in/1.78mm)
Recommended Guide Catheter

≥ 4F (1.50mm)
Recommended Introducer Sheath

mm	INCH	mm	INCH
4.0	0.157	150	5.91
4.5	0.177	150	5.91
5.0	0.197	150	5.91
5.5	0.217	150	5.91
6.0	0.236	150	5.91
6.5	0.256	150	5.91
7.0	0.276	150	5.91
7.5	0.295	150	5.91
8.0	0.315	150	5.91
8.5	0.335	150	5.91
9.0	0.354	150	5.91
9.5	0.374	150	5.91
10.0	0.394	150	5.91
10.5	0.413	150	5.91
11.0	0.433	150	5.91
11.5	0.453	150	5.91
12.0	0.472	150	5.91
12.5	0.492	150	5.91
13.0	0.512	150	5.91
13.5	0.531	150	5.91
14.0	0.551	150	5.91
14.5	0.571	150	5.91
15.0	0.591	150	5.91

GTIN 08714729782384

REF Catalog No. H74939148401510

LOT 17867820

Use By 2017-04-30

018

Катетер баллонный дилатационный Sterling SL Over-The-Wire, диаметр баллона 4 мм, длина катетера 150 см: маркировка боковой стороны

ПРОШТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
33 ЛИСТОВ

Генеральный директор
Шевчук Е.Е.

