



Фотографии RS80A–RUS с принадлежностями
SAMSUNG MEDISON Co., Ltd., Республика Корея

Ультразвуковой диагностический аппарат RS80A-RUS



Специальный LED Монитор



Сенсорная панель



Панель управления



Нагреватель ге



Электронная консоль



Системный адаптер



FSP GROUP INC.

全漢企業股份有限公司/全漢企業股份有限公司

Switching Power Adapter(電源供應器/電源适配器/직렬전원장치)

(Commutation adaptateur secteur)

Model No.(Numéro de modèle)(型號/型番/모델명): FSP160-ABAM1

AC Input(輸入/輸入電壓): 100-240V~2.3-0.8A 50-60Hz

DC Output(輸出/輸出電壓): 19V=9.47A

CAUTION (Prudence)(警告/주의사항)

For use with Medical Electrical

Equipment(適用醫療電氣設備)

(For use with Medical Equipment)(의료기기 사용)

(Pour utilisation avec des appareils électromédicaux)



E211696



MADE IN CHINA

(Fabriqué en Chine)

中國製造



RoHS


Ультразвуковой диагностический аппарат RS80A-RUS

Датчики конвексные:
CA2-8A,



Ультразвуковой диагностический аппарат RS80A-RUS

CF 4-9; МГц.

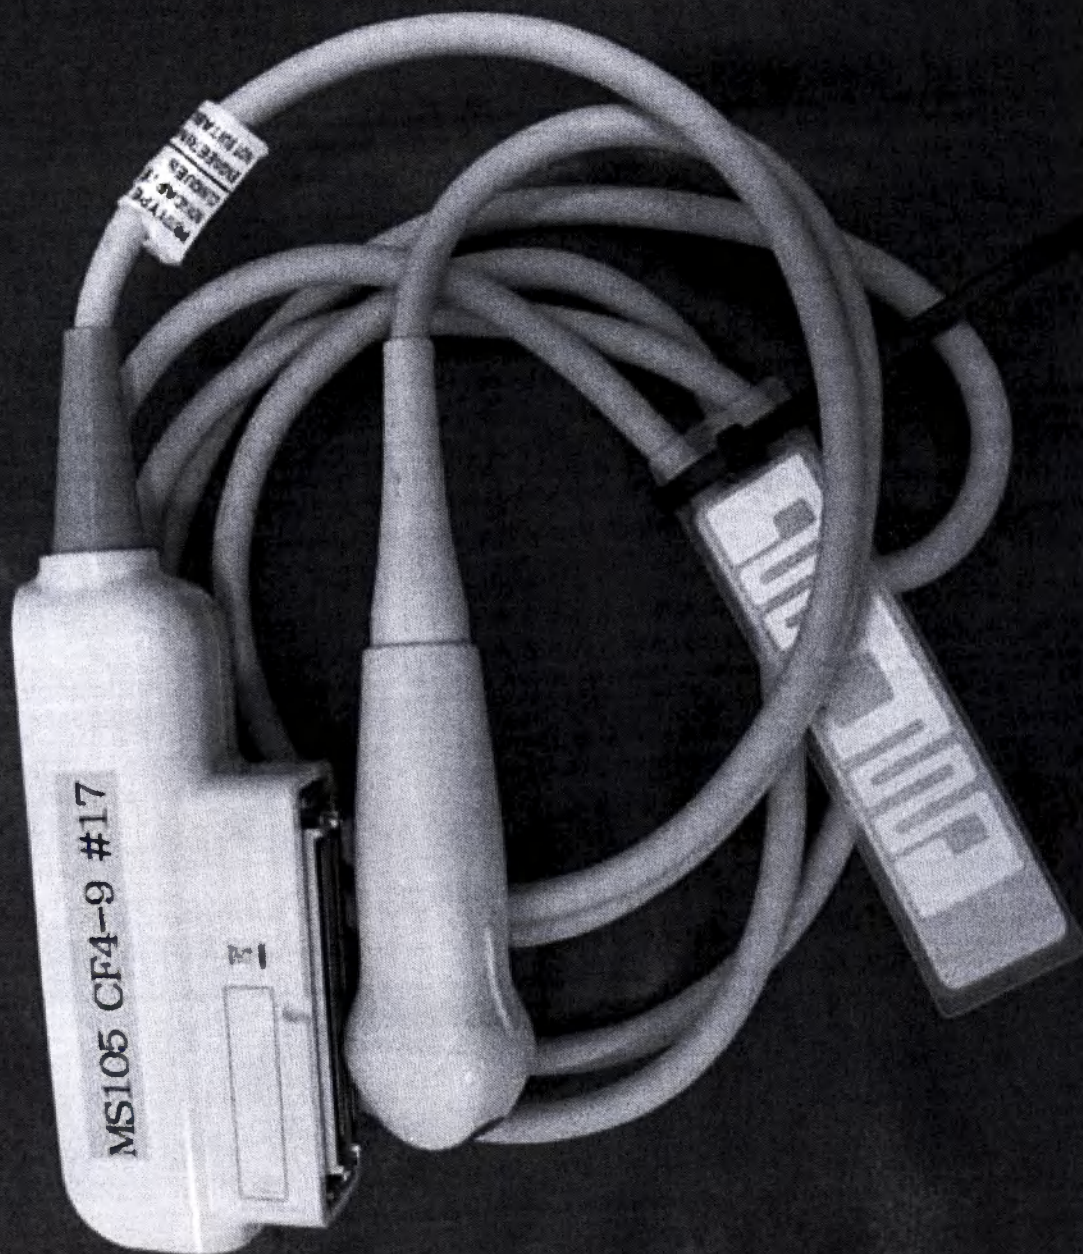

Ультразвуковой диагностический аппарат RS80A-RUS

Датчик конвексный-монокристалльный: CA1-7A,



Ультразвуковой диагностический аппарат RS80A-RUS

Датчики конвексные-эндокавитальные:

E3-12A,




Ультразвуковой диагностический аппарат RS80A-RUS

EA2-11B МГц




Ультразвуковой диагностический аппарат RS80A-RUS

Датчики линейные:
L3-12A,

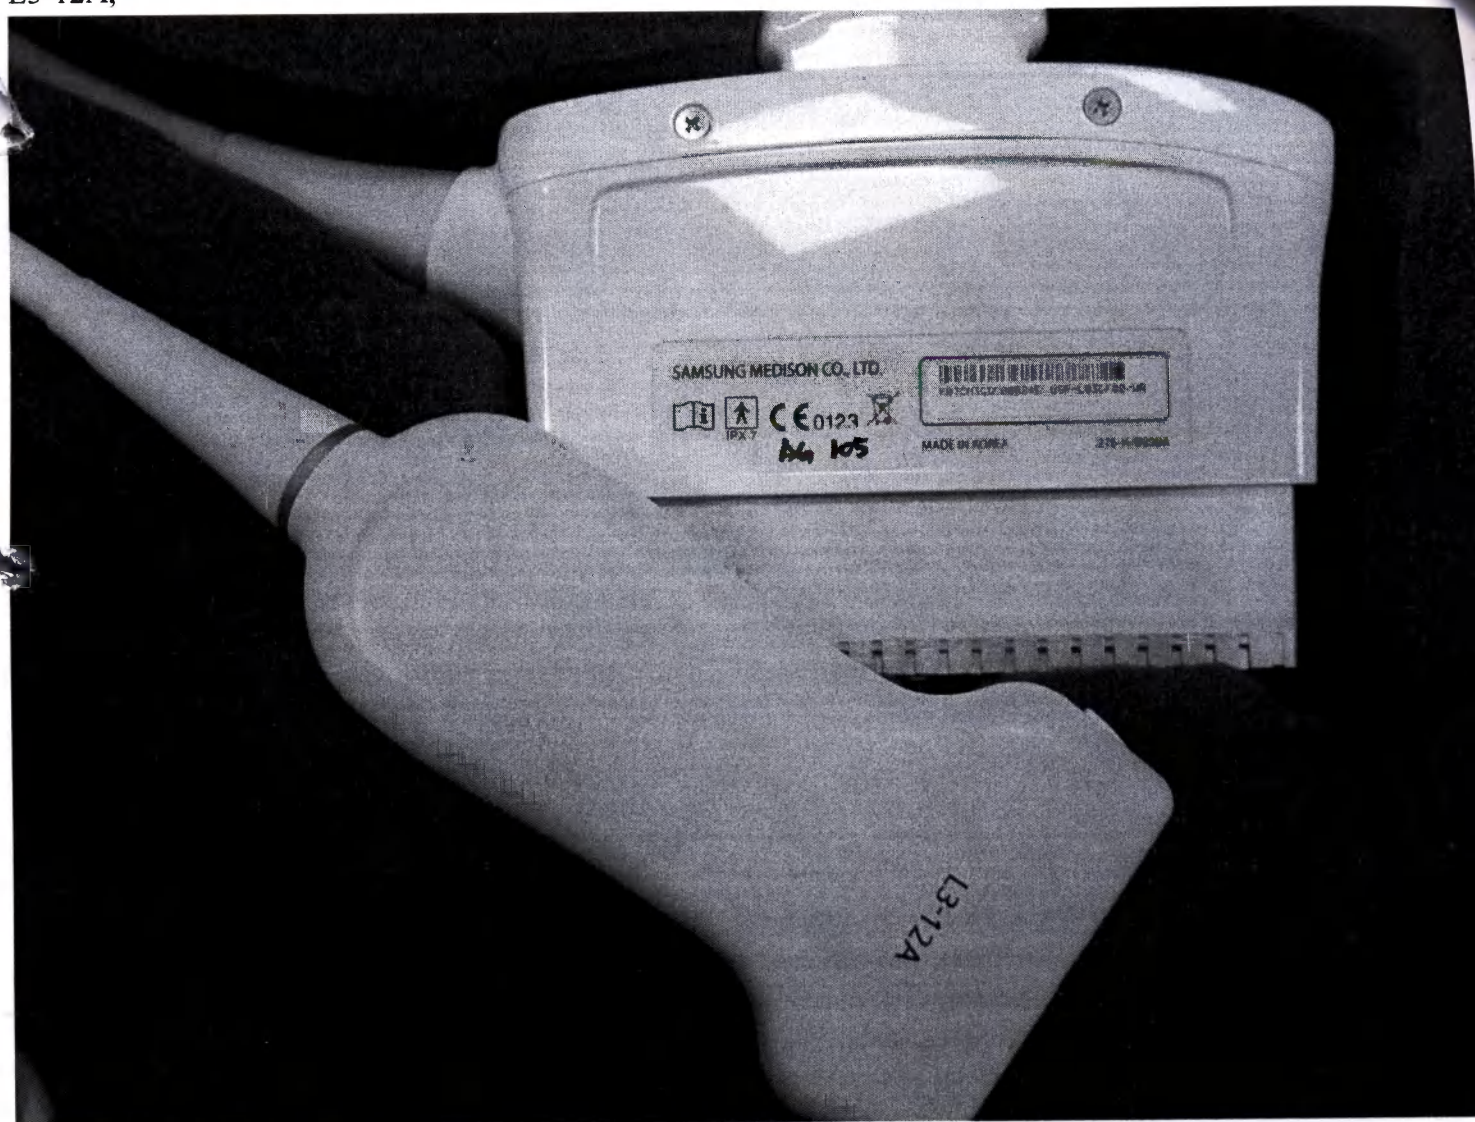


Ультразвуковой диагностический аппарат RS80A-RUS

LA3-16A, LA2-9A,

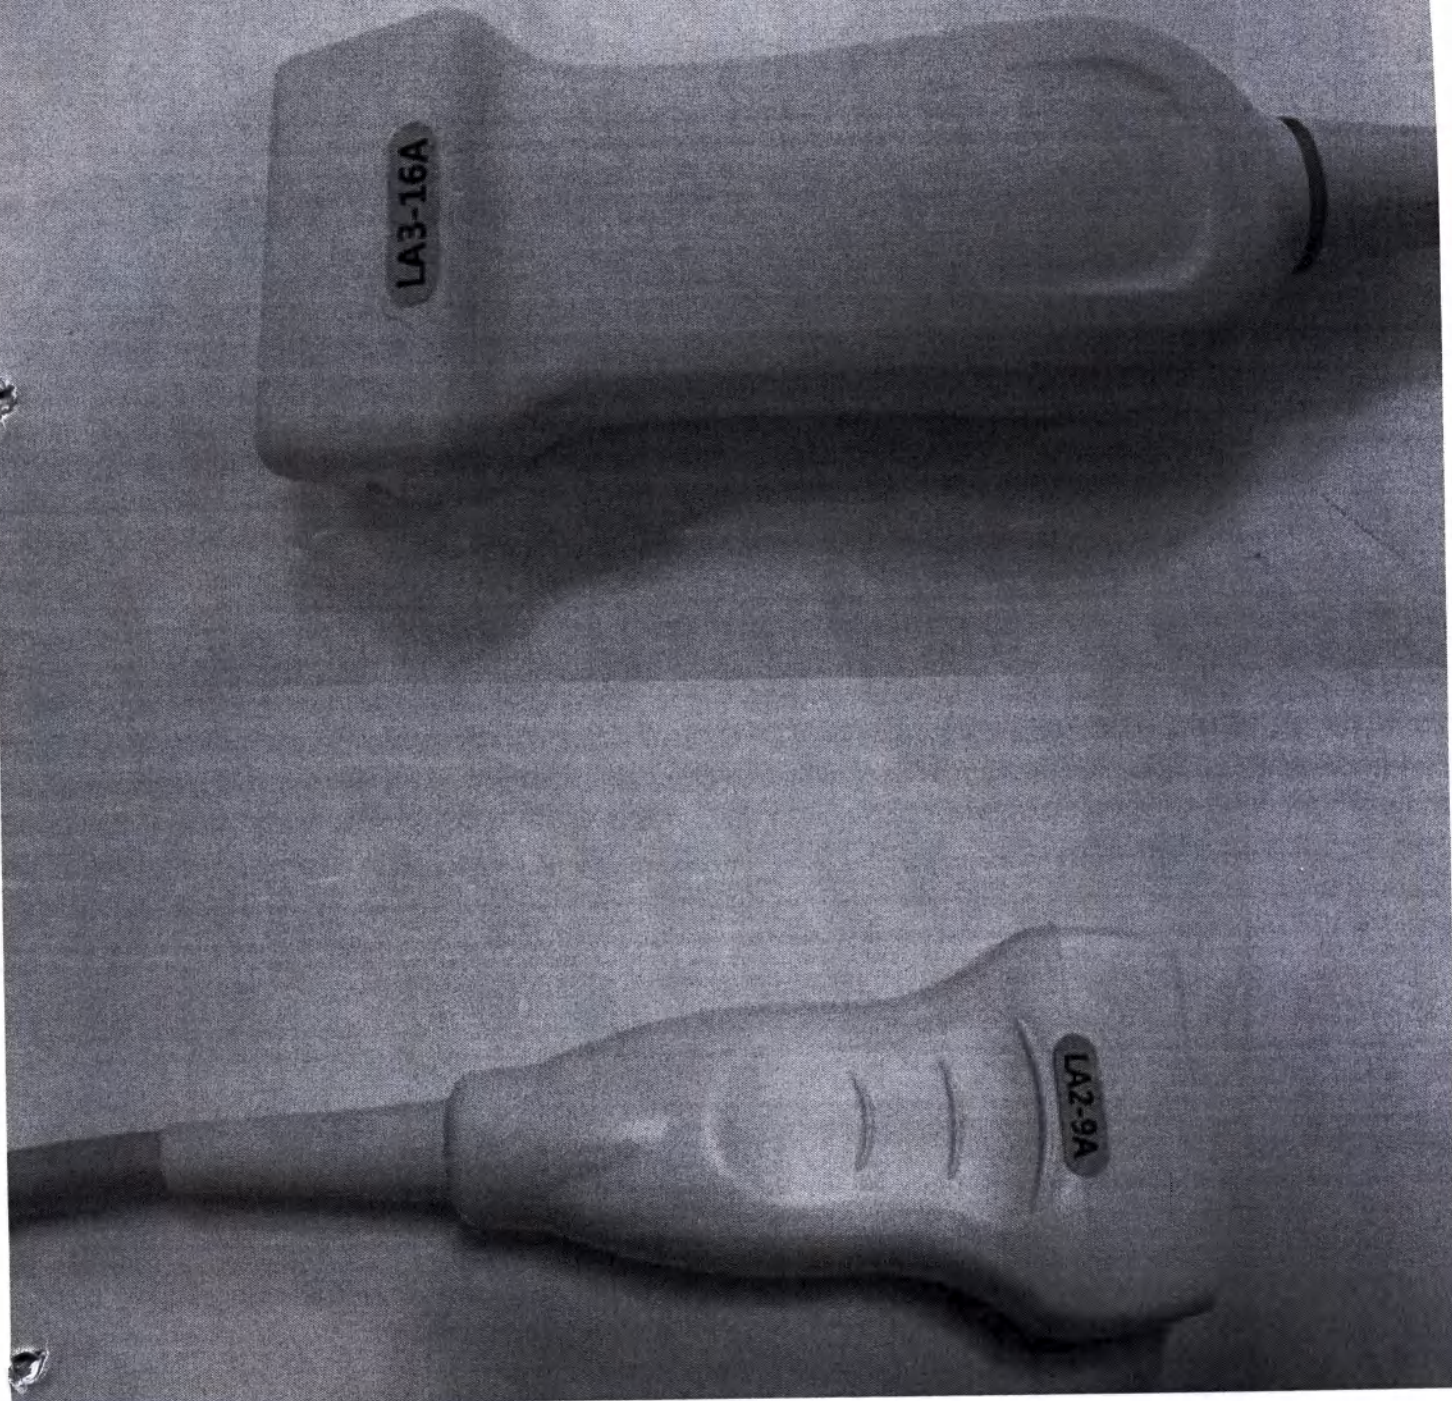

L7-16 МГц

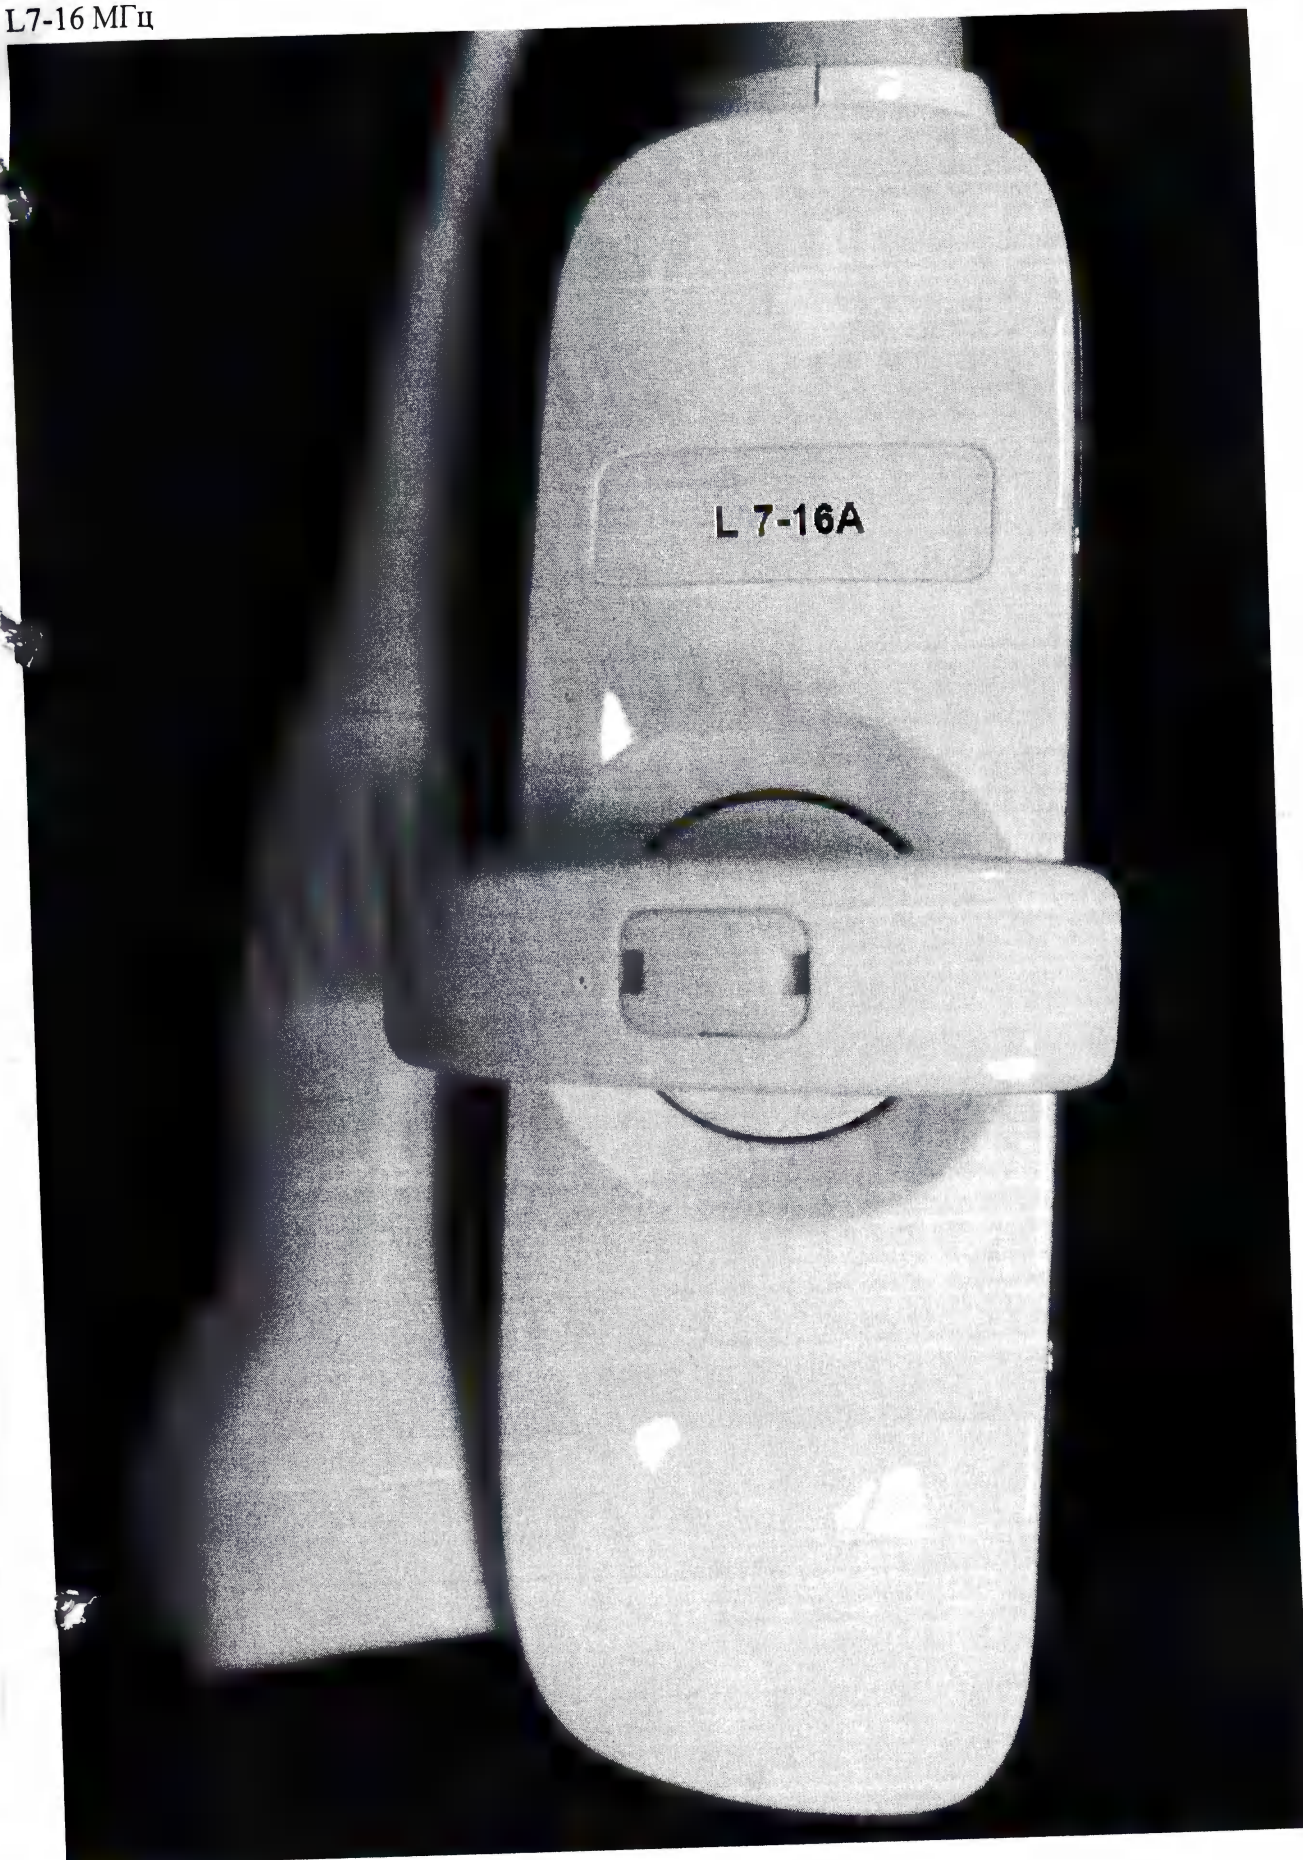


Ультразвуковой диагностический аппарат RS80A-RUS


LA3-16AI МГц.



LA4-18B


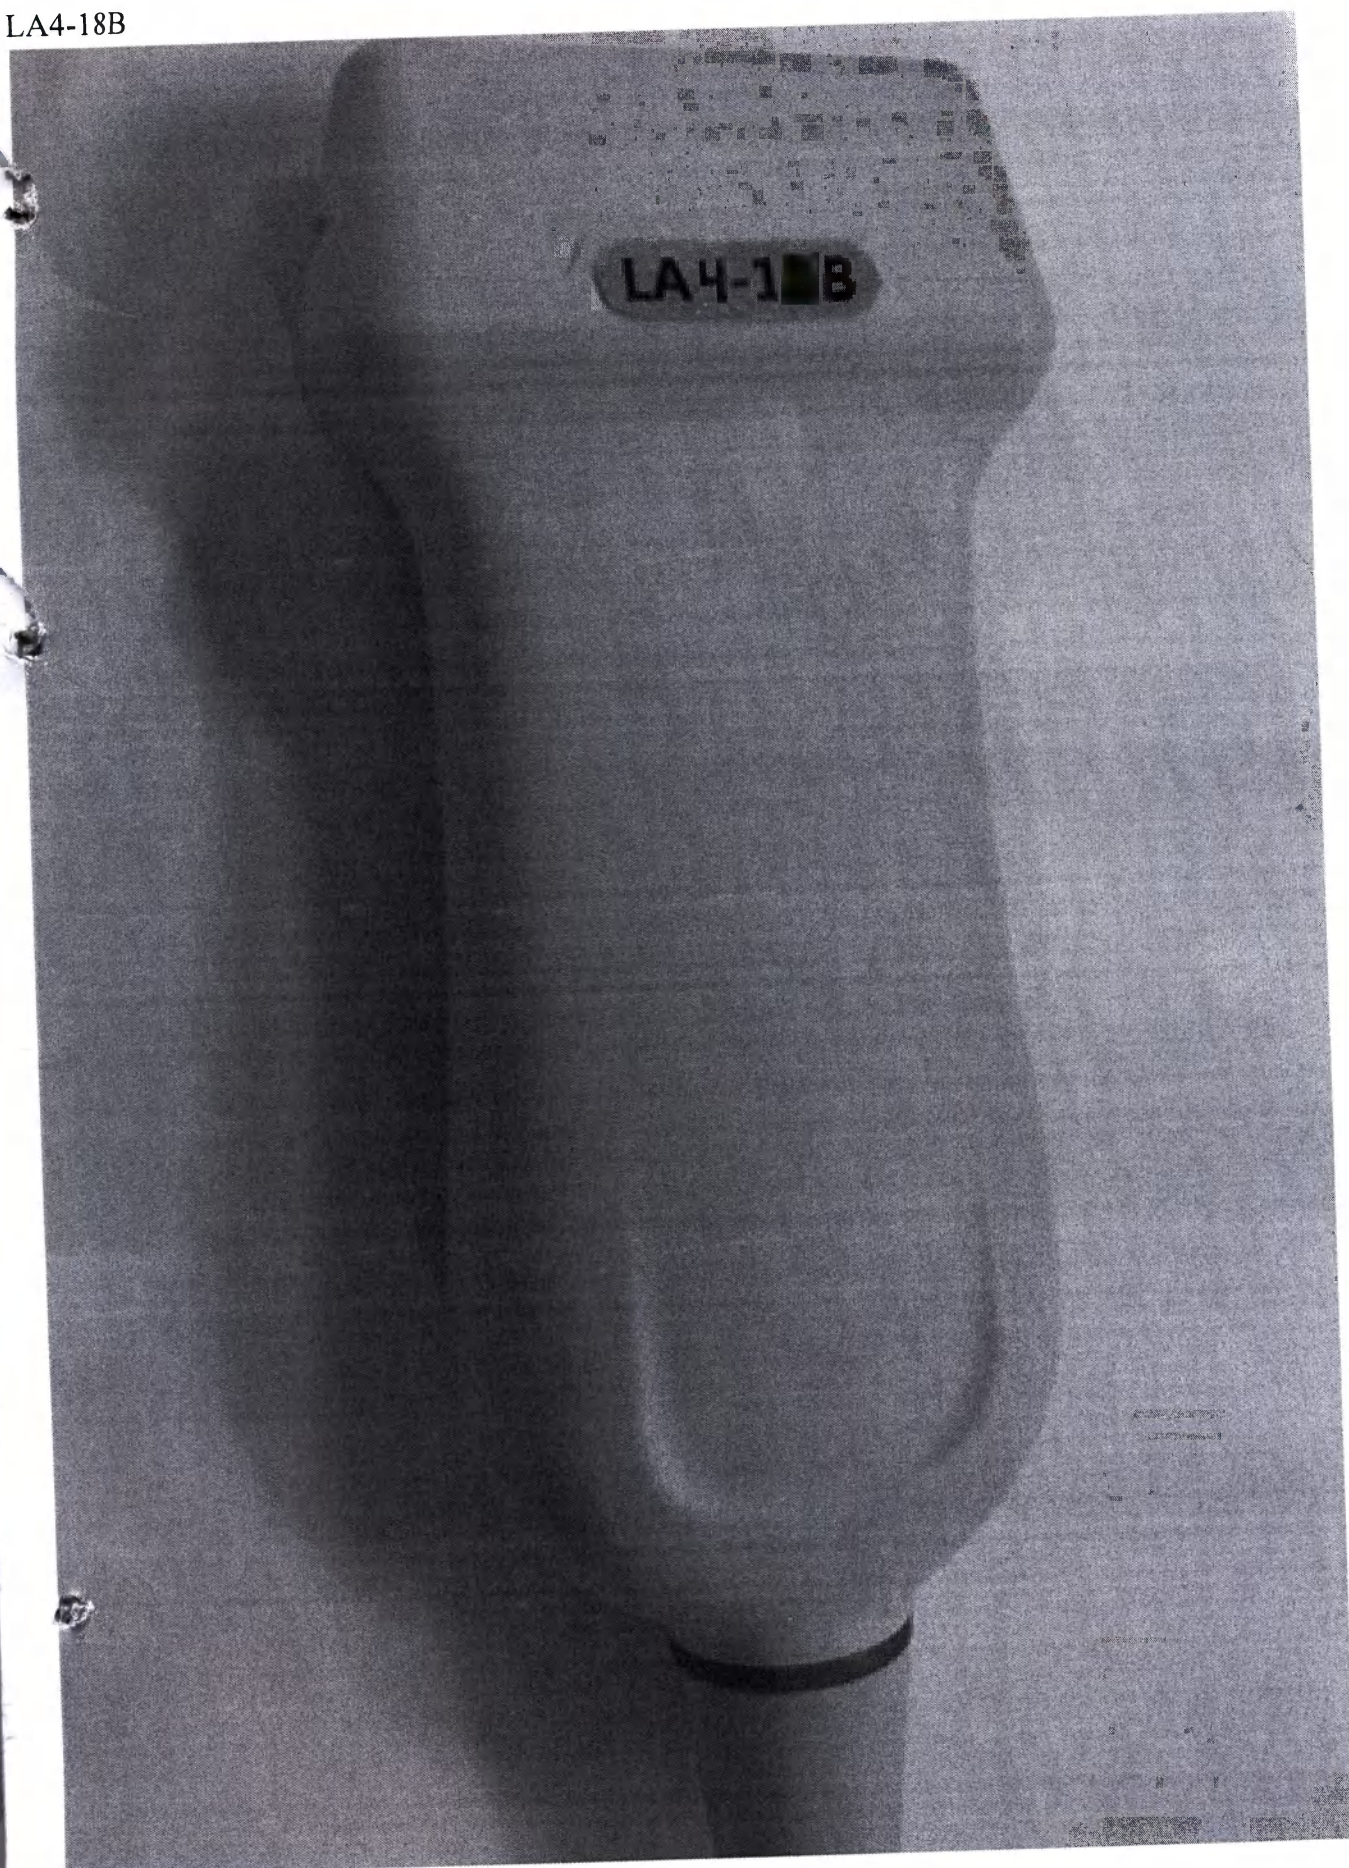


Датчики фазированные:
SP3-8,

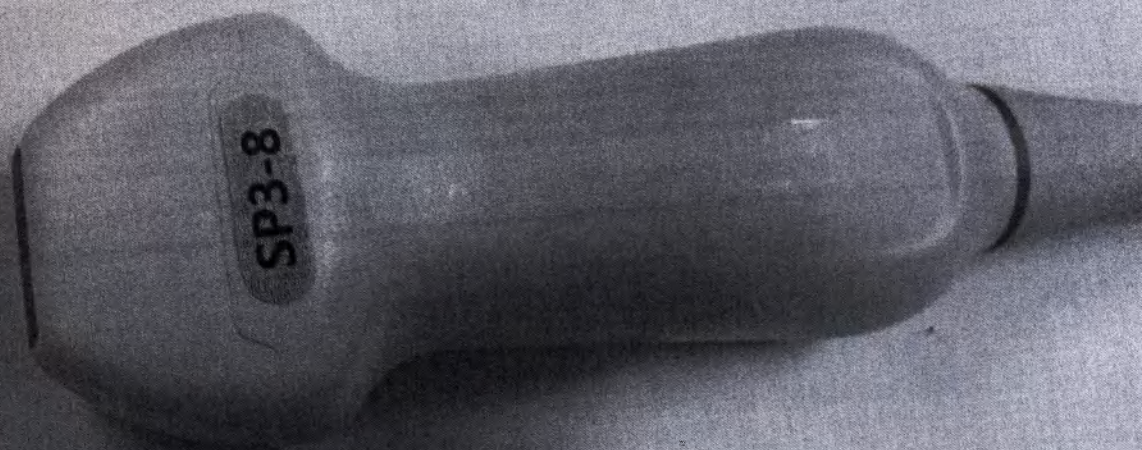


Ультразвуковой диагностический аппарат RS80A-RUS

P4-12, PA4-12B, PA3-8B, МГц.

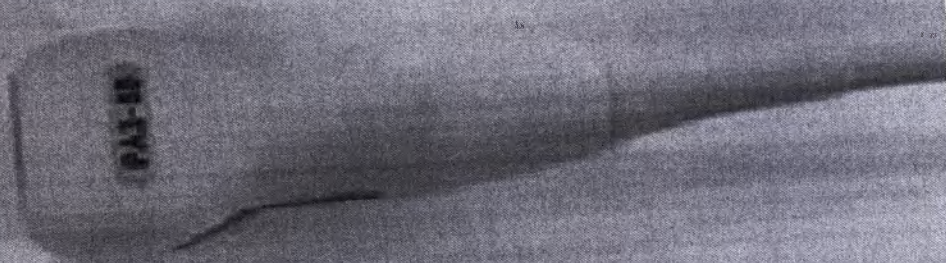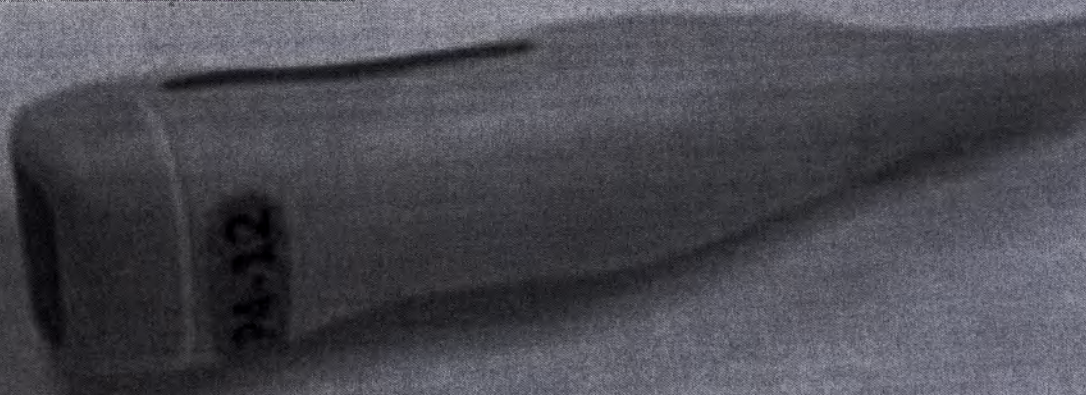


Ультразвуковой диагностический аппарат RS80A-RUS

PM1-6A МГц.

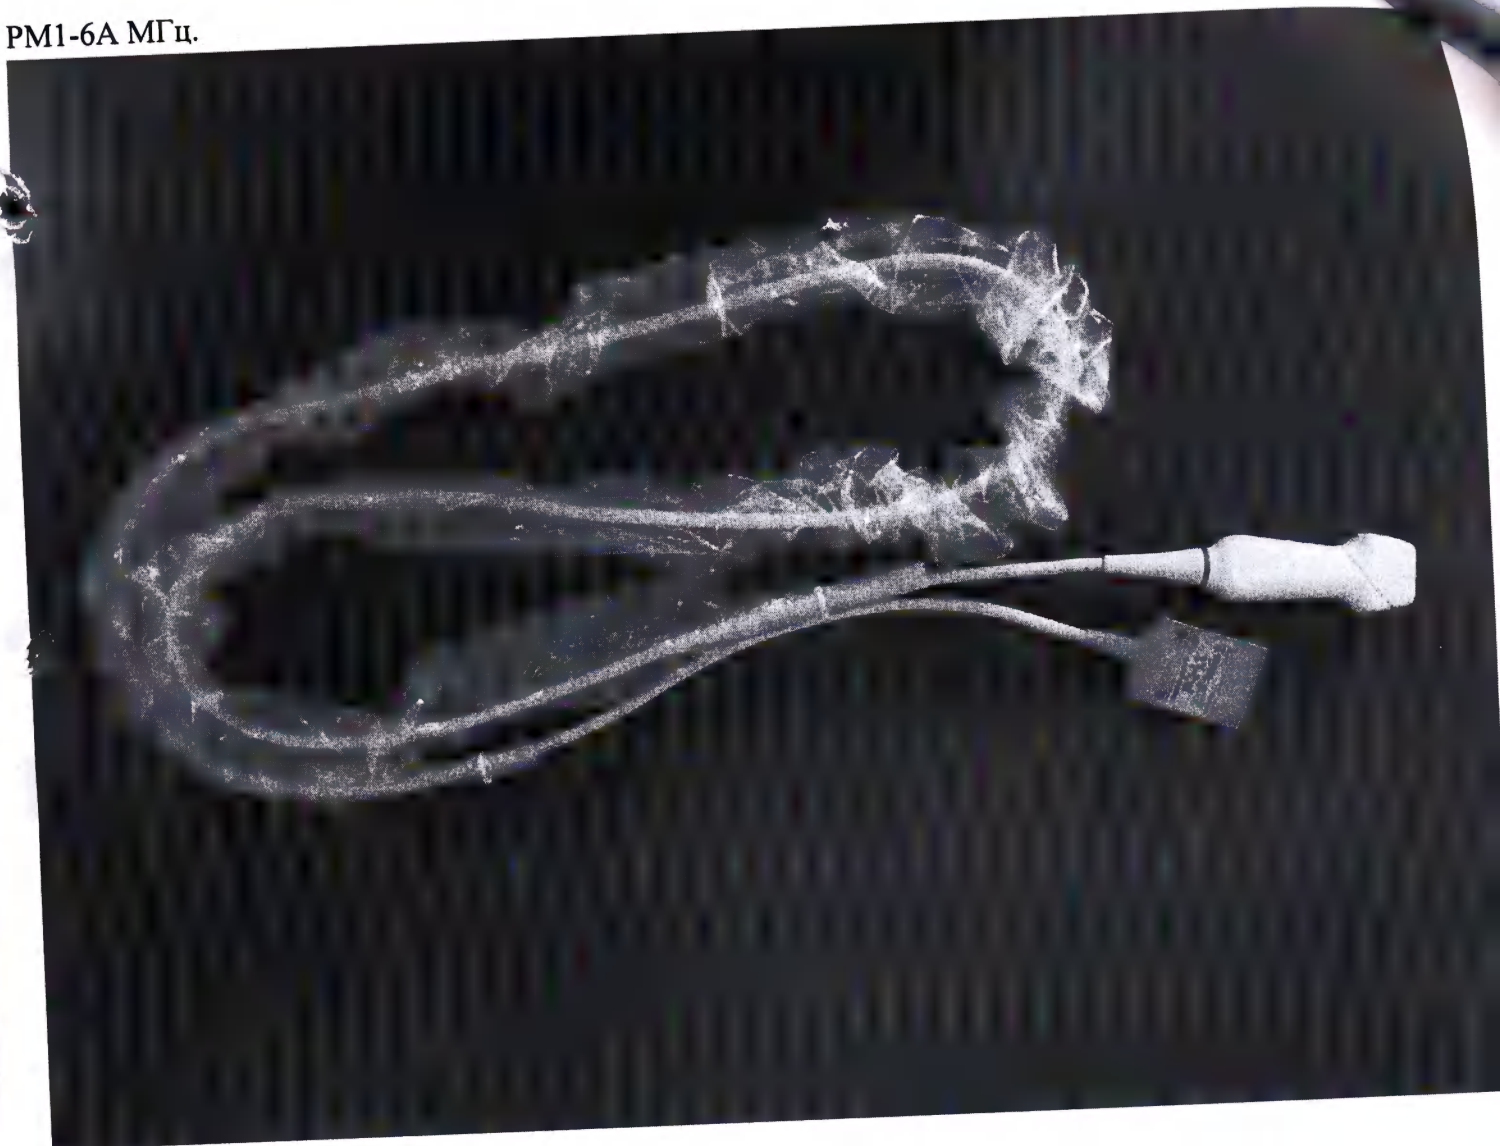


Ультразвуковой диагностический аппарат RS80A-RUS

ММРТЗ-7, ТАЗ-7В МГц.

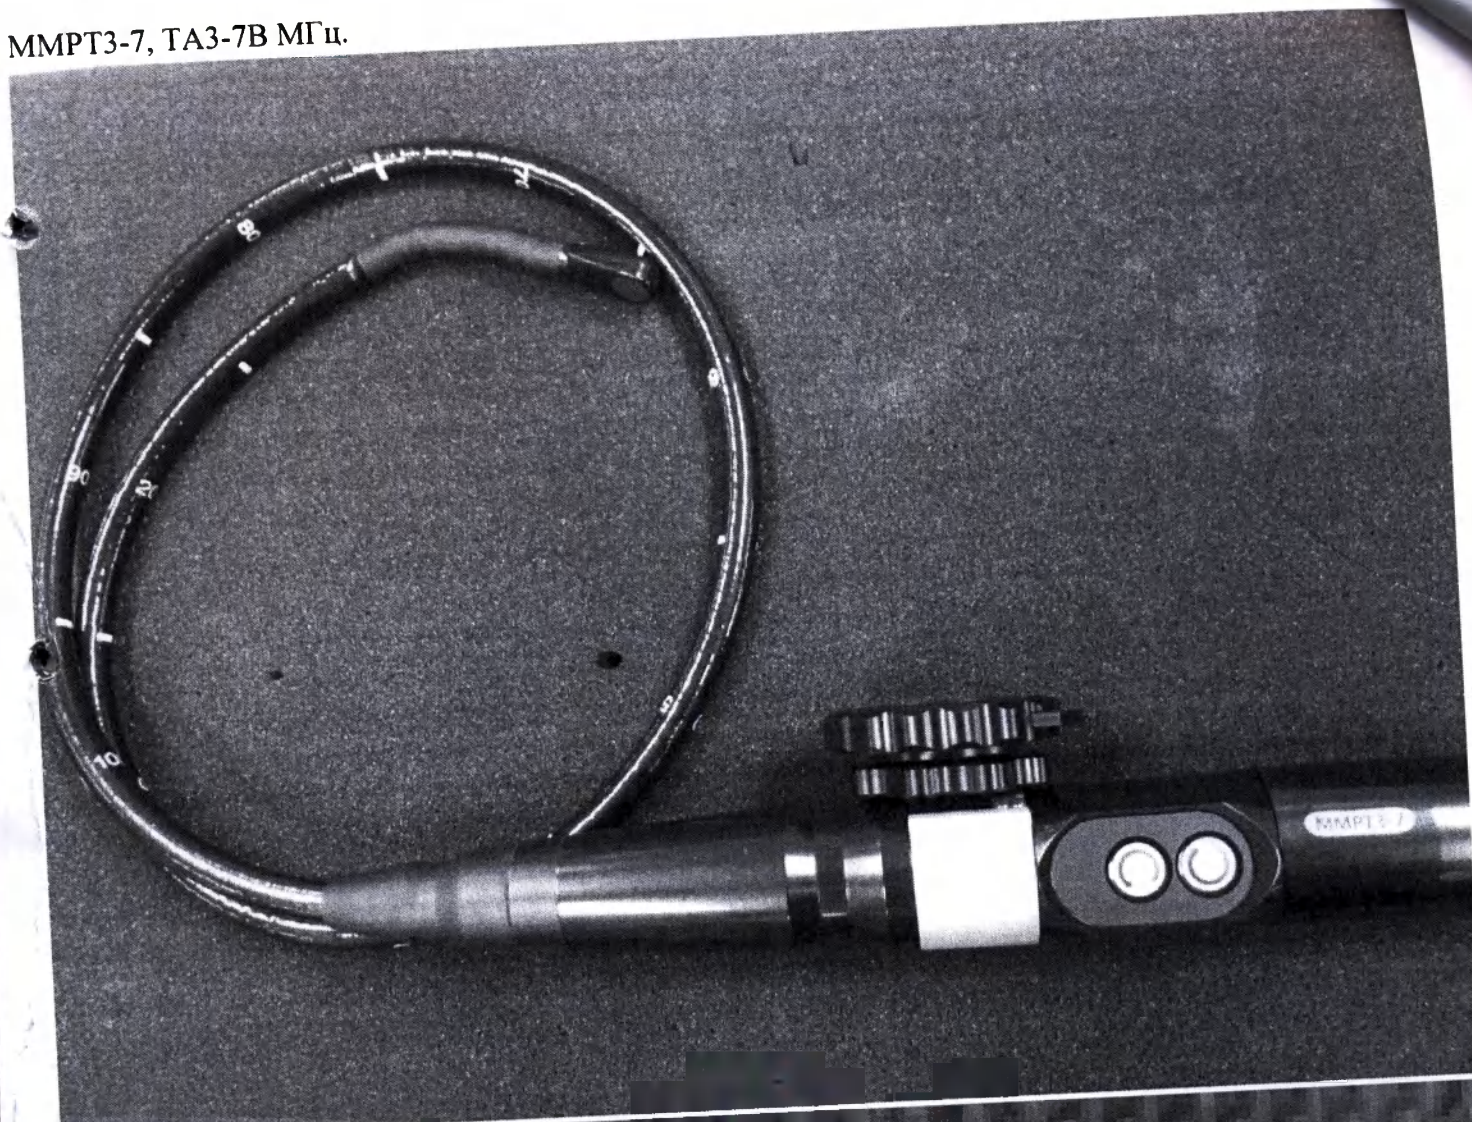


Датчики объемные :


V4-8,

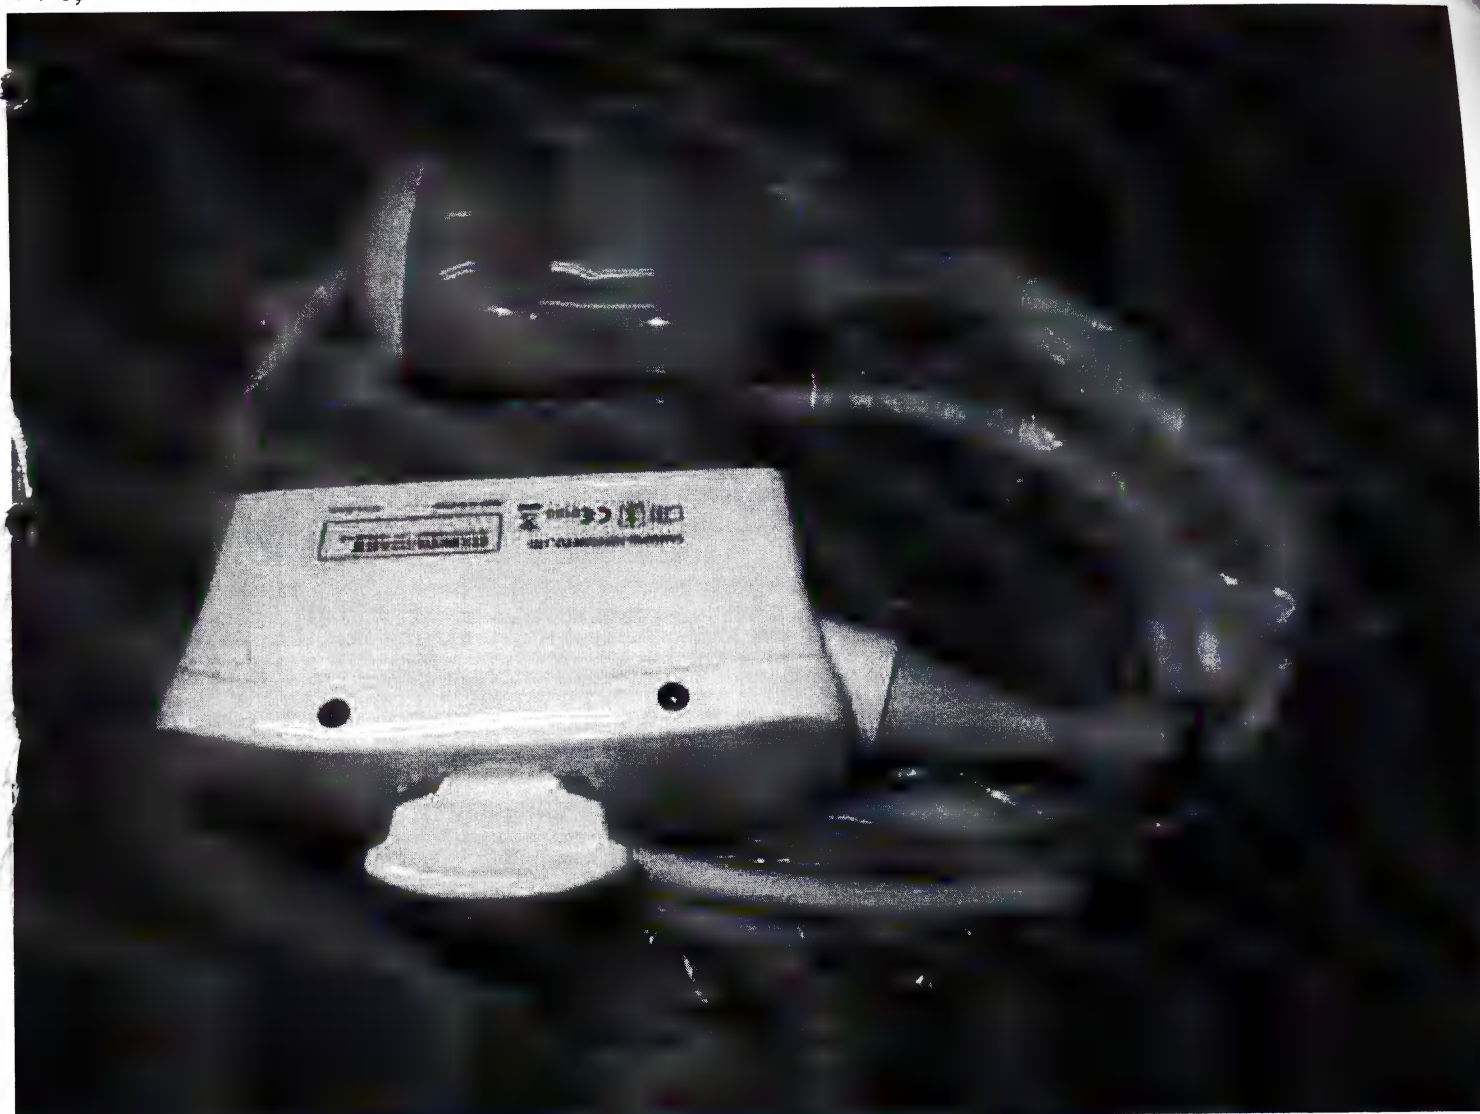

V5-9,

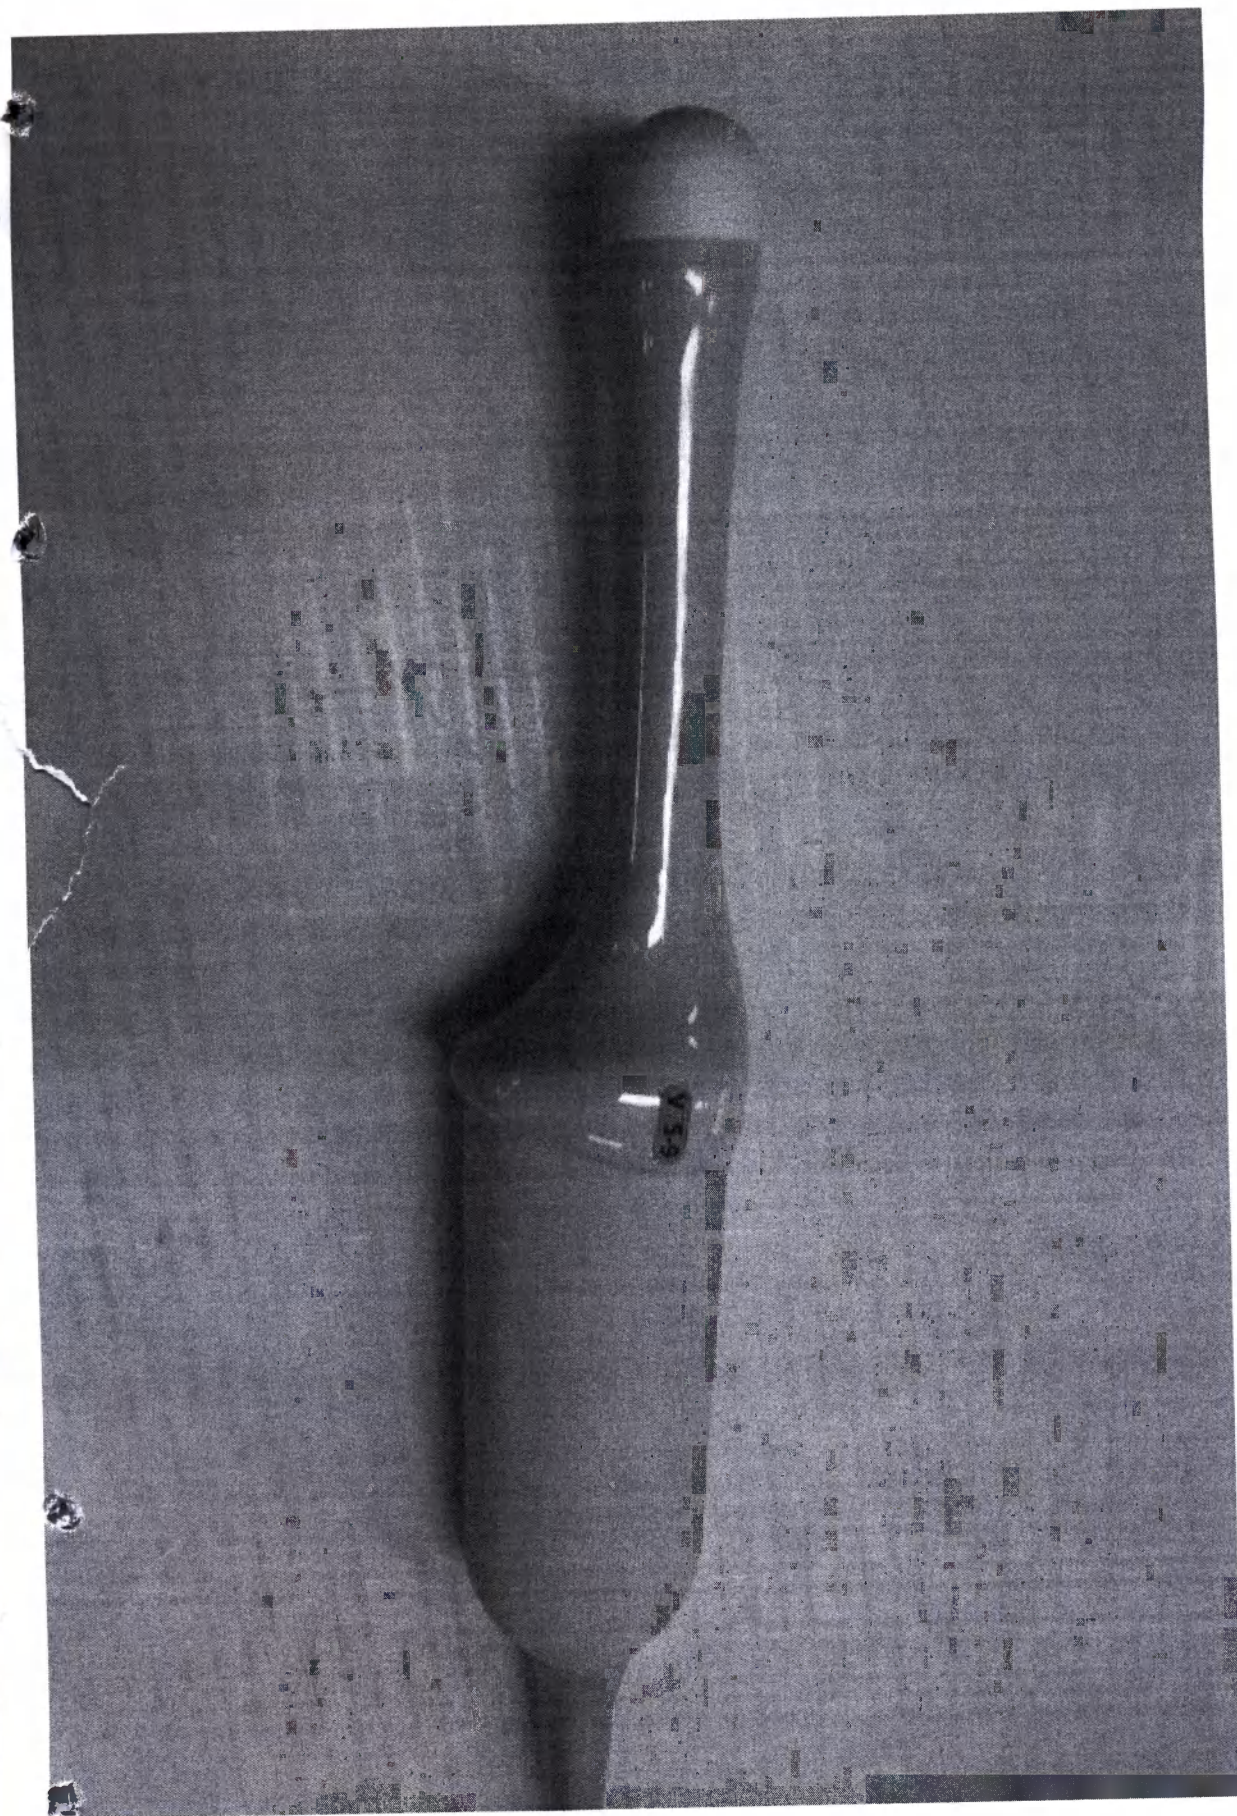


CV1-8A,

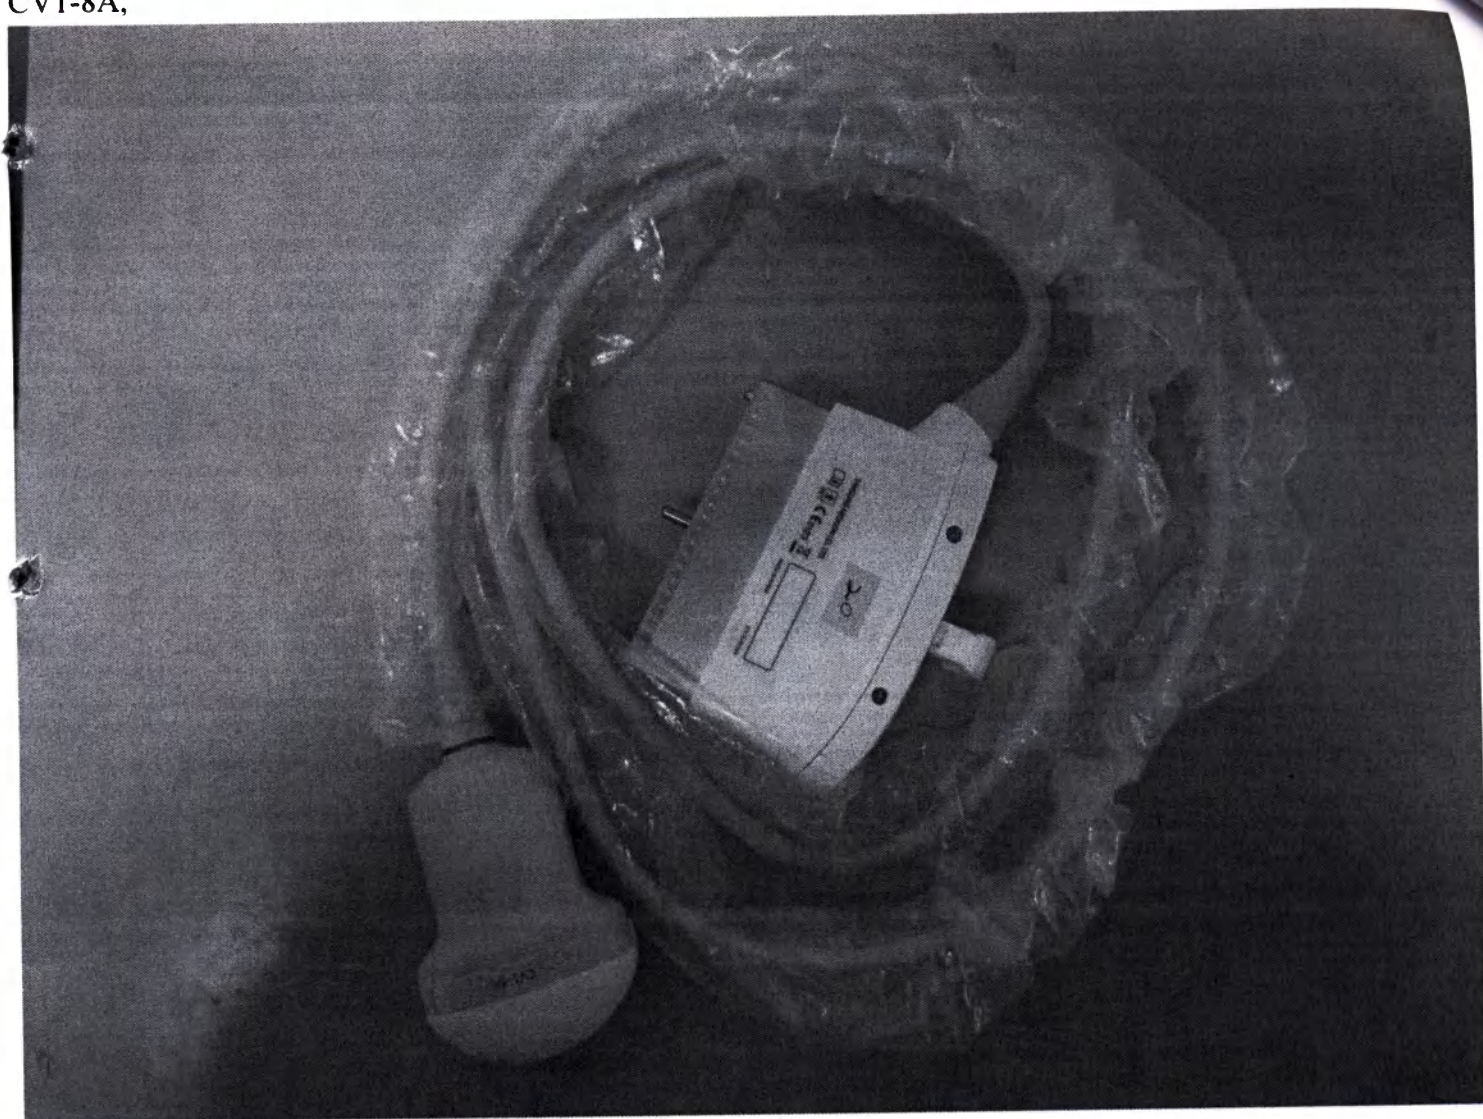

Ультразвуковой диагностический аппарат RS80A-RUS


LV3-14A МГц.

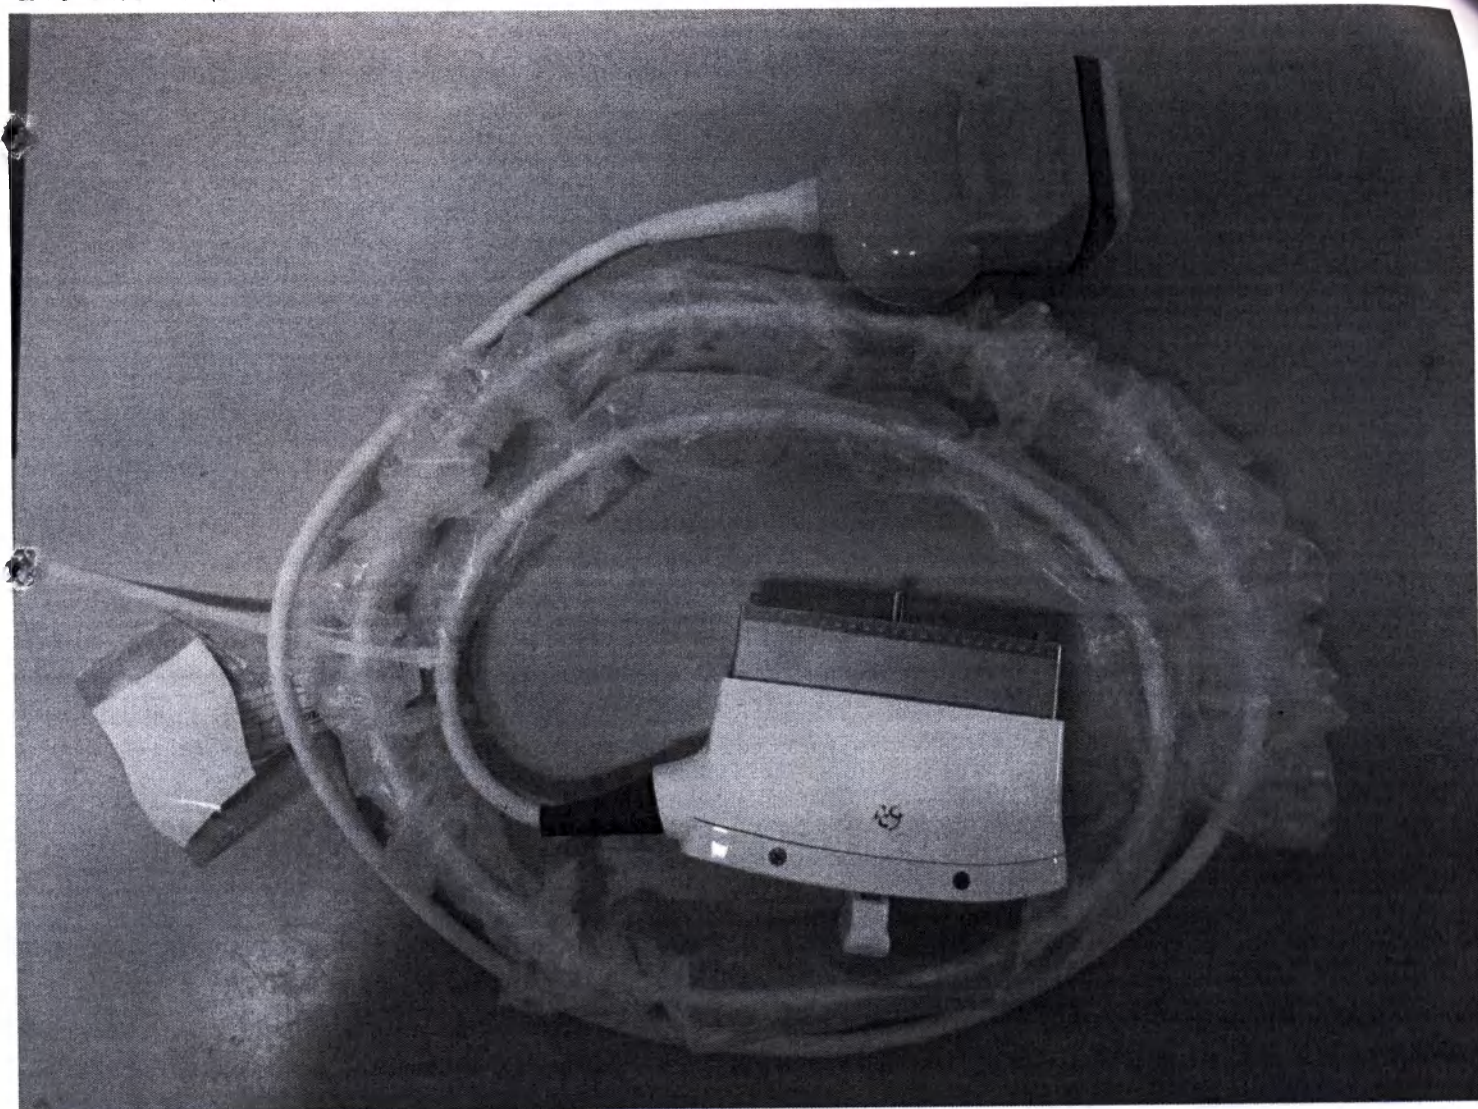

Ультразвуковой диагностический аппарат RS80A–RUS

Постоянно-волновые датчики:

CW2.0 МГц.

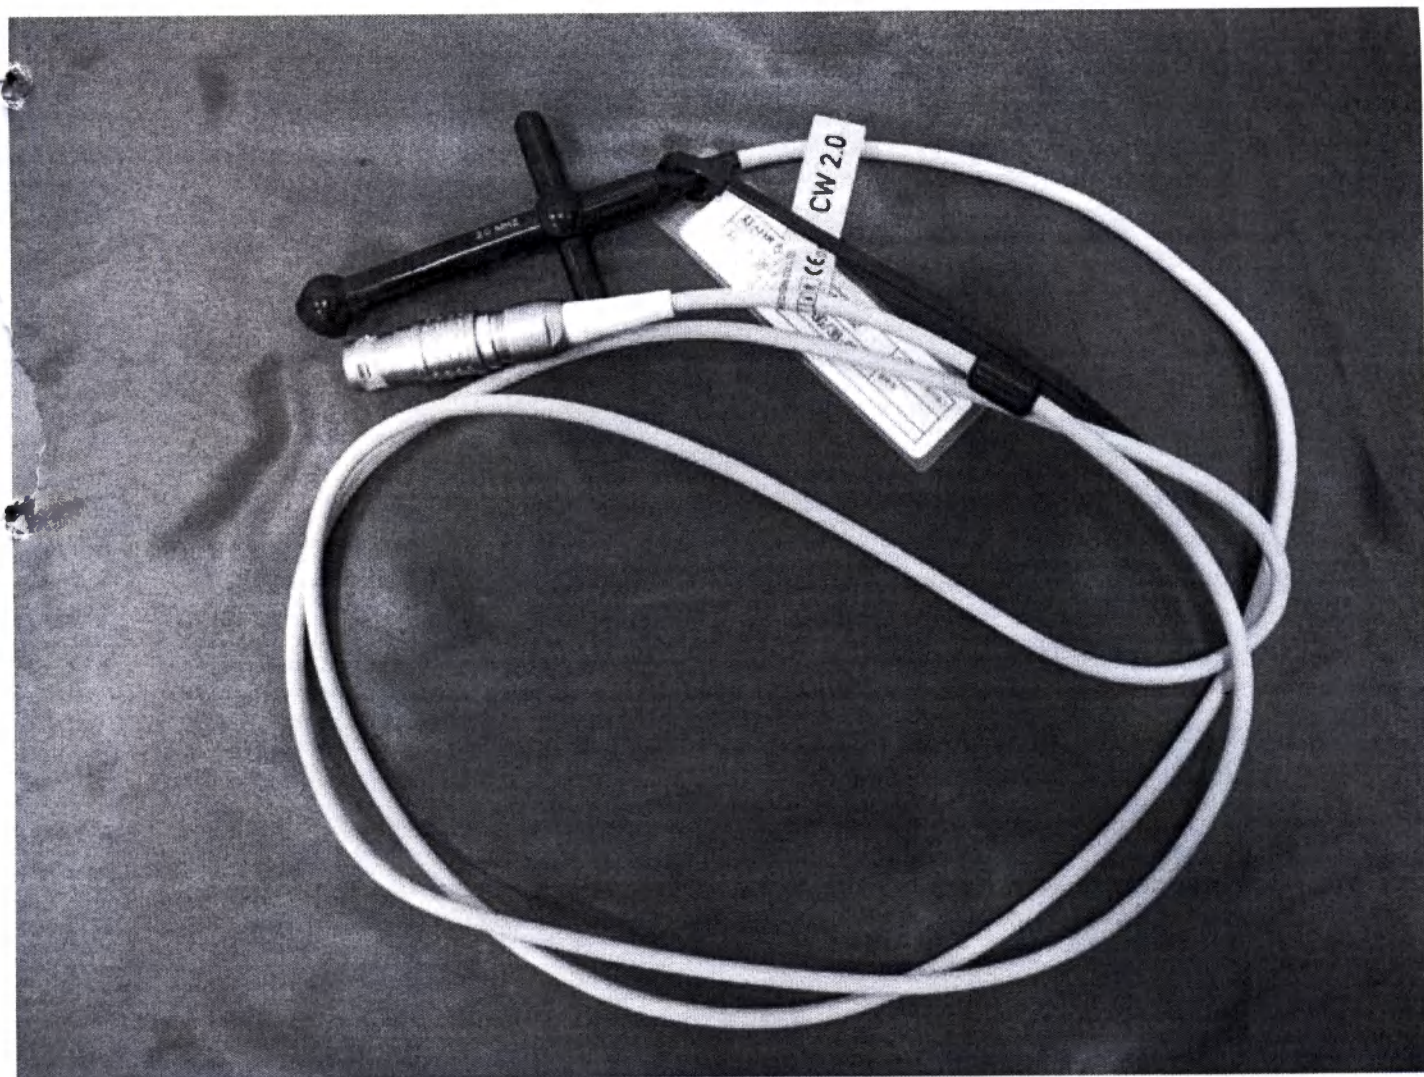

DP2B




Ультразвуковой диагностический аппарат RS80A-RUS

CW6.0 МГц.




Набор для проведения биопсии:

направляющая

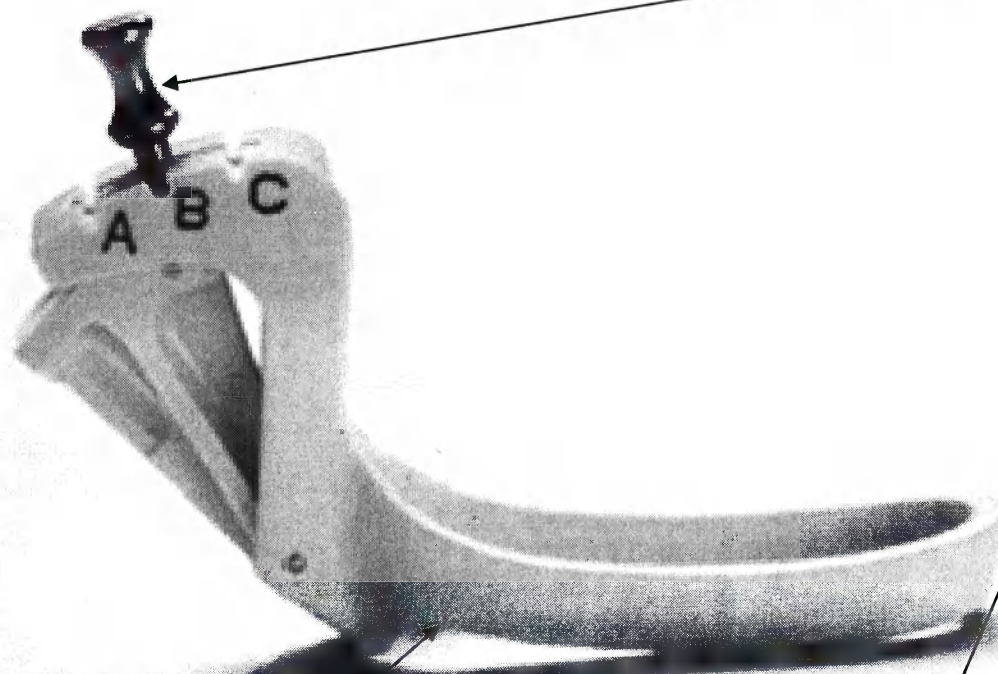


Насадка для биопсии

Крепление

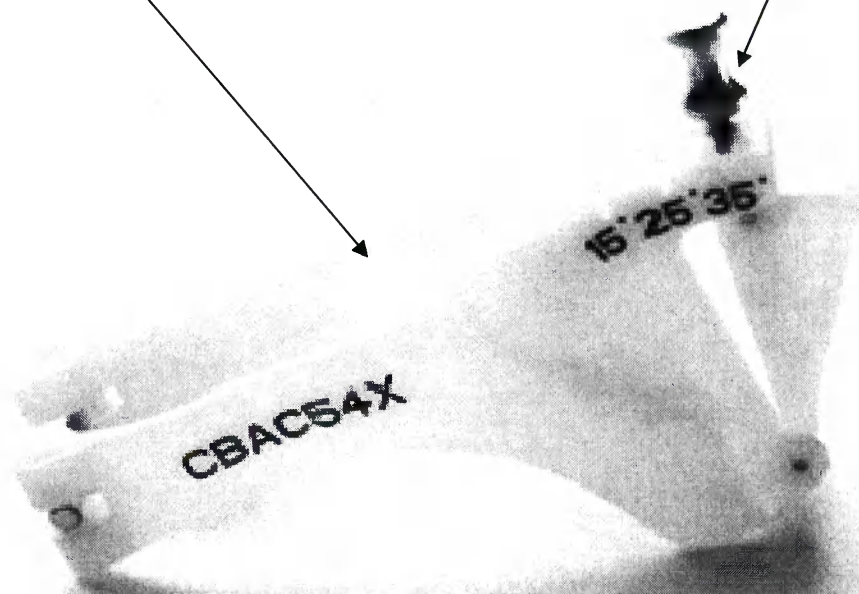

Набор для проведения биопсии:

Насадка для биопсии

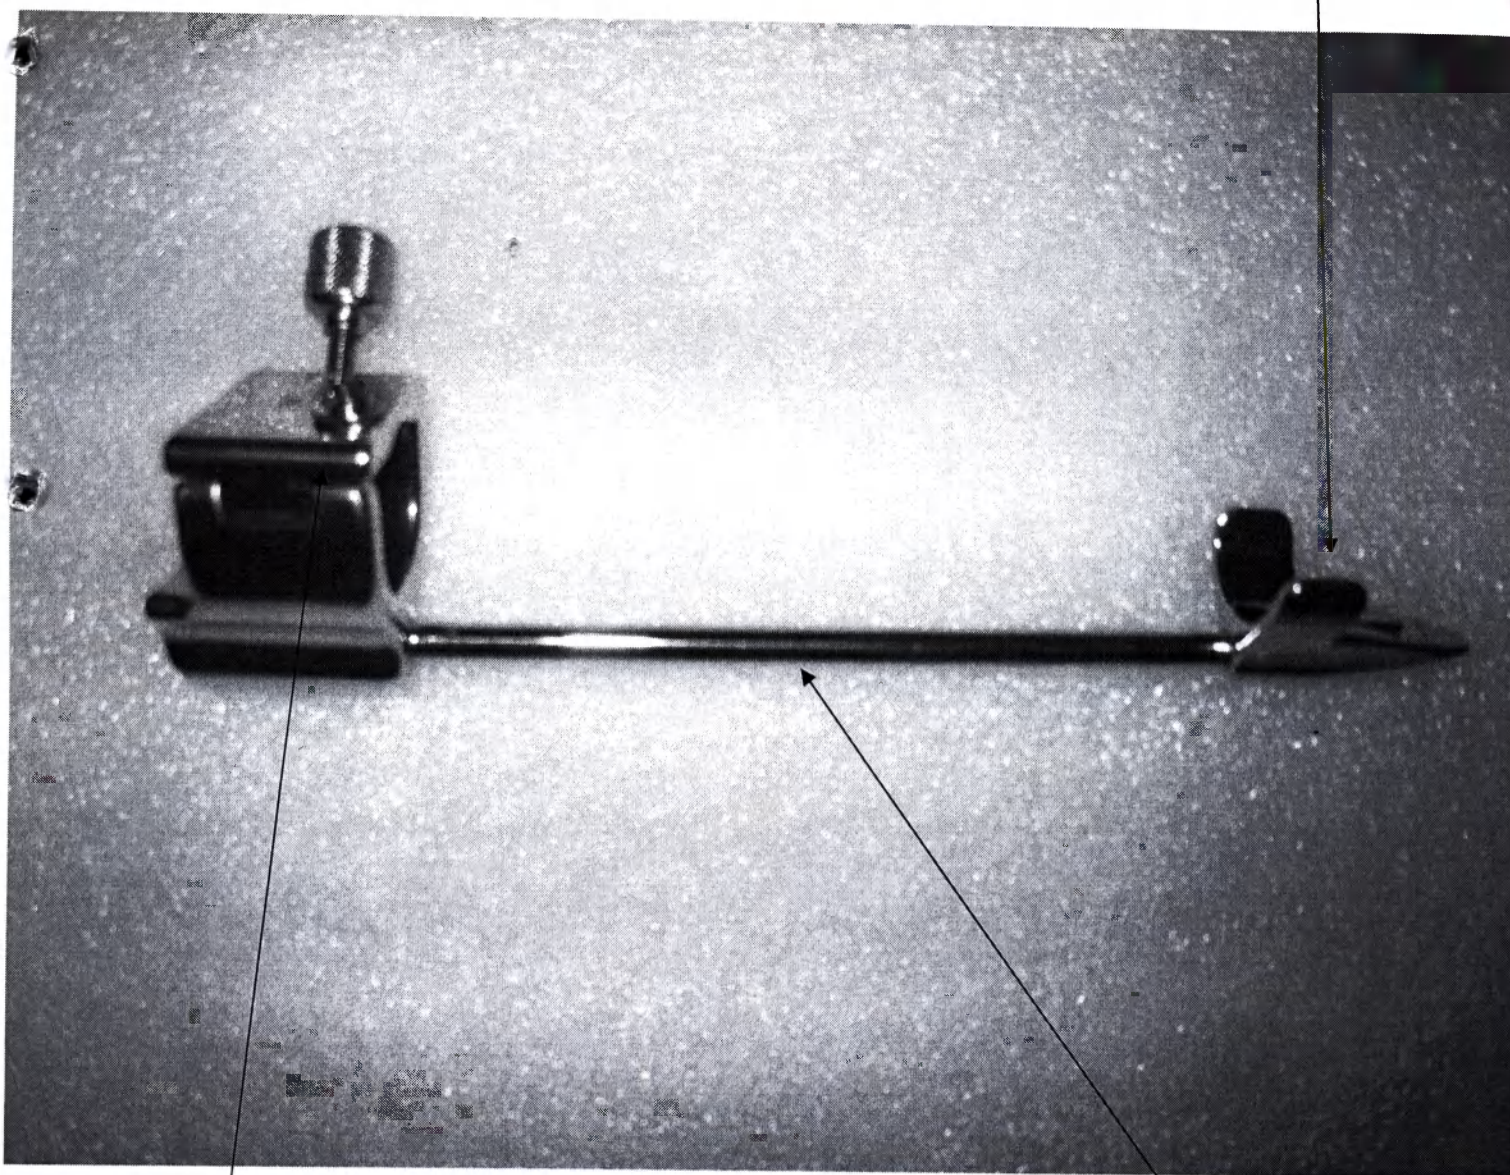


Крепление

Направляющая иглы

Ультразвуковой диагностический аппарат RS80A-RUS

ЭКГ Модуль

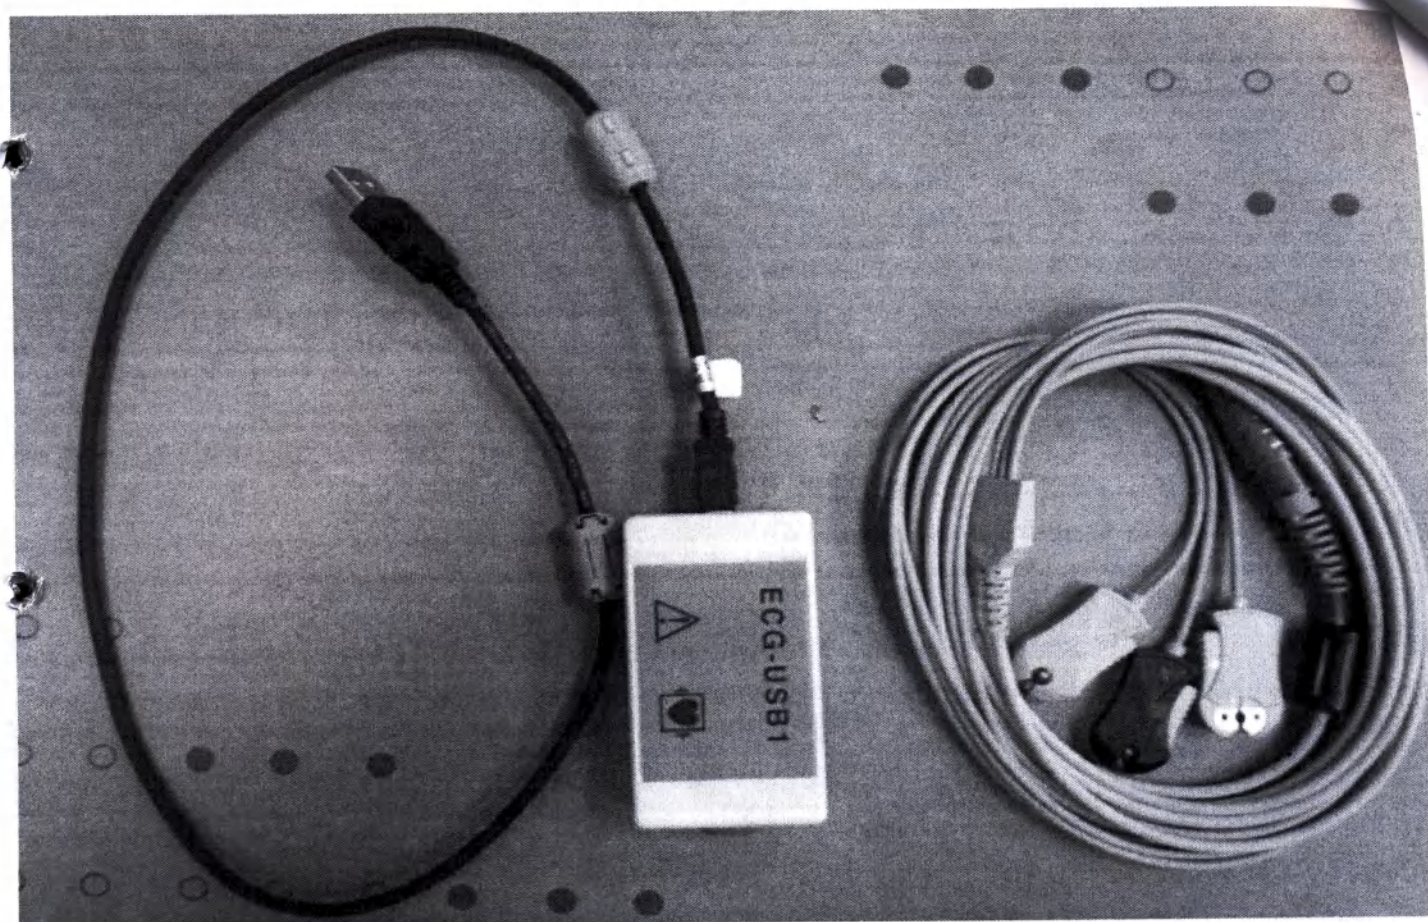

Соединительные провода и кабели.



устройства
Ножной переключатель



Ультразвуковой диагностический аппарат RS80A-RUS


Кабель заземления



Ультразвуковой диагностический аппарат RS80A-RUS

Лицензионный ключ для активаций функций и режимов

5D Heart

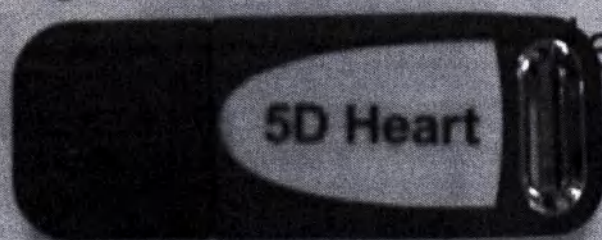

Ультразвуковой диагностический аппарат RS80A-RUS

Лицензионный ключ для активации функции определения комплекса Интима/Медиа (Авто IMT+);

117031001
1.03.18.07
2018
0000

117031001
1.03.18.07
2018
0000

Лицензионный ключ для активации функции, обеспечивающей передачу данных DICOM 3.0;

Настройка DICOM

Имя AE	Set AETitle	Название станции	Set Station Name
№ порта	104		
Имя службы	Псевдоним	Имя AE	IP адрес
			Порт Запрос
			Проверка

Добавить

Очередь

Формат отправки DICOM

2D-режим

Режим ЦДК

Цветной

Цветной

Компр. DICOM

Непод. изобр.

Несж

☒ Сохранить СтрОТМ в конце осмотра

Лицензионный ключ для активации функции проведения кардиологических измерений

ЭхоКГ	ЭхоКГ	ЭхоКГ	детск. ЭхоКГ	Выход
взрослого-младан	взрослого-Системный			
	Об ЛЖс (по Симпсону)	Масса ЛЖ	ЛП	Маркер тела
ПЖ (2D)	ПП	Аорта	Т	Аннотирование
Все КДР ЛЖ (2D)	МЖПд	ВнутрДиамЛЖ(д)	ТЗСЛЖд	
Все КСР ЛЖ (2D)	МЖПс	ВнутрДиамЛЖ(с)	ТЗСЛЖс	
				активировать дан



Лицензионный ключ для активации режима эластографии (Elastoscan)



Ультразвуковой диагностический аппарат RS80A-RUS

Лицензионный ключ для активации функции записи данных на внешний носитель ADVR2.0

Дополнительное оборудование

Модель видеосигна

Built-in Recorder

COM

Линейная передача

Ножной переключатель

Влево

Средний

Вправо

Сохранить

Стоп-кадр

Стоп-кадр

Настройка печати

Дополнительная область печати

Видеовыход (1280 x 872)

☐ Тольк. изобр.

Настройка изобр.

Печать1

Печать2

Печать1

Сброс

☐ 2D

3D

10

100

100

Метод записи ADVR

☐ DVD

USB

Экспорт на мобильное устройств

Лицензионный ключ для активации функции получения изображения высокой четкости HDV

VOCAL

MCB

Косая проекц.

XI VOCAL

Объемн. КТ

2D

5D CNS

5D Follicle

→

ЩС 5D

Аппроксимация лица плода

Прин. ОИ

ДК 5D

VSI

Клип 3D

Нач. Realistic Vue

Настройка Realistic Vue

MagiCut

ЦД


Ориентир

Аннотирование

ClearVision

Ультразвуковой диагностический аппарат RS80A–RUS

Лицензионный ключ для активации режима получения объемных данных в режиме SMART 4D

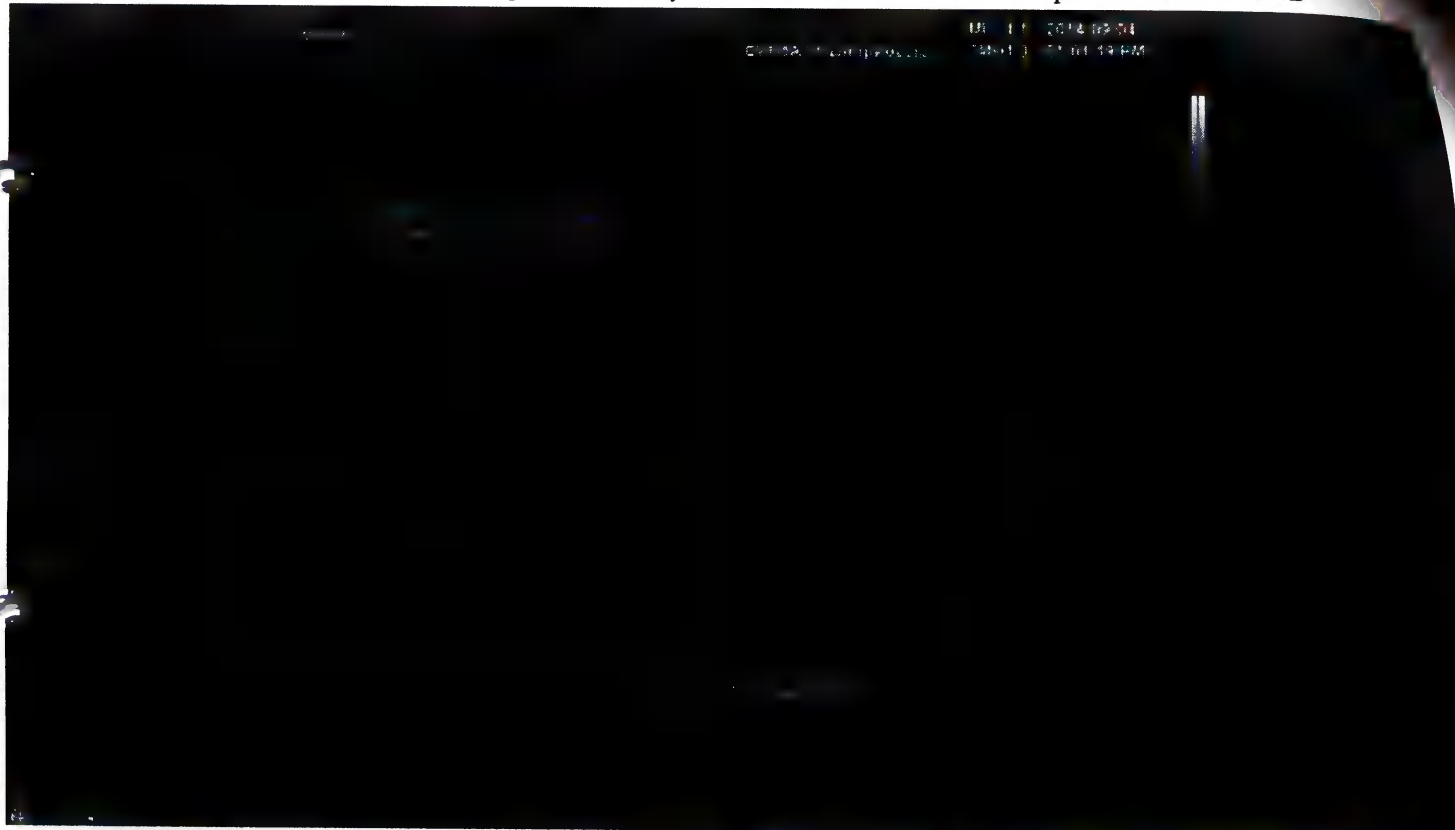

Лицензионный ключ для активации функции регистрации работы сердца плода в режиме XI STIC




Ультразвуковой диагностический аппарат RS80A-RUS


Лицензионный ключ для активации функции исследований в режиме постоянно-волнового доплера;



Лицензионный ключ для активации режима Realistic Vue;

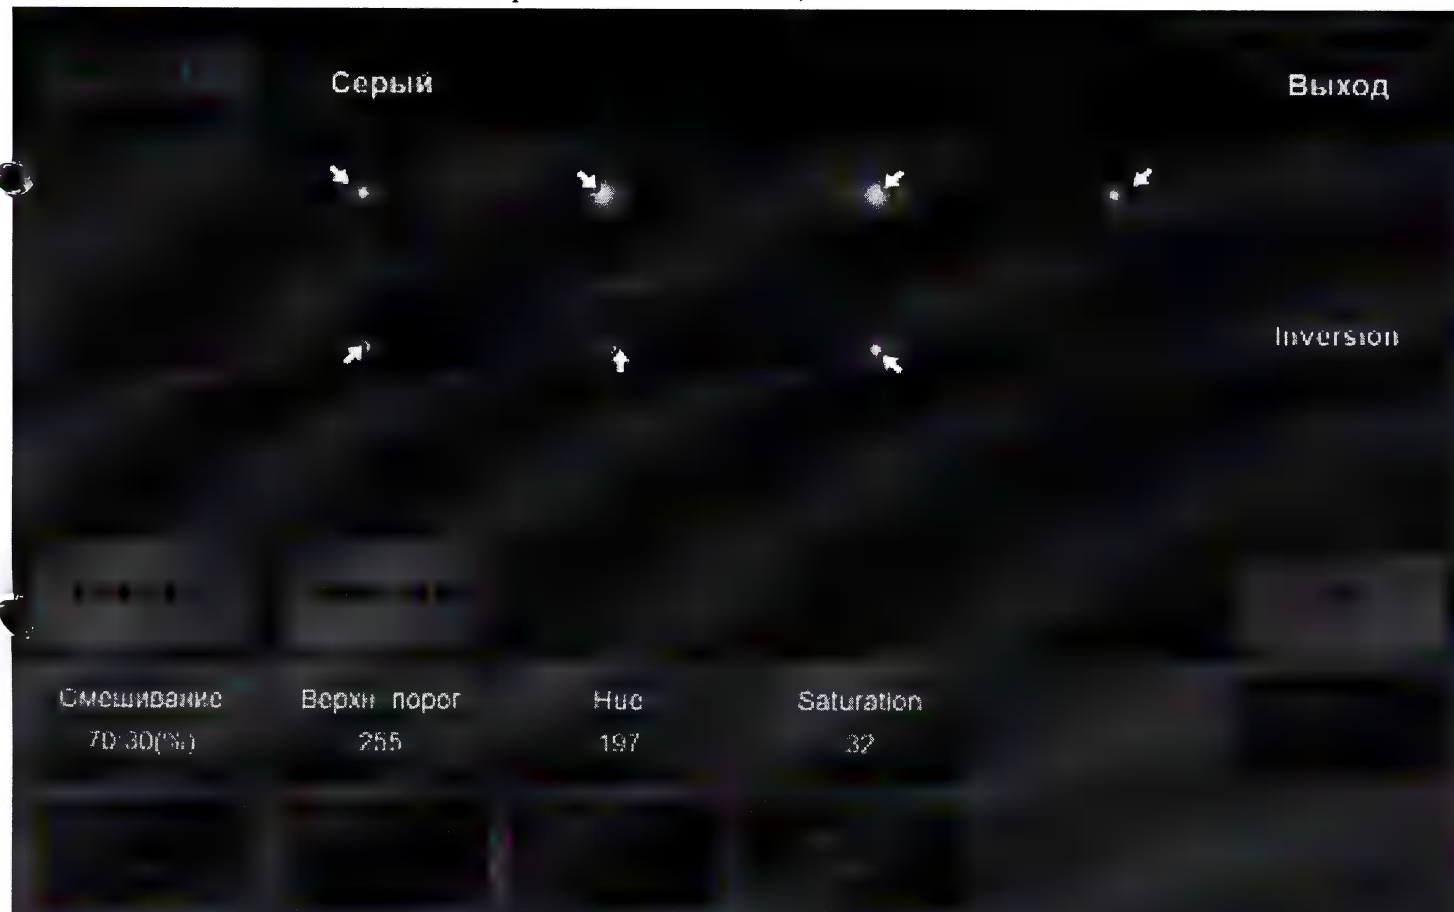


Лицензионный ключ для активации функции E-Breast;

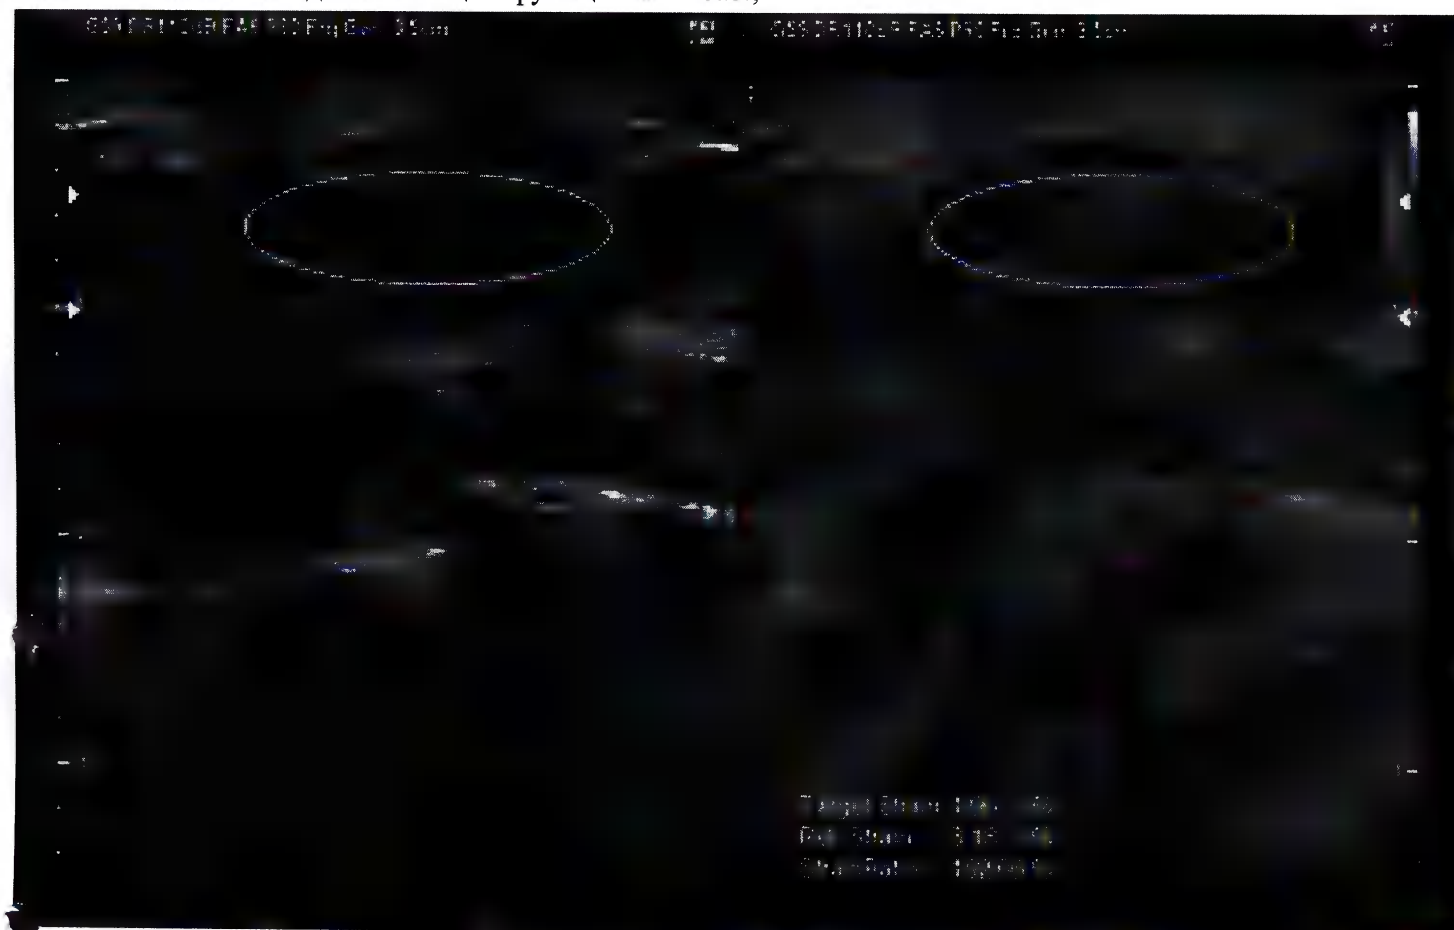

Ультразвуковой диагностический аппарат RS80A-RUS

Лицензионный ключ для активации функции E-Thyroid;

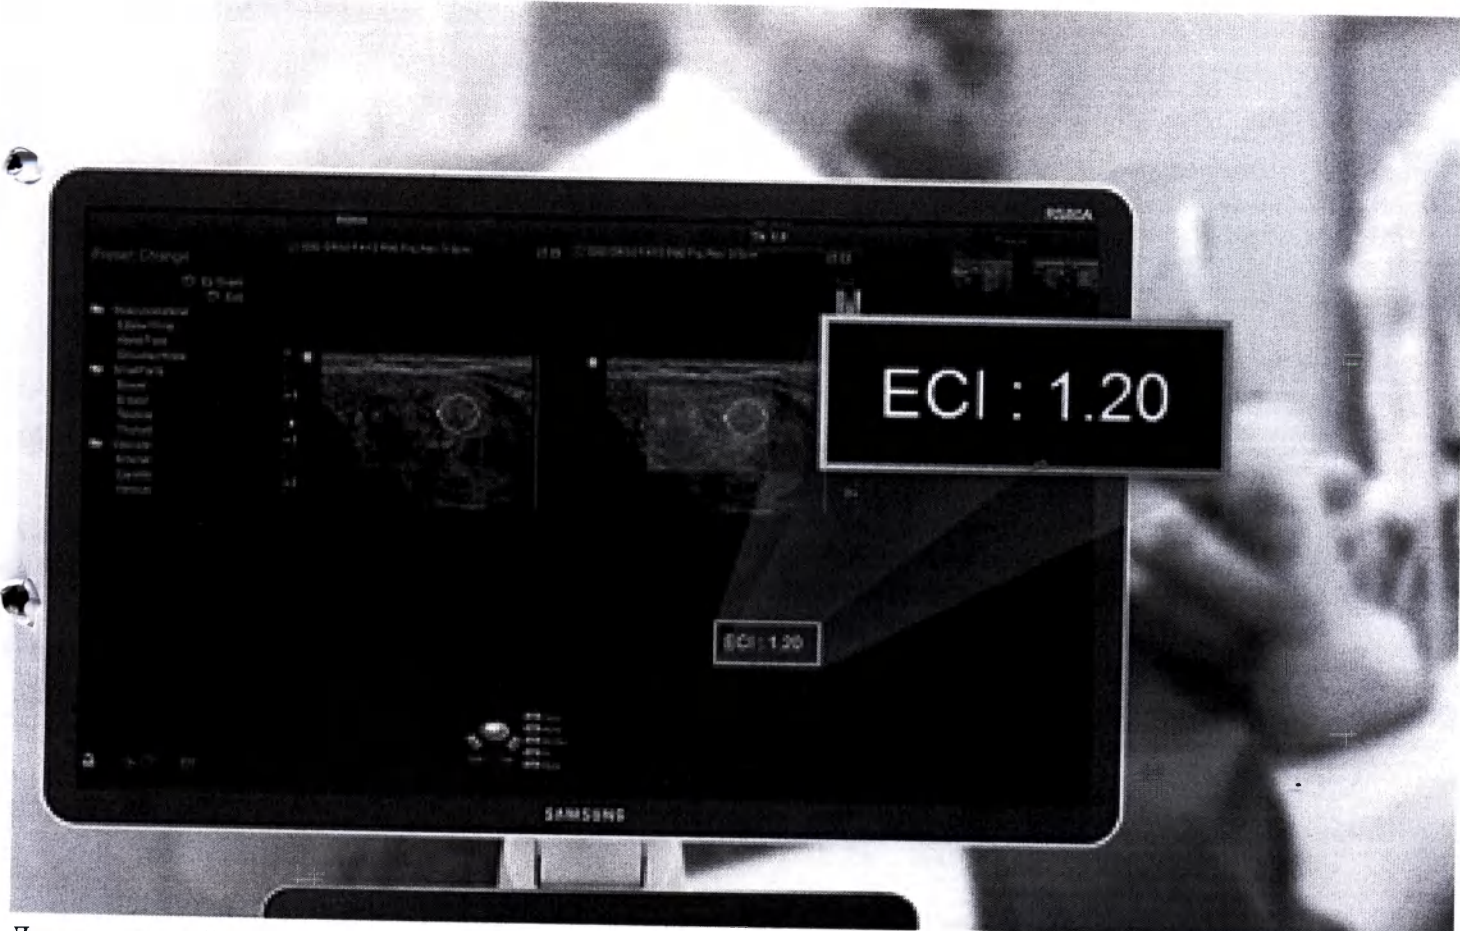


Лицензионный ключ для активации функции S-Detect



Ультразвуковой диагностический аппарат RS80A–RUS

Устройство Clear Track

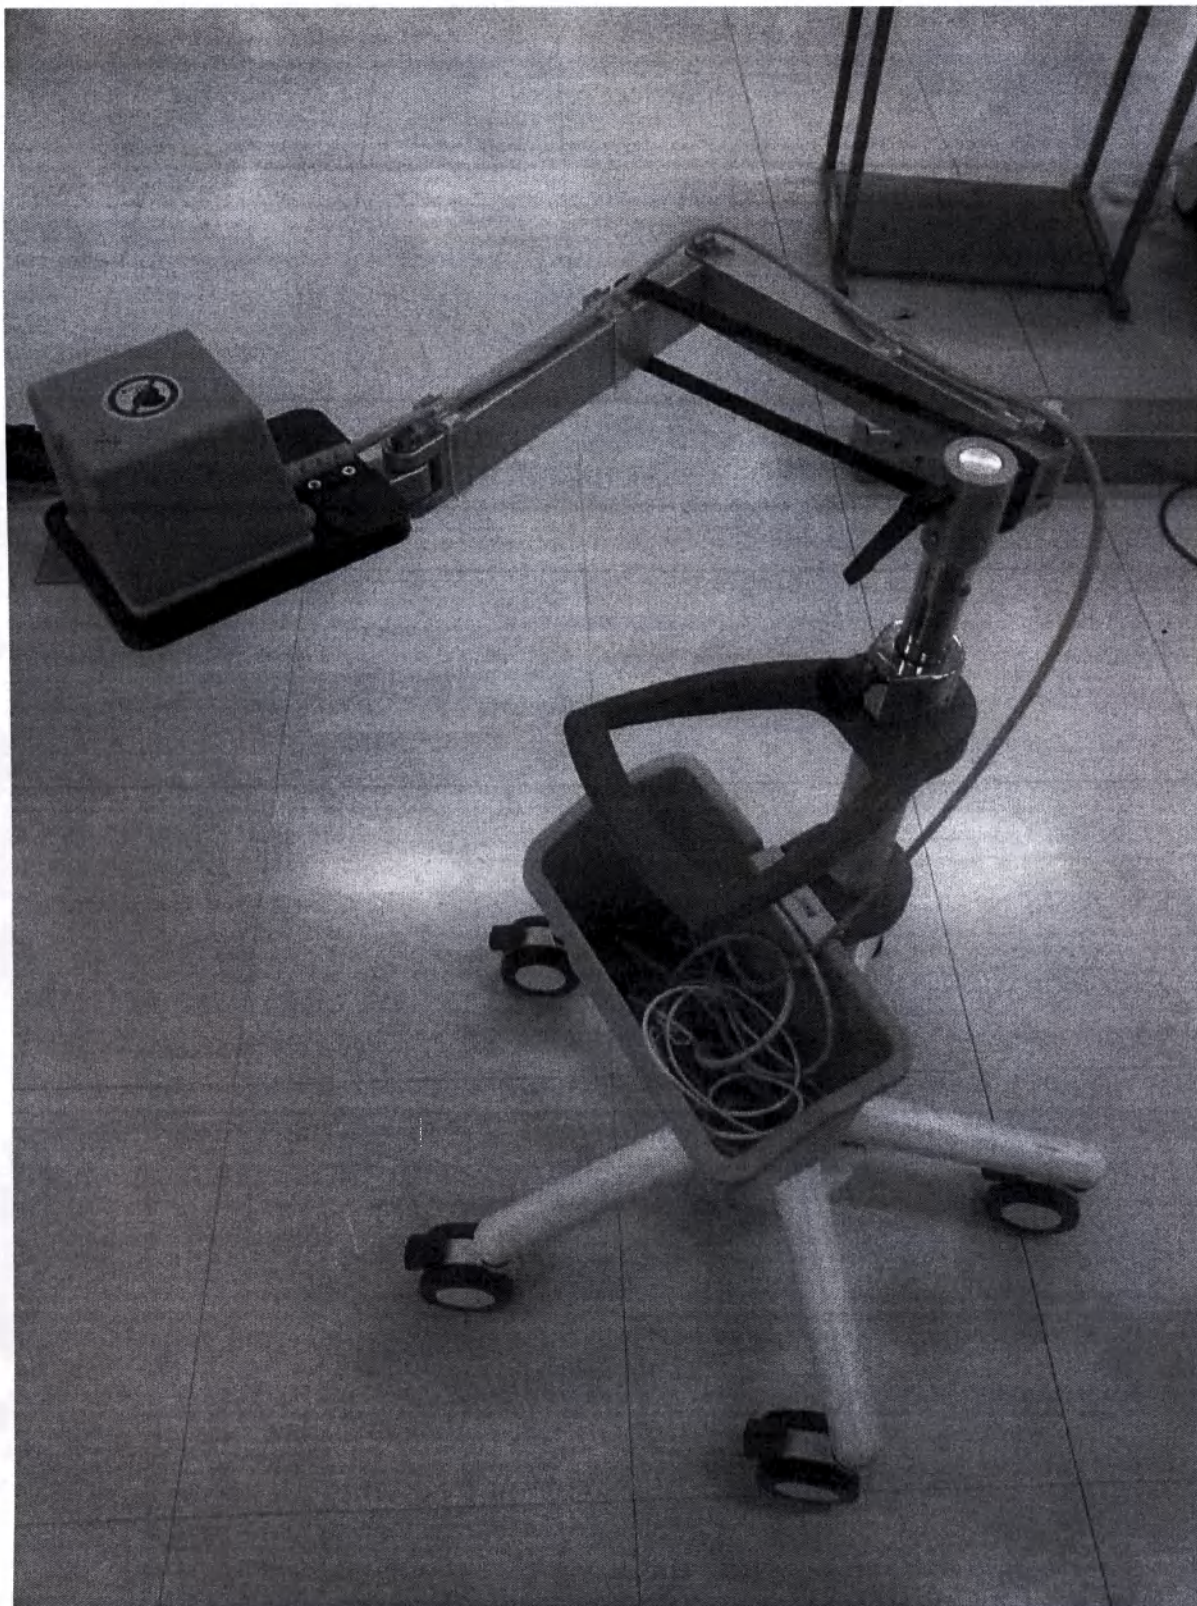

нац. *Handwritten: H.B.*
Handwritten: 300

