



**Фотографические изображения
на медицинское изделие:**

**Установка для локальной ЭМ-гипертермии злокачественных
новообразований «Яхта-4», в составе:**

1. Установка для локальной ЭМ-гипертермии злокачественных новообразований «Яхта-4», в составе:

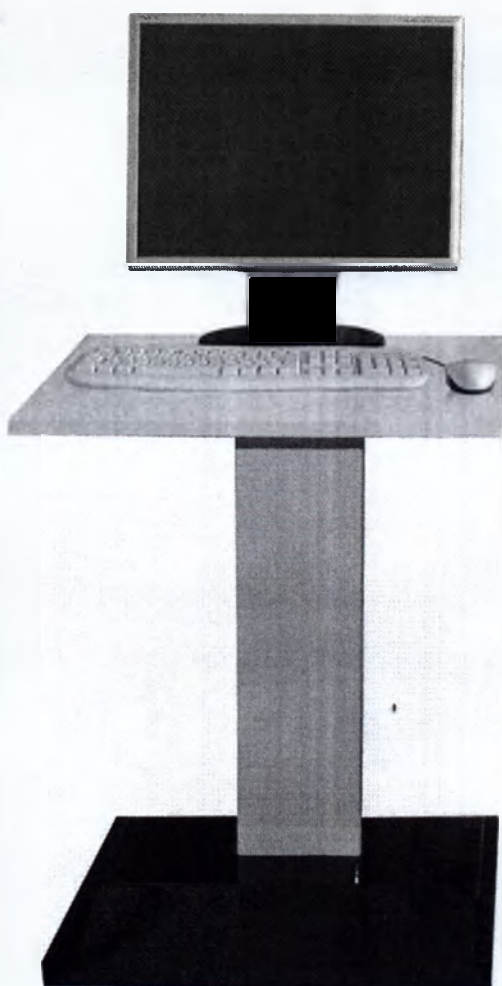



АО « НПП «Исток»
им. Шокина

Установка для локальной ЭМ – гипертермии
злокачественных новообразований
«Яхта-4»

ТУ 9444-002-07622667-2015



ME67

~ 220 В, 50 Гц $P_{\text{догр}}$ – 2,0 кВА

Непрерывный режим работы – 6 ч.

Заводской № 127153140

Дата выпуска: 2015г



Ноутбук Ноутбук HP Envy 17-n001ur 17.3", производство фирмы Hewlett-Packard (HP), Китай.




МФУ HP Officejet Pro 8620, производство фирмы Hewlett-Packard (HP), Китай.




Принадлежности:


1. Устройство термостатическое.

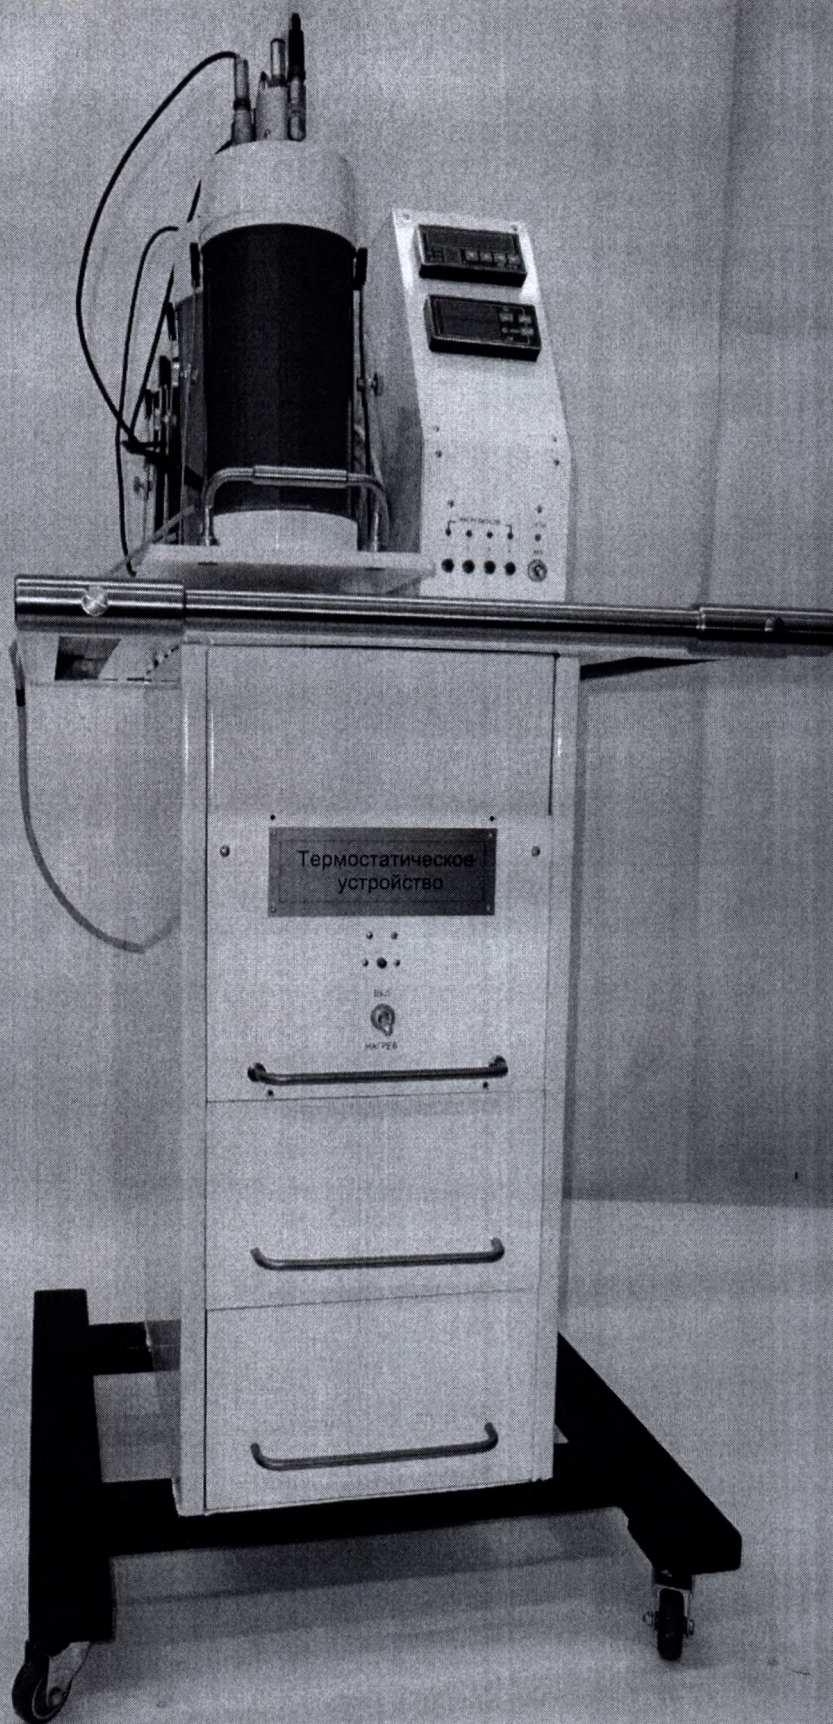


Излучатели: Я-2Н; Я-1Н; Я-4Н; Я-3Н; Я-5Н

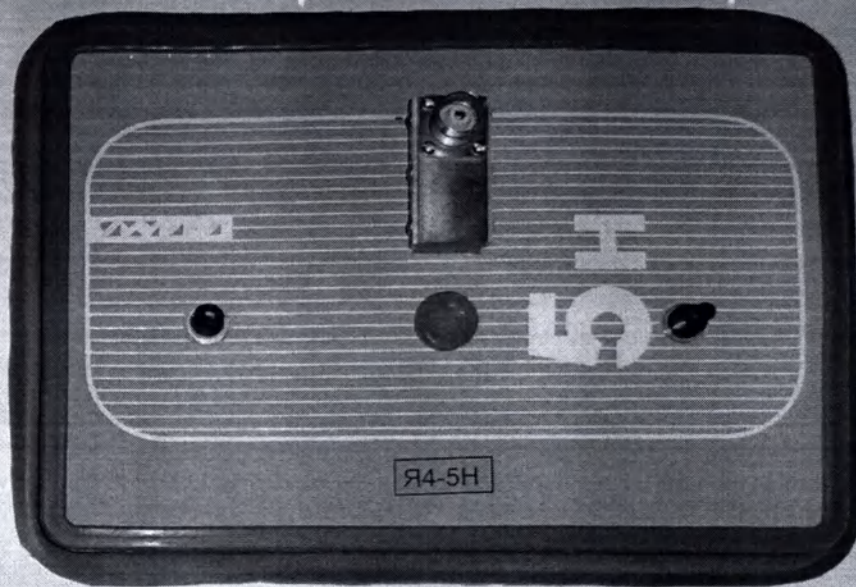


3. Излучатели: Я-2В; Я-1В; Я-3В; Я-4В; Я-5В; Я-6В

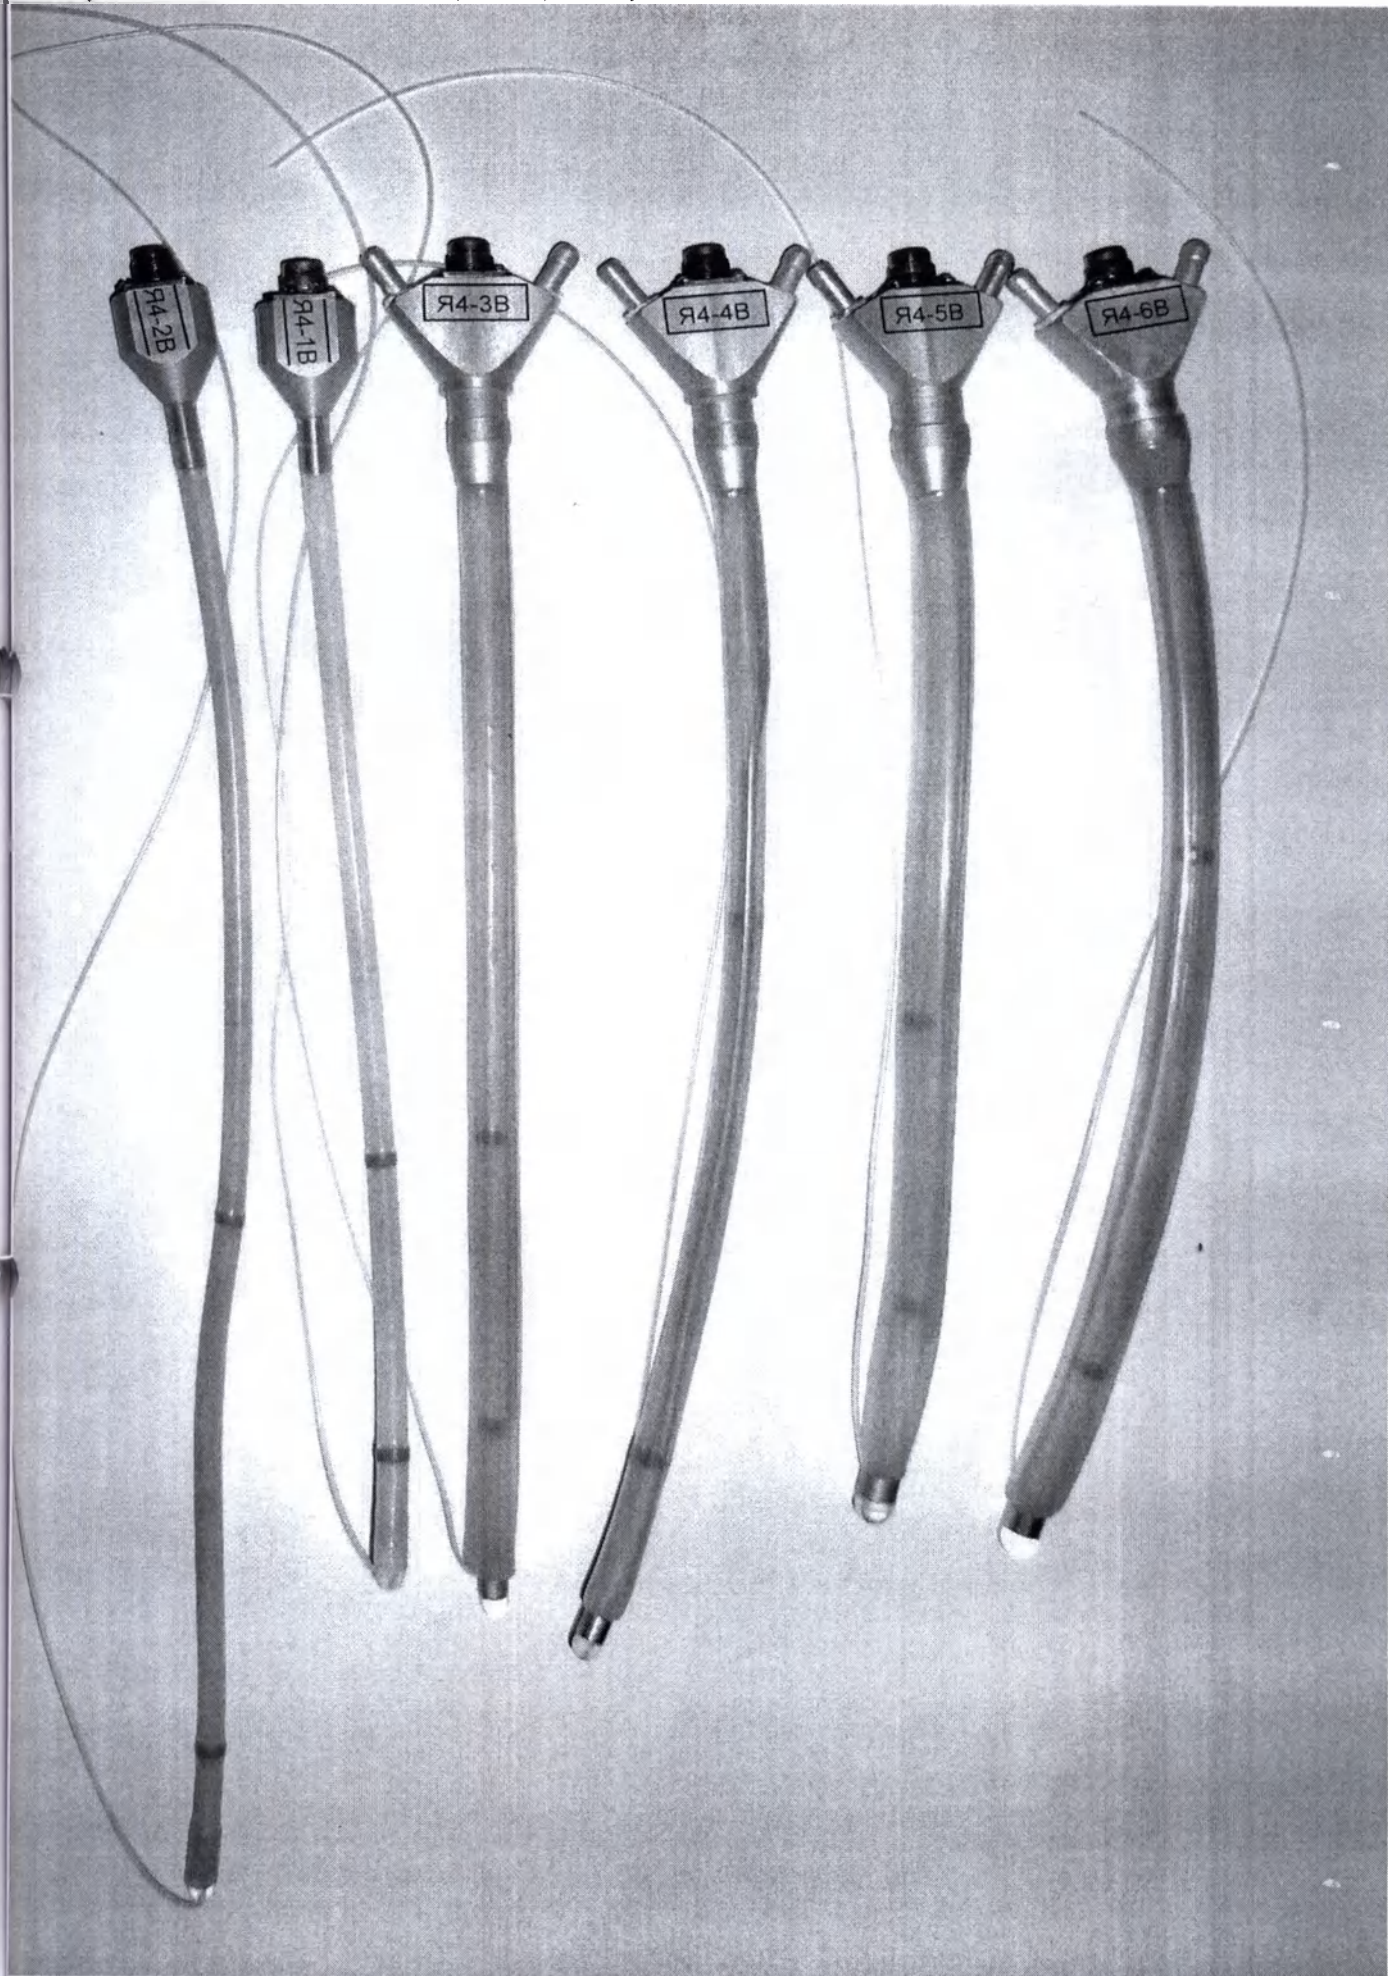

4. Датчик температуры: игольчатый - 4 шт; катеторный - 3 шт

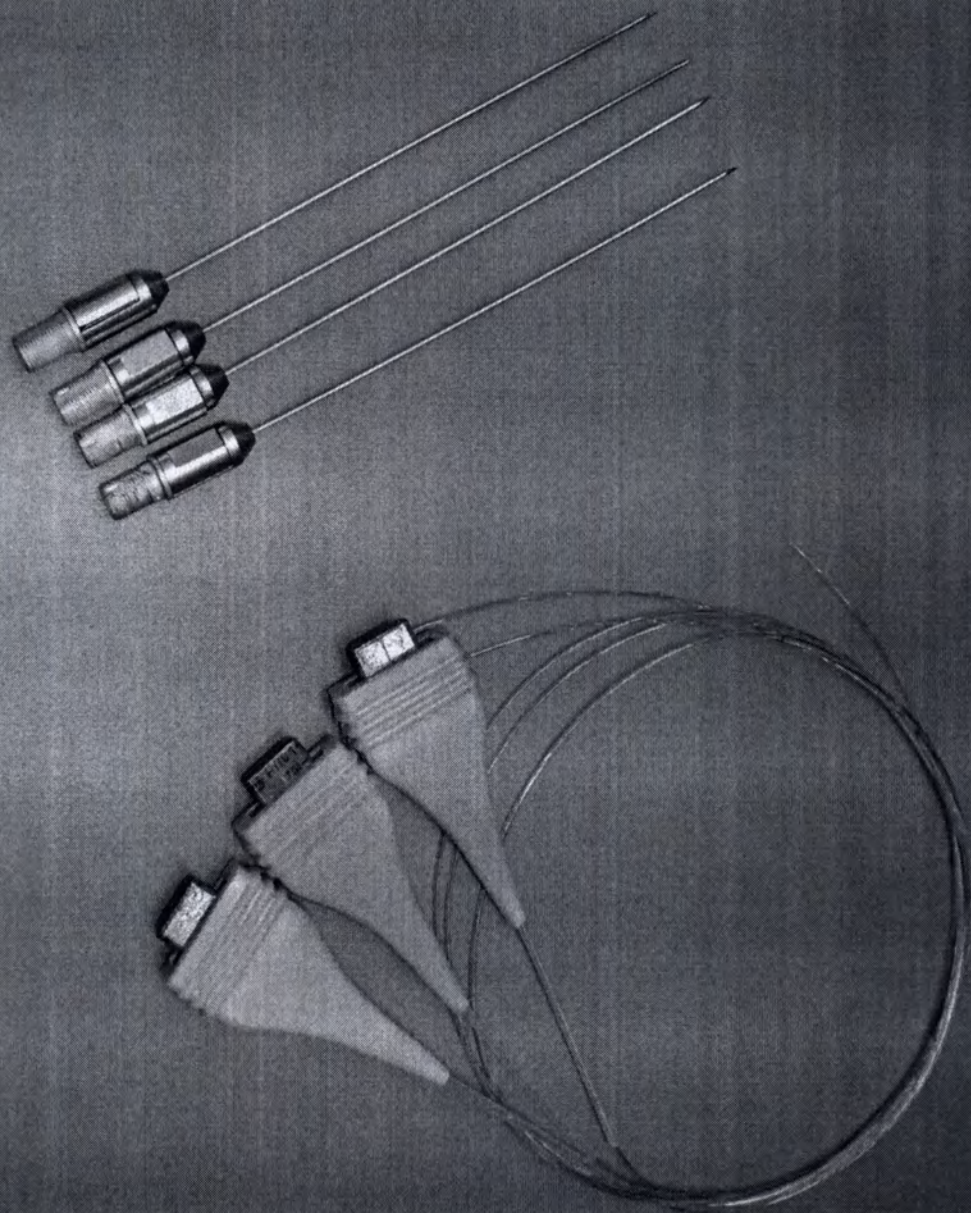



5. Ремень: длинный – 2шт, короткий – 2шт

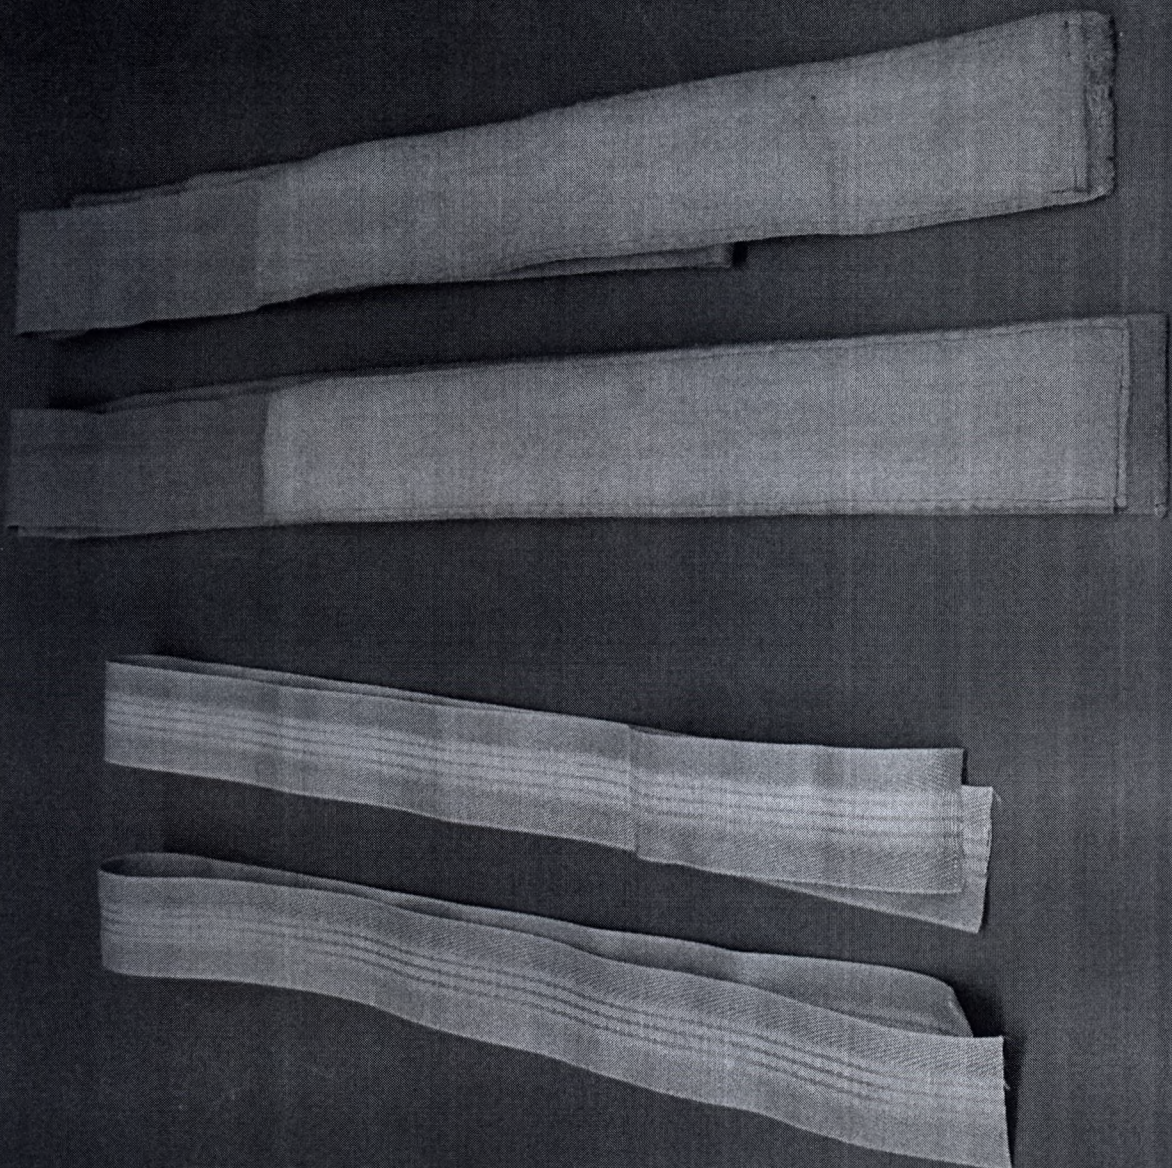


III. Монтажные части:

1. Кабель №1 – 3шт

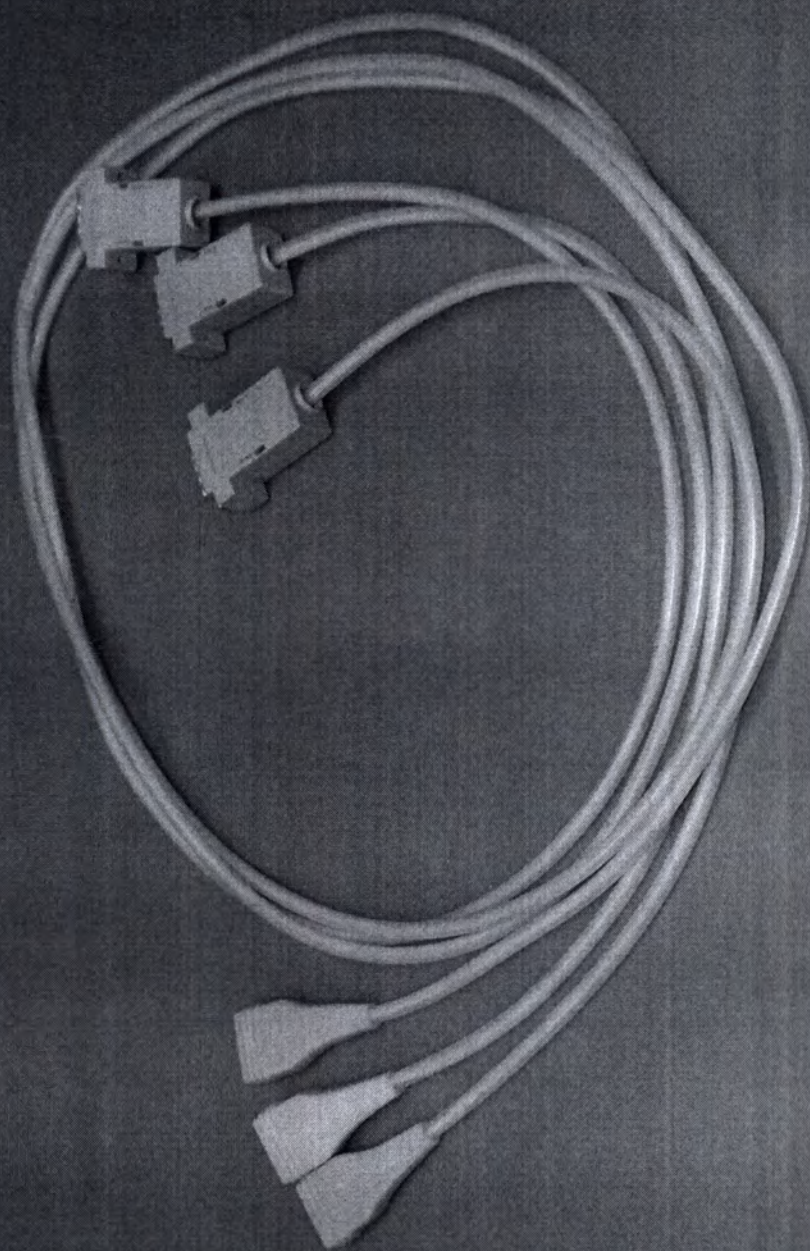


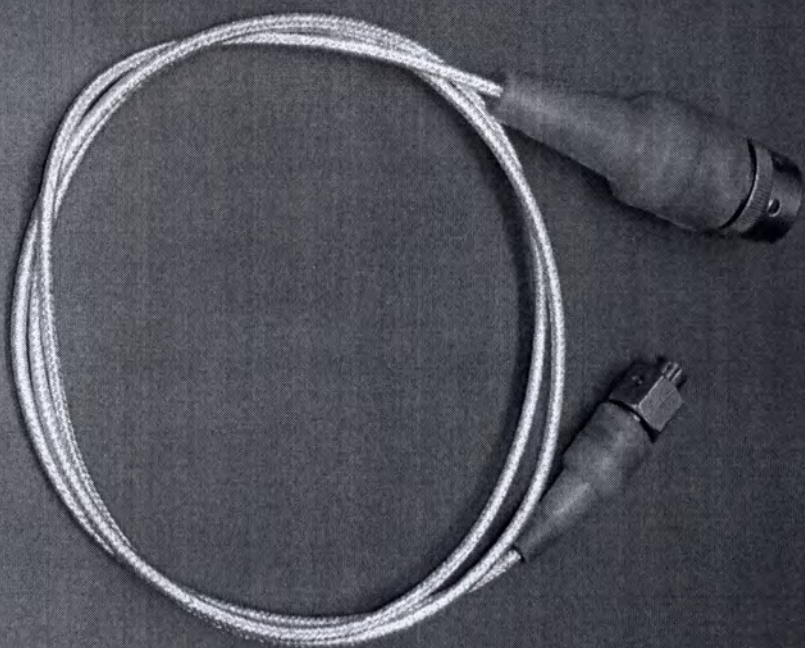

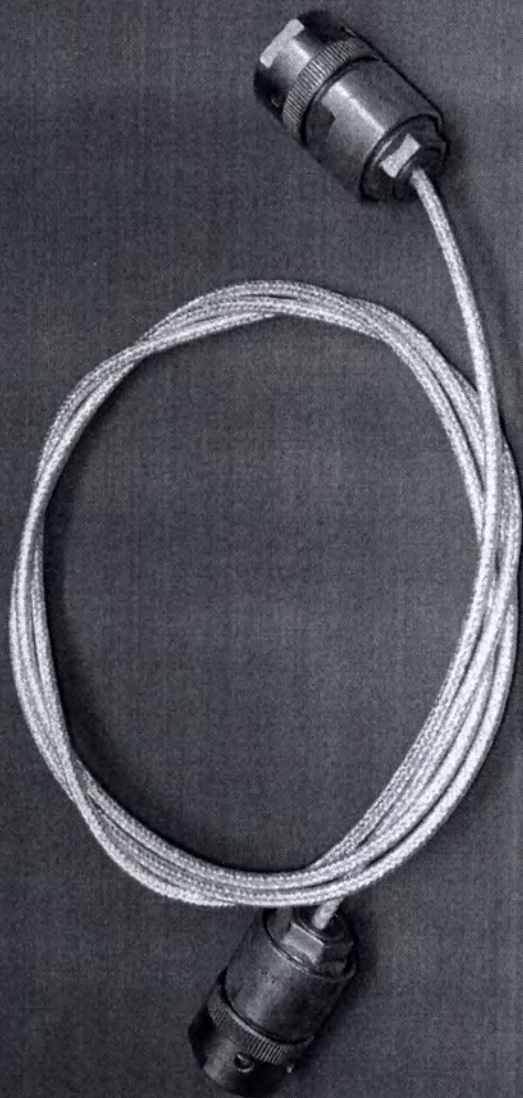






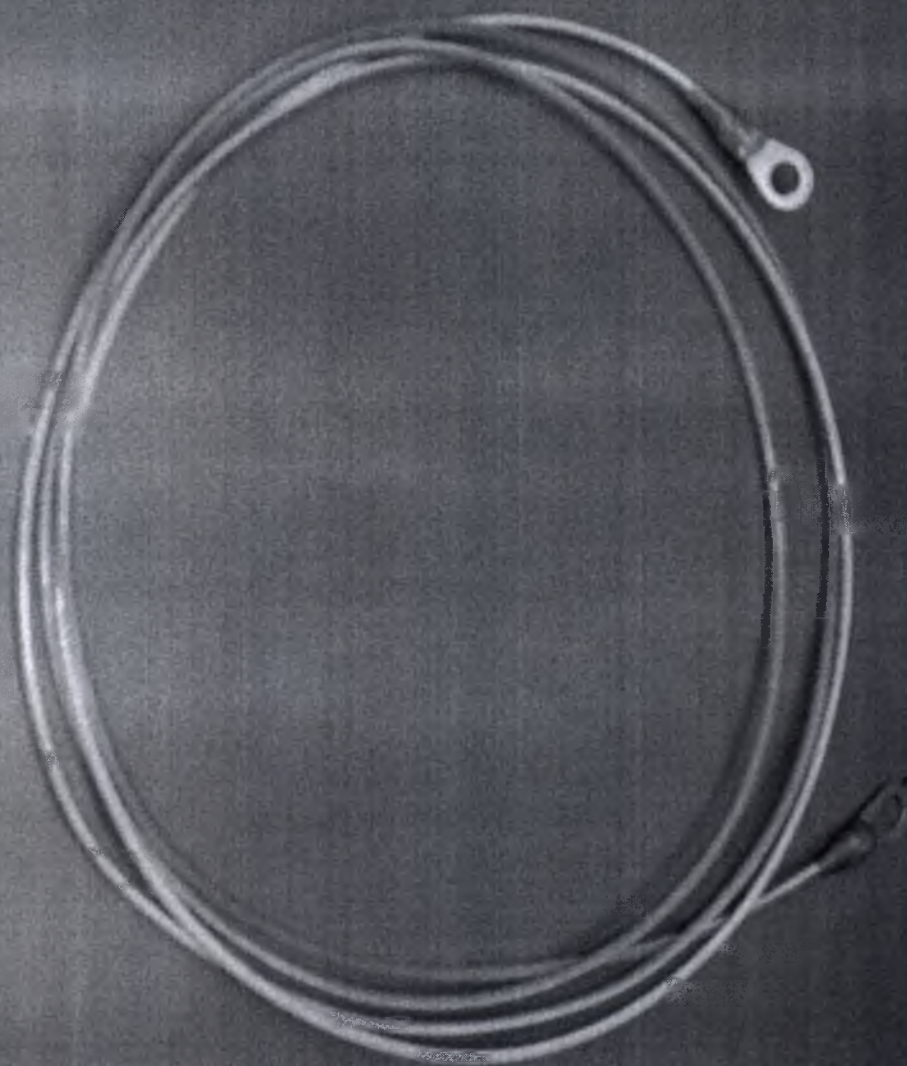

7. Кабель №7 – 2шт

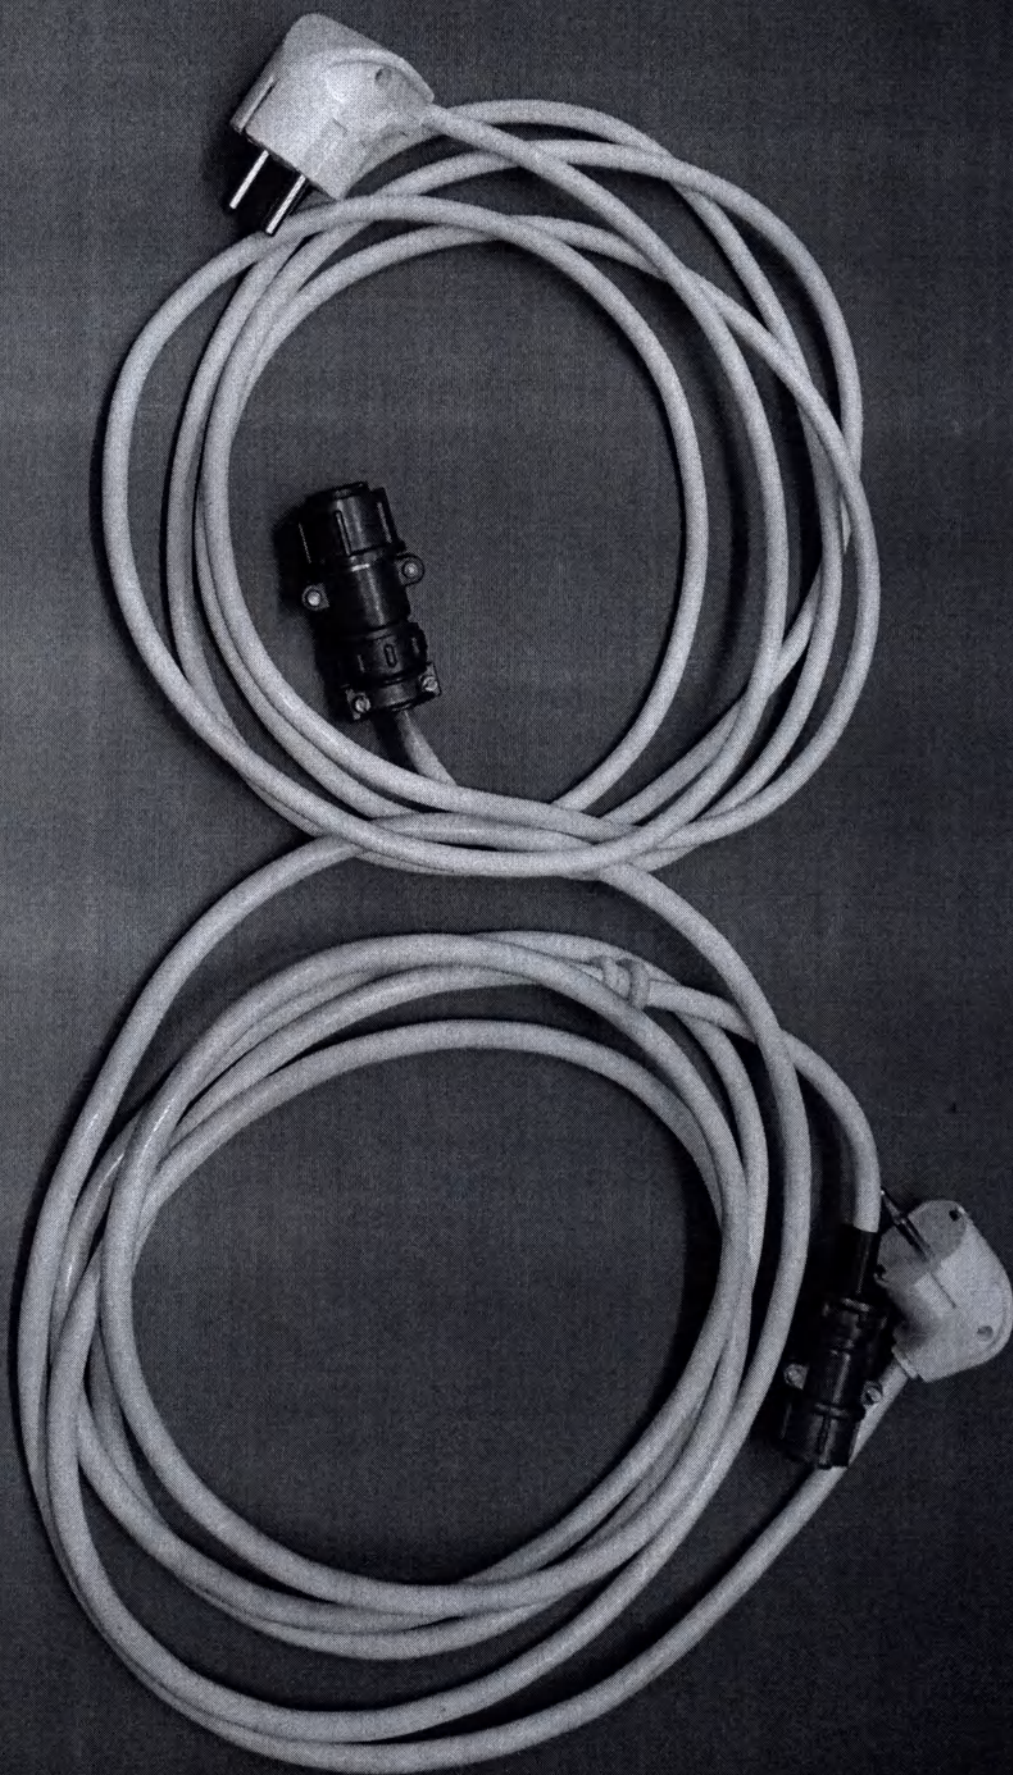

III. Запасные части:
Светодиод АЛ307БМ



светодиод АЛ307ГМ



В настоящем документе
прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

лист
Начальник лаборатории НК-2
АО «НПП «Исток» им. Шокина»
Мазохин В.Н.
КАНЦЕЛЯРИЯ
« 03 » 201 г.