


**Фотографические изображения
на медицинское изделие:**

**Установка для локальной СВЧ-гипертермии злокачественных
новообразований с системой автоматической
стабилизации температуры в зоне облучения
«Яхта-3» , в составе:**

I. Установка для локальной СВЧ-гипертермии злокачественных новообразований с системой автоматической стабилизации температуры в зоне облучения «Яхта-3», в составе:





АО « НПП «Исток»
им. Шокина

Установка для локальной СВЧ-гипертермии
злокачественных новообразований с системой
автоматической стабилизации температуры
в зоне облучения «Яхта-3»

ТУ 9444-128-07622667-2015



ME67




~ 220 В, 50 Гц $P_{\text{потр.}}$ – 1,5 кВА


Непрерывный режим работы – 6 ч.

Заводской № 127153139


Дата выпуска: 2015г


1. Блок генератора

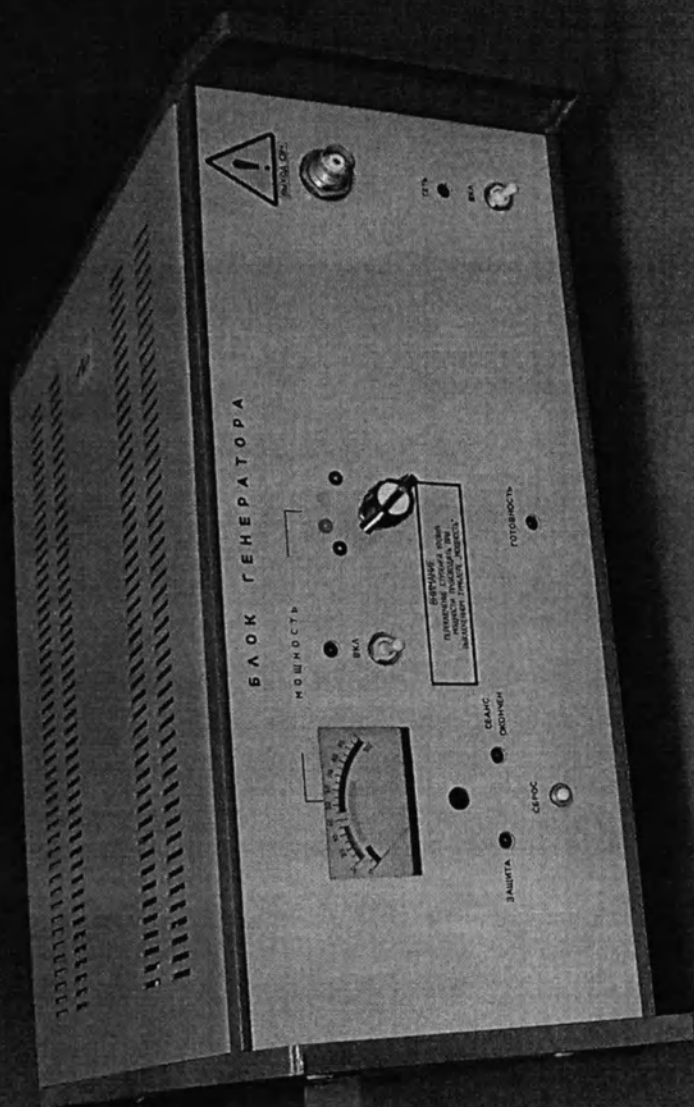

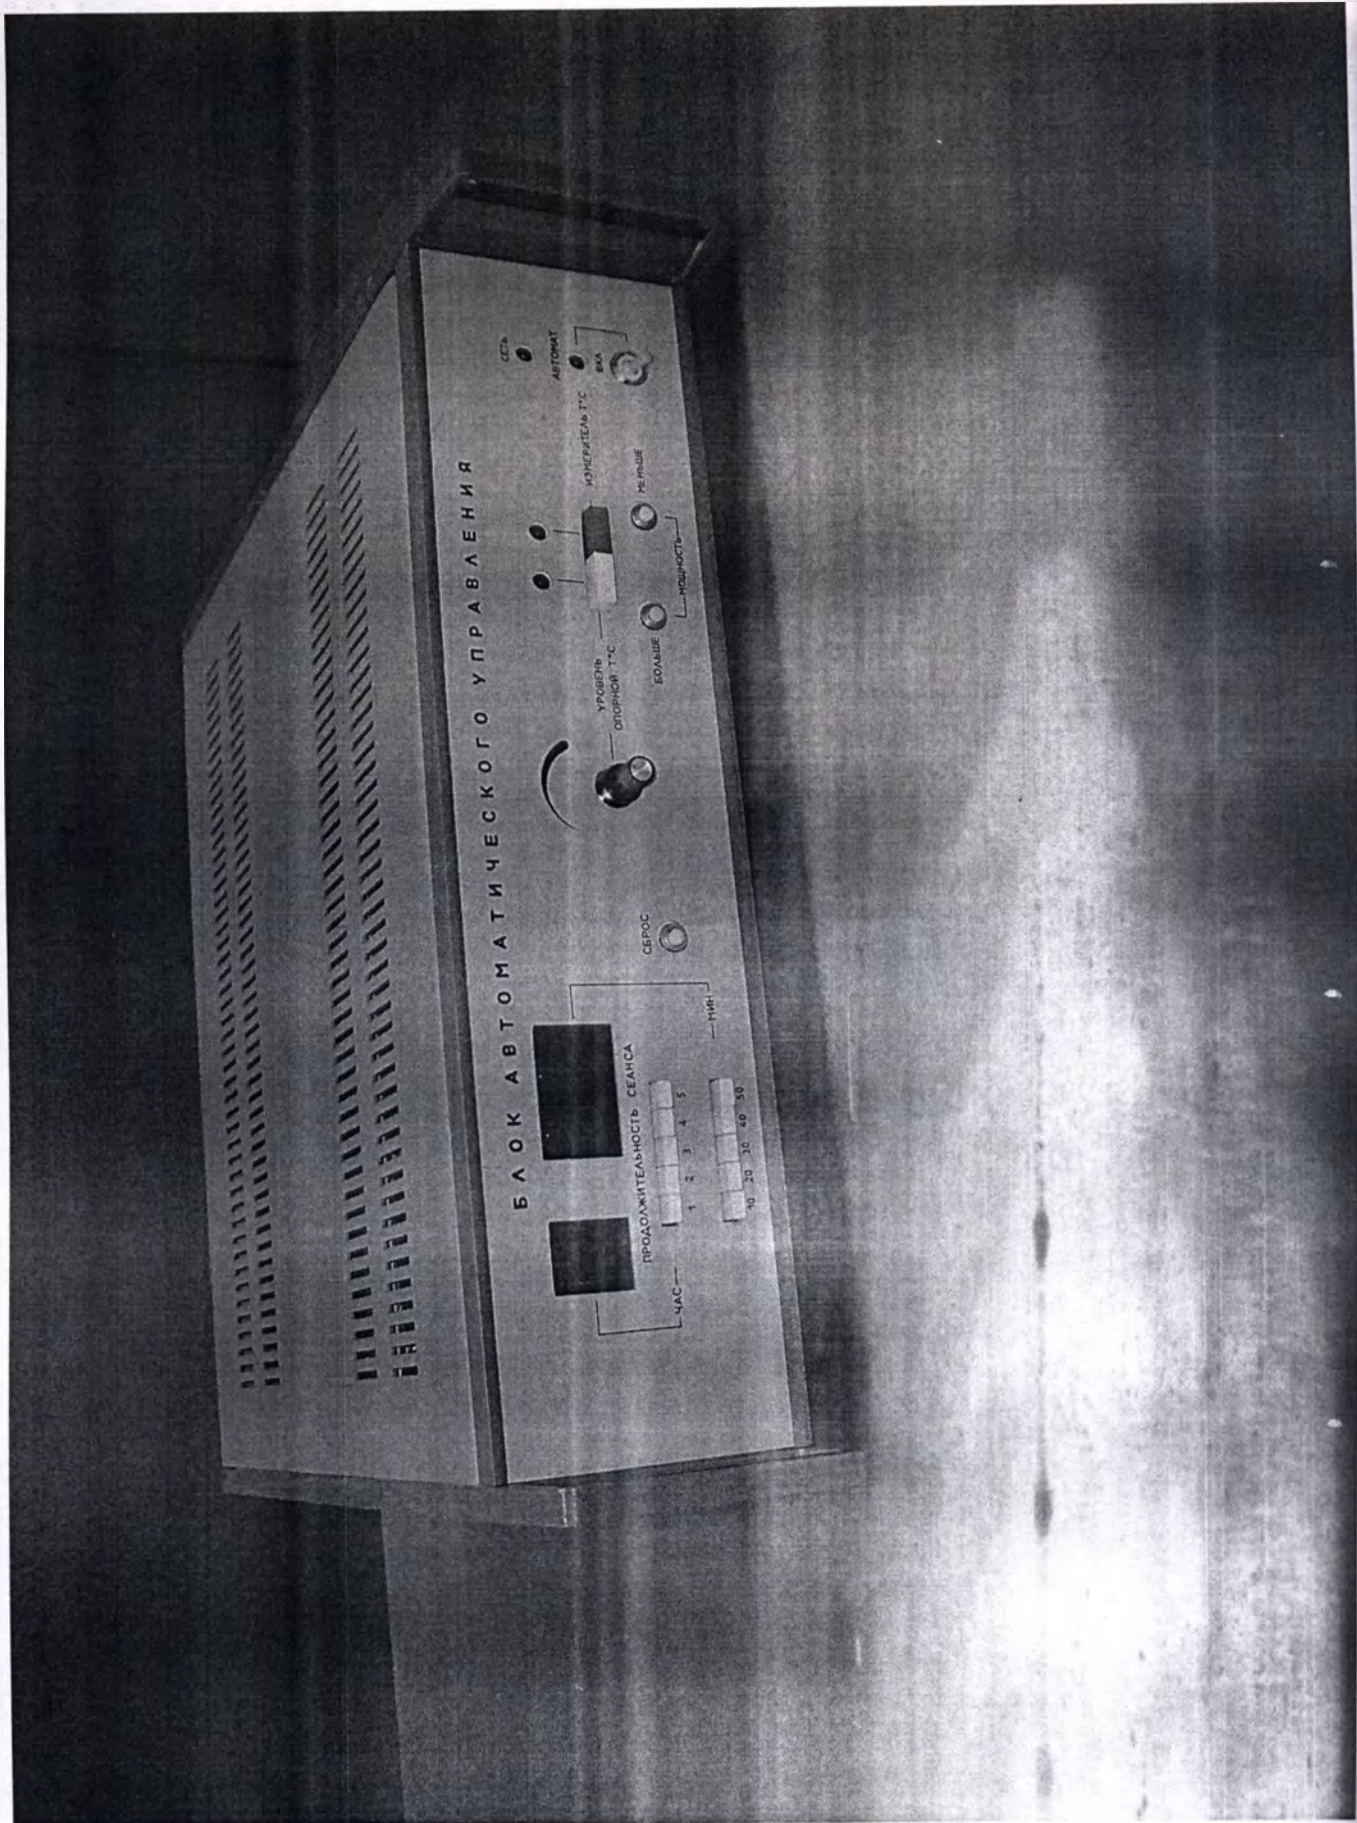


3 Блок измерителя температуры

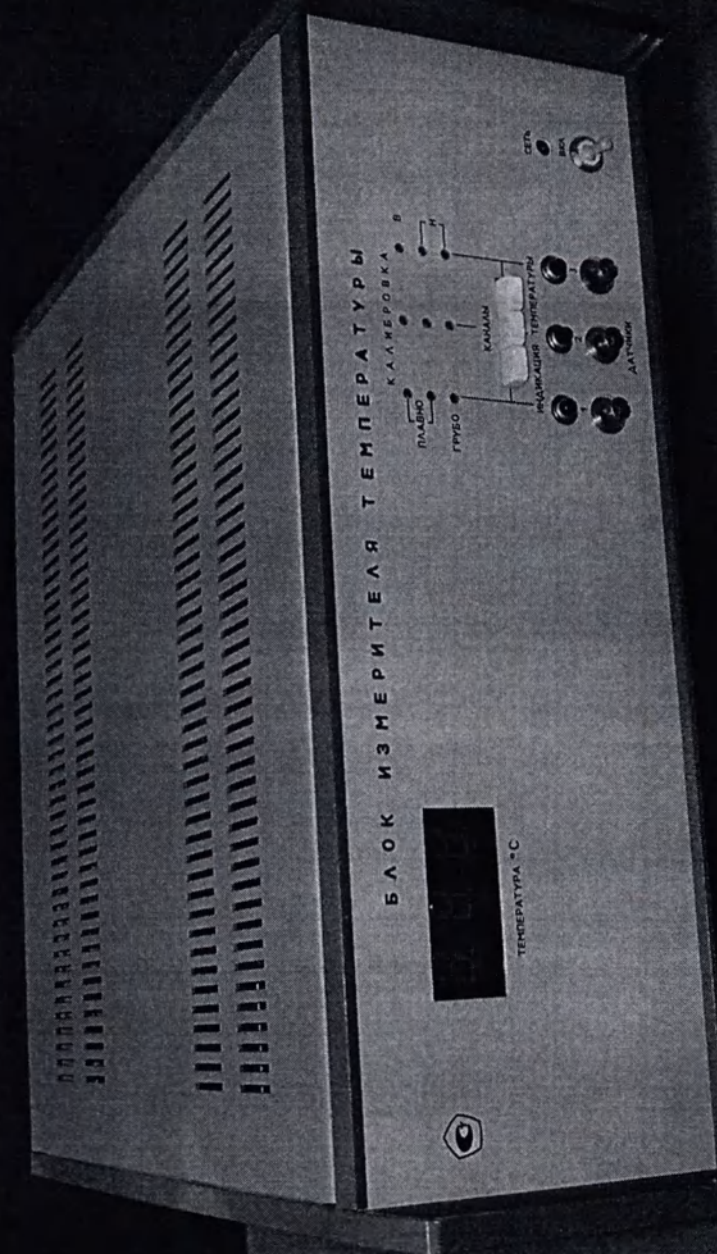

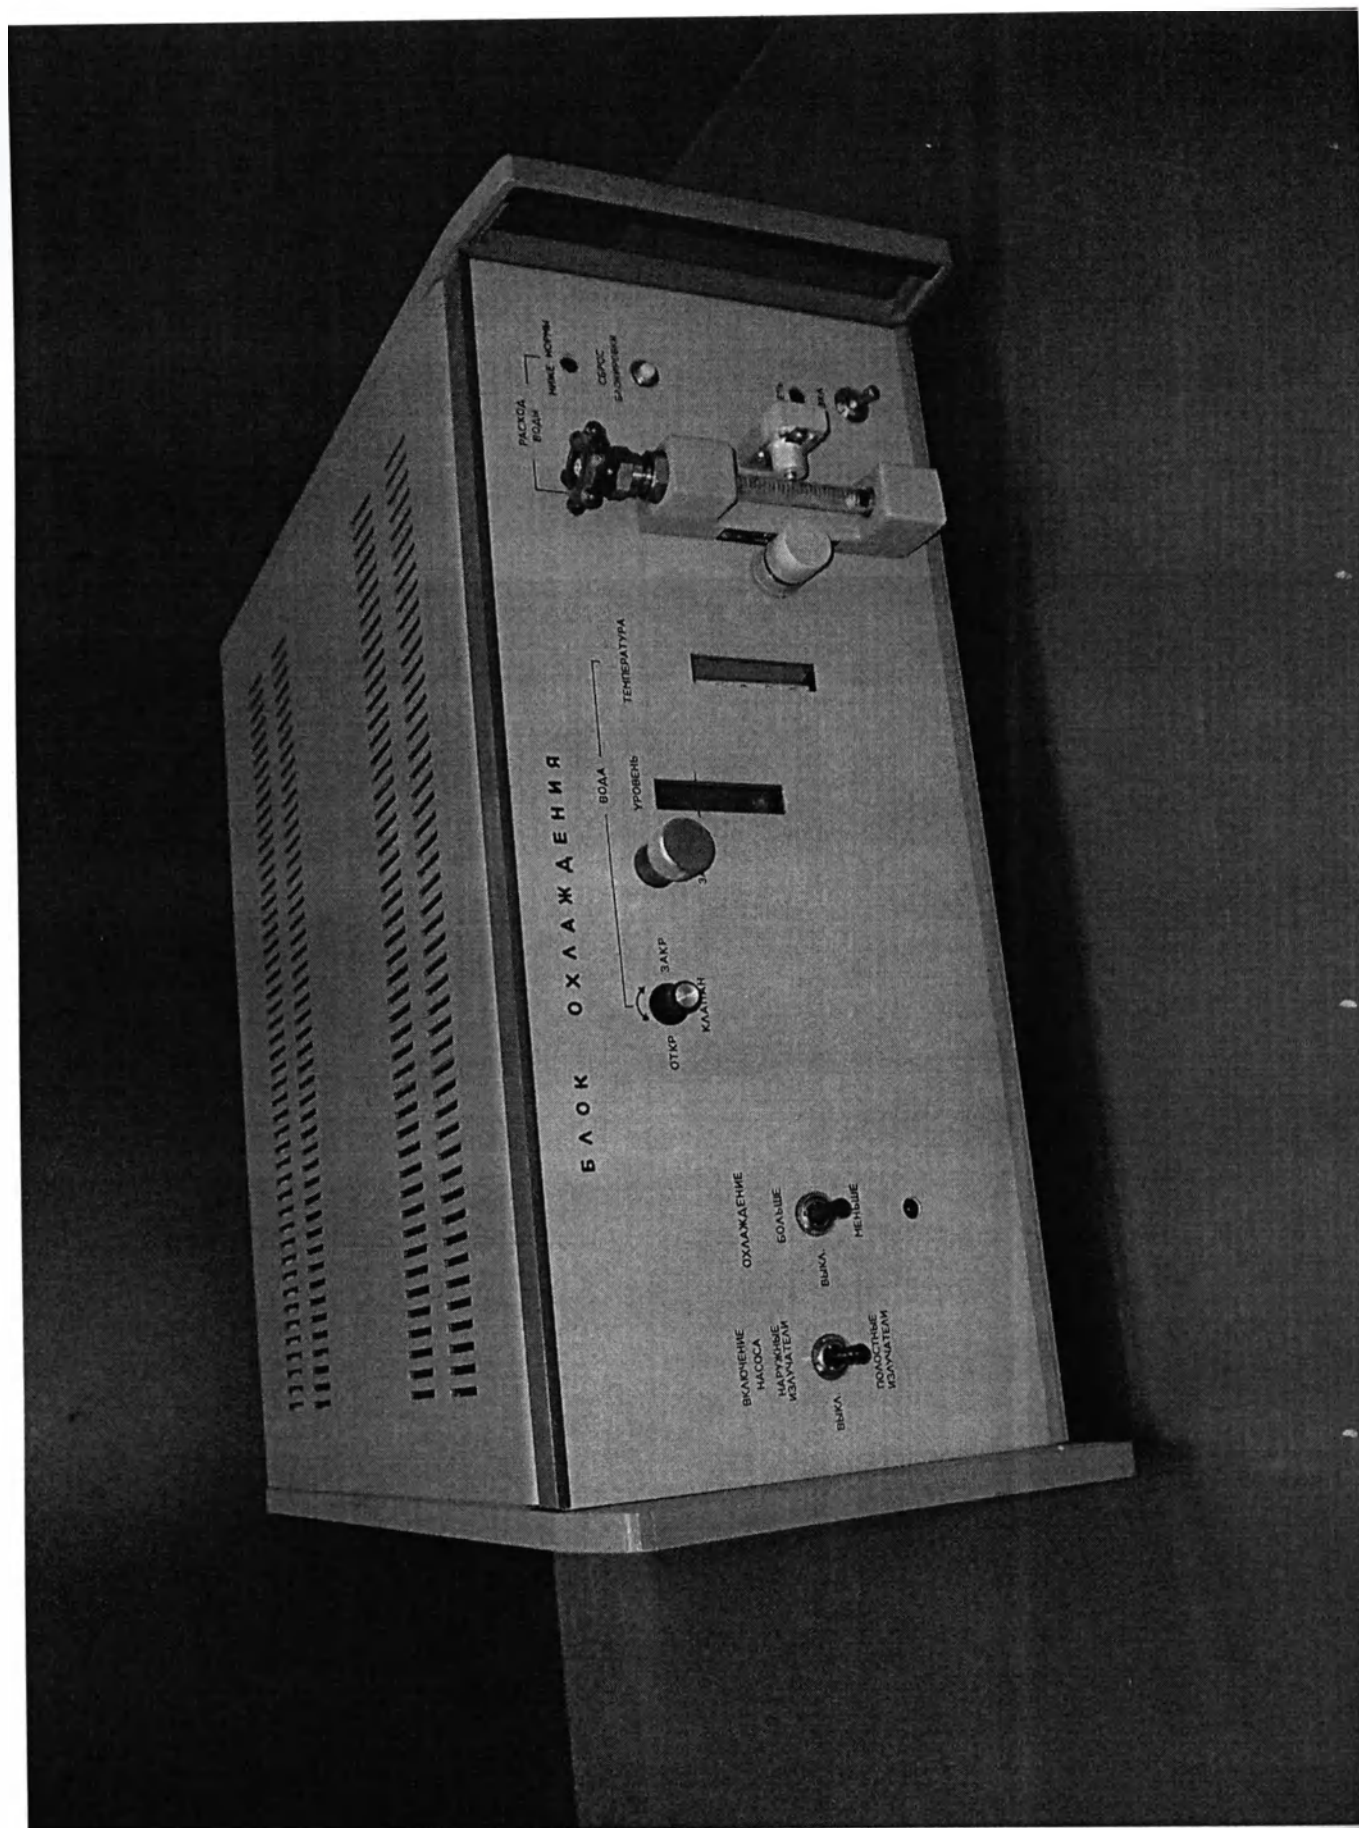


5. Блок регулятора напряжения

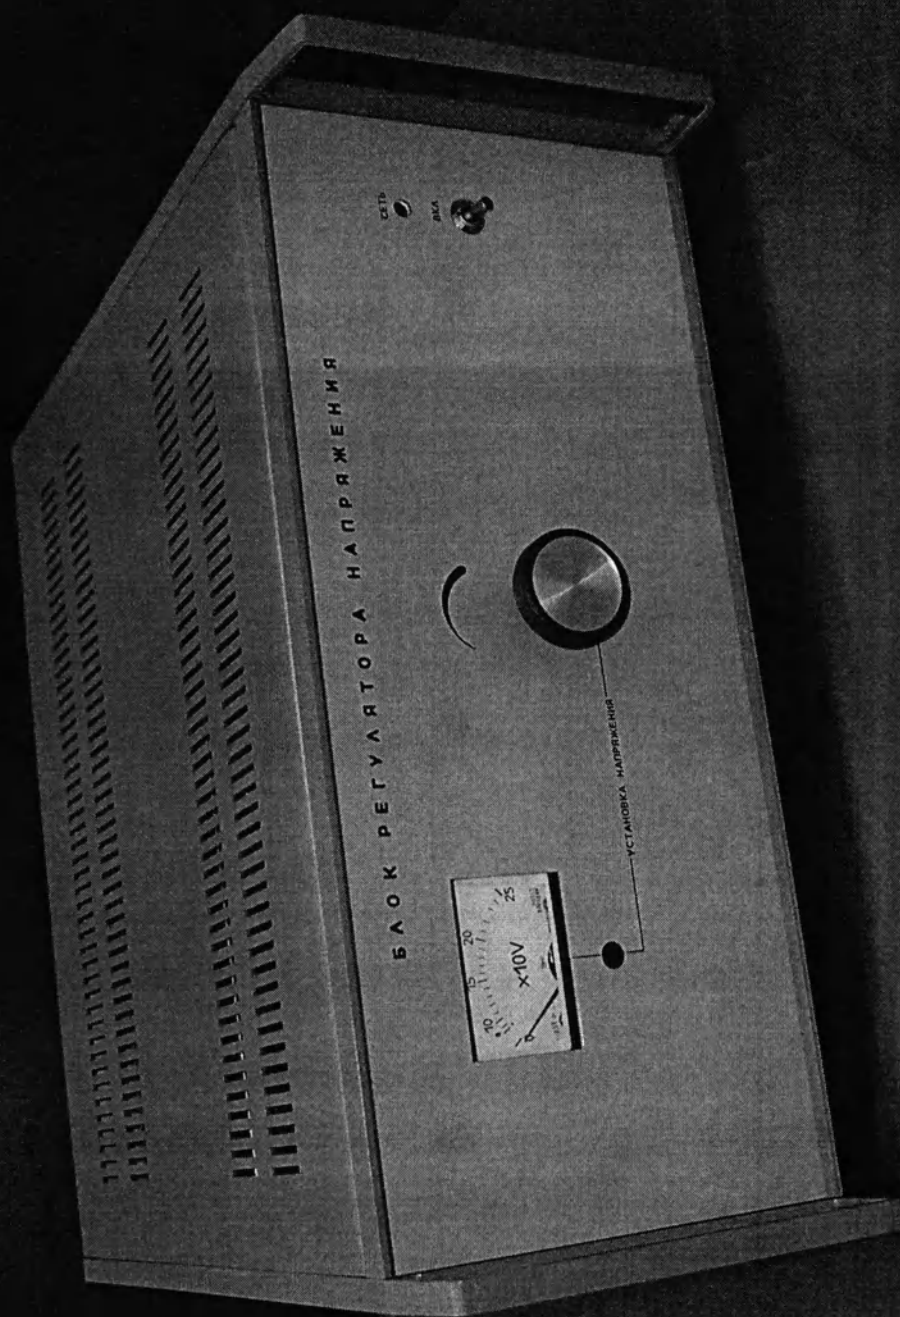


6. Блок-ящик для инструмента, ЗИП, и принадлежностей

7.

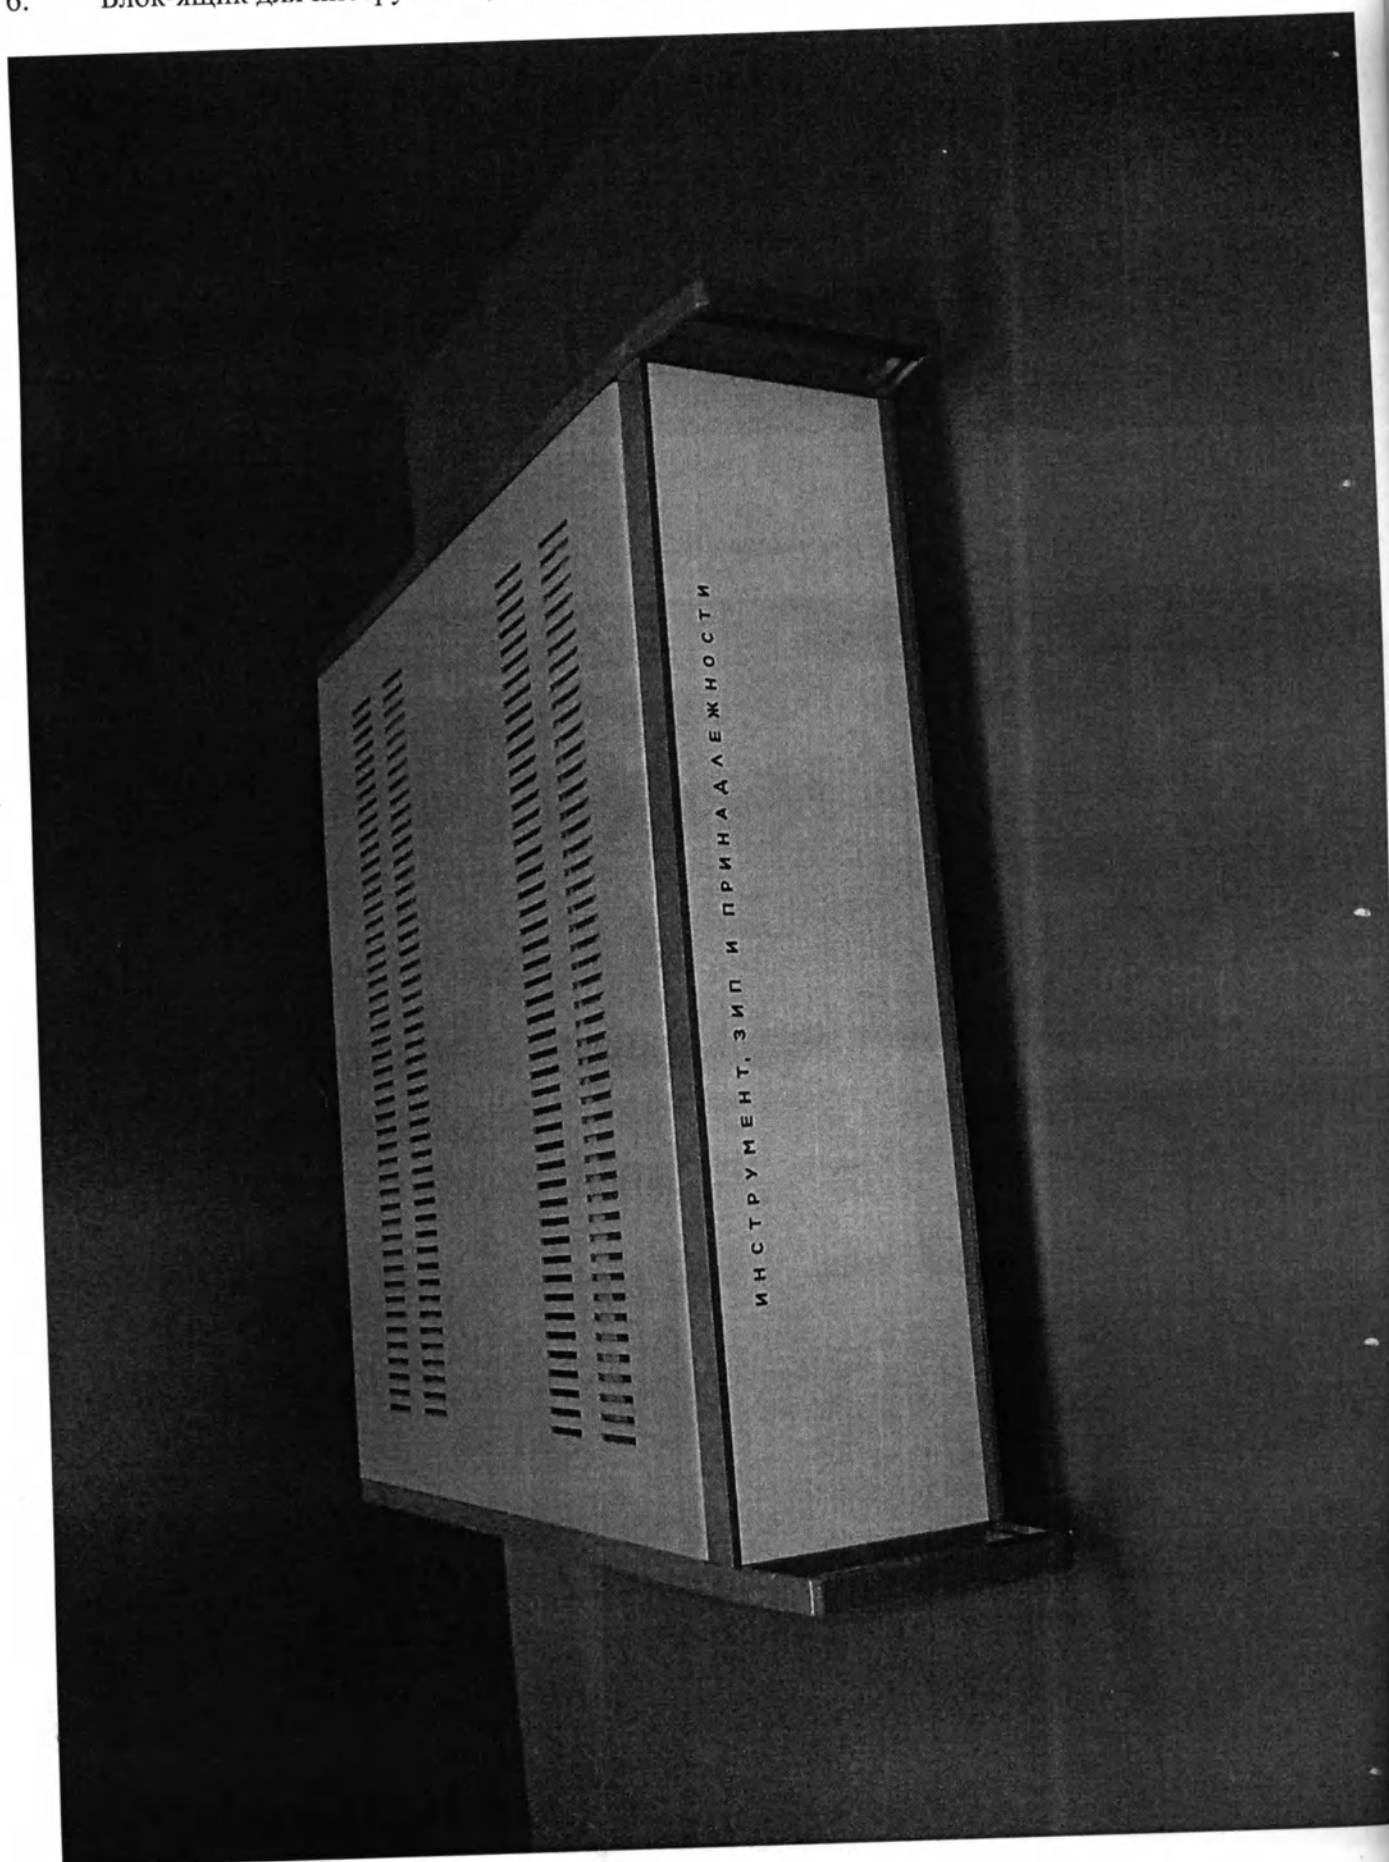

7. Манипулятор

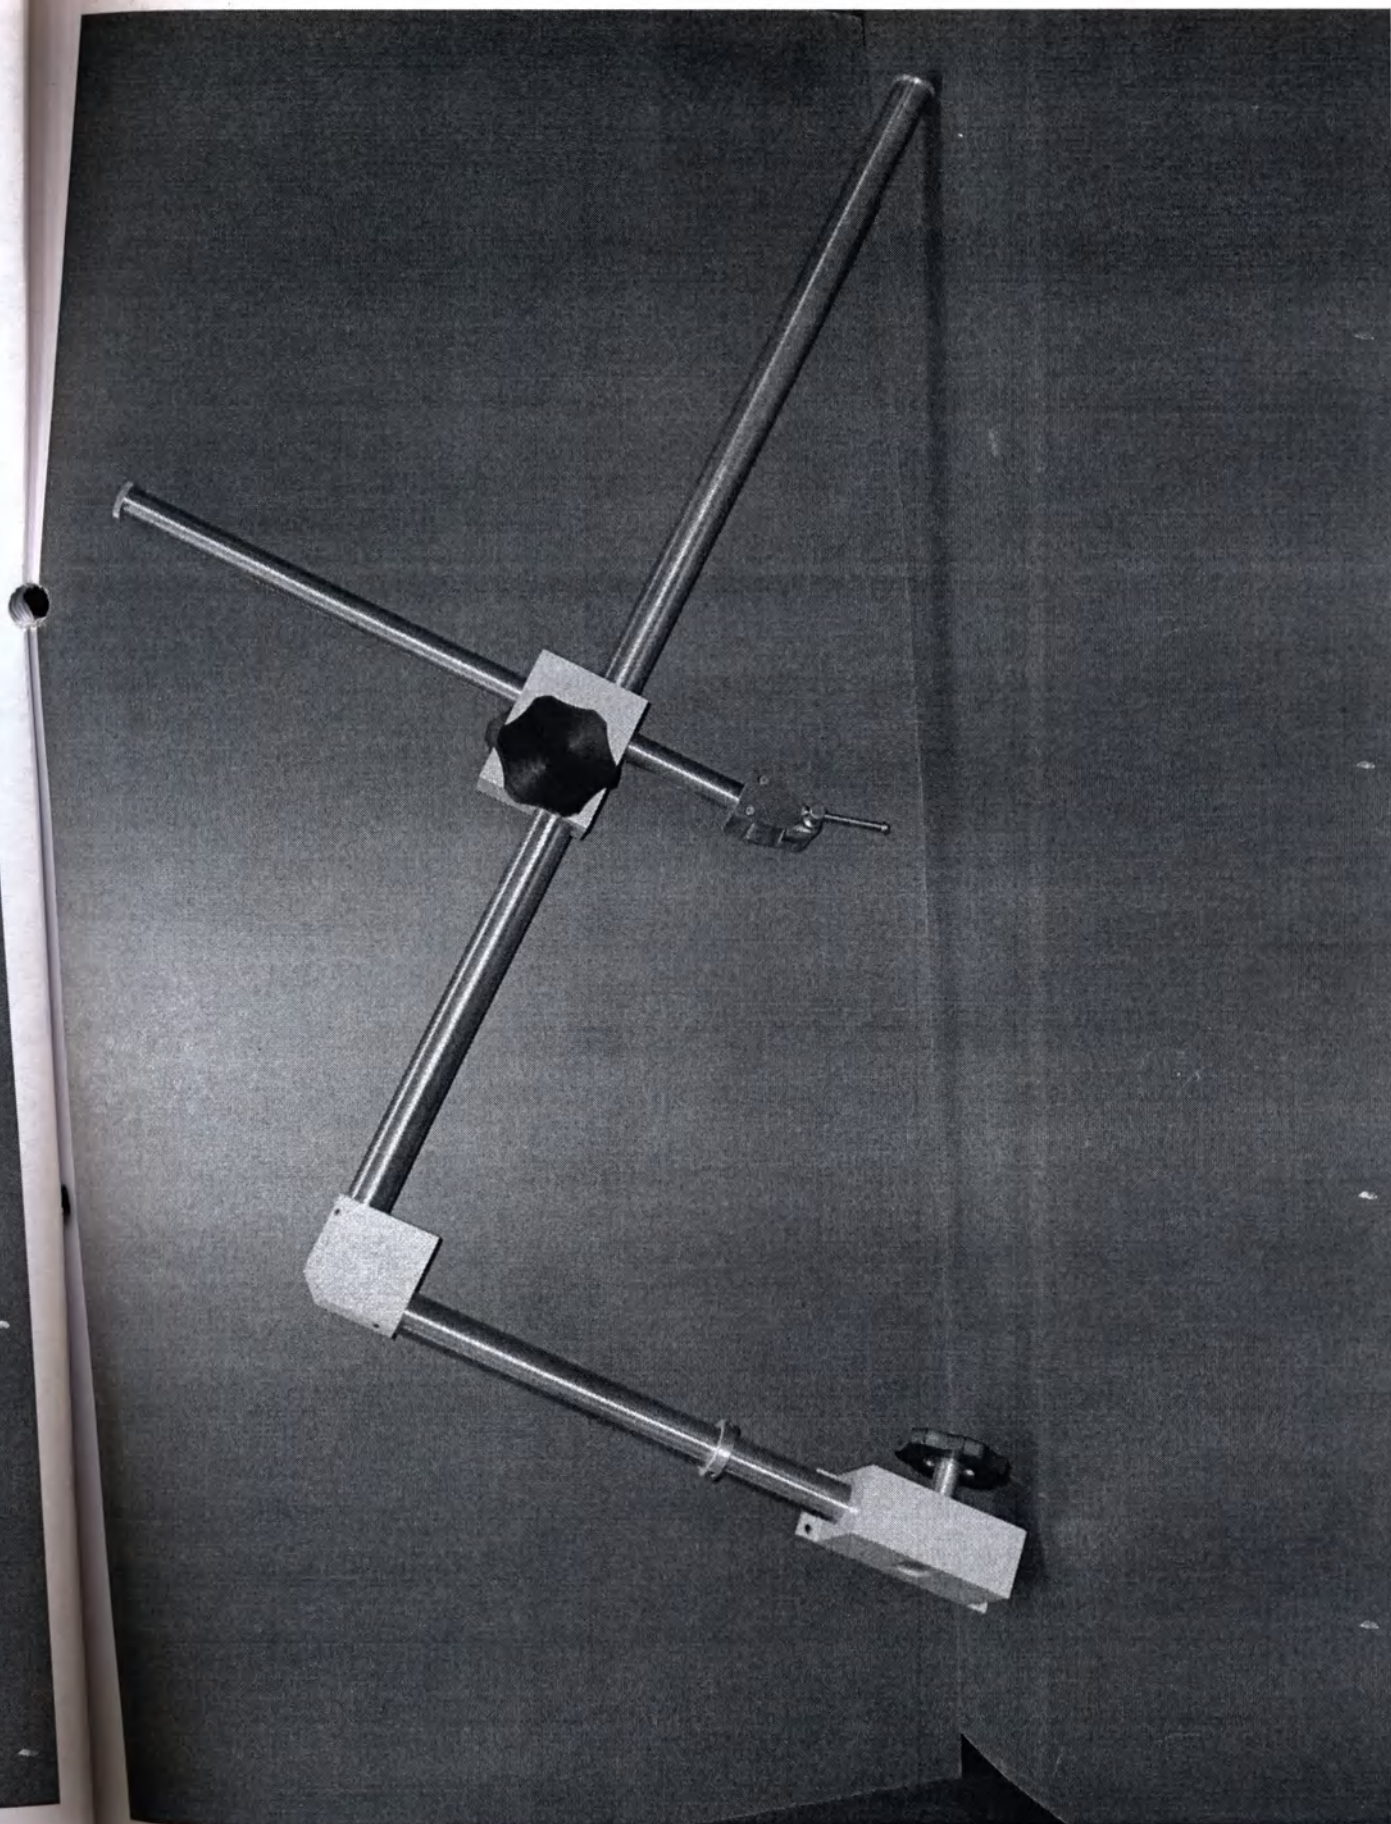

8. Стойка




II. Принадлежности:

1. Устройство термостатическое.



2. Излучатели: ЯЗ-2Н; ЯЗ-1Н; ЯЗ-4Н; ЯЗ-3Н

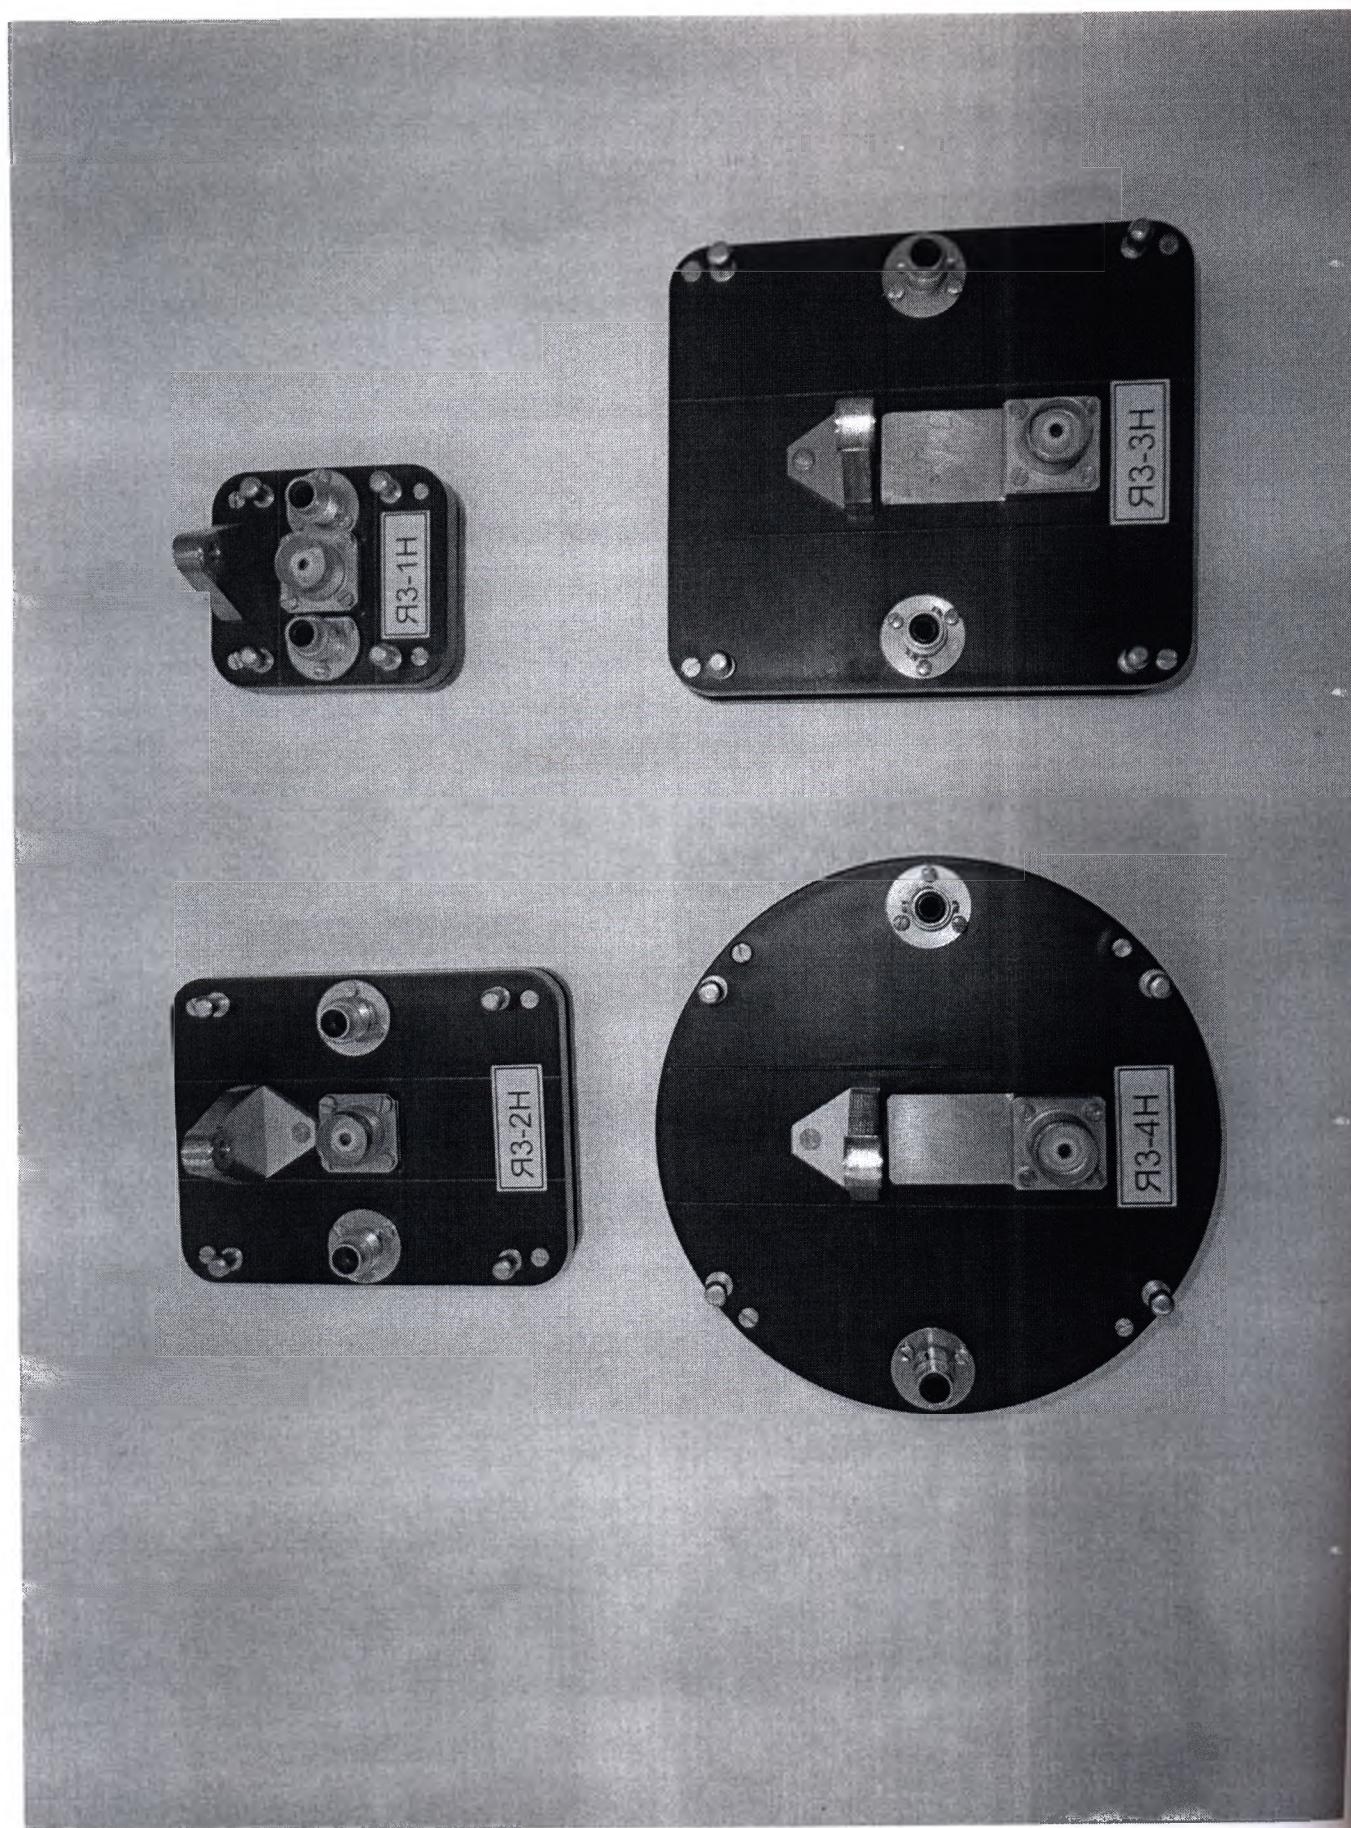


3. Излучатели: ЯЗ-1В; ЯЗ-2В; ЯЗ-6В; ЯЗ-5В; ЯЗ-4В; ЯЗ-3В




4. Датчик температуры: игольчатый - 3 шт; катеторный - 3 шт

5.

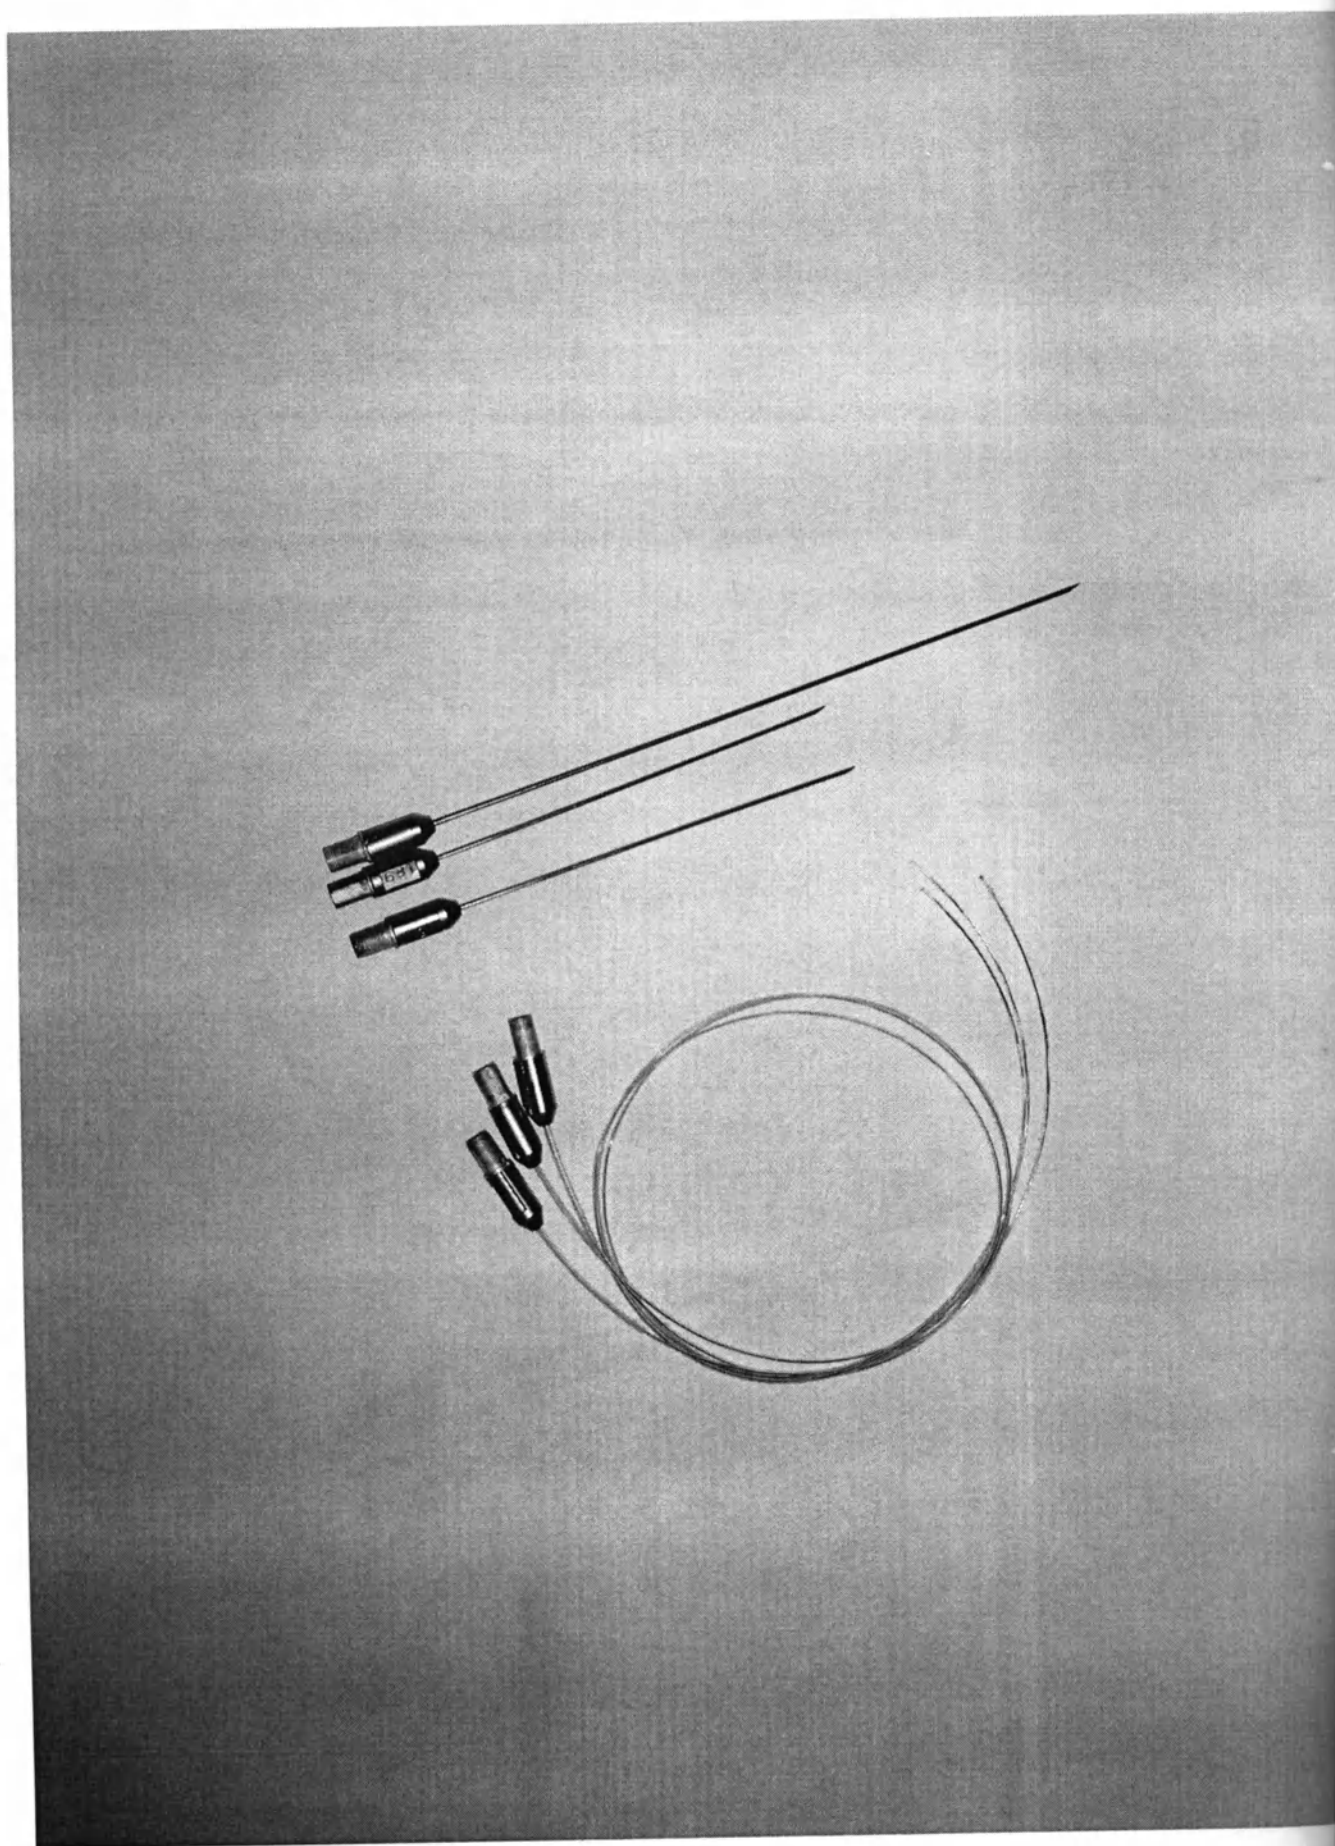


5. Воронка

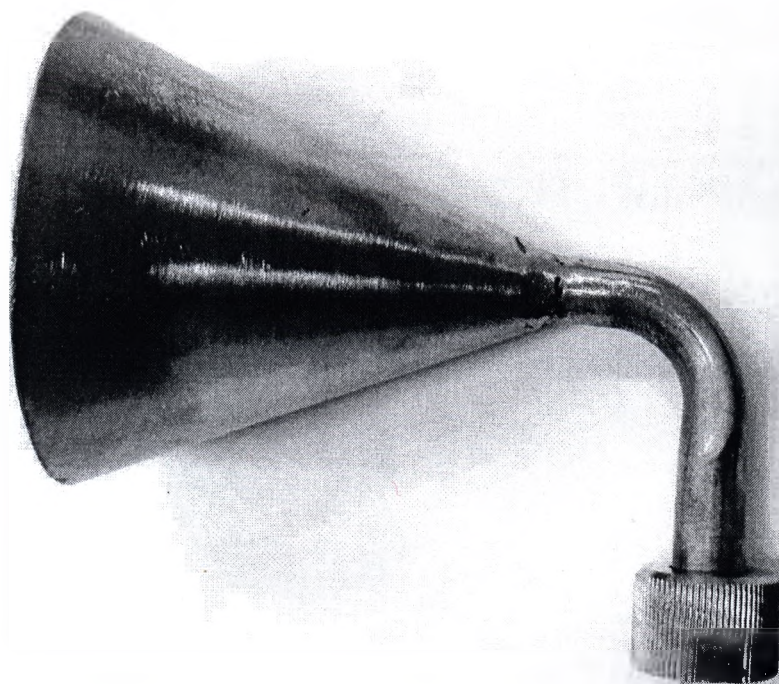


III. Монтажные части:


1. Кабель №1 – 3шт

2.

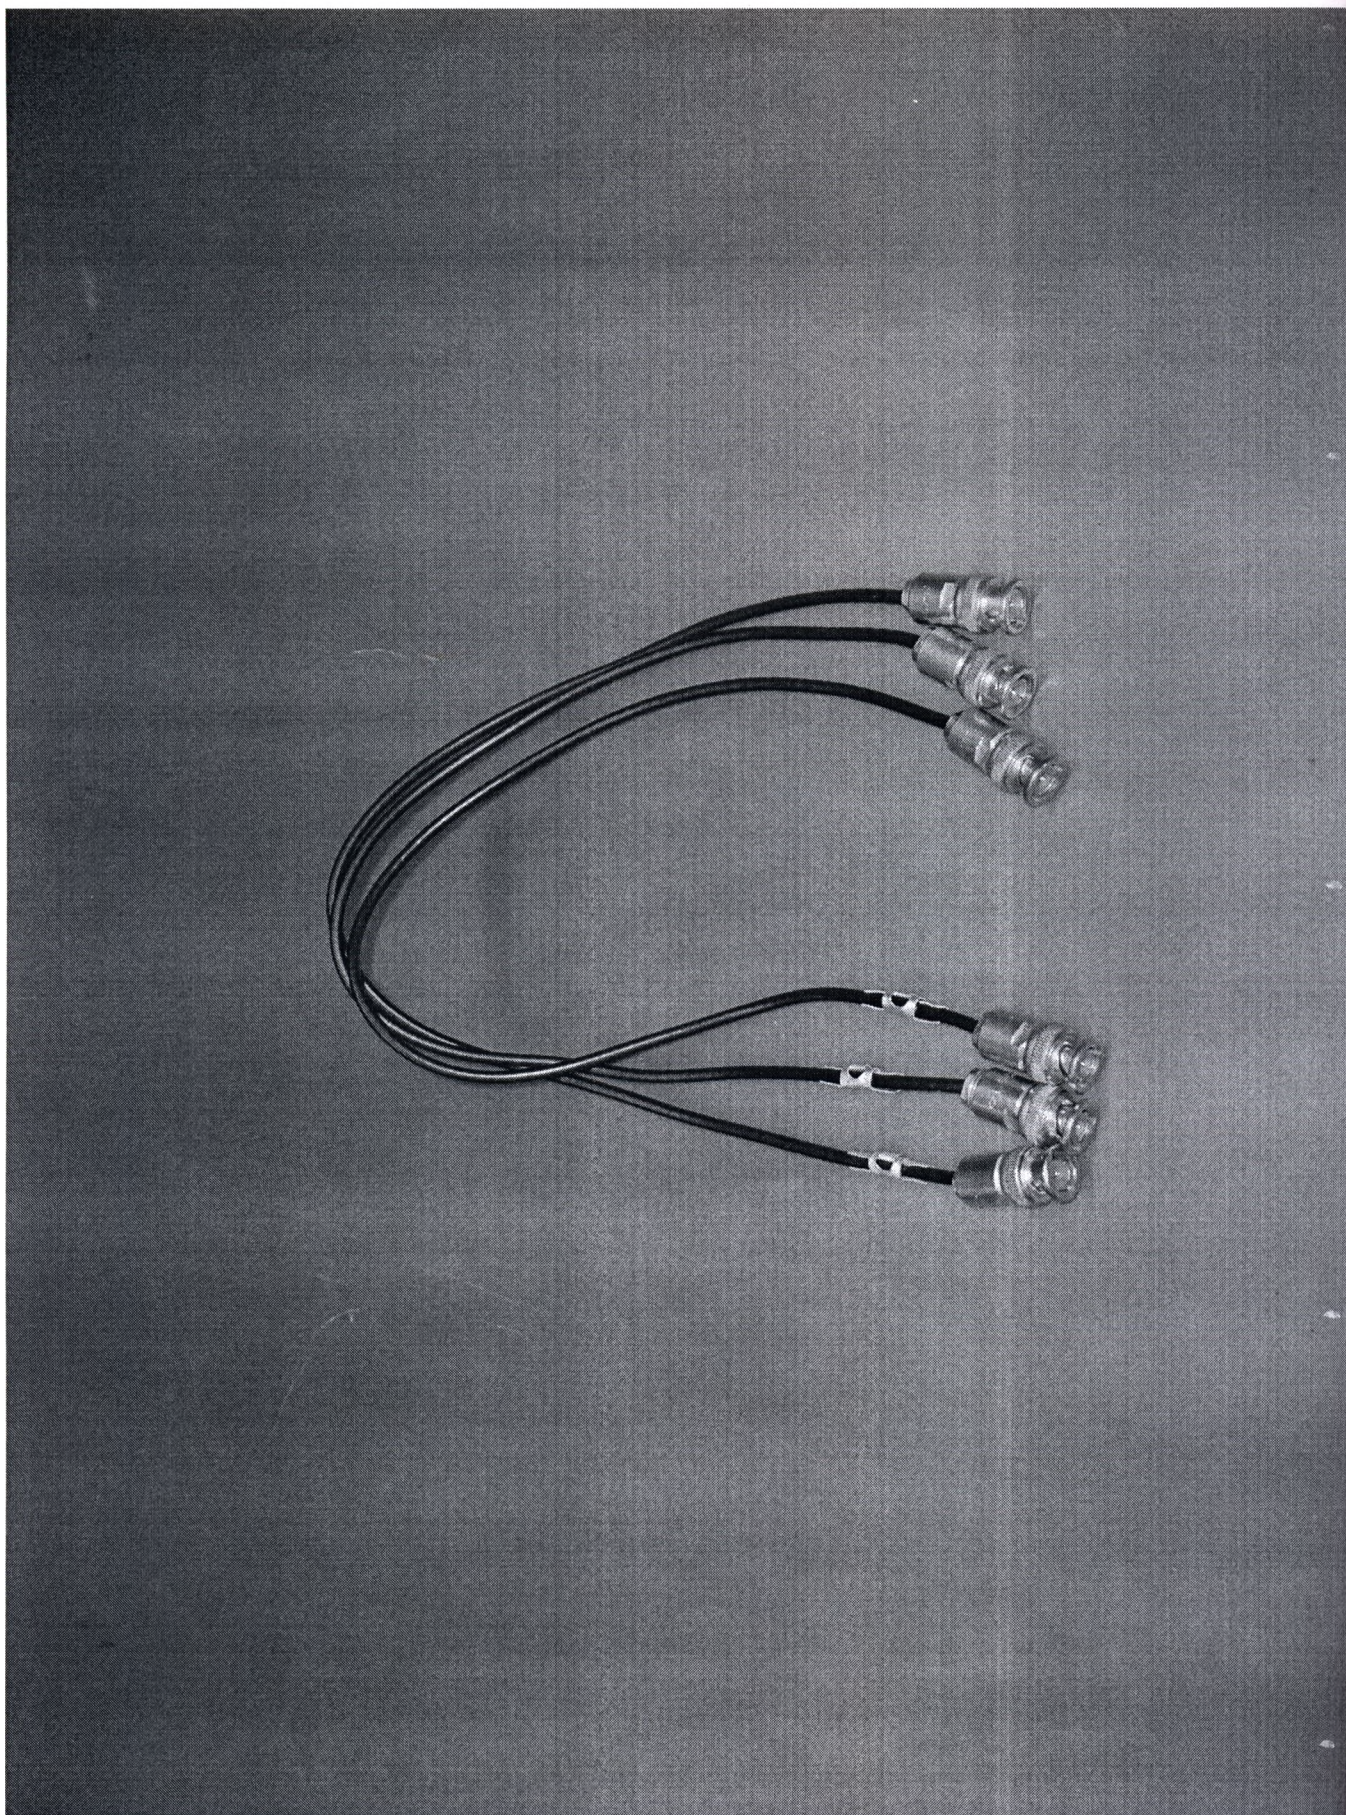


2. Кабель №2

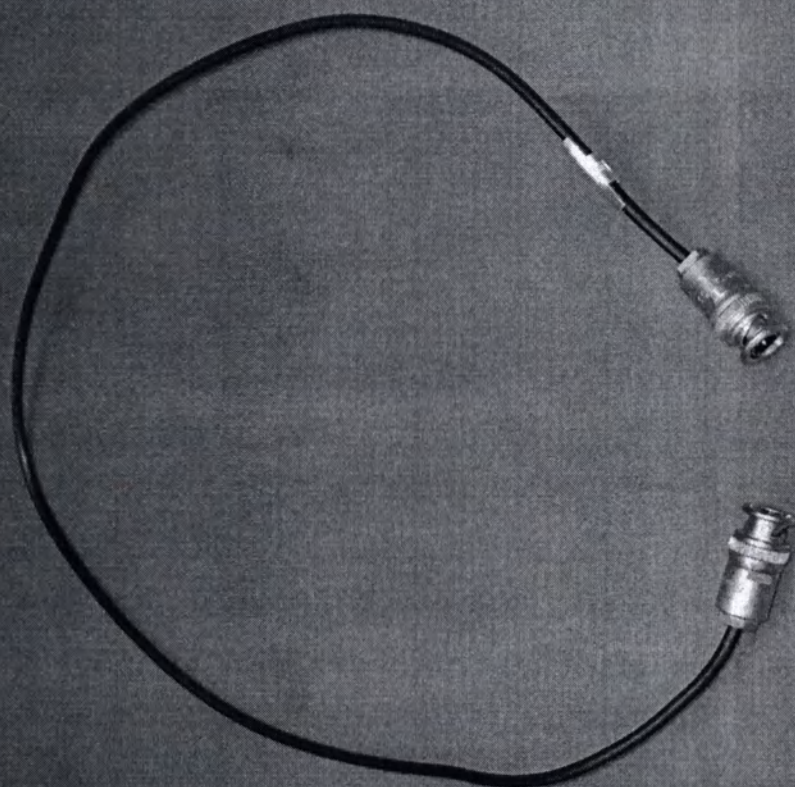

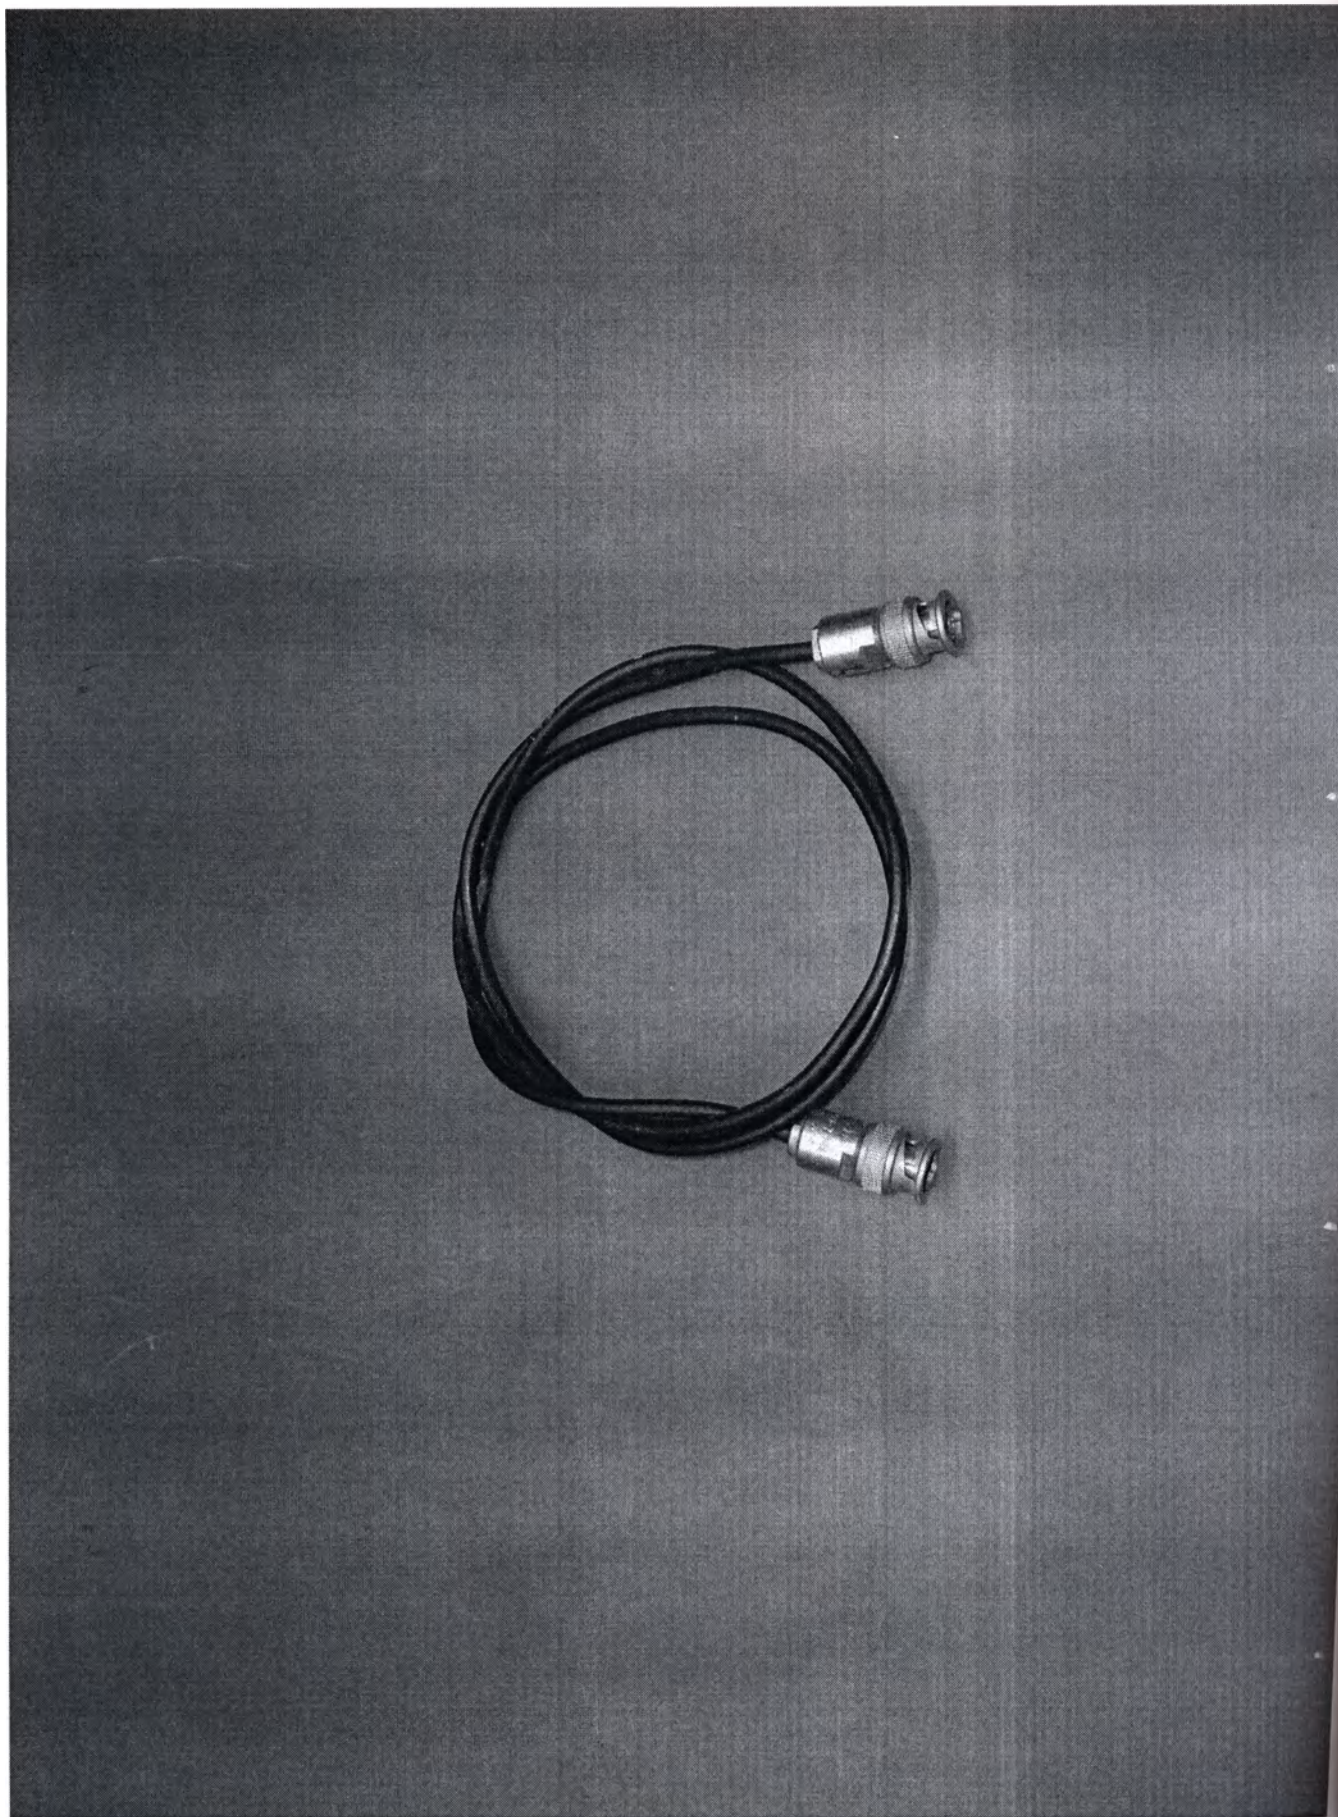



4. Кабель №4

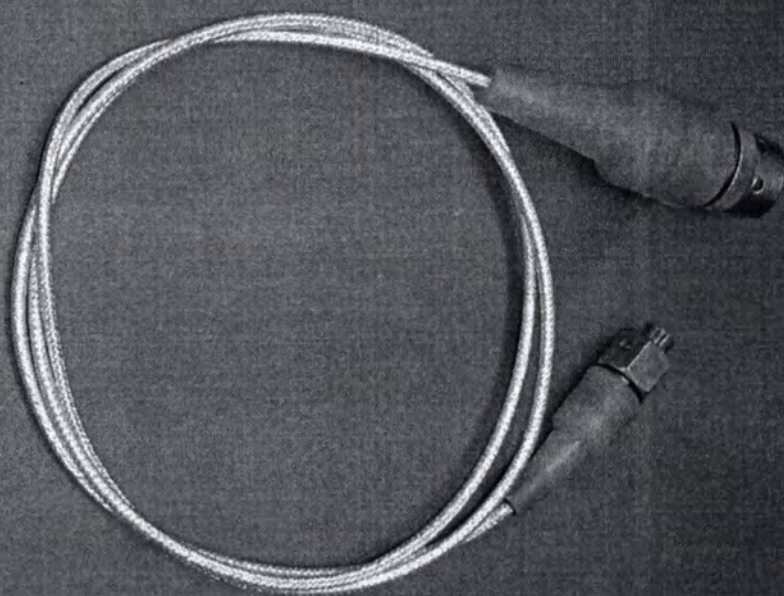

5. Кабель №5 – 3шт


6. Ка

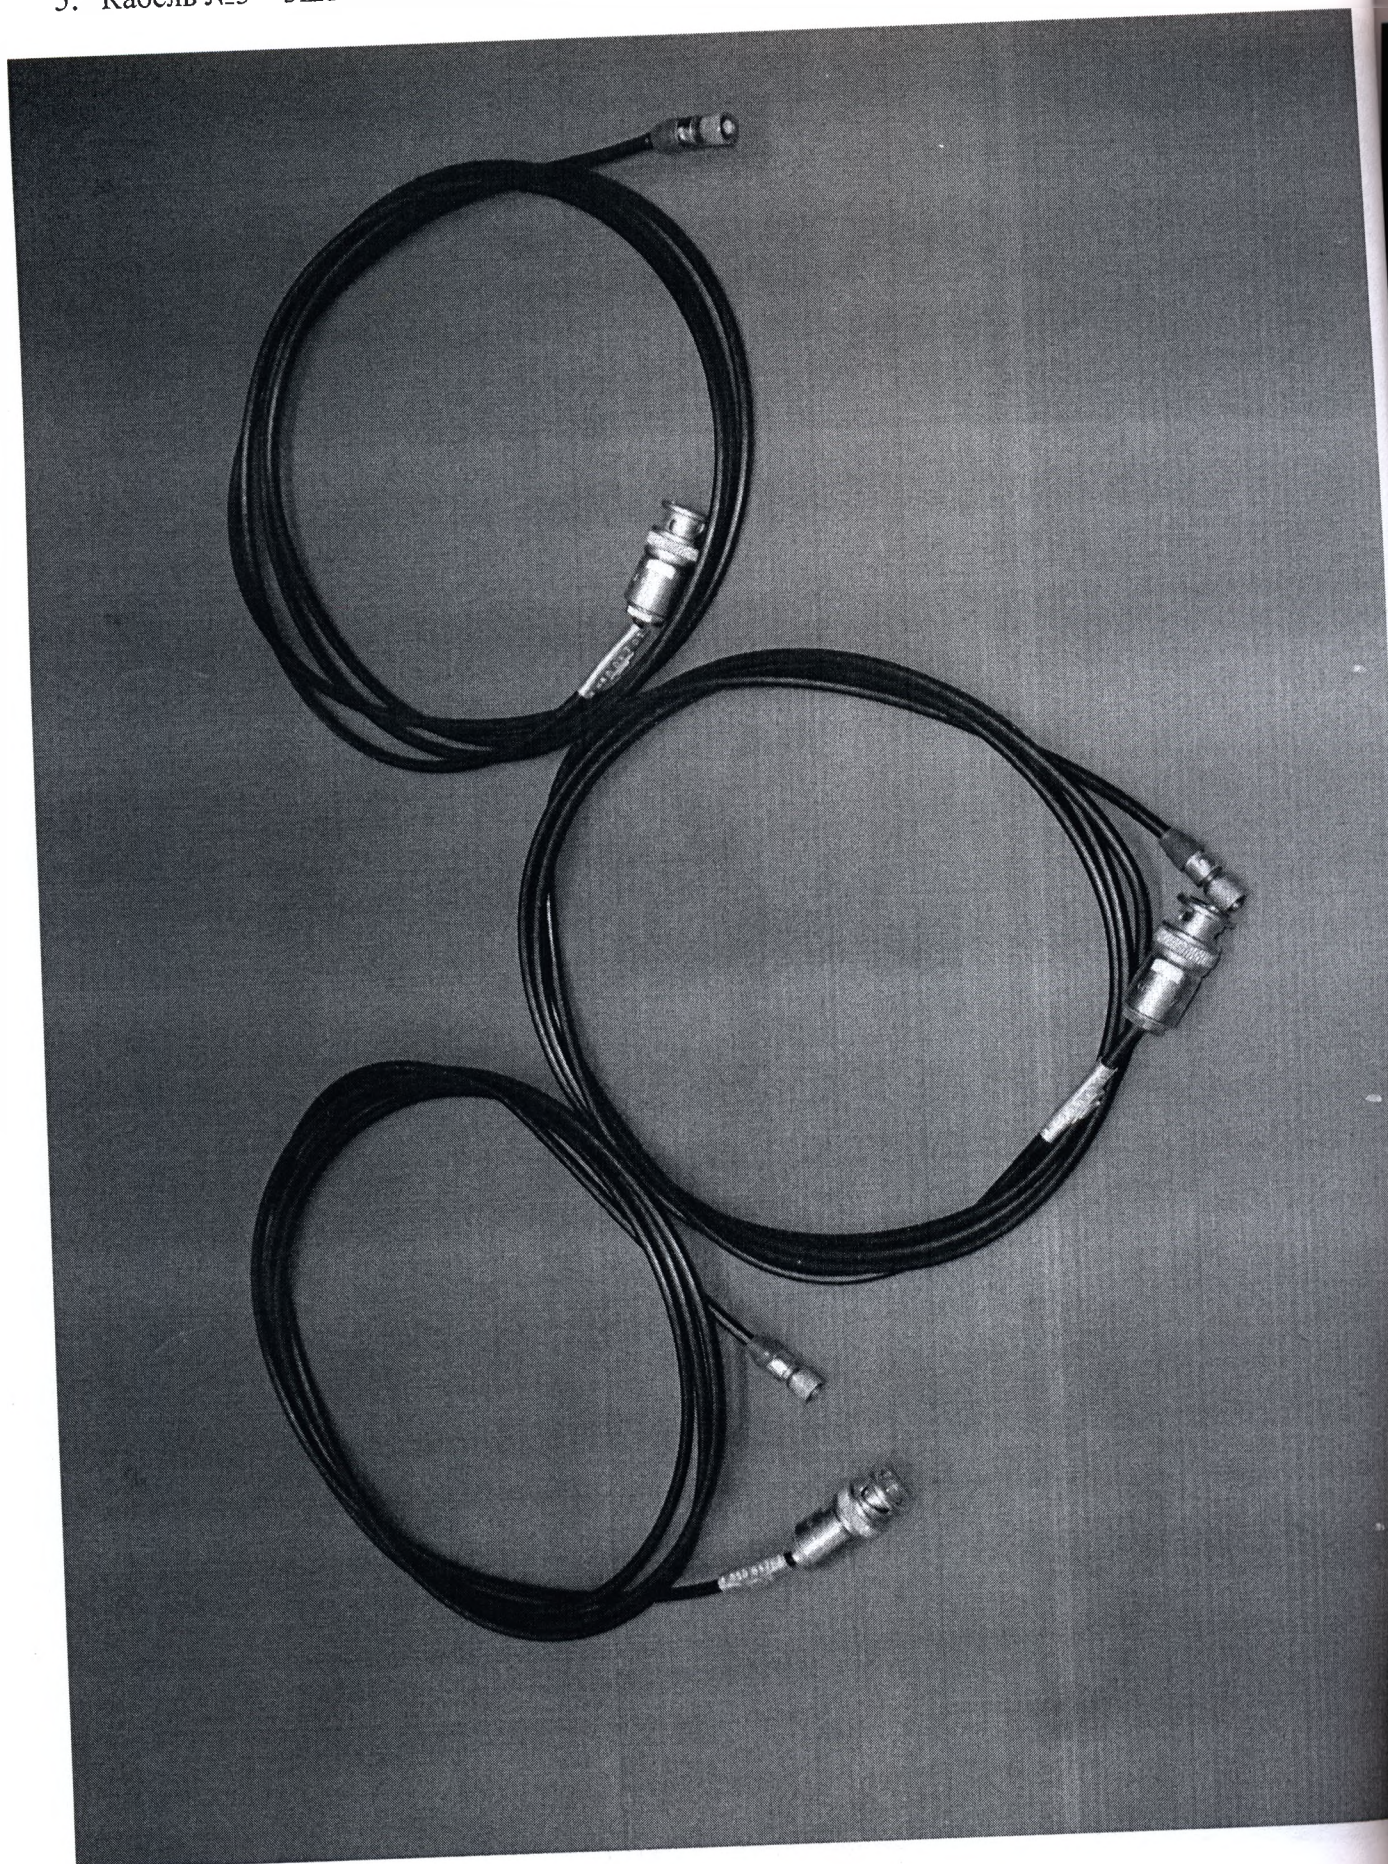


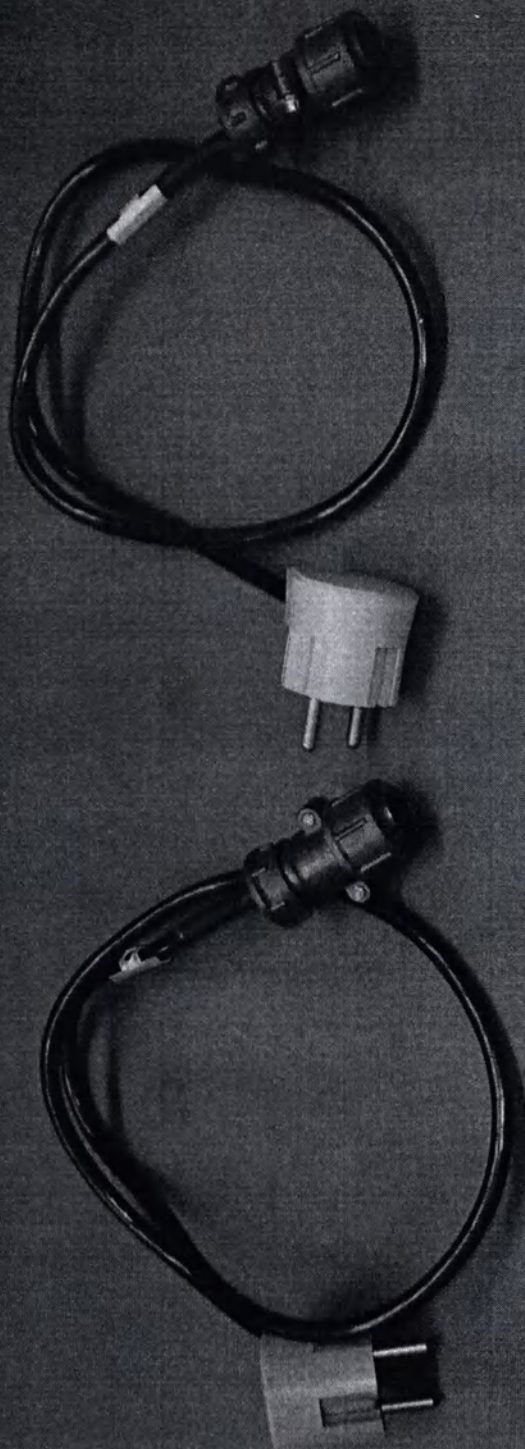


7. Кабель №7


8. Кабе

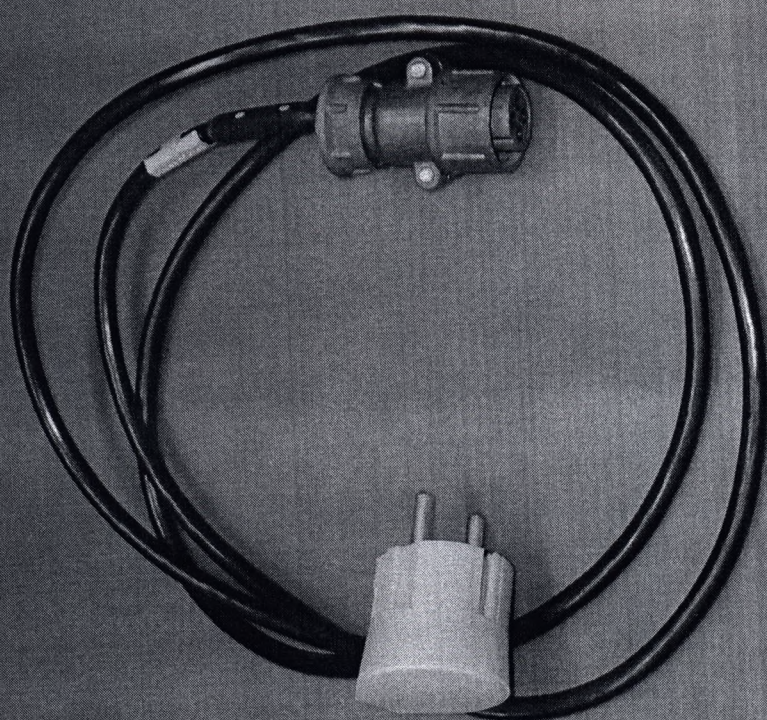


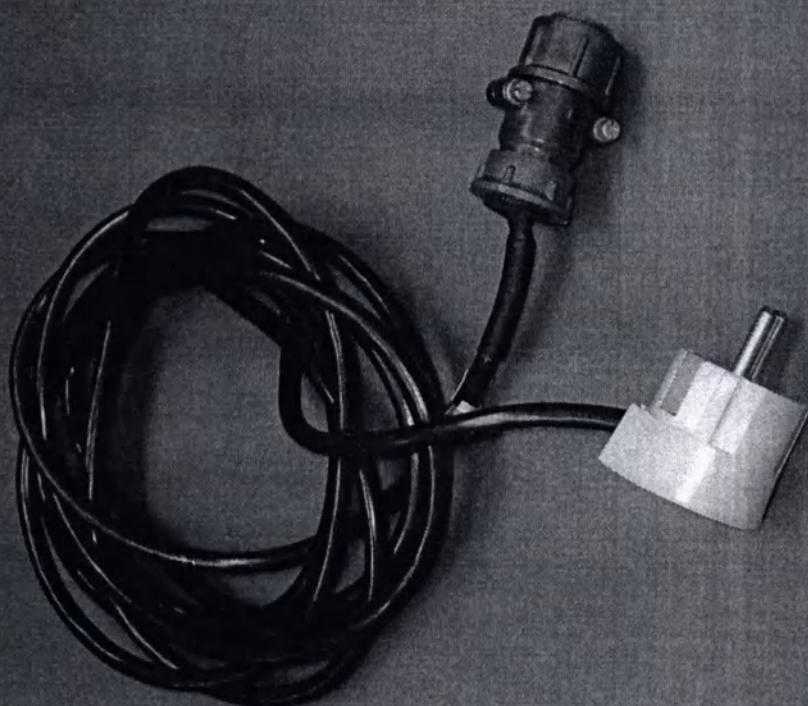

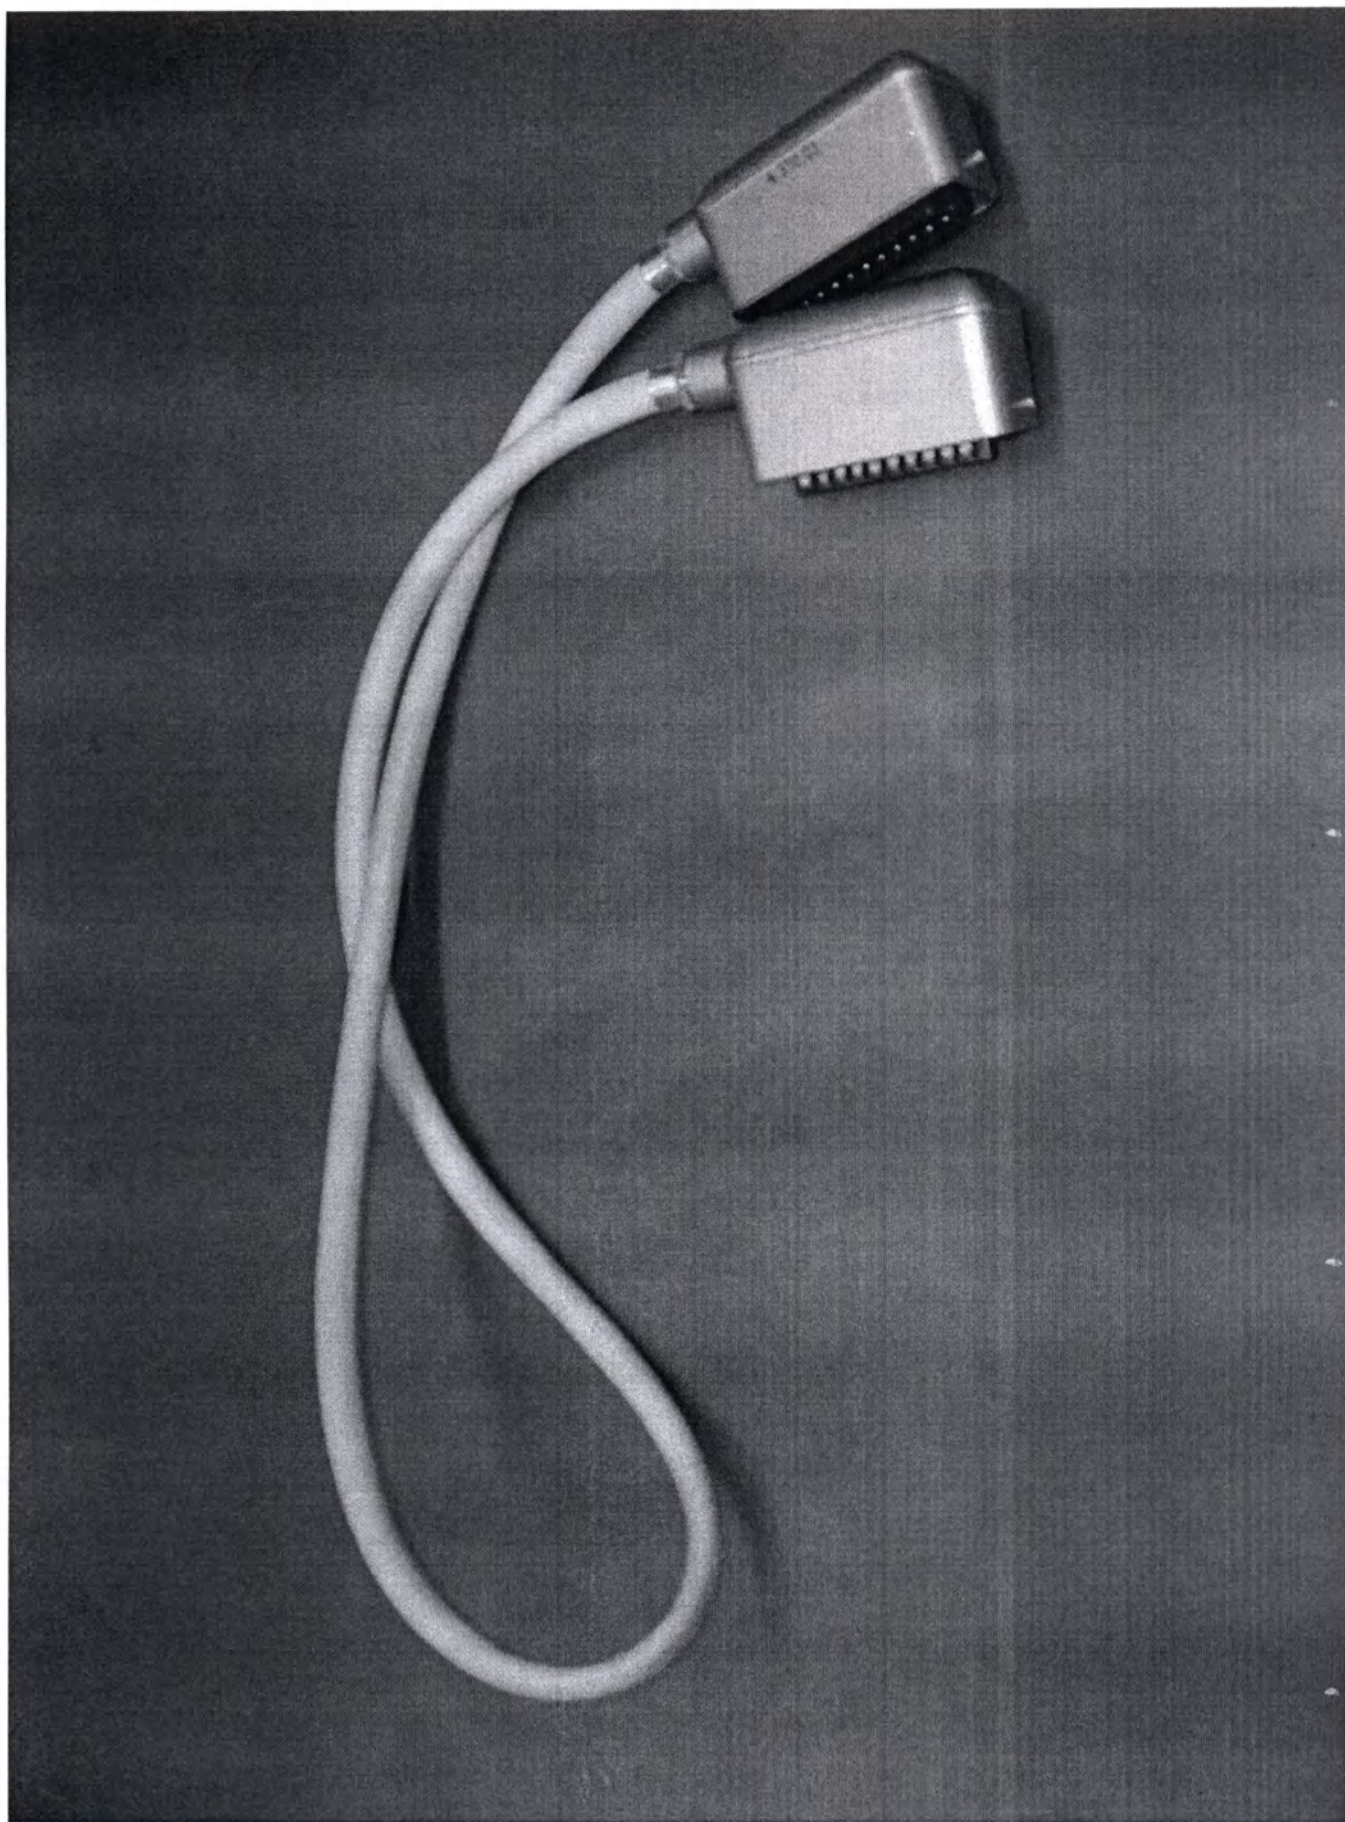

10. Кабель №10

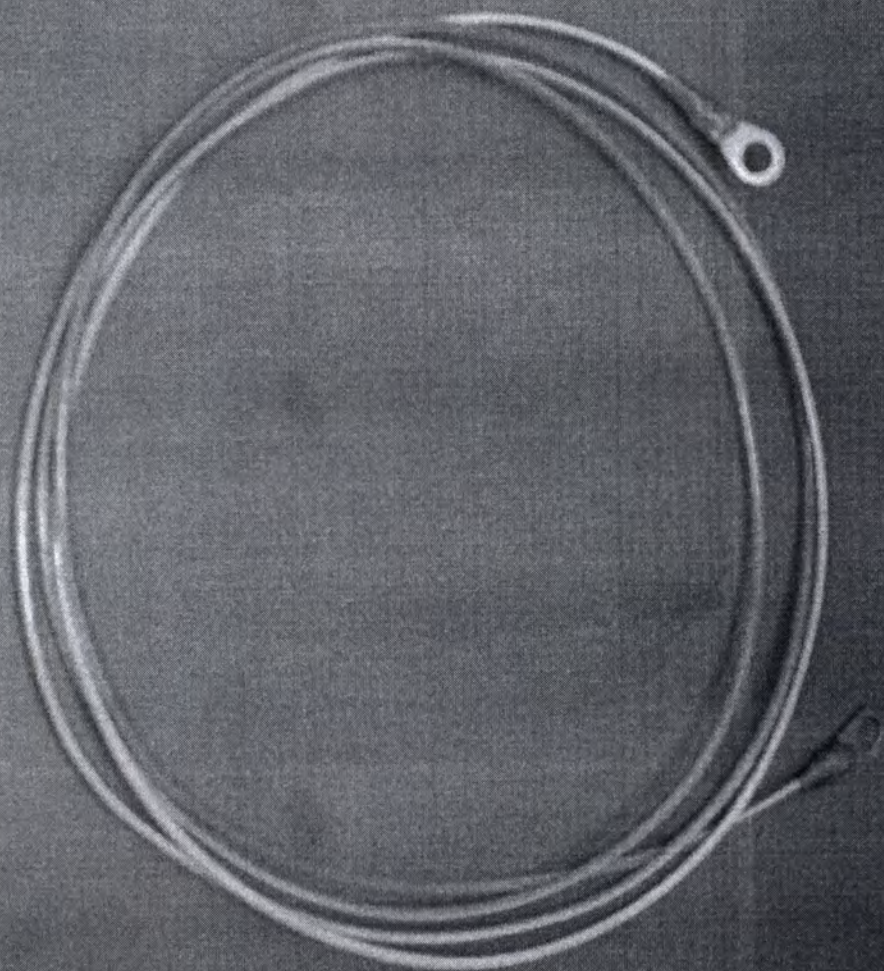


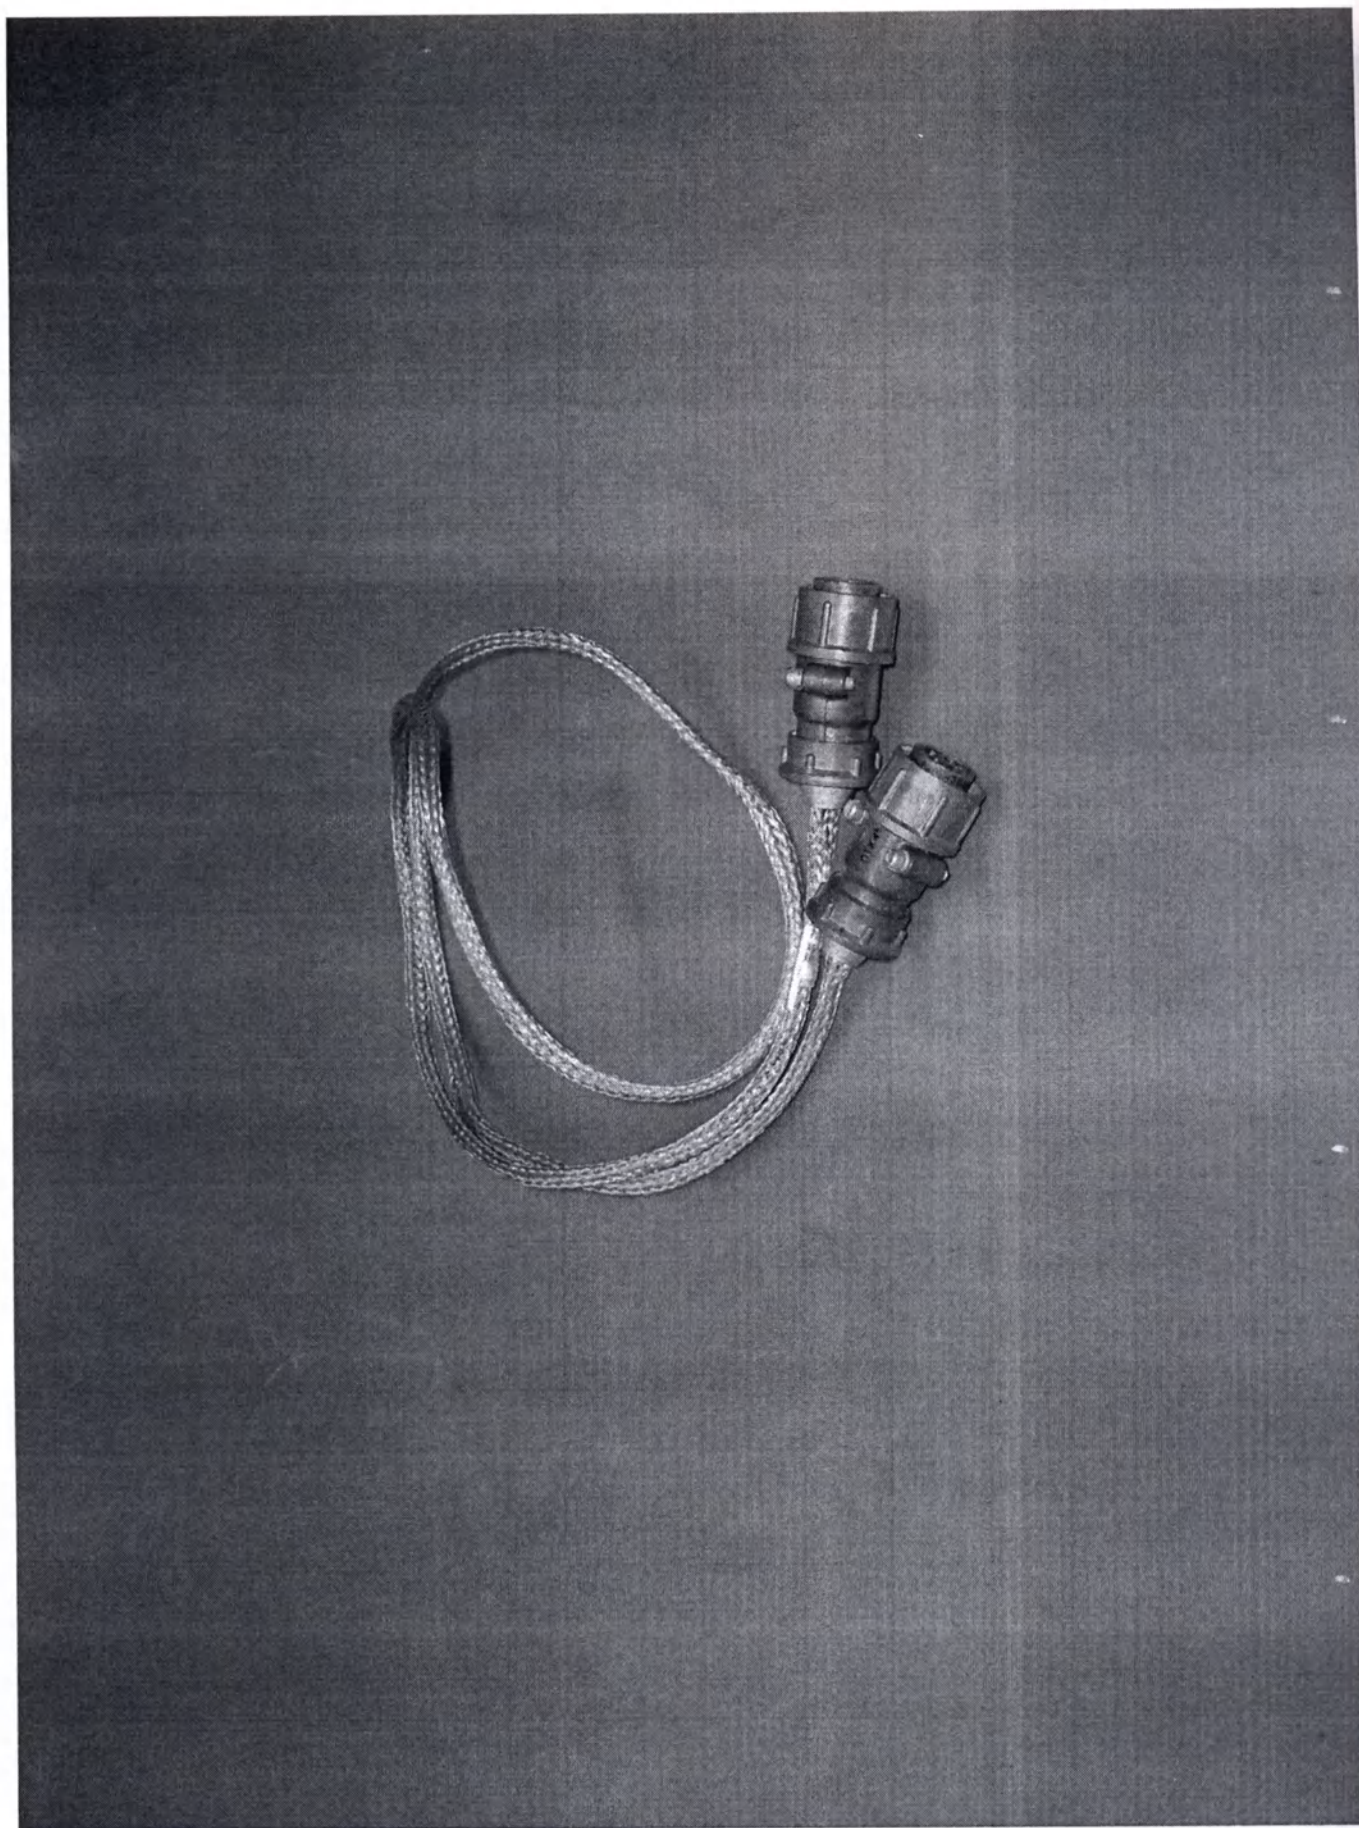






14. Кабель №14

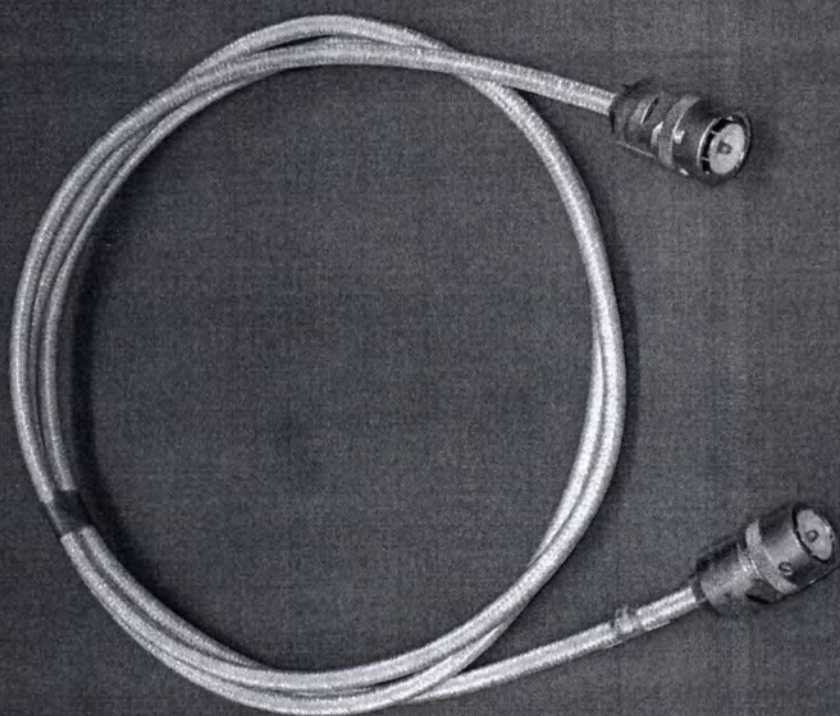

IV. Запасные части:
Светодиод АЛ307БМ

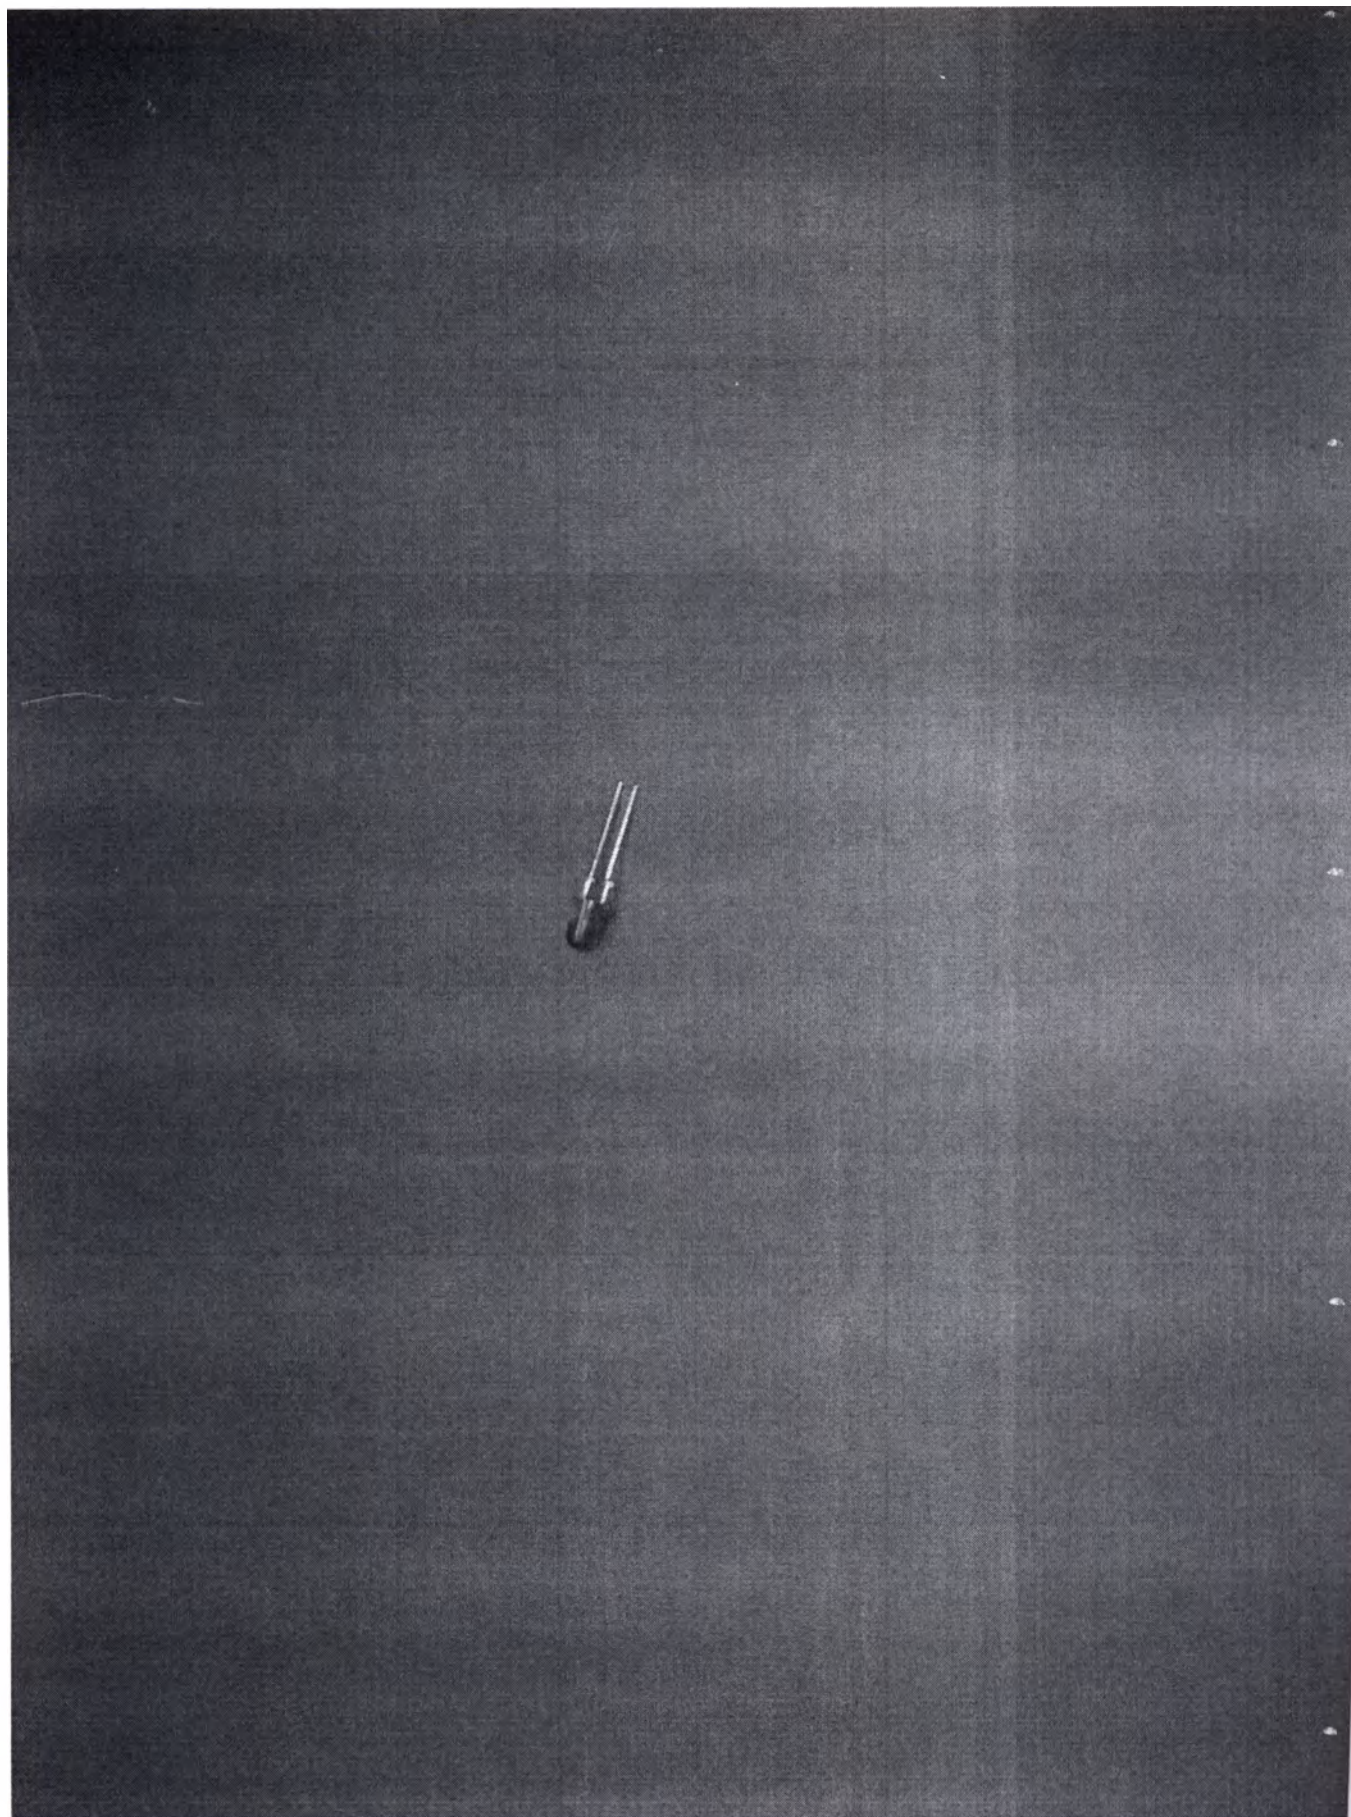

Копия верна.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

17 лист

Начальник лаборатории НПК-2
АО «НПП «Исток» им. Шокина»,
главный конструктор установок
«Яхта»

Мазохин В.Н.

«17» 12 2015г.

М.П.