




DTE

Лампа полимеризационная серии DTE, модель LUX I



18.03.2015

SN

L1530002X1

CE




«Гуилин Вудпекер Медикал Инструмент Ко., Лтд.», (Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.), Китай

Адрес: Information Industrial Park, National High-Tech Zone, Guilin, Guangxi 541004, China /


Тел: + 86-773-5855350, Факс: + 86-773-5822450


E-mail: woodpecker@glwoodpecker.com sales@glwoodpecker.com

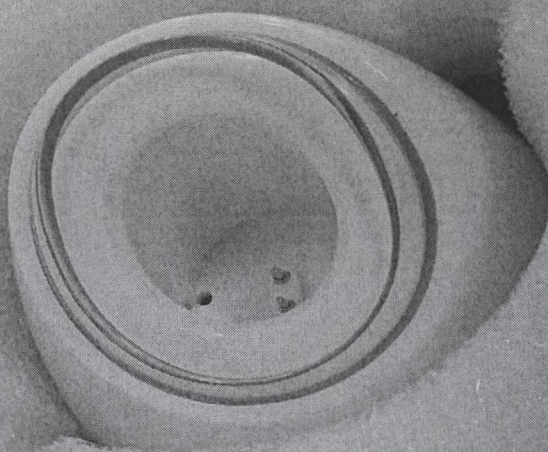


Насадка на
основной блок
сменная
одноразовая

Количество (50 шт.)



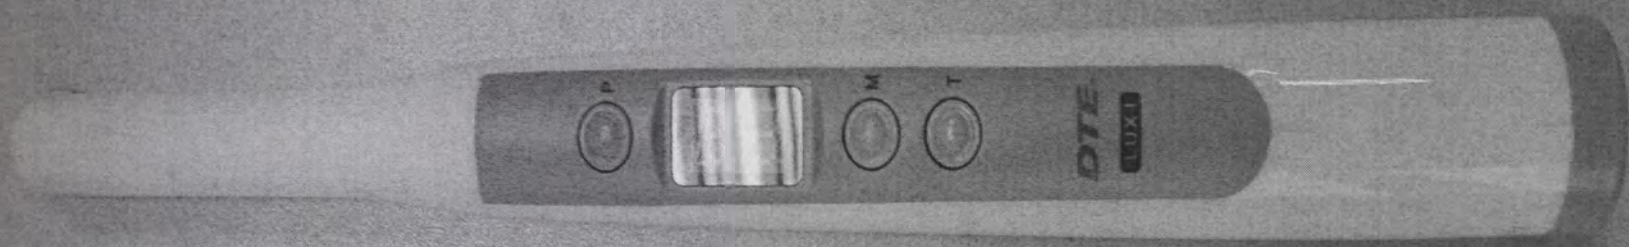


DTE

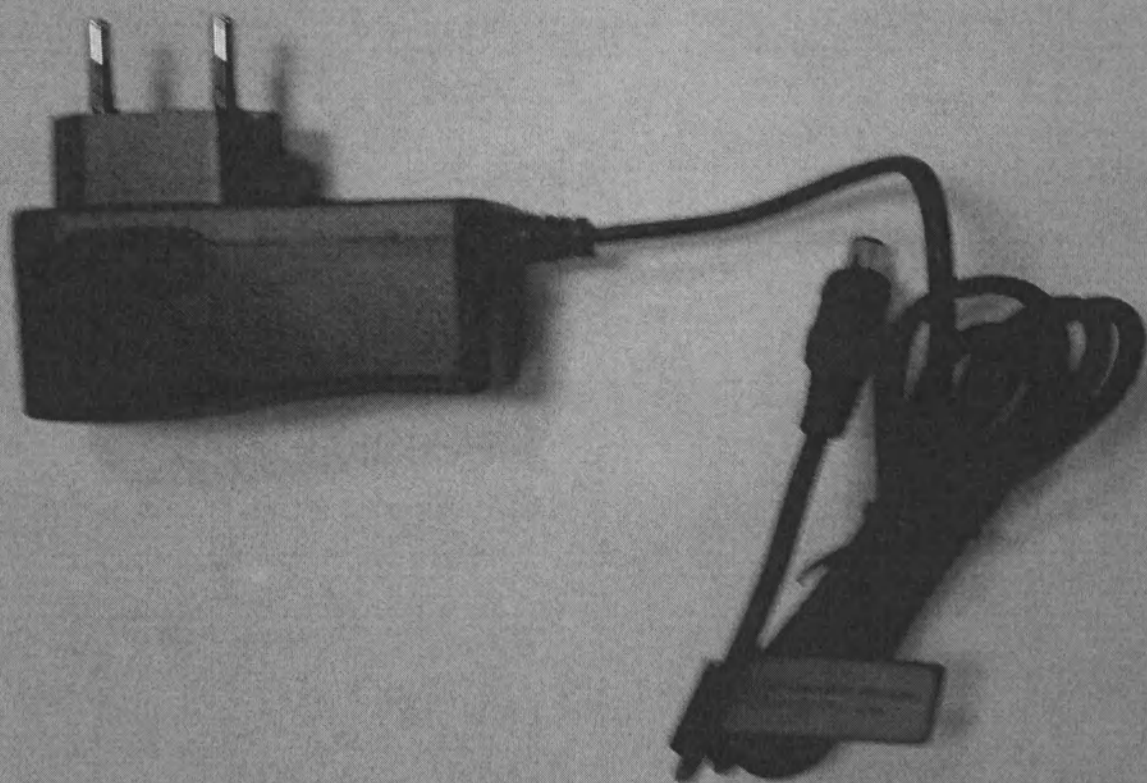




**Насадка на
основной блок
сменная
одноразовая**

Количество (50 шт.)

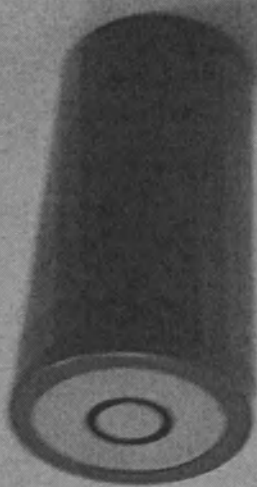

DTE

Инструкция по эксплуатации
Лампа полимеризационная серии
DTE, модель LUX I

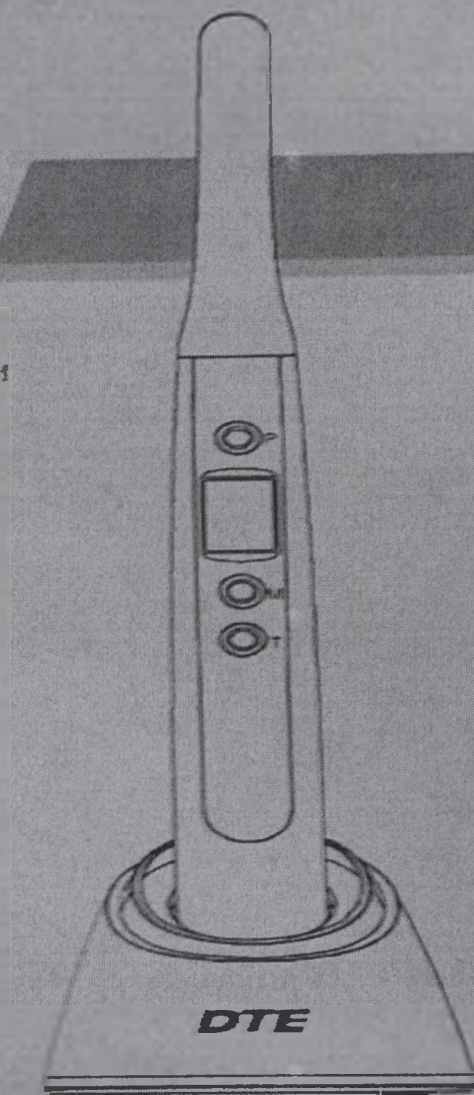

Пожалуйста, прочтите данную инструкцию перед началом работы

Гуилин Вудпекер Медикал Инструмент Ко., Лтд
(Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.)

DTE

Лампа полимеризационная серии DTE, модель LUX VI



08.06.2015

SN

L1370107X6

CE




«Гуилин Вудпекер Медикал Инструмент Ко., Лтд.», (Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.), Китай


Адрес: Information Industrial Park, National High-Tech Zone, Guilin, Guangxi 541004, China /


Тел: + 86-773-5855350, Факс: + 86-773-5822450


E-mail: woodpecker@glwoodpecker.com sales@glwoodpecker.com



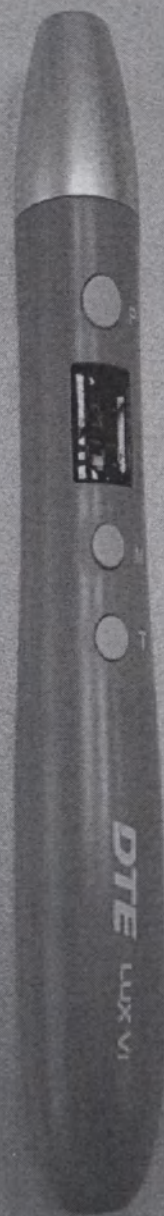

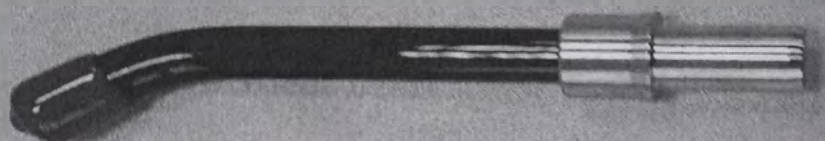

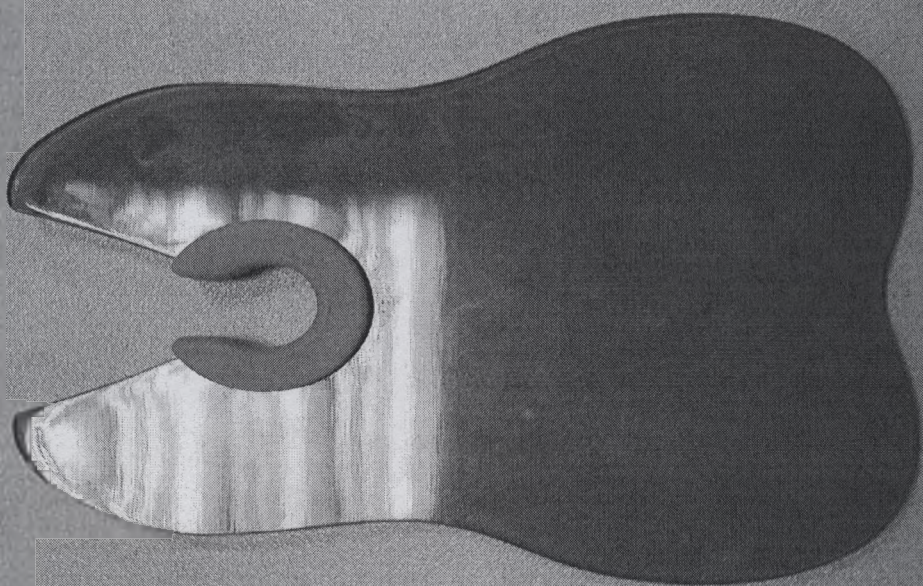


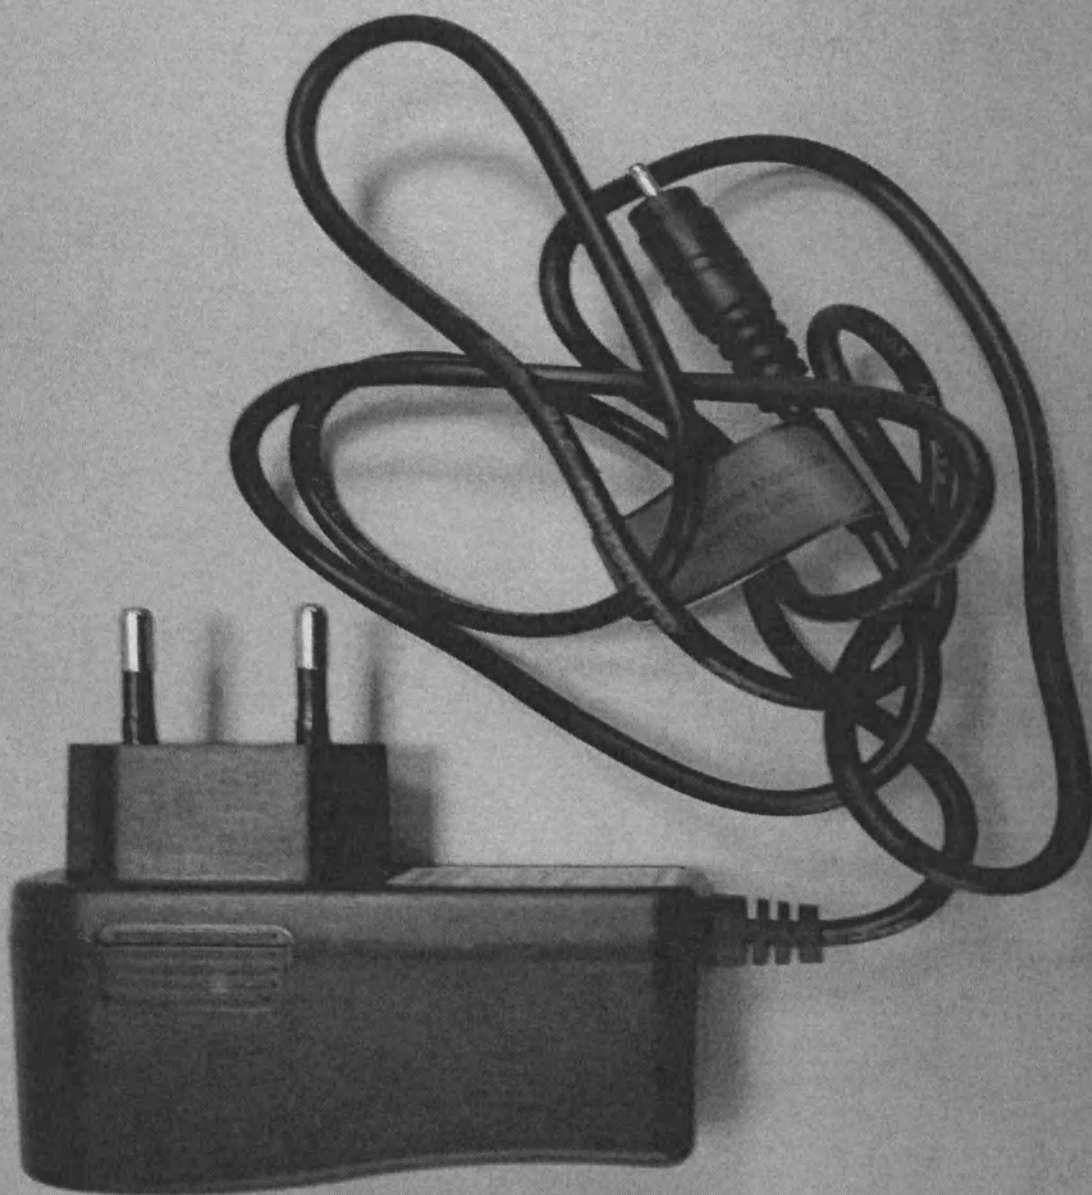

Пожалуйста, прочтите данную инструкцию перед началом работы.

DTE


Инструкция по эксплуатации Лампа полимеризационная серии DTE, модель LUX VI

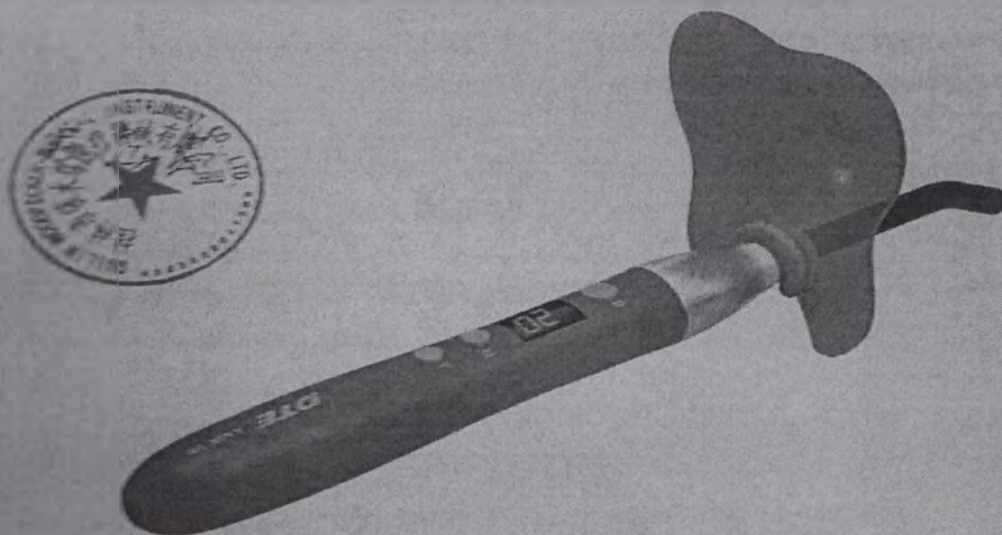

Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.
(Гуилин Вудпекер Медикал Инструмент Ко., Лтд)
www.gwoodpecker.com

DTE

Лампа полимеризационная серии DTE, модель LUX E



CE



«Гуилин Вудпекер Медикал Инструмент Ко., Лтд.», (Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.), Китай

Адрес: Information Industrial Park, National High-Tech Zone, Guilin, Guangxi 541004, China /

Тел: +86-773-5855350, Факс: +86-773-5822450


E-mail: woodpecker@glwoodpecker.com sales@glwoodpecker.com









2. ОПТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО

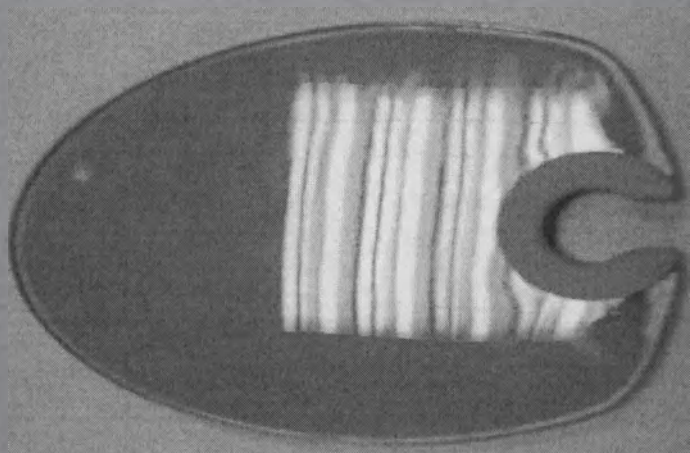

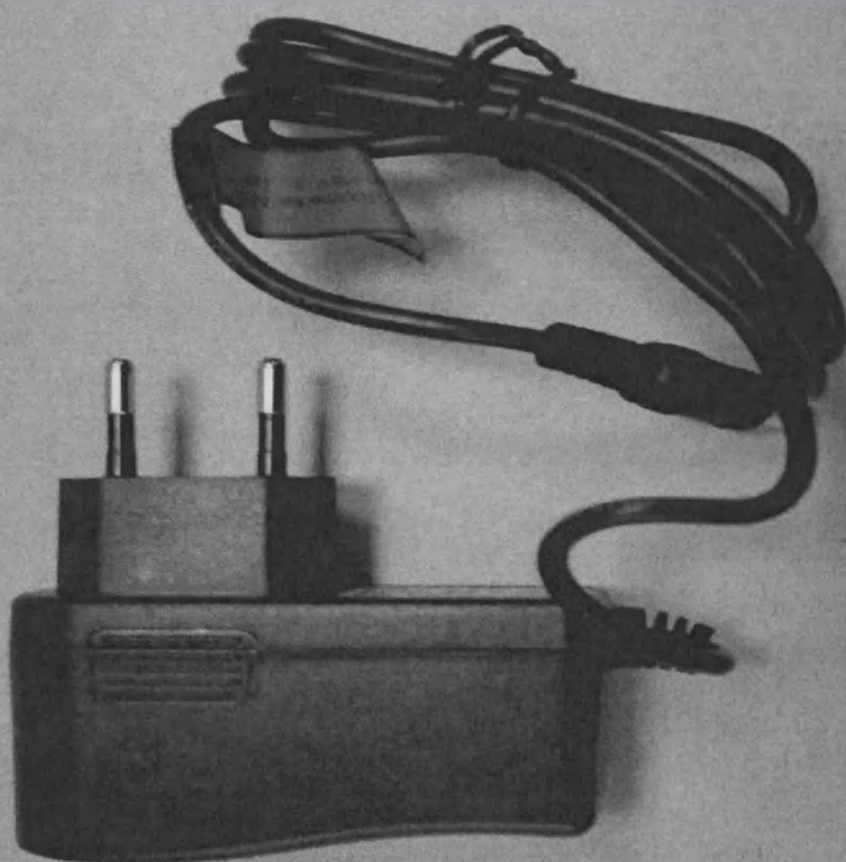


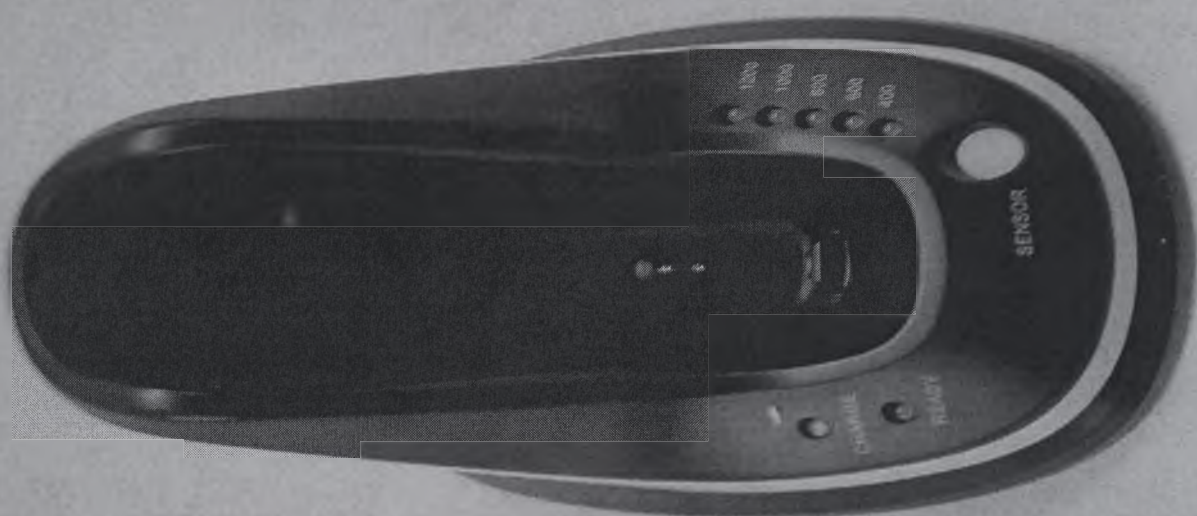

DTE

Инструкция по эксплуатации
Лампа полимеризационная серии
DTE, модель: LUX E


Пожалуйста, прочтите данную
инструкцию перед началом работы

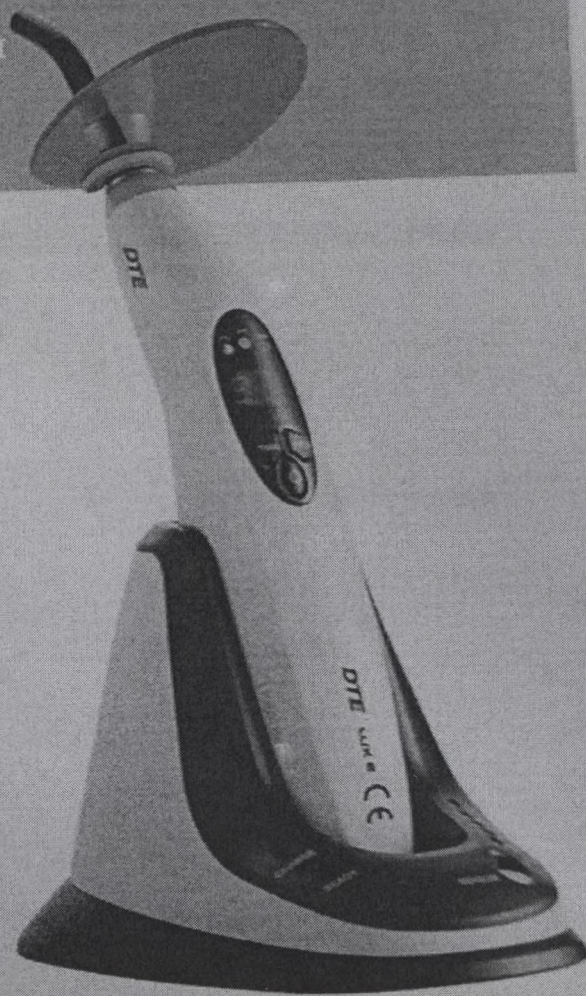

Гуилин Вудпекер Медикал Инструмент Ко., Лтд
(Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.)

DTE

Лампа полимеризационная серии DTE, модель LUX E
Simple version

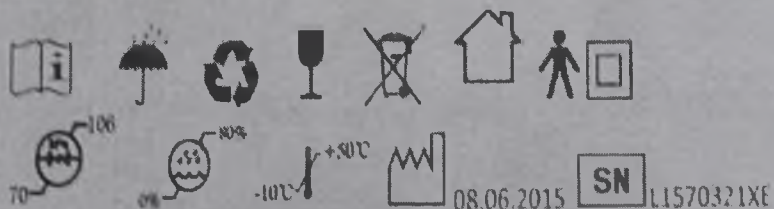

CE




«Гуилин Вудпекер Медицинал Инструмент Ко., Лтд.», (Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.), Китай


Адрес: Information Industrial Park, National High-Tech Zone, Guilin, Guangxi 541004, China /


Тел: + 86-773-5855350, Факс: + 86-773-5822450

E-mail: woodpecker@glwoodpecker.com sales@glwoodpecker.com




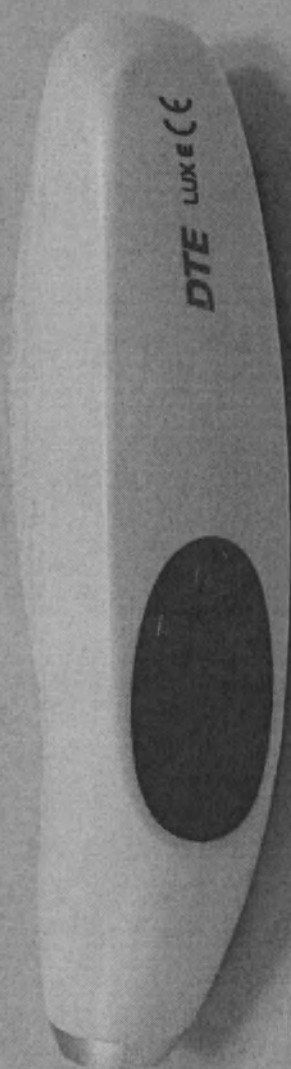


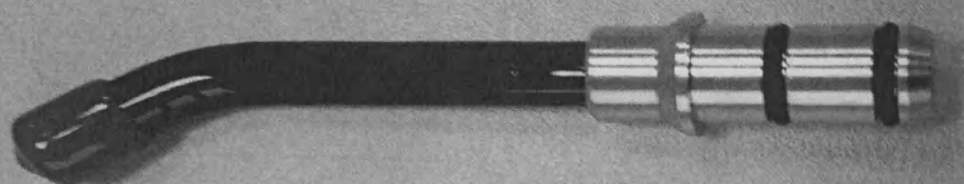


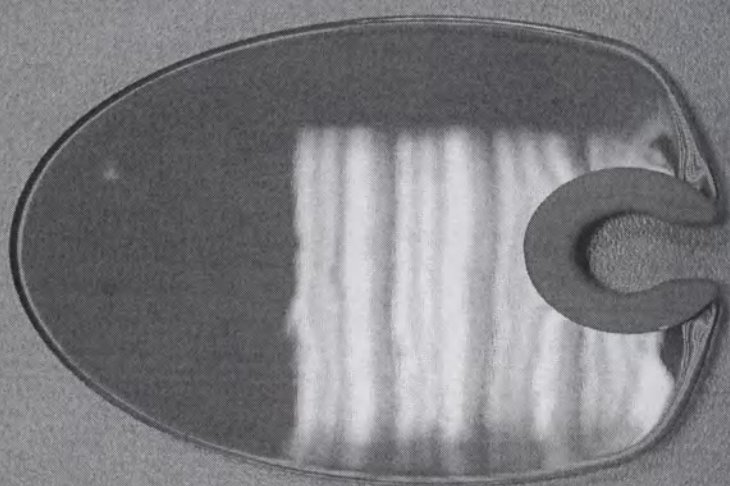

Свет
3.

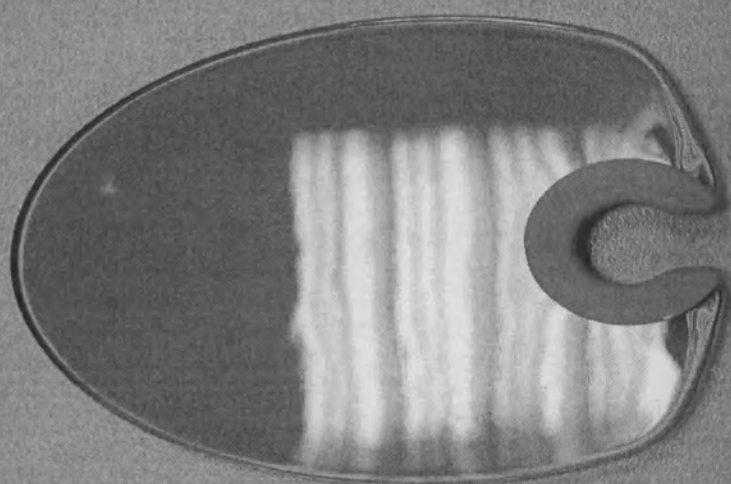

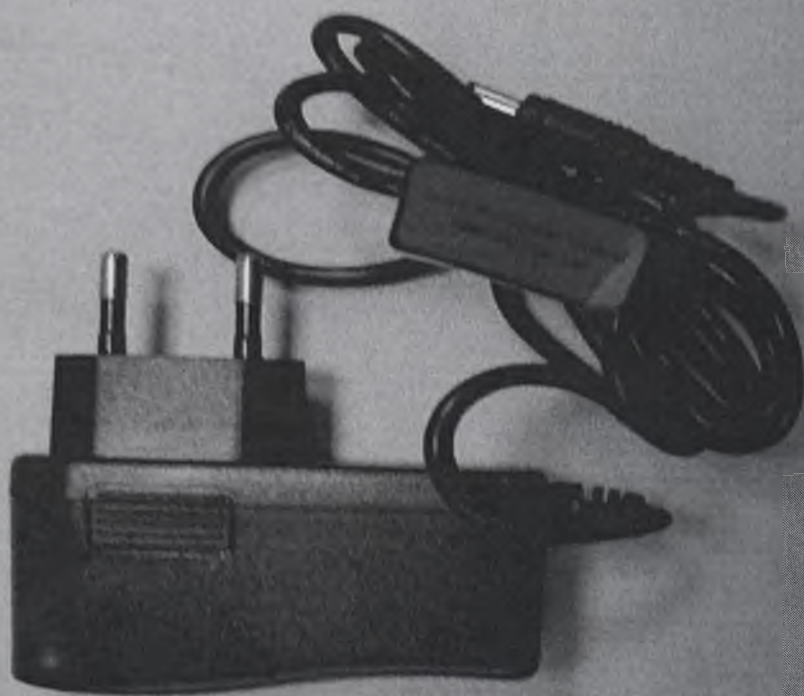


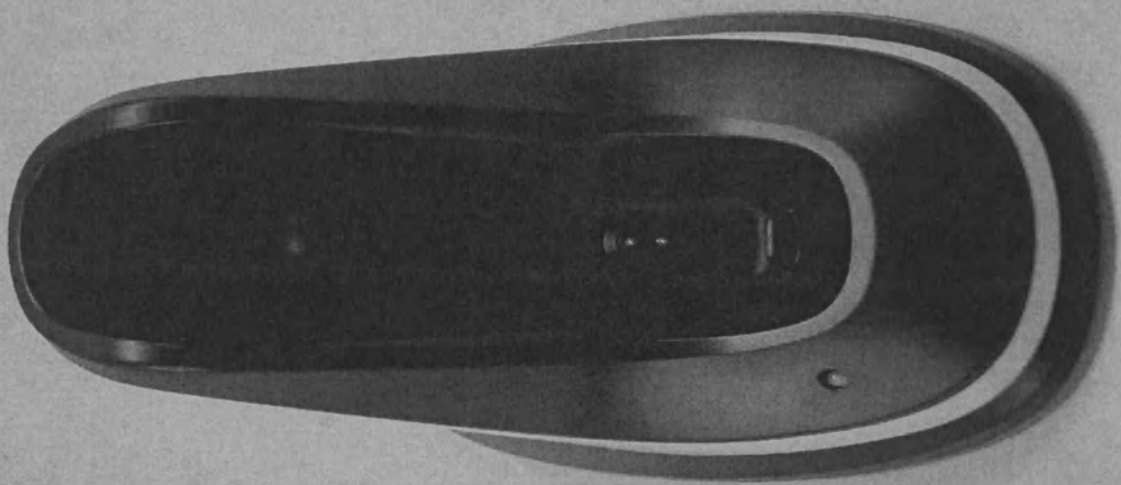

DTE

Инструкция по эксплуатации
Лампа полимеризационная серии
DTE, модель: LUX E

Пожалуйста, прочтите данную
инструкцию перед началом работы

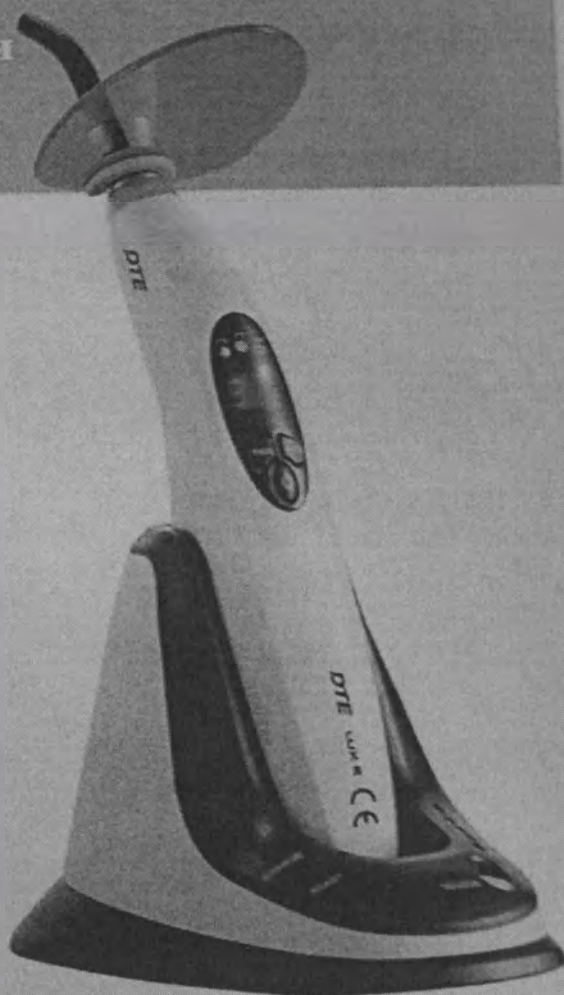

Гуилин Вудпекер Медикал Инструмент Ко., Лтд
(Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.)

В настоящем документе прошито,
прошнуровано и скреплено
оттиском печати 33 лист а.

Генеральный директор

ООО «МайДент24»

И.А. Балаев

