





Катетер баллонный дилатационный Ryujiin Plus OTW для ЧТКА : общий вид, без индивидуальной упаковки

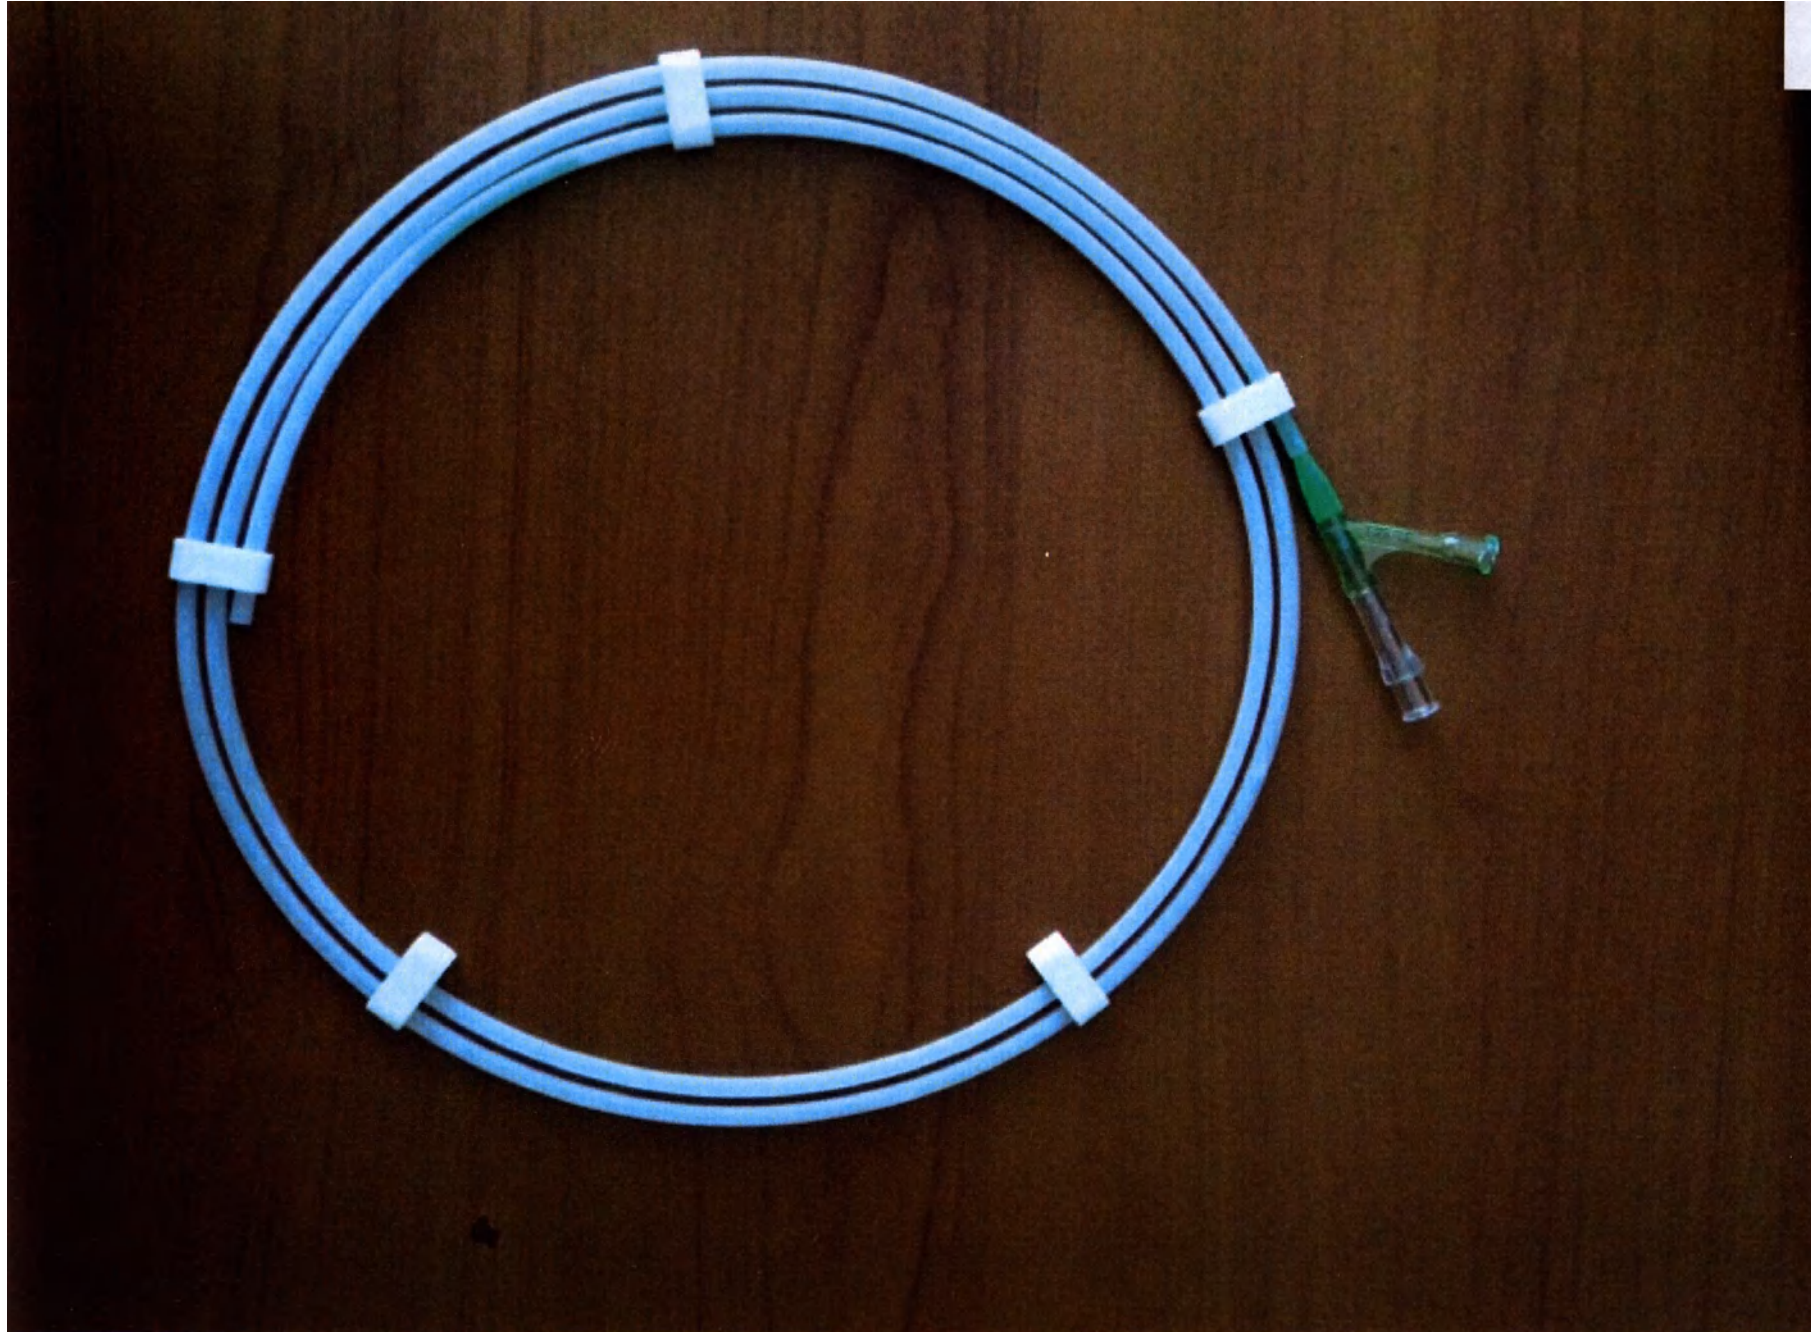

Трубка шифта

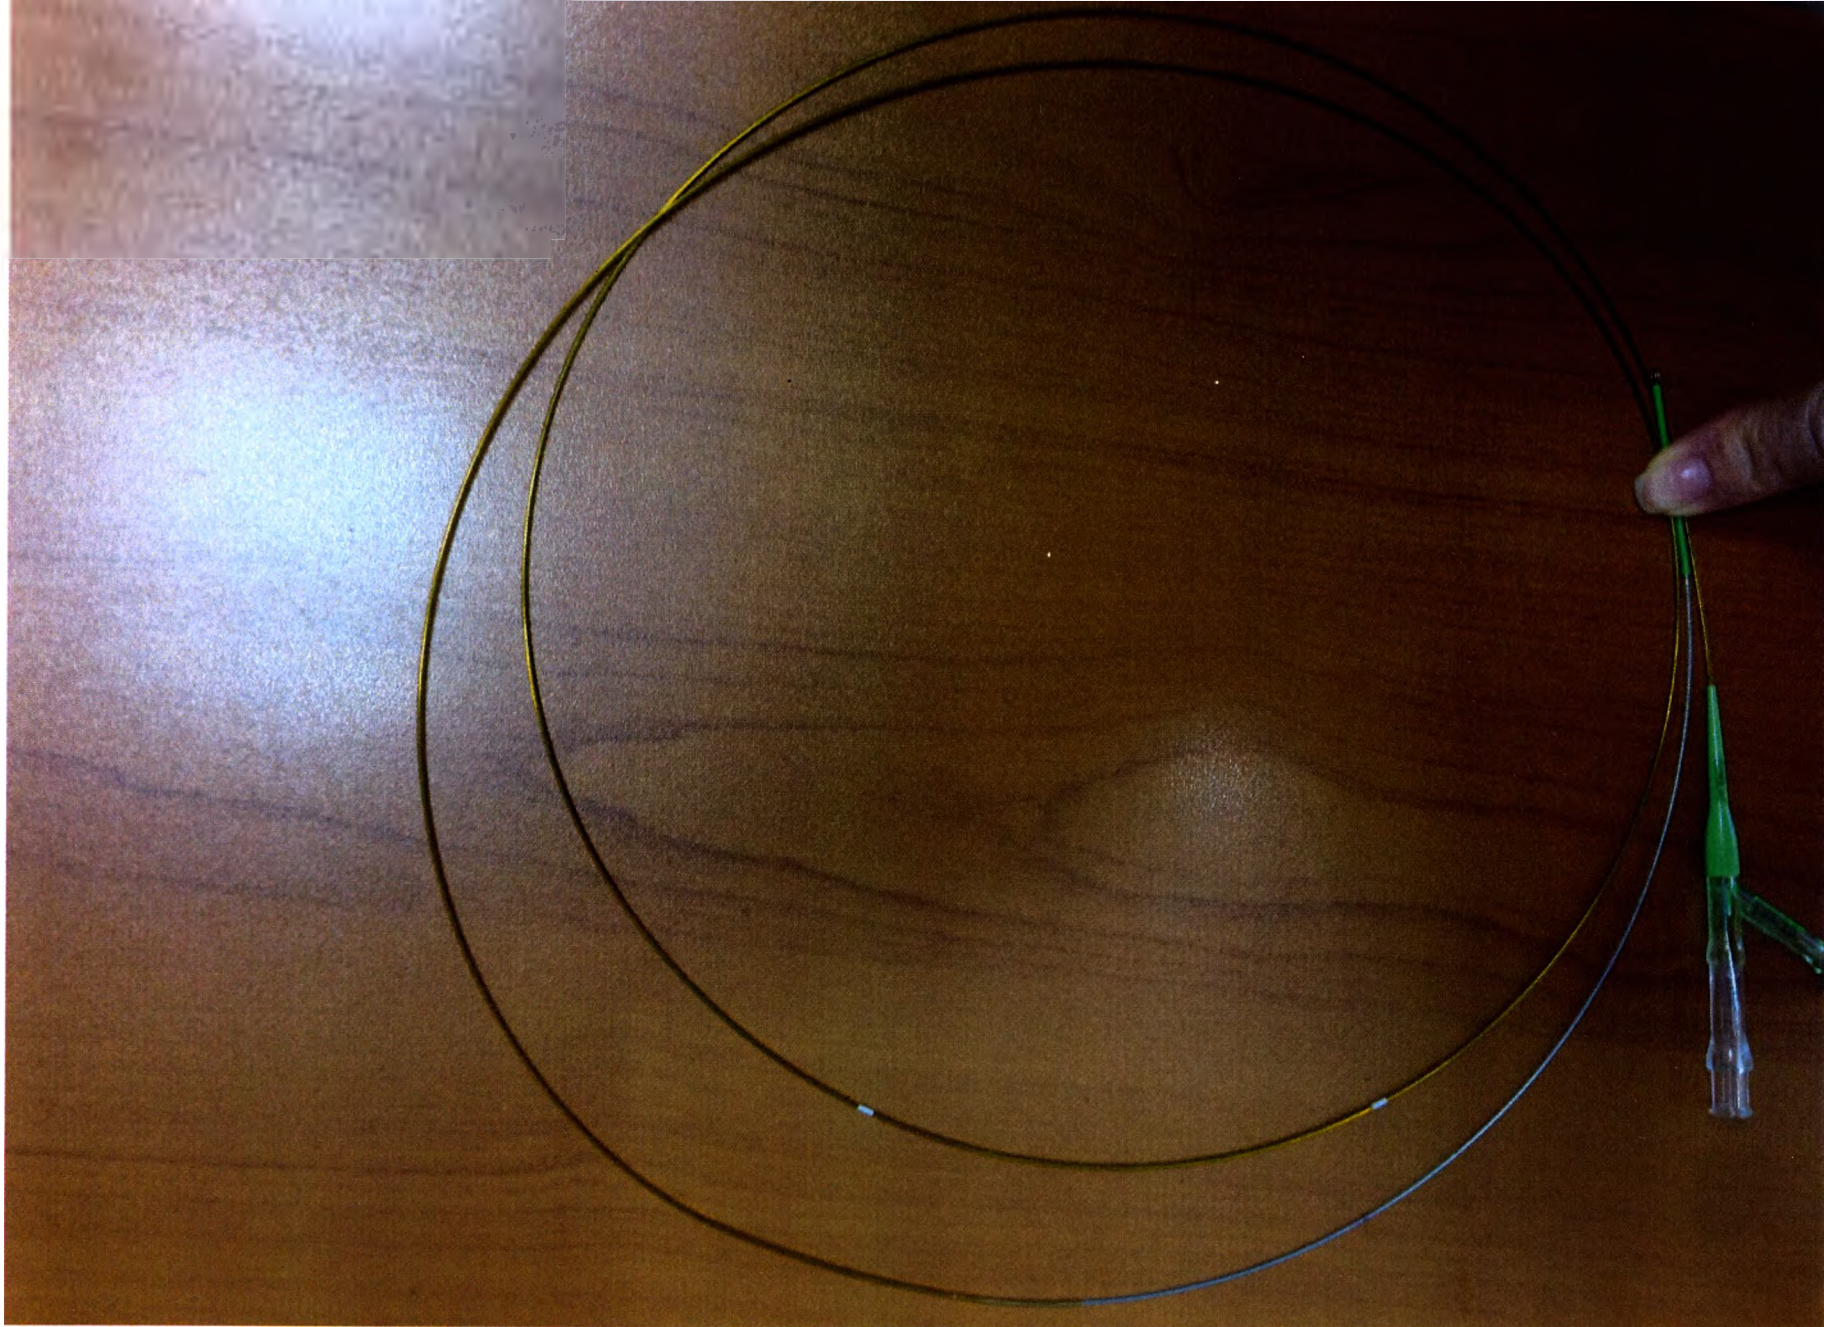






Защитная оболочка баллона



Зажимы держателя

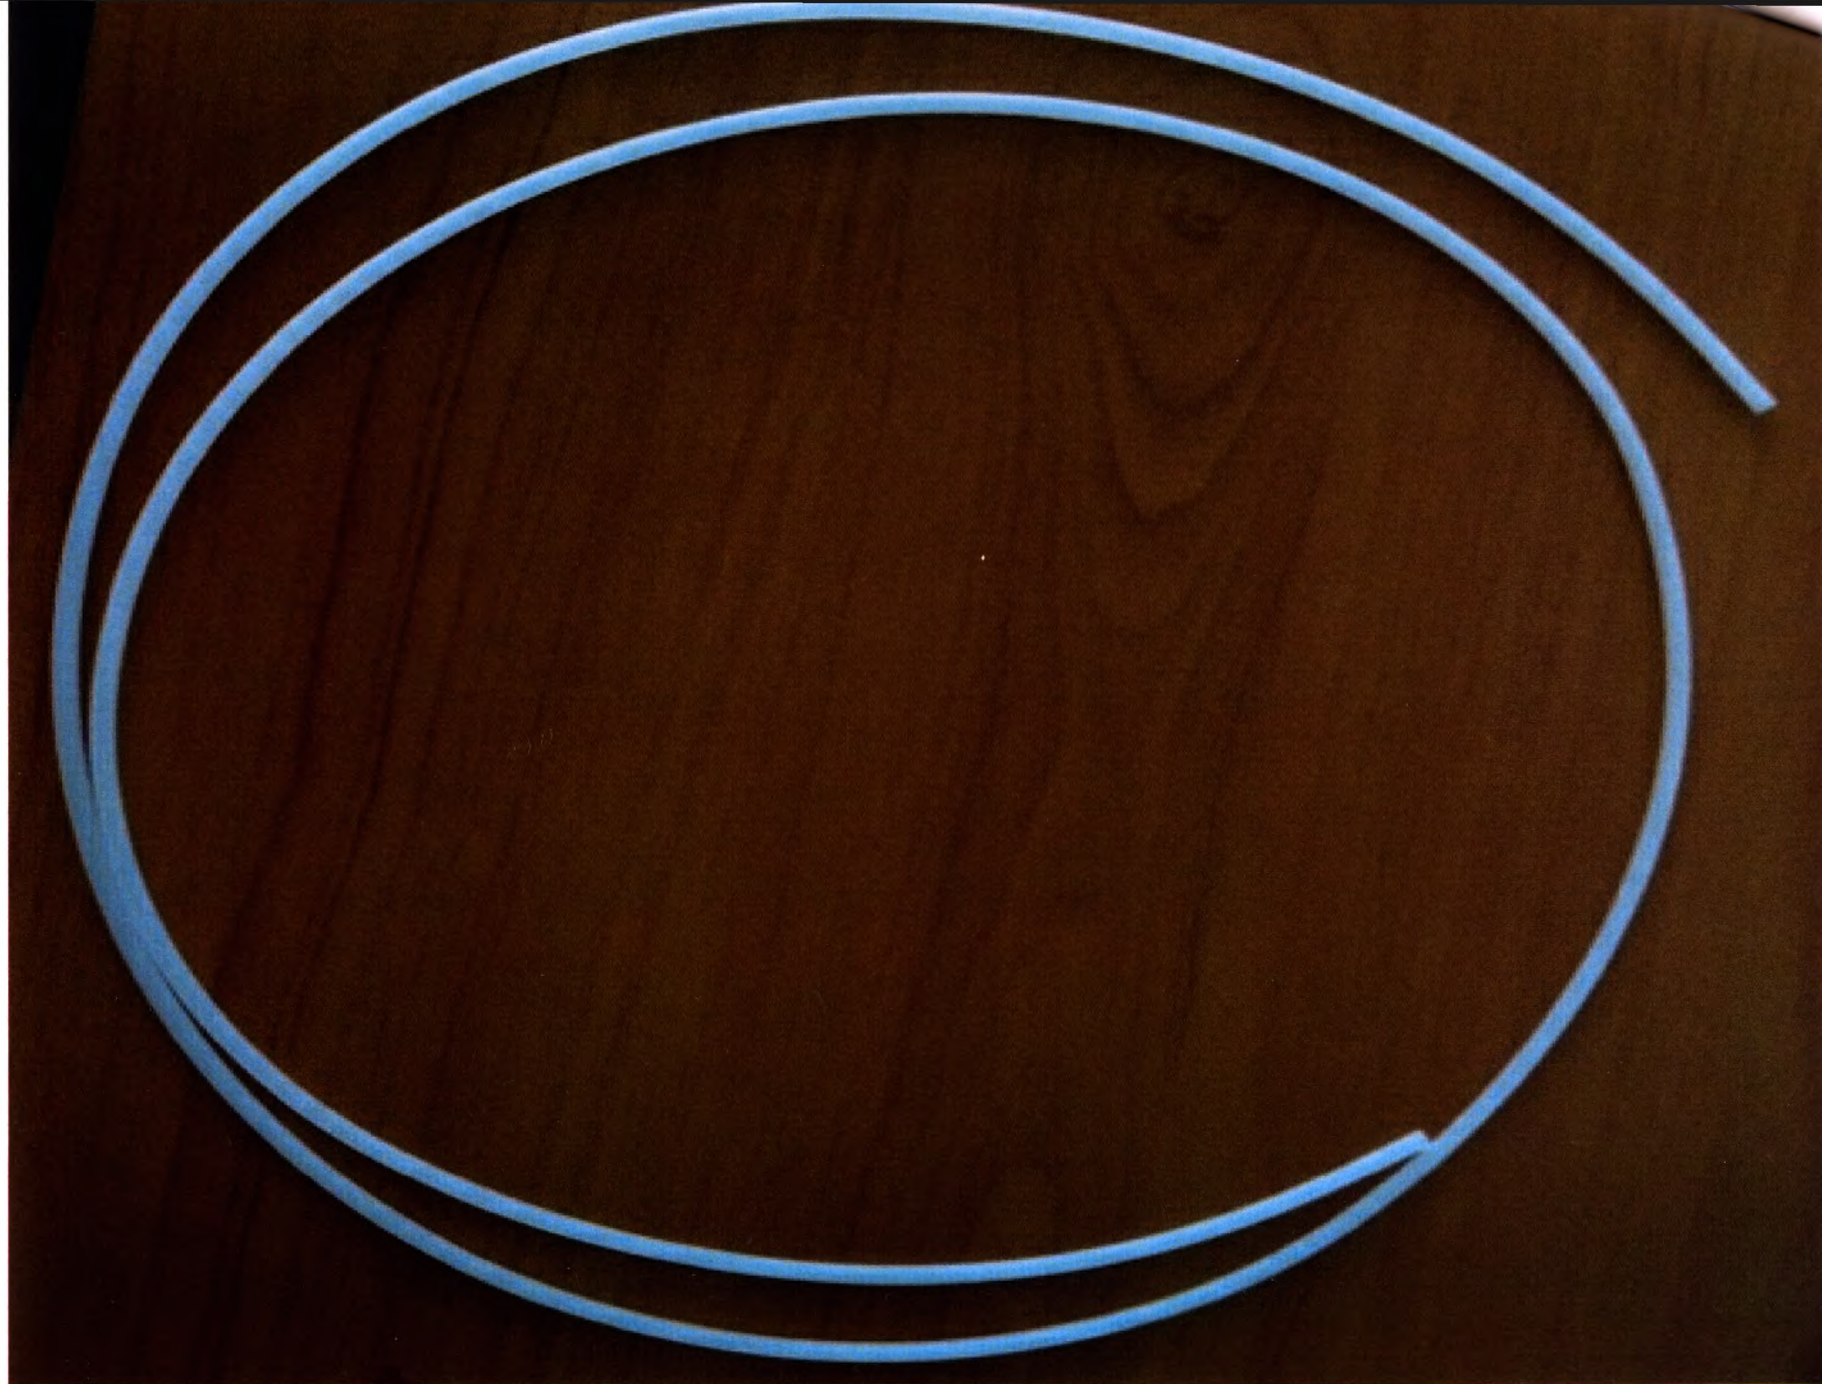



Маркеры глубины

TERUMO

RyujiTMPlus OTW

PTCA dilatation catheter (OTW)
PTCA拡張カテーテル(オーバーザワイヤータイプ)

P 圧力	(atm/ 気圧) (kPa)	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
		405	507	608	709	811	912	1013	1115	1216	1317	1419	1520	1621	1723	1824
バルーン径 (mm) Ø	1.25	1.20	1.23	1.25	1.28	1.30	1.32	1.34	1.36	1.37	1.39	1.40	1.42	1.44	1.45	1.47
	1.5	1.43	1.47	1.50	1.53	1.56	1.59	1.61	1.63	1.66	1.68	1.70	1.72	1.74	1.76	1.78
	2.0	1.91	1.96	2.00	2.04	2.07	2.09	2.12	2.14	2.17	2.19	2.22	2.24	2.26	2.28	2.31
	2.5	2.35	2.44	2.50	2.54	2.58	2.61	2.63	2.66	2.68	2.71	2.73	2.76	2.79	2.82	2.86
	3.0	2.89	2.95	3.00	3.05	3.09	3.12	3.15	3.18	3.21	3.24	3.27	3.29	3.33	3.37	3.42
	3.5	3.37	3.44	3.50	3.55	3.59	3.62	3.66	3.69	3.73	3.77	3.81	3.86	3.92		




DC34M1601-01

NP 規定圧力

RBP 定格破襲圧(この圧力を超えないこと)

Карта соответствия баллона

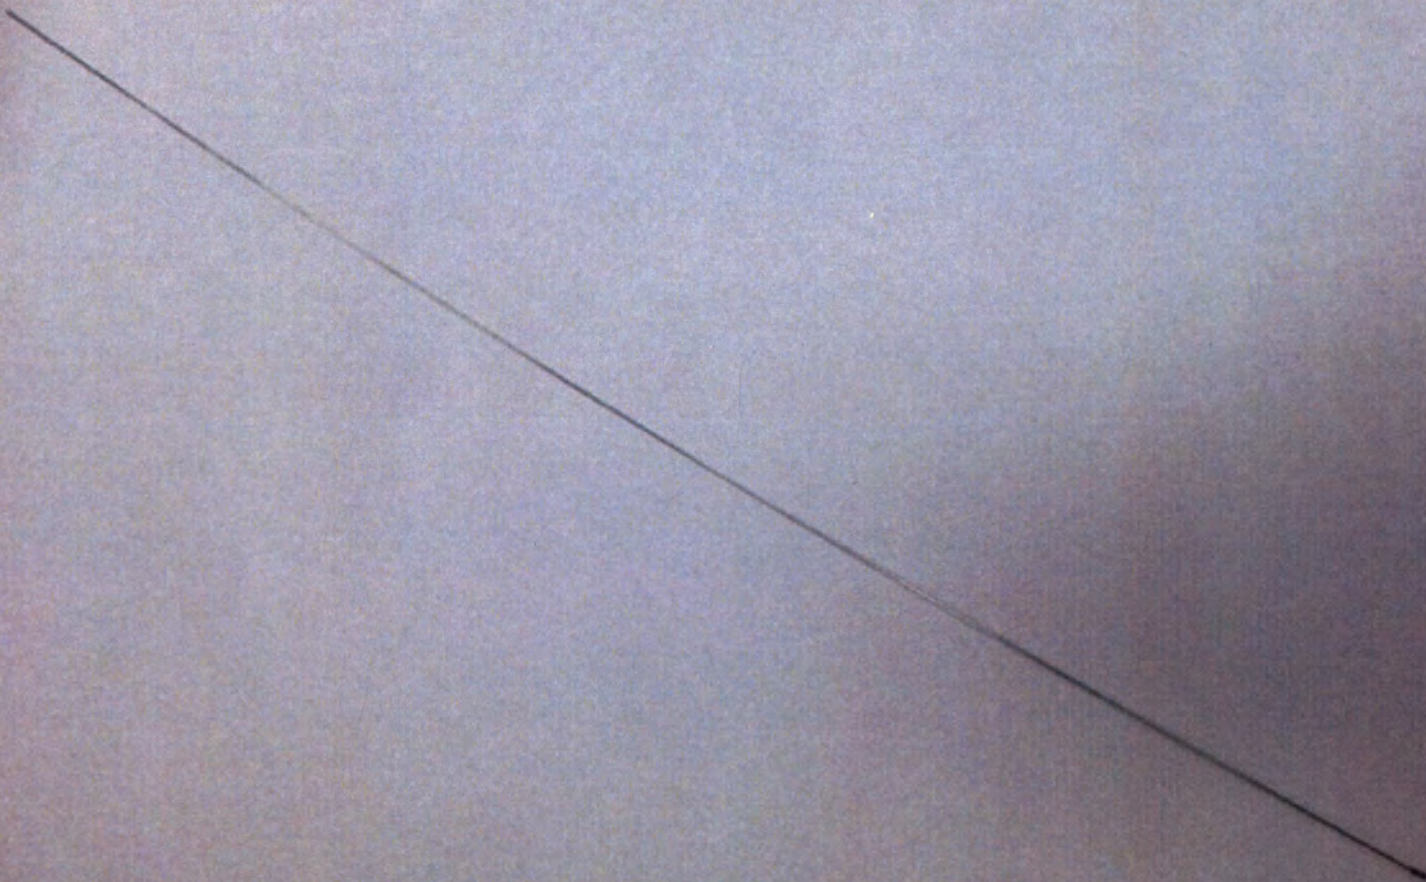



Рентгеноконтрастная метка



TERUMO® **Ryujin Plus OTW** **2.5-20** CE 0086

エチレンオキサイドガス滅菌済

Ryujin Plus OTW

PTCA dilatation catheter (Over The Wire Type)
Cathéter de dilatation coaxial
Over The Wire Balloondilatationskatheter
Catéter de balón para dilatación coaxial
Coaxial Balloon Dilatation Catheter (Type OTW)
Cathetere dilatatie per PTCA (Type OTW)
PTCA dilatatie catheter (Over-the-wire type)
Over-leidaren balloons dilatatie catheter
PTCA拡張カテーテル (オーバーワイヤータイプ)

1 UNIT / UNITS / STÜCK / UNIDADES / UNITÀ / STUK / STYCK / SETS

Pressure (atm)	Pressure (kPa)	Balloon diameter (mm)
4	405	2.35
6	608	2.50
8	811	2.65
10	1013	2.83
12	1216	2.95
14	1419	3.10
16	1621	3.25
17	1723	3.32
18	1824	3.42

NOMINAL PRESSURE / PRESSION NOMINALE / NOMINALDRUCK / PRESSION NOMINAL / PRESSION NOMINAL / PRESSION NOMINALE / NOMINALE DRUCK / NOMINELLY TRYCK / NERBETZ
6 atm (608 kPa)

RATED BURST PRESSURE / PRESSION DE RUPTURE ESTIMÉE / DEFINIERTER ZERSTÖRUNGSDRUCK / PRESSION ESTIMADA DE ESTALLIDO / PRESÃO ESTIMADA DE RUPTURA / PRESSIONE STIMATA DI ROTTURA / BEPAALDE SCHERFDRUK / UPPSKATTAT BRYSTNINGSTRYCK / BRYSTNINGS
14 atm (1419 kPa)

MIN. GUIDING CATHETER I.D. / DIAMETRE INTERNE MIN. DU CATHETER GUIDE / MIN. WÄHRLEITKATHETER-DIA. FÖRLENGERKATHETER / DIAMETRO INTERNO MINIMO DEL CATHETER GUIDA / DIAMETRO INTERNO MINIMO DO CATHETER GUIDA / DIAMETRO INTERNO MINIMO DEL CATHETER GUIDA / MINIMUM LEIDINGSKATHETERWAL DI GUIDING KATHETER / MINSTA WÄHRLEITERSKATHETERWÄR / 最小導引ワイヤカテーテル内径
0.056\" (1.42 mm)

REF / コード番号: **DC-PH2520LHW**

LOT / 製造番号: **140701**

EXP / 有効期限: **2017-06**

TERUMO CORPORATION
DAI-ICHI 1-11-1, HIGASHI-KU, TOKYO, JAPAN
MADE IN JAPAN

Катетер баллонный дилатационный Ryujin Plus OTW для ЧТКА в индивидуальной упаковке

Ryujin™ Plus OTW

PTCA dilatation catheter (Over The Wire Type)
Cathéter de dilatation coaxial
Over The Wire Ballondilatationskatheter
Catéter de balón para dilatación coaxial
Catetere dilatativo per PTCA (tipo OTW)
PTCA dilatatie catheter (Over-de-voerdraad type)
Over-ledaren ballongdilatationskateter

(Product name: Terumo PTCA Catheter OTW-1)

CE 0086

REF

LOT



STERILE EO

Code No.
Reference
Artikelnummer
Código
Codice
Artikelnummer
Artikelnummer

Lot No.
Número de lot
Chargen-Bezeichnung
Lote
Lotto
Lot
Tilverkningsnummer

Expiry date
Utiliser avant
Verwendbar bis
Caducidad
Scadenza
Vervaldatum
Utgångsdatum

Sterilized by ethylene oxide.
Stérilisé à l'oxyde d'éthylène.
Sterilisiert mit Äthylenoxid.
Esterilizado con óxido de etileno.
Sterilizzato con ossido di etilene.
Gesteriliseerd met ethyleenoxide.
Steriliserad med etylenoxid.



For single use only.
Strict usage unique.
Nur zum einmaligen Gebrauch.
Válido para un solo uso.
Monouso.
Voor éénmalig gebruik.
Endast för engångsbruk.



Read the instructions for use.
Lire le mode d'emploi.
Lesen Sie die Gebrauchsanweisungen.
Leer las instrucciones de uso.
Leggere le istruzioni per l'uso.
Lees de gebruiksaanwijzing.
Läs bruksanvisningen.



Manufacturer
Fabricant
Hersteller
Fabricante
Fabricante
Fabrikant
Tillverkare

TERUMO



※2007年10月29日改訂(新規格第3版)
※2006年1月20日改訂

器械器具 51 医療用導管及び体液誘導管

医療機器承認番号 21160028200035
JMDNコード: 17184024

テルモPTCAカテーテルOTW-1

再使用禁止

【警告】

＜使用方法＞

・血管内の操作は、高分解能X線透視下で慎重に行い、操作中に少しでも抵抗を感じたら操作を中止し、その原因を特定すること。〔血管を損傷したり、本品の破損、切断を生じる可能性がある。〕

・本品の交換の際は、事前に生理食塩液でぬらしたガーゼ布でガイドワイヤーを拭き、ガイドワイヤーと導管の接れを取り除くこと。〔ガイドワイヤーと導管の接れが、あるいは導管が十分にガイドワイヤーの長さ、挿入は、本品の破損、切断が生じる可能性がある。〕

・スラットの拡張、あるいはスラット内気や石灰化病変の拡張は、慎重に行うこと。〔拡張過度によりスラット破損を招く可能性がある。〕


・スラットのスラットへの挿入や引き、あるいは拡張は、高分解能X線透視下で慎重に行うこと。〔血管を損傷したり、スラットとの摩擦により本品の破損、切断を生じる可能性がある。〕

・バルーンは、高分解能X線透視下で慎重に行い、加圧に際して、バルーンが拡張していることを確認すること。〔バルーンが拡張しない場合は、無意に加圧しないこと。無意に加圧すると破損できなくなる可能性がある。〕

・手技にあたっては、術者の状態を考慮して適切な拡張間、処

【形状・構造及び原理等】

＜構造図（代表図）＞

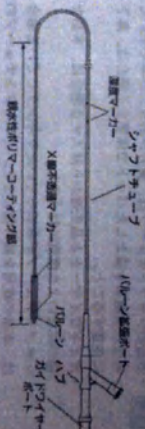

※＜原理＞

シャフトチューブには、造影剤注入ポートを設け、造影剤を注入し、造影剤によって発生した圧力がバルーンに伝わり、バルーンが拡張する。

【使用目的、効能又は効果】

＜使用目的＞

本品は、経皮的経動脈形成術を実施するに際し、経動脈の狭窄を拡張する目的で使用するバルーンカテーテルである。

Инструкция по применению и вкладыш на японском языке

TERUMO®

Open here

CE 0086



RyujiTM Plus OTW

販売名: テルモPTCAカテーテルOTW-1

TERUMO RyujiTM Plus OTW 1.25-10 [REP]: DC-PH1210PH [LOT]: 150107



TERUMO RyujiTM Plus OTW 1.25-10 [REP]: DC-PH1210PH [LOT]: 150107



TERUMO
RyujiTM Plus OTW
1.25-10
DC-PH1210PH
[REP]: 150107


TERUMO
RyujiTM Plus OTW
1.25-10
DC-PH1210PH
[REP]: 150107

TERUMO
RyujiTM Plus OTW
1.25-10
DC-PH1210PH
[REP]: 150107

TERUMO
RyujiTM Plus OTW
1.25-10
DC-PH1210PH
[REP]: 150107

TERUMO
RyujiTM Plus OTW
1.25-10
DC-PH1210PH
[REP]: 150107

TERUMO
RyujiTM Plus OTW
1.25-10
DC-PH1210PH
[REP]: 150107

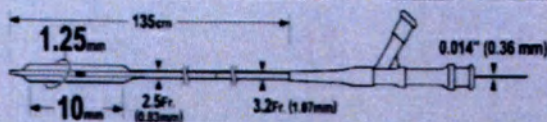

NP / 規定圧力:
6 atm (608 kPa)

RBP / 拡張破断圧:
14atm(1419kPa)

Min GC
0.056" (1.42 mm)

1.25^ø - 10^{mm}

REP / コード番号: DC-PH1210PH

LOT / 製造番号: 150107

使用期限: 2017-12

保用期限保証書付: PTCAカテ 一般型



P (atm)	4	6	8	10	12	14	15	16	17	18
P (kPa)	405	608	811	1013	1216	1419	1520	1621	1723	1824
φ (mm)	1.20	1.25	1.30	1.34	1.37	1.40	1.42	1.44	1.45	1.47

PTCA dilatation catheter (OTW)
Cathéter de dilatation pour PTCA (OTW)
PTCA-Dilatationskatheter (OTW)
Catéter de dilatación para ACTP (OTW)
Cateter de dilatación para ACTP (OTW)
Catetere dilatativo per PTCA (OTW)
PTCA Dilatatie catheter (OTW)
PTCA dilatationskatheter (OTW)
PTCA dilatationskatheter (OTW)
PTCA dilatationskatheter (OTW)
PTCA dilatationskatheter (OTW)
PTCA dilatationskatheter (OTW)
Καθετήρας διαστολής PTCA (OTW)
Дилатационный катетер для ЧТКА (OTW)
Cewnik poszerzający do PTCA (OTW)
PTCA tágitó katéter (OTW)
Dilatační katétr pro PTCA (OTW)
Dilatačný katéter PTCA (OTW)
PTCA dilatasyon kateteri (OTW)
PTKA dilatatsioon kateter (OTW)
PCTA dilatācijas katetra (OTW)
PTCA dilatācijas kateteris (OTW)
Kateter za dilataciju PTCA (OTW)
PTCA dilatatori kateter (OTW)
Cateter de dilatare PTCA (OTW)
PTCA Дилатационен катетър (OTW)
Дилатационный катетер для ЧТКА (OTW)

Катетер баллонный дилатационный Ryuji Plus OTW для ЧТКА, вариант исполнения: DC-PH1210PH, диаметр баллона 1.25 мм, длина баллона 10 мм

TERUMO

Open here

CE 0086




RyujiTM Plus OTW

販売名：テルモPTCAカテーテルOTW-1



TERUMO RyujiTM Plus OTW 1.5-15 DC-PH1515PH 141223
 TERUMO RyujiTM Plus OTW 1.5-15 DC-PH1515PH 141223
 TERUMO RyujiTM Plus OTW 1.5-15 DC-PH1515PH 141223
 TERUMO RyujiTM Plus OTW 1.5-15 DC-PH1515PH 141223
 TERUMO RyujiTM Plus OTW 1.5-15 DC-PH1515PH 141223
 TERUMO RyujiTM Plus OTW 1.5-15 DC-PH1515PH 141223



NP 6 atm (608 kPa)

RBP 14atm(1419kPa)

Min GC 0.056\" (1.42 mm)

1.5 - 15 mm

コード番号: DC-PH1515PH

LOT / 製造番号: 141223

使用期限: 2017-11

保険医療材料請求分類: PTCAカテ 一般型

Contents / 入り数: 1

P 圧 (atm)	4	6	8	10	12	14	15	16	17	18
カ (kPa)	405	608	811	1013	1216	1419	1520	1621	1723	1824
径 (mm)	1.43	1.50	1.58	1.61	1.66	1.70	1.72	1.74	1.76	1.78

PTCA dilatation catheter (OTW)
 Cathéter de dilatation pour P.T.C.A. (OTW)
 PTCA-Dilatationskatheter (OTW)
 Catéter de dilatación para ACTP (OTW)
 Cateter de dilatação para ACTP (OTW)
 Catetere dilatativo per PTCA (OTW)
 PTCA Dilatatie catheter (OTW)
 PTCA dilatationskatheter (OTW)
 PTCA dilatationskatheter (OTW)
 PTCA dilatationskatheter (OTW)
 PTCA dilatationskatheter (OTW)
 Катетер дилатационный PTCA (OTW)
 Дилатационный катетер для ЧТКА (OTW)
 Catetere p dilataciójy do PTCA (OTW)
 PTCA tegőző katéter (OTW)
 Dilatační katéter pro PTCA (OTW)
 Dłatacyjny kateter PTCA (OTW)
 PTCA dilatasyon kateteri (OTW)
 PTKA dilatatsioon kateter (OTW)
 PCTA dilatācijas katetrs (OTW)
 PTCA dilatācijas katetrs (OTW)
 Kateter za dilataciój PTCA (OTW)
 PTCA dilatacioni kateter (OTW)
 Cateter de dilatare PTCA (OTW)
 PTCA Дилатационен катетър (OTW)
 Дилатационный катетер для ЧТКА (OTW)

Катетер баллонный дилатационный Ryuji Plus OTW для ЧТКА, вариант исполнения: DC-PH1515PH, диаметр баллона 1.50 мм, длина баллона 15 мм

TERUMO®

↑
Open here

CE 0086




RyujiTM Plus OTW

販売名: テルモPTCAカテーテルOTW-1

TERUMO RyujiTM Plus OTW 2.0 20 DC-PH2020PHW LOT: 150202



TERUMO RyujiTM Plus OTW 2.0 20 DC-PH2020PHW LOT: 150202



TERUMO RyujiTM Plus OTW 2.0 20 DC-PH2020PHW LOT: 150202


TERUMO RyujiTM Plus OTW 2.0 20 DC-PH2020PHW LOT: 150202

TERUMO RyujiTM Plus OTW 2.0 20 DC-PH2020PHW LOT: 150202

TERUMO RyujiTM Plus OTW 2.0 20 DC-PH2020PHW LOT: 150202

TERUMO RyujiTM Plus OTW 2.0 20 DC-PH2020PHW LOT: 150202

TERUMO RyujiTM Plus OTW 2.0 20 DC-PH2020PHW LOT: 150202



NP / 規定圧力: **6 atm (608 kPa)**

RBP / 定常膨張圧: **14 atm (1419 kPa)**

最小内径 (カテーテル先端部): **0.056" (1.42 mm)**

コード番号: **DC-PH2020PHW**

製造番号: **150202**

使用期限: **2018-01**

包装形態: **PTCAカテ 一般型**

Contents / 入り数: **1**

P (atm)	4	6	8	10	12	14	15	16	17	18
カ (kPa)	405	608	811	1013	1216	1419	1520	1621	1723	1824
バルーン径 (mm)	1.91	2.00	2.07	2.12	2.17	2.22	2.24	2.26	2.28	2.31

PTCA dilatation catheter (OTW)
Cathéter de dilatation pour PTCA (OTW)
PTCA-Dilatationskatheter (OTW)
Catéter de dilatación para ACTP (OTW)
Cateter de dilatação para ACTP (OTW)
Cateter dilatativo per PTCA (OTW)
PTCA Dilatatie catheter (OTW)
PTCA dilatationskatheter (OTW)
PTCA dilatationskatheter (OTW)
PTCA dilatationskatheter (OTW)
PTCA dilatationskatheter (OTW)
PTCA dilatationskatheter (OTW)
Katheter dilatativ per PTCA (OTW)
Дилатационный катетер для ЧТКА (OTW)
Cewnik poszerzający do PTCA (OTW)
PTCA tágító katéter (OTW)
Dilatační katétr pro PTCA (OTW)
Dilatačný katéter PTCA (OTW)
PTCA dilatasyon kateteri (OTW)
PTKA dilatatsiooni kateter (OTW)
PCTA dilatācijas katērs (OTW)
PTCA dilatācijas katēris (OTW)
Kateter za dilataciju PTCA (OTW)
PTCA dilatacioni kateter (OTW)
Cateter de dilatare PTCA (OTW)
PTCA Дилатационен катетер (OTW)
Дилатационный катетер для ЧТКА (OTW)

Катетер баллонный дилатационный RyujiTM Plus OTW для ЧТКА, вариант исполнения: DC-PH2020PHW, диаметр баллона 2.00 мм, длина баллона 20 мм

CE 0086

↑
Open here

CE 0086

Ryujin™ Plus OTW

販売名：テルモPTCAカテーテルOTW-1

(00)054132061029625774



25774



RF: DC-PH1210LH



01124557350097392(17)171100(10)141219



PyralisTM Plus OTW: 25-10 REF: DC-PH1210LH



01304987350097392(17)17100(10)141219

TERUMO

Ryujin™ Plus OTW
1.25-10
DC-PH1210LH
LOT: 141219

TERUMO

Ryujin™ Plus OTW
1.25-10
DC-PH1210LH
LOT: 141219

①TERUMO

Ryujin™ Plus OTW
1.25-10
DC-PH1210LM
LOT: 141219

TERUMO


Ryujin™ Plus OTW
1.25-10
DC-PH1210LM
LOT: 141219

①TERUMO

Ryujin™ Plus OTW
1.25-10
DC-PH1210LM
LOT: 141219

①TERUMO

Ryujin™ Plus OTW
1.25-10
DC-PH1210LH
LOT: 141219



NP / 额定压力:

6 atm (608 kPa)

 $1.25 - 10$

RBP / 2002

14atm(1419kPa)

コード番号: DC-PH1210LH

LOT / 製造番号: **141219**

2017-11

1. 最小面積ガイドラインカーネル内径



0.056" (1.42 mm)

PTCAカチー 一

Contents / A-29

P	n	(atm)	4	6	8	10	12	14	15	16	17	18
		(kPa)	405	608	811	1013	1216	1419	1520	1621	1723	1824
Ø	パナシール(mm)		1.20	1.25	1.30	1.34	1.37	1.40	1.42	1.44	1.45	1.47

PTCA dilatatori catheter (OTW)
 Catheter de dilatation pour P.T.C.A. (OTW)
 PTCA-Dilatationskatheter (OTW)
 Cateter de dilatación para ACTP (OTW)
 Cateter de dilatação para ACTP (OTW)
 Catetere dilatativi per PTCA (OTW)
 PTCA Dilatatie catheter (OTW)
 PTCA dilatationskatheter (OTW)
 PTCA dilatationskatheter (OTW)
 PTCA dilatationskatheter (OTW)
 PTCA laajennuskatetri (OTW)
 Καθετήρας διαστολής PTCA (OTW)
 Дилатационный катетер для ЧКА (OTW)
 Cewnik poszerzający do PTCA (OTW)
 PTCA ligtht catheter (OTW)
 Dilatační katetr pro PTCA (OTW)
 Dilatación kateter PTCA (OTW)
 PTCA dilatasyon kateteri (OTW)
 PTCA dilatationi kateter (OTW)
 PTCA dilatációs kateter (OTW)
 PTCA dilatációs kateteris (OTW)
 Kateter za dilatację PTCA (OTW)
 PTCA dilatationi kateter (OTW)
 Cateter de dilatare PTCA (OTW)
 PTCA lágúszakos katéter (OTW)
 Дилатационный катетер для ЧКА (OTW)

Катетер баллонный дилатационный Ruujin Plus OTW для ЧТКА, вариант исполнения: DC-PH1210LH, диаметр баллона 1.25 мм, длина баллона 10 мм

CE₀₀₈₆



RyujinTM Plus OTW

販売名：テルモPTCAカテーテルOTW-1

① TERUMO Rygel™ Plus OTW 2.0-20 DC-PH2020LHW ② 141205

① TERUMO Rygel™ Plus OTW 2.0-20 DC-PH2020LHW ② 141205

① TERUMO Rygel™ Plus OTW 2.0-20 DC-PH2020LHW ② 141205

① TERUMO Rygel™ Plus OTW 2.0-20 DC-PH2020LHW ② 141205

① TERUMO Rygel™ Plus OTW 2.0-20 DC-PH2020LHW ② 141205

① TERUMO Rygel™ Plus OTW 2.0-20 DC-PH2020LHW ② 141205

① TERUMO Rygel™ Plus OTW 2.0-20 DC-PH2020LHW ② 141205

① TERUMO Rygel™ Plus OTW 2.0-20 DC-PH2020LHW ② 141205

① TERUMO Rygel™ Plus OTW 2.0-20 DC-PH2020LHW ② 141205

① TERUMO Rygel™ Plus OTW 2.0-20 DC-PH2020LHW ② 141205

① TERUMO Rygel™ Plus OTW 2.0-20 DC-PH2020LHW ② 141205

① TERUMO Rygel™ Plus OTW 2.0-20 DC-PH2020LHW ② 141205

[illegible]

Катетер баллонный дилатационный Ruujin Plus OTW для ЧТКА, вариант исполнения: DC-PH2020LHW, диаметр баллона 2.00 мм, длина баллона 20 мм

TERUMO®

Open here

CE 0086

25880



08642900110001140701

Ryujiin™ Plus OTW

販売名: テルモPTCAカテーテルOTW-1 Product Name: Terumo PTCA Catheter OTW-1

TERUMO®
Ryujiin™ Plus OTW 2.5-20 3Fr DC-PH2520LHW LOT: 140701
(8) 144 58 7529 233 (5) 11 71 19 68 (8) 144 701



TERUMO®
Ryujiin™ Plus OTW 2.5-20 3Fr DC-PH2520LHW LOT: 140701
(8) 144 58 7529 233 (5) 11 71 19 68 (8) 144 701



TERUMO®
Ryujiin™ Plus OTW
2.5-20
DC-PH2520LHW
LOT: 140701

TERUMO®
Ryujiin™ Plus OTW
2.5-20
DC-PH2520LHW
LOT: 140701


TERUMO®
Ryujiin™ Plus OTW
2.5-20
DC-PH2520LHW
LOT: 140701

TERUMO®
Ryujiin™ Plus OTW
2.5-20
DC-PH2520LHW
LOT: 140701

TERUMO®
Ryujiin™ Plus OTW
2.5-20
DC-PH2520LHW
LOT: 140701

TERUMO®
Ryujiin™ Plus OTW
2.5-20
DC-PH2520LHW
LOT: 140701

TERUMO®
Ryujiin™ Plus OTW
2.5-20
DC-PH2520LHW
LOT: 140701

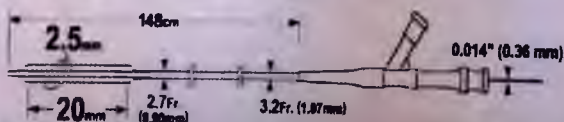

NOMINAL PRESSURE / PRESSION NOMINALE / NOMINALDRUCK / PRESIÓN NOMINAL / PRESSÃO NOMINAL / PRESSIONE NOMINALE / NOMINALE DRIJK / NOMINALE TRYCK / NEEDE
6 atm (608 kPa)

RATE OF RUPTURE / PRESSION DE RUPTURE ESTIMÉE / DEFINIERTER DRUCK / PRESIÓN ESTIMADA DE ESTALIDO / PRESSÃO ESTIMADA DE RUPTURA / PRESSIONE STIMATA DI ROTTURA / BEPAALDE SKEURDRUK / LIPSCHATTIGHEDIGHEID / STREKKE
14atm (1419kPa)

MIN. GUIDING CATHETER LEN. / DIAMETRO INTERNO MIN. DU CATHETER GUIDE / MIN. RINELENGHTE BESCH. DES FLEURCATHEETERS / DIAMETRO INTERNO MINIMO DEL CATERE GUIDA / DIAMETRO INTERNO MINIMO DO CATERE GUIDA / DIAMETRO INTERNO MINIMO DEL CATERE GUIDO / MINIMUM RINLENGHTE VAN DE GUIDING KATHETER / MINSTA RINLENGHTE FÖR LEDARKATHETER / 最小ガイドカテーテル長さ
0.056" (1.42 mm)

2.5-20

REF: **DC-PH2520LHW**

LOT / 製造番号: **140701**

EXPIRATION / 有効期限: **2017-06**

製品区分 / 製品区分: **PTCAカテ 一般型**

1 UNIT / UNITE / STUCK / UNIDAD / UNIDADE / UNITA / STUK / STYCK / セット入

PTCA dilatation catheter (Over The Wire Type)
Cathéter de dilatation coaxial
Over The Wire Balloondilatationskatheter
Cateter de balón para dilatación coaxial
Cateter Balão para Angioplastia Coronária (Tipo OTW)
Catetere dilatativo per PTCA (tipo OTW)
PTCA dilatatie catheter (Over-de-waardraad type)
Over-tedaren ballon-dilatationskatheter
PTCA 拡張カテーテル (オーバーザワイヤータイプ)

Pressure (atm) 圧力 (kPa)	4	6	8	10	12	14	15	16	17	18
Balloon Diameter (mm)	405	508	811	1013	1216	1419	1520	1621	1723	1824
	3.35	2.76	2.58	2.63	2.76	2.76	2.76	2.79	2.82	2.86

Катетер баллонный дилатационный Ryujiin Plus OTW для ЧТКА, вариант исполнения: DC-PH2520LHW, диаметр баллона 2.50 мм, длина баллона 20 мм.

